


Фотоизображение медицинского изделия
«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам. сухая
(Агар Мюллера-Хинтон II)»
ТУ 9385-227-78095326-2015




вид спереди

Фотоизображение медицинского изделия
«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам. сухая
(Агар Мюллера-Хинтон II)»
ТУ 9385-227-78095326-2015

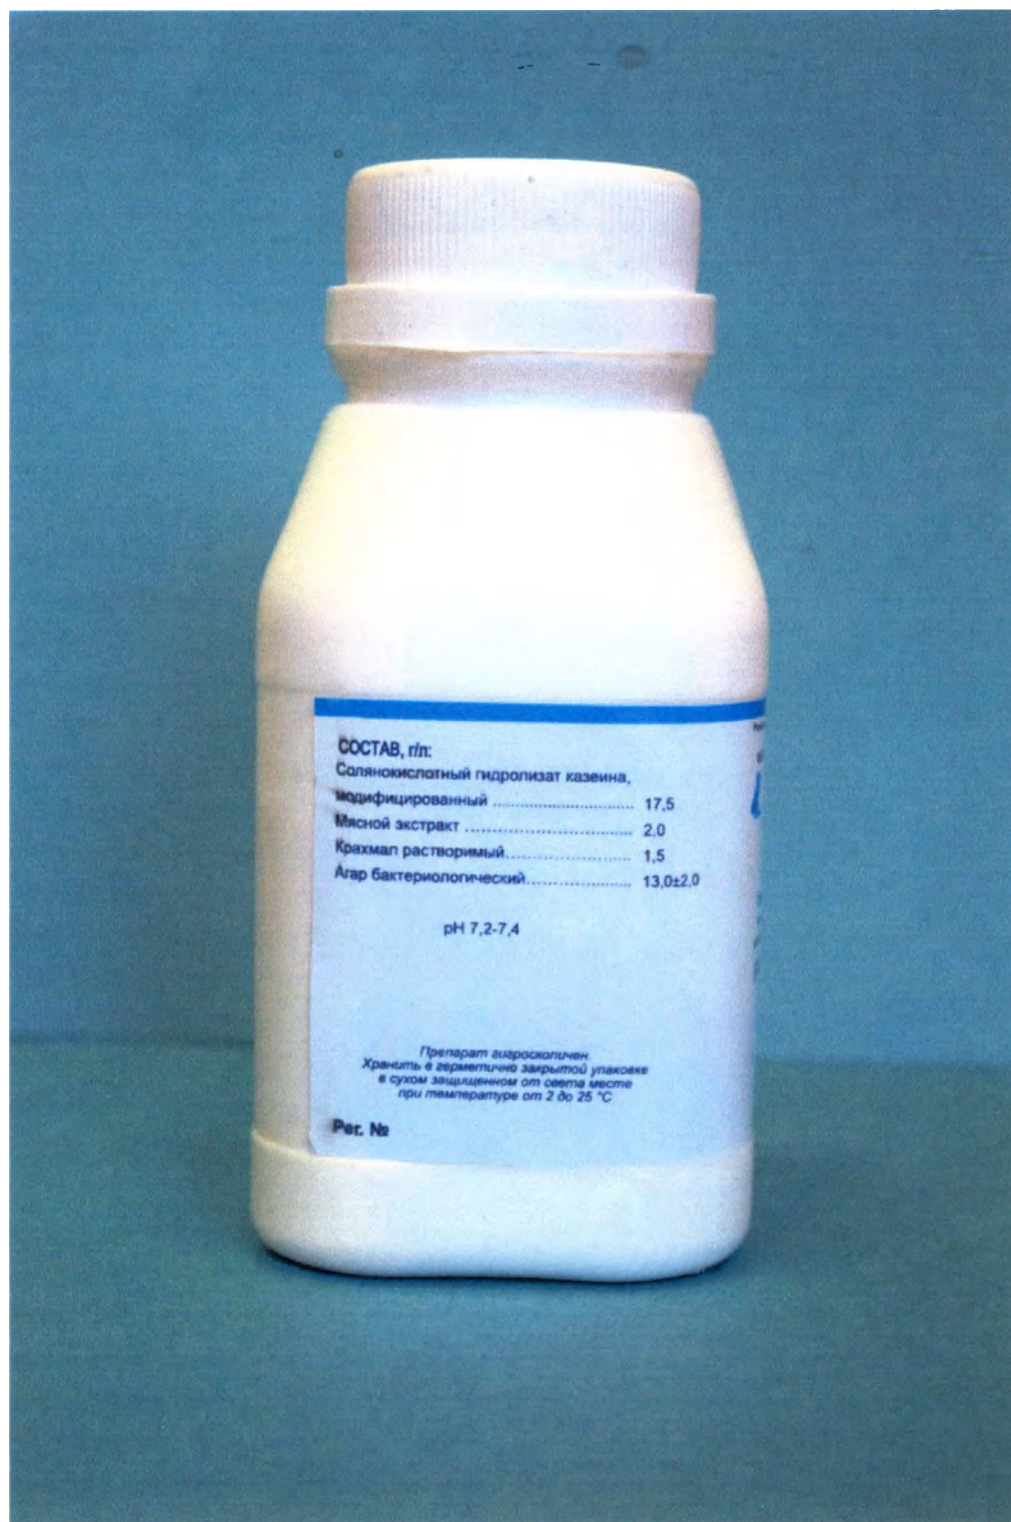

ВИД СЛЕВА

Фотоизображение медицинского изделия
«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам. сухая
(Агар Мюллера-Хинтон II)»
ТУ 9385-227-78095326-2015

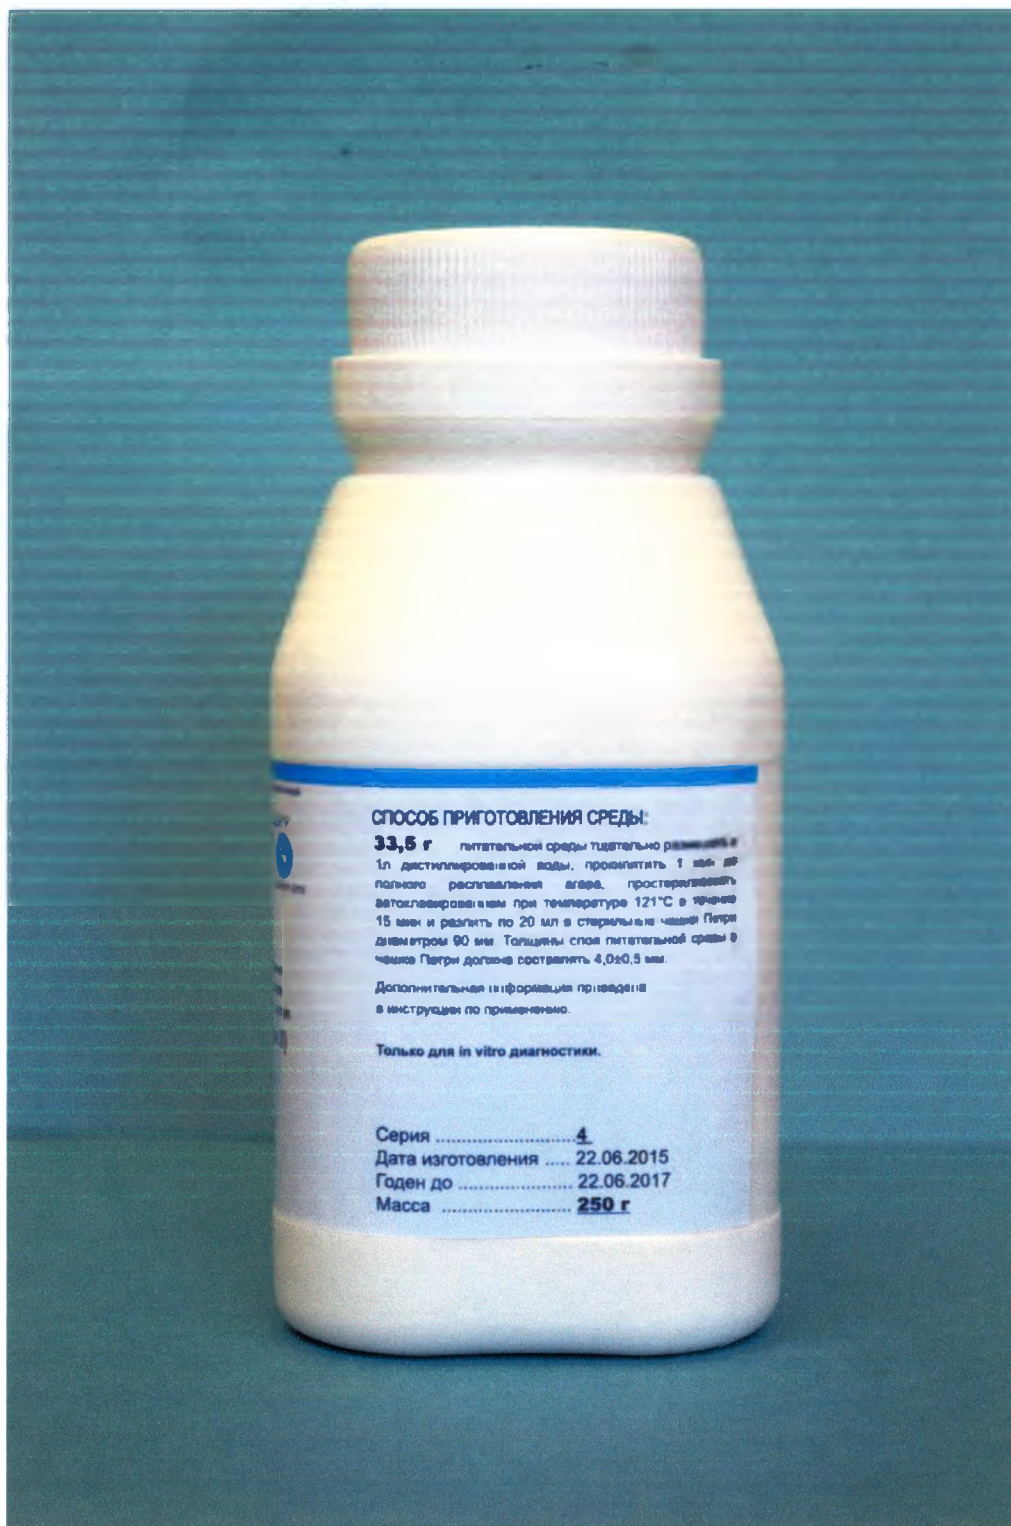

вид справа

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

3 (три)

листов. Подпись

"10" 06

20

