

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МТ ДИАГНОСТИКА»

А.Н. Зеленев

М.П.



Фотографии медицинского изделия

«Ларингоскоп медицинский Classic+, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями»

производства «Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко. КГ» / HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Germany



Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh размер 5;




Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh размер 4;




Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh размер 3;




Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh размер 2;

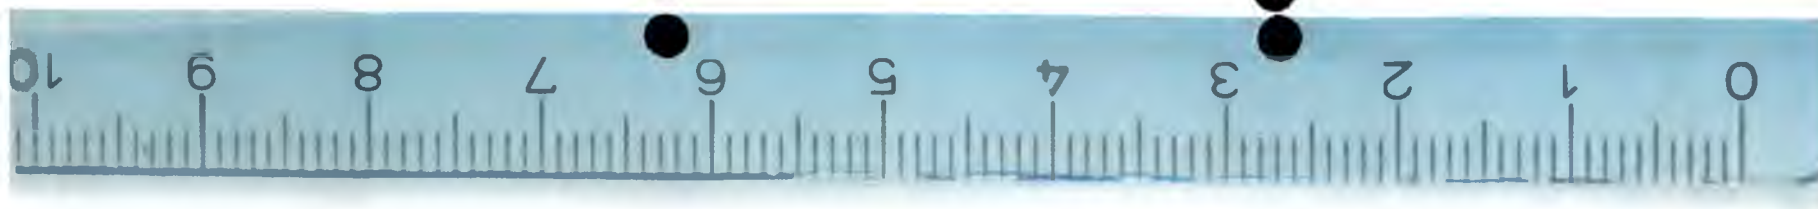

Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh размер 1;

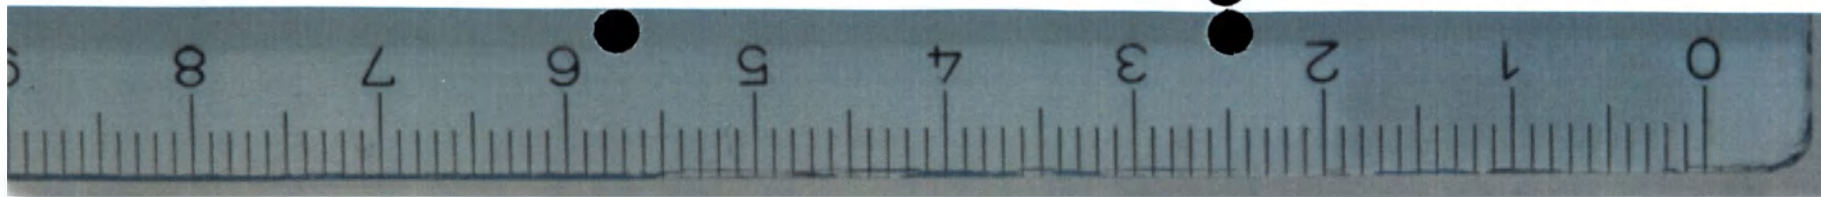


Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh размер 0;

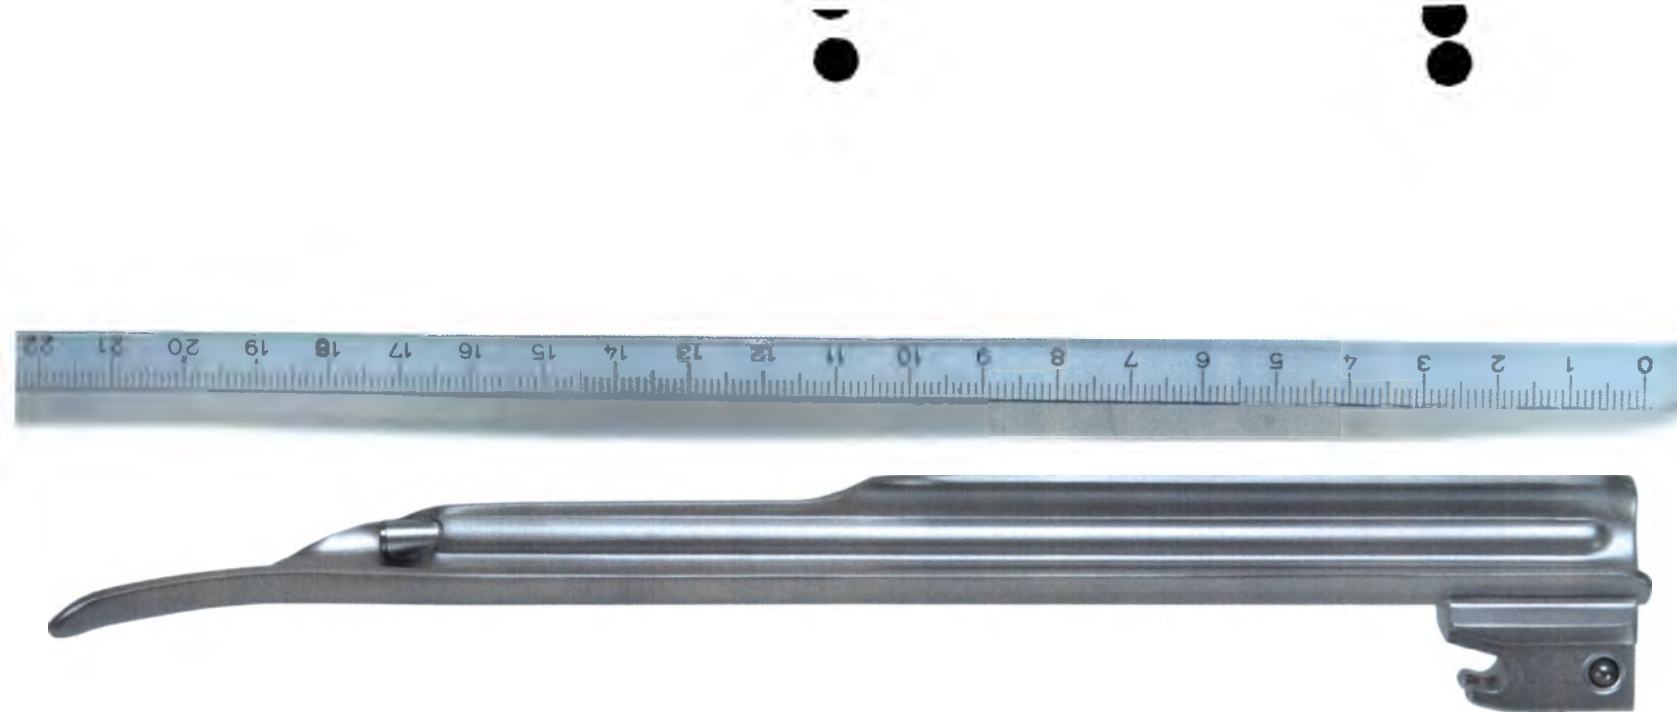


Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Miller размер 4;




Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Miller размер 0,1,3;

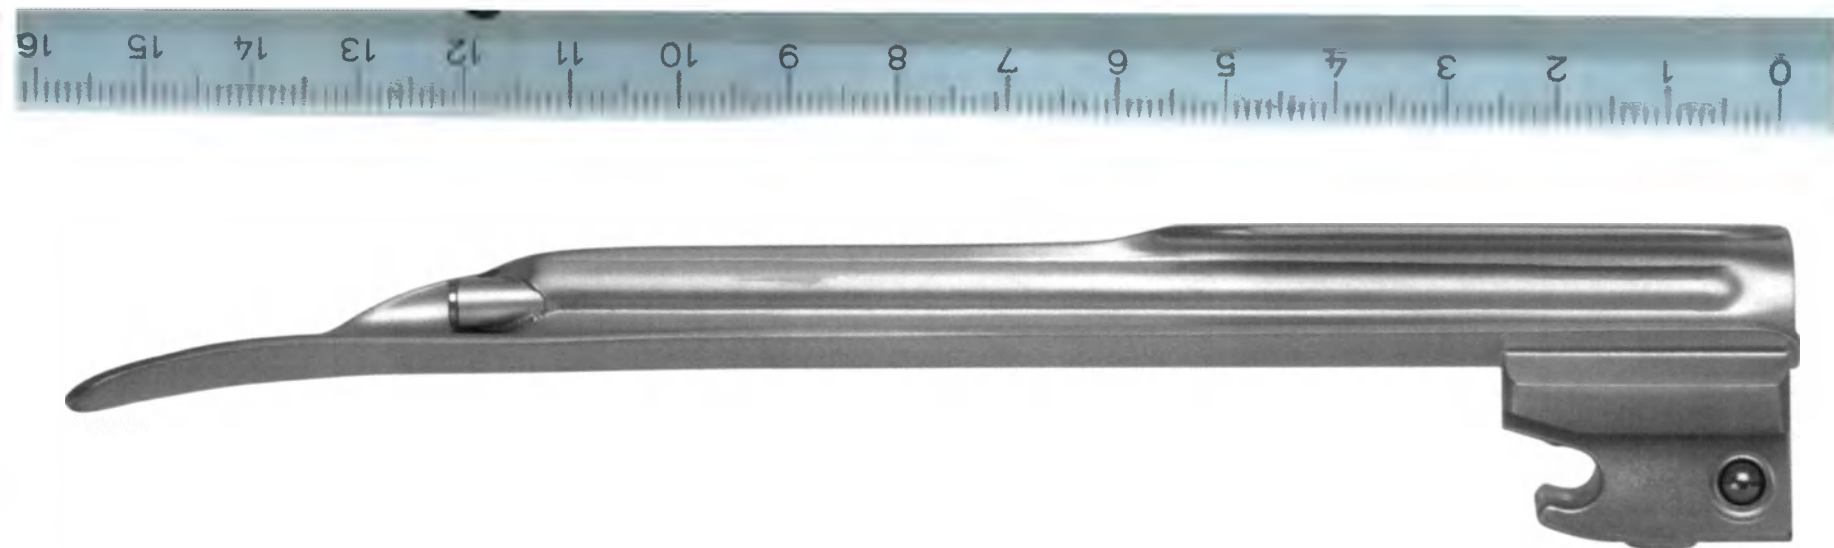

Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Miller размер 2;

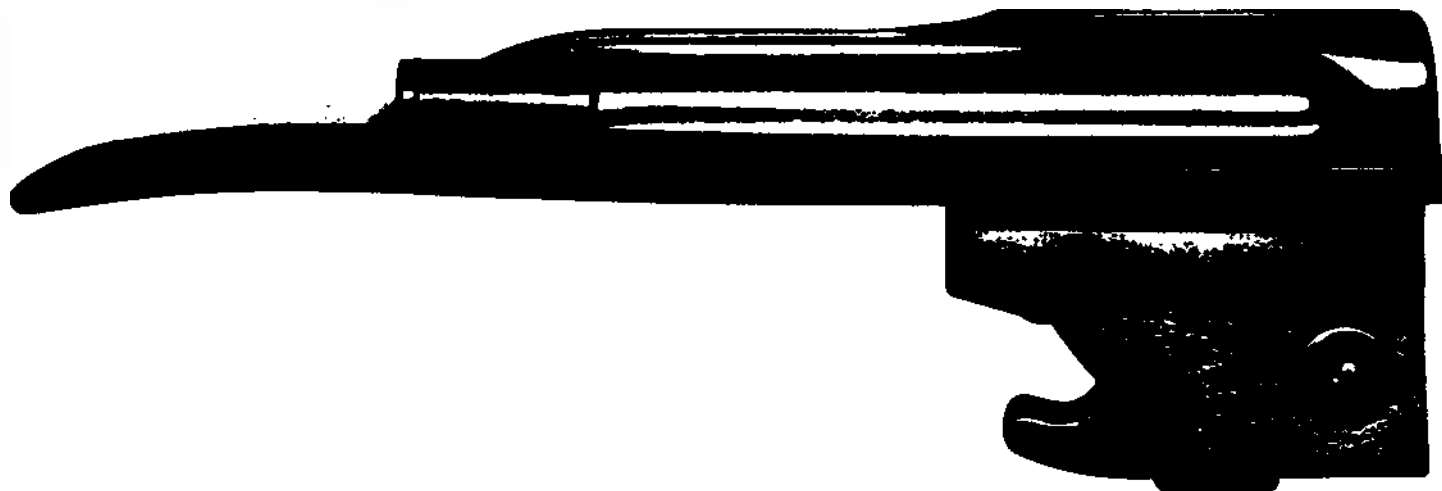

Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Miller размер 00;

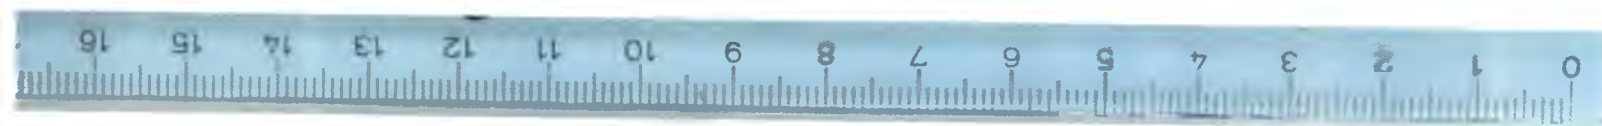

Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ WIS размер 3;



Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ WIS размер 2;




Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ WIS размер 1;



Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Paed размер 0;




Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Paed размер 1;

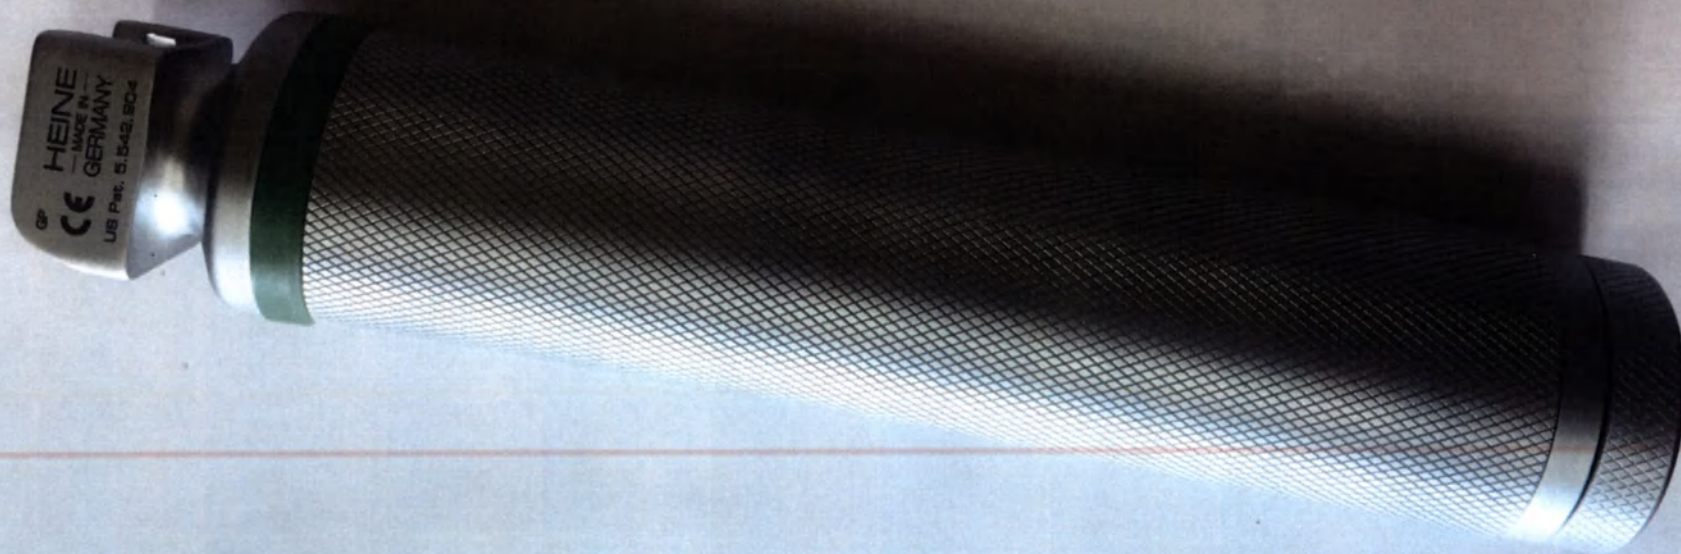




Рукоятка ларингоскопа перезаряжаемая Standard F.O. 4 NT и внутренняя часть рукоятки без крышки

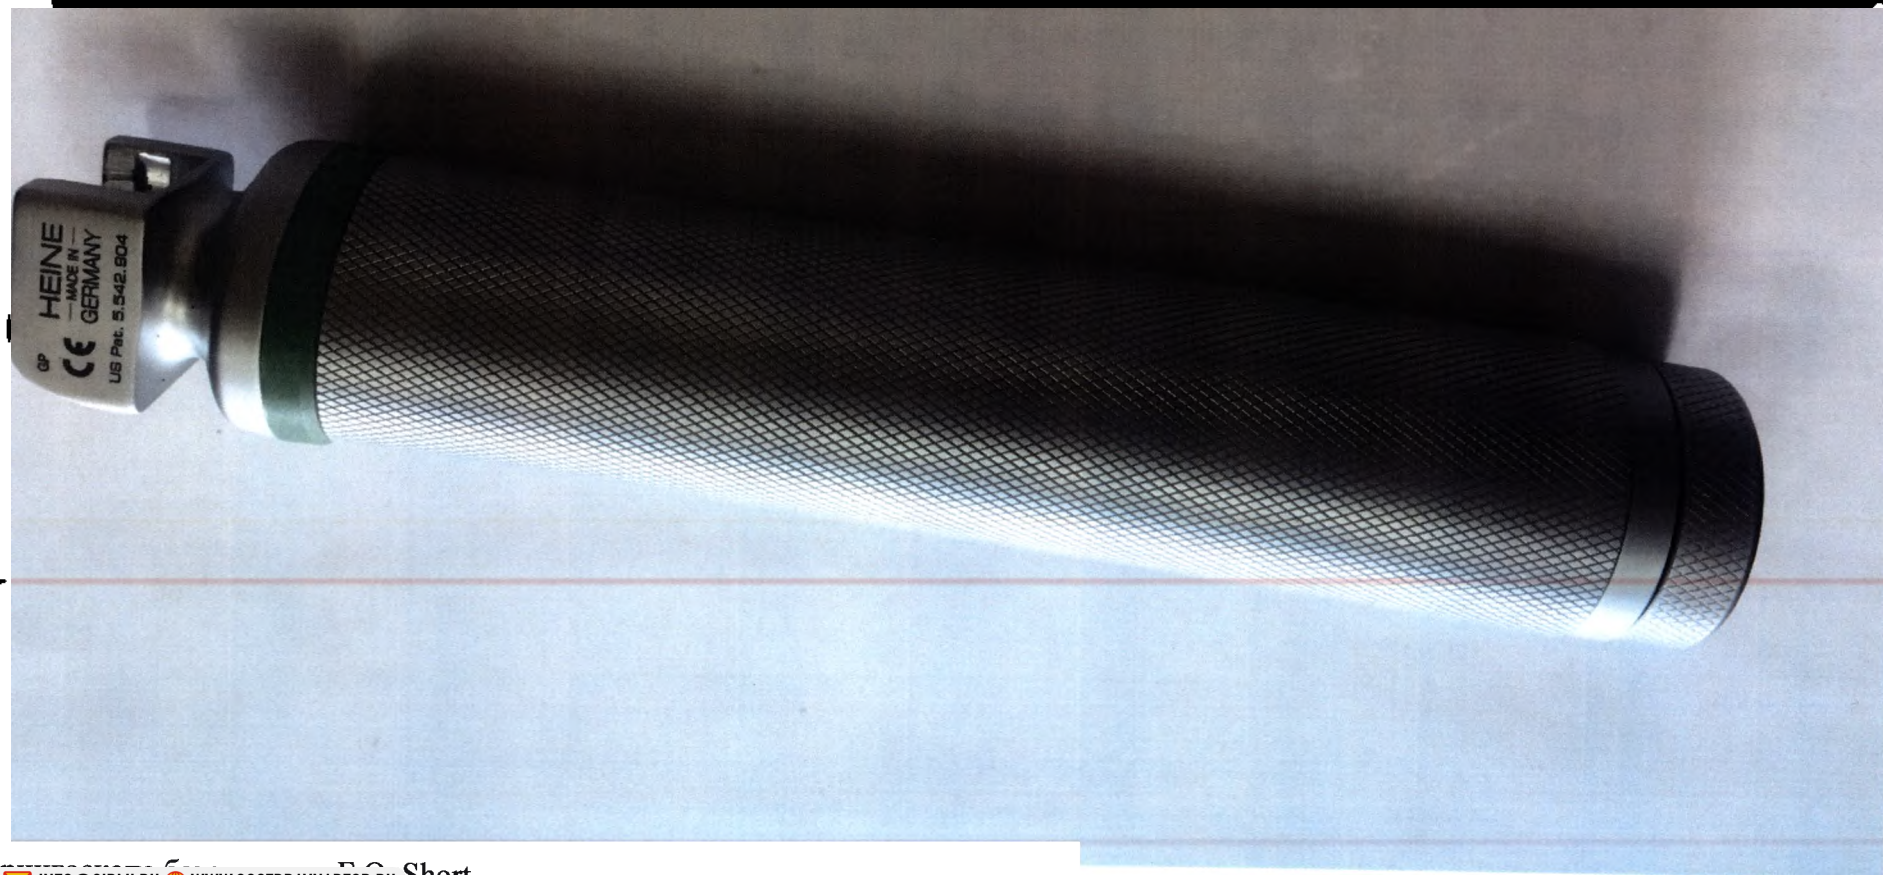





Рукоятка ларингоскопа перезаряжаемая F.O. 4 SHORT NT

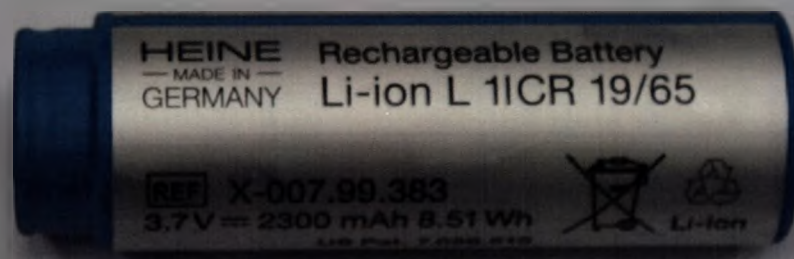


Аккумулятор Li-ion L 3.5 B.

ООО ЦРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru



Аккумулятор S2Z 4NT Li-ion 3,5 В

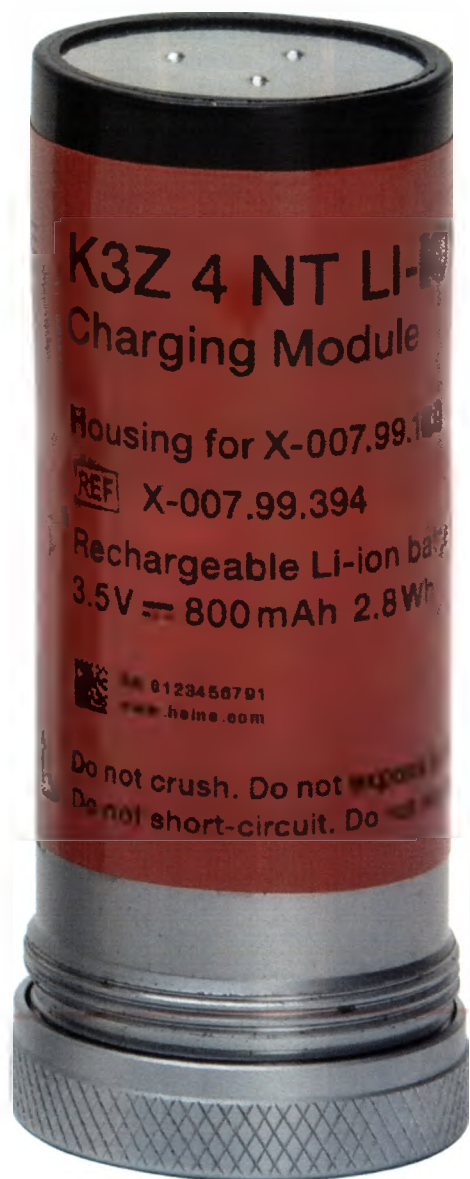



Аккумулятор M2Z 4NT Li-ion 3,5 В. – не более 5 шт.



Блок зарядный настольный NT 4



Адаптер для рукоятки для зарядного блока 4NT и зарядный блок 4NT



Лампа ксенон-галогеновая тип XHL 2,5 В. – не более 5 шт.



Лампа ксенон-галогеновая тип XHL 3,5 В. – не более 5 шт.



Кейс транспортировочный



Нижняя крышка рукоятки батарейной Standard F.O.



Нижняя крышка рукоятки батарейной F.O. Slim




Нижняя крышка рукоятки перезаряжаемой Standard F.O.4NT






Защитный кожух ХР для рукоятки

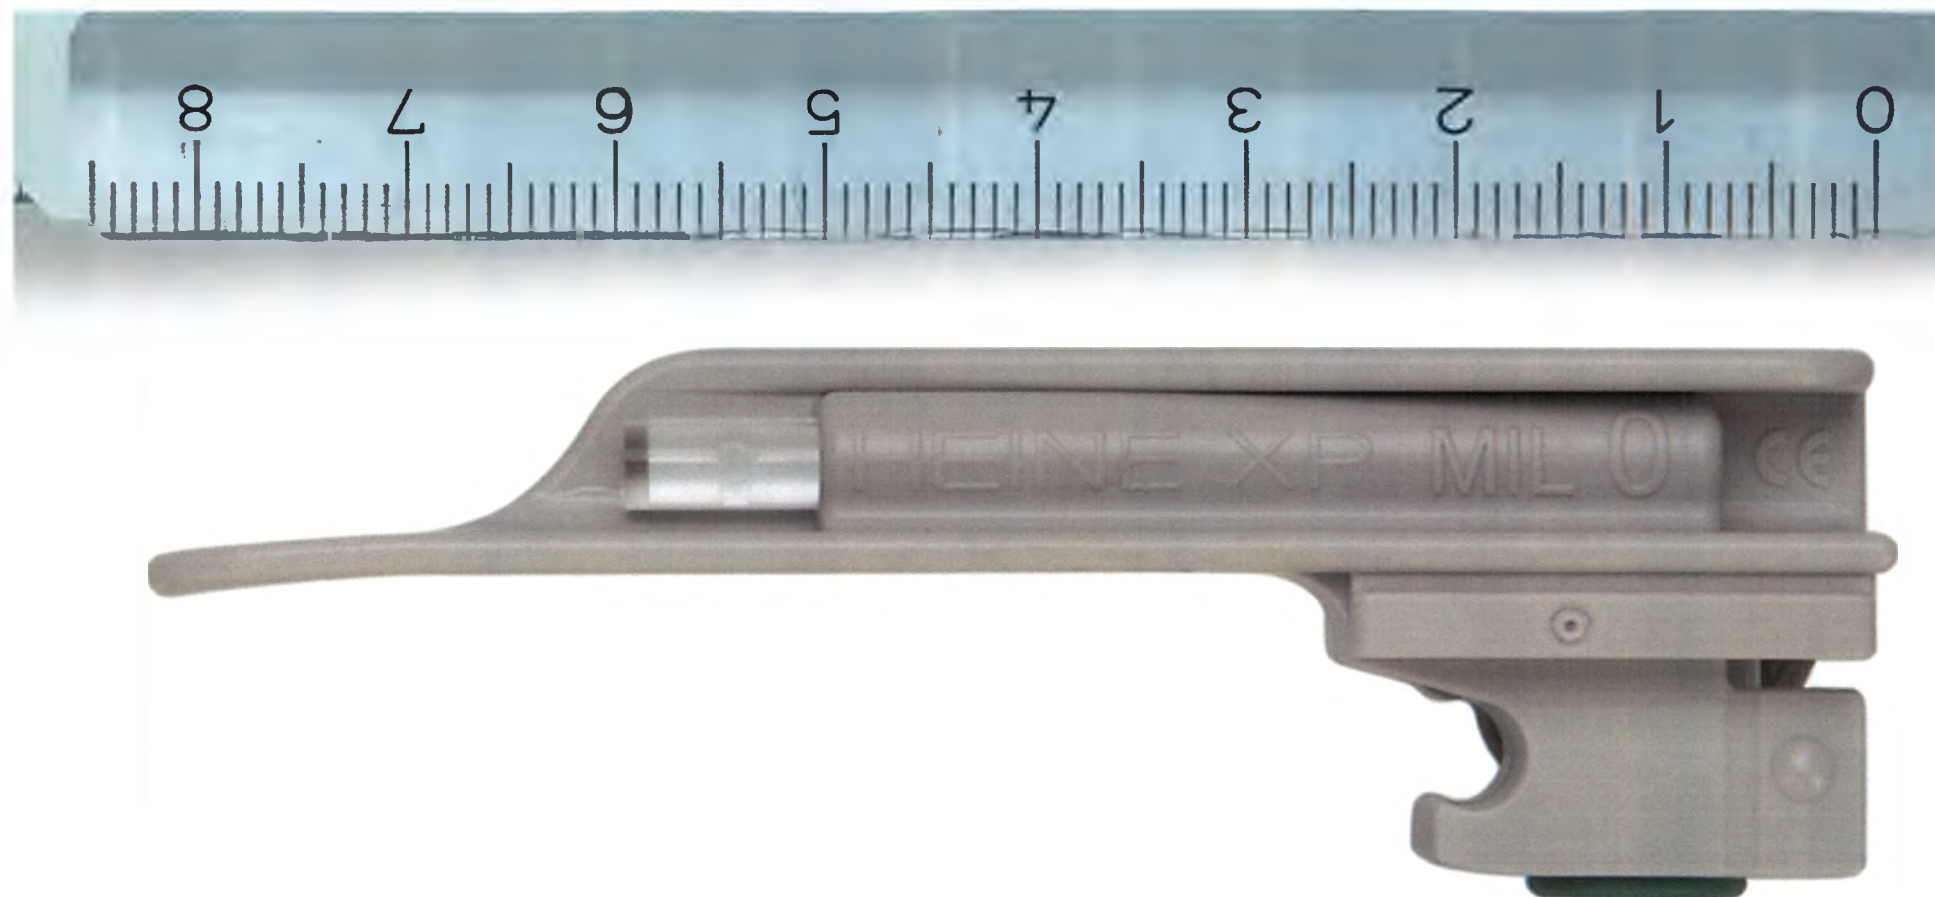


Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Miller, размер 0

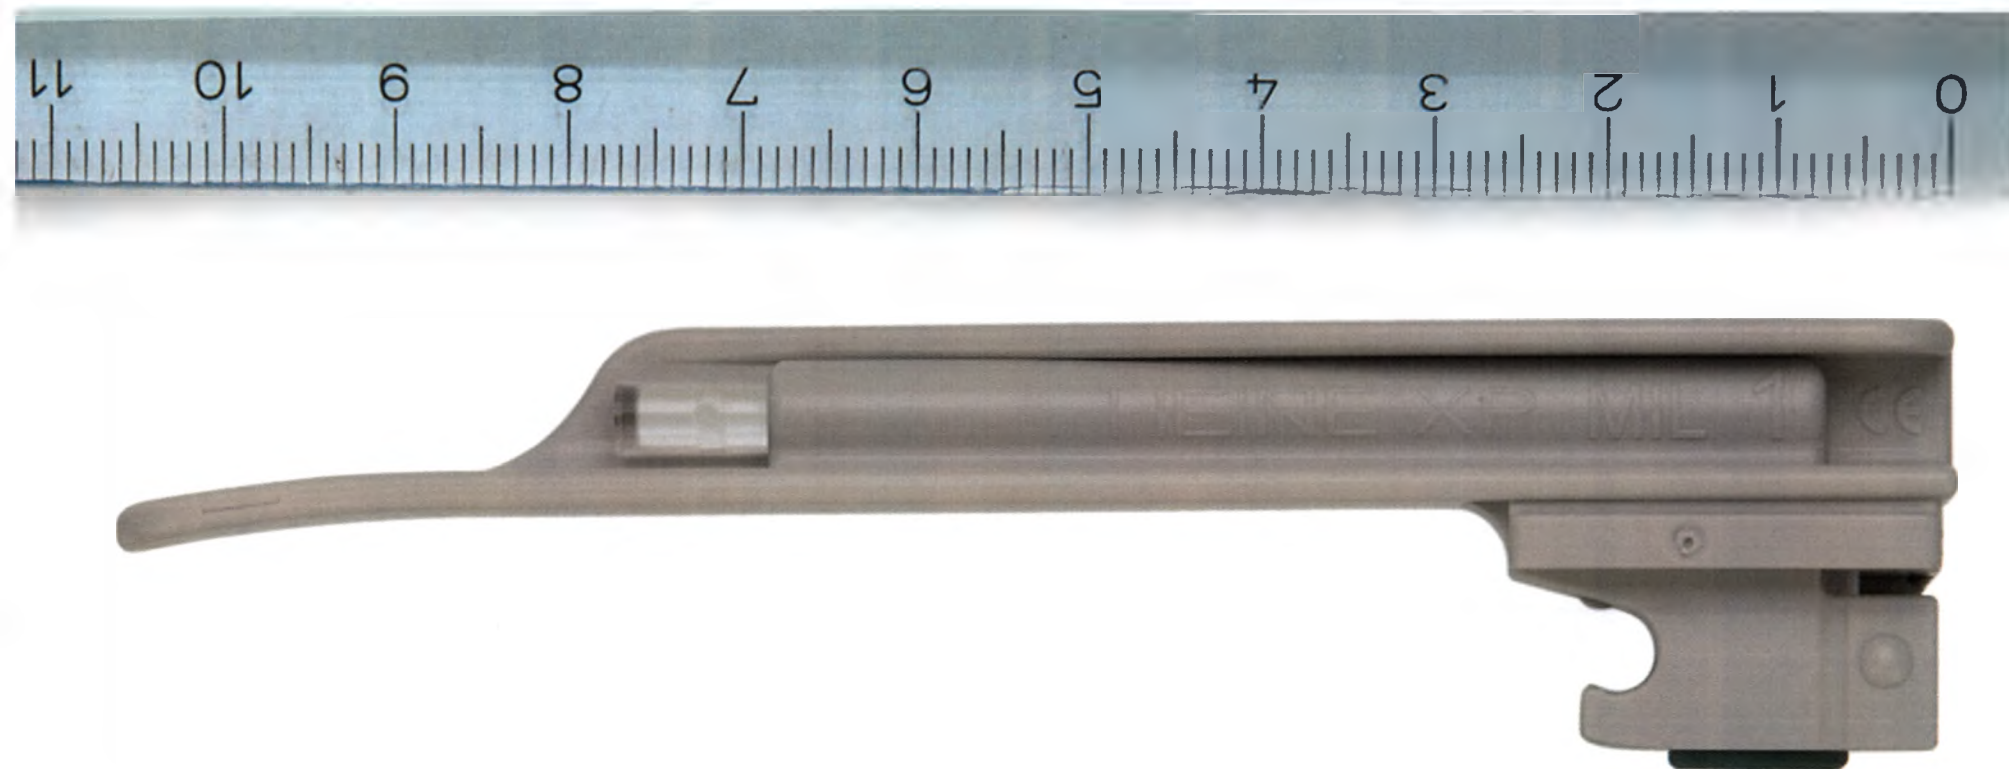

Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Miller, размер 1



Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Miller, размер ,2

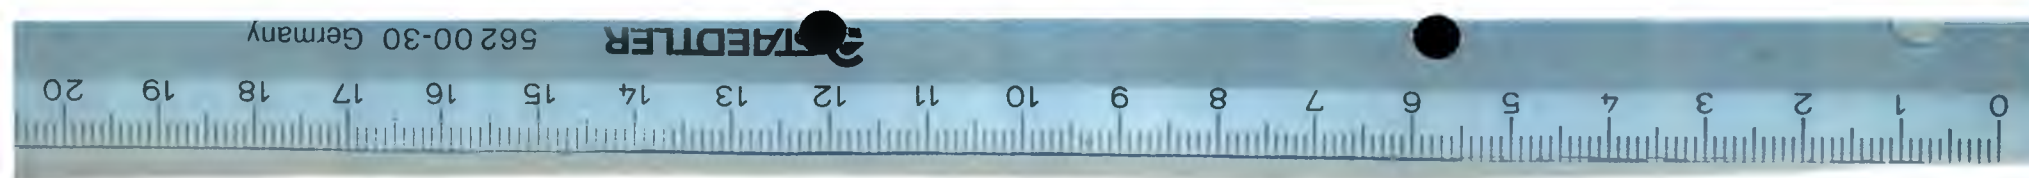

Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Miller, размер 3




Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XR Miller, размер 4



Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Мас, размер 1



Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Mac, размер 2

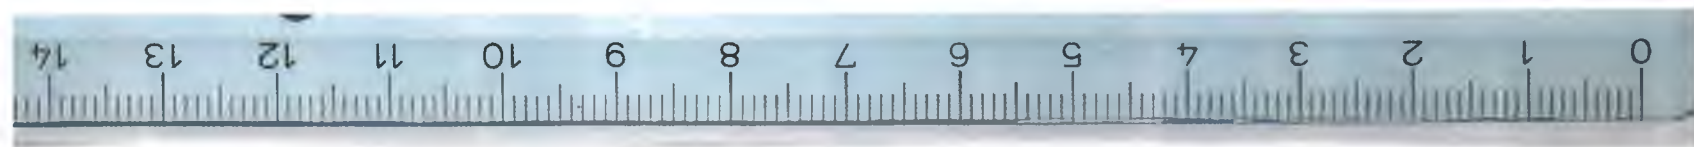

Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Mac, размер 3



Насадка ларингоскопическая (одноразовая) XP Мас, размер 4

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

46 лист(ов)

Генеральный директор ООО "МТ
Диагностика" _____ А.Н.
Зеленов

