

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15

**производства «РАЛ Текника пара эль Лабораторно, С.А.», Испания
место производства АО «ДИАКОН-ДС», Россия**

2020

1. Маркировка анализатора

Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15

Варианты исполнения:

I. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15

Образец маркировки, расположенной на корпусе анализатора

Анализатор полуавтоматический биохимический									
Clima MC-15, вариант исполнения:									
Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15									
РУ № РЗН 2014/2054 от _____									
IVD	REF	RA 117000	SN	0227					
Напряжение: ~230 В, 50 Гц						Мощность: 200 В·А		Хранить при температуре от +5°C до +40°C	
Производитель: «РАЛ Техника пара эль Лабораторио, С.А.», Испания, RAL Técnica para el Laboratorio, S.A., Av. Mare de Déu de Montserrat, 51, Sant Joan Despi, 08970 Barcelona, Spain									
Место производства: АО «ДИАКОН-ДС», Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а.									
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН», Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а, тел.(495)980-63-38, 980-63-39, sale@diakonlab.ru									

Фото 1

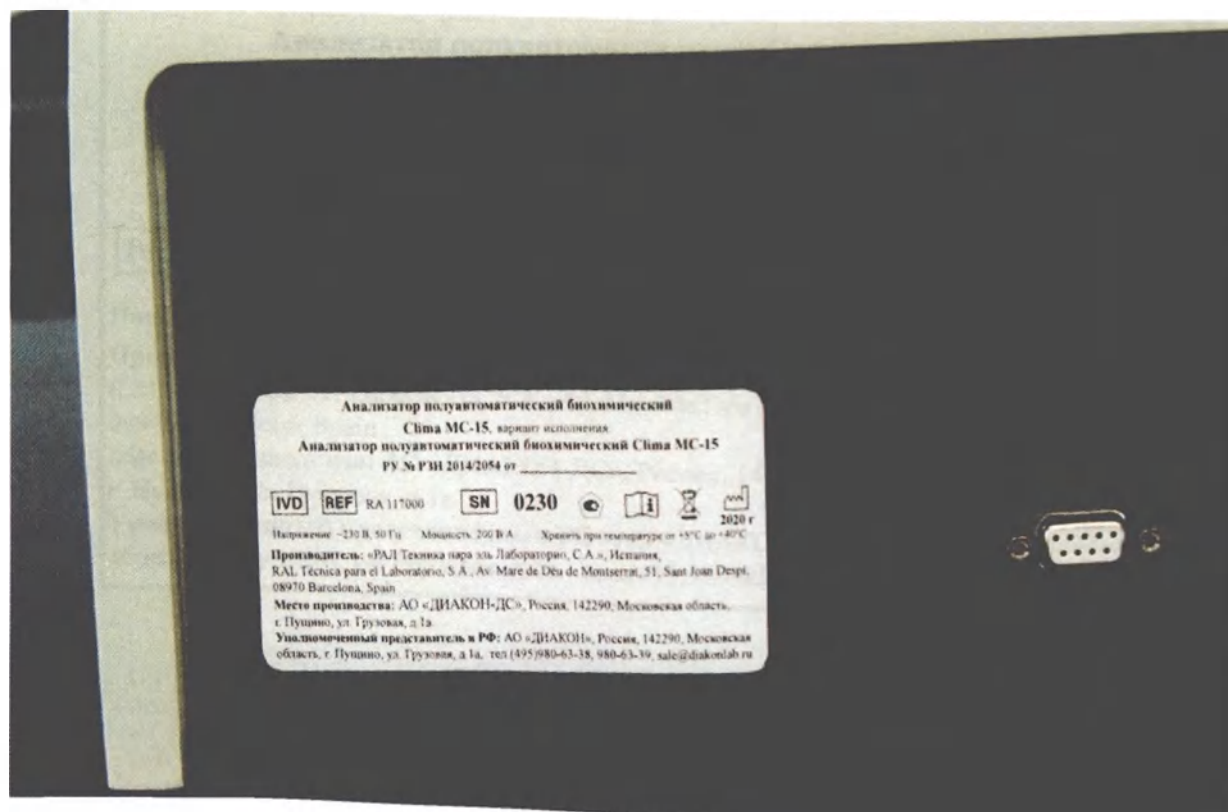


Фото 2



II. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 со сканером радиочастотной метки (RFID)

Образец маркировки, расположенной на корпусе анализатора

Анализатор полуавтоматический биохимический
Clima MC-15, вариант исполнения:
Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 со
сканером радиочастотной метки (RFID)
 РУ № РЗН 2014/2054 от _____

IVD	REF	RA 119000	SN	0001				
------------	------------	-----------	-----------	-------------	--	--	--	--

Напряжение: ~230 В, 50 Гц Мощность: ≤ 200 Вт Хранить при температуре от +5°C до +40°C

Производитель: «РАЛ Текника пара эль Лабораторио, С.А.», Испания,
 RAL Técnica para el Laboratorio, S.A., Av. Mare de Déu de Montserrat, 51, Sant Joan Despí,
 08970 Barcelona, Spain

Место производства: АО «ДИАКОН-ДС», Россия, 142290, Московская область,
 г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а.

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН», Россия, 142290, Московская
 область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а, тел.(495)980-63-38, 980-63-39, sale@diakonlab.ru

Фото 1

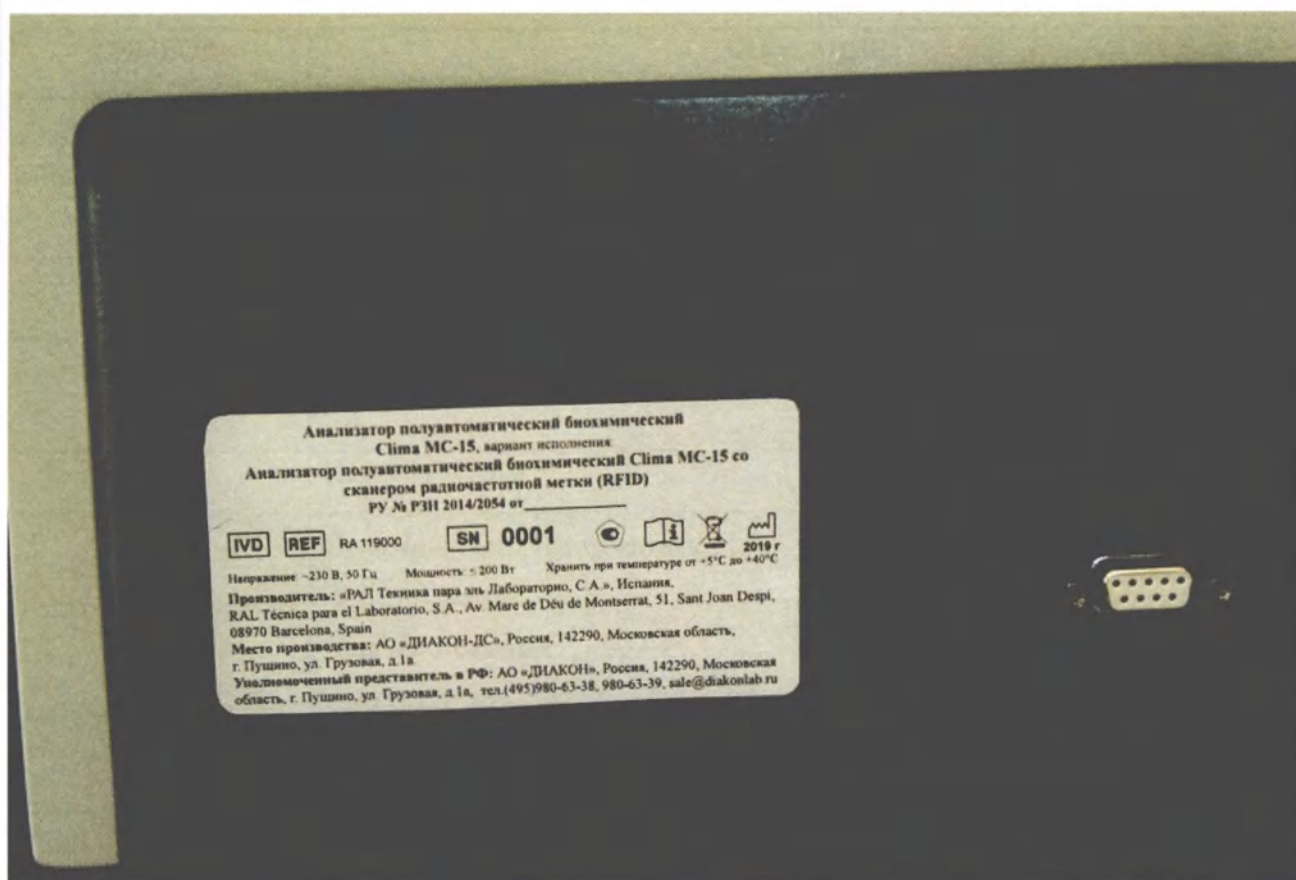


Фото 2



Описание символов, применяемых при маркировке Анализатора

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Медицинский прибор для диагностики <i>in vitro</i>
	Серийный № прибора
	Код модели/руководства
	Знак утверждения типа средства измерения
	Переменный ток
	Производитель / Изготовитель
	Дата изготовления
	ОСТОРОЖНО: риск получения травмы или повреждения оборудования
	См. соответствующие инструкции
	Место расположения сканера радиочастотной метки (RFID)
	Биологическая опасность
	Заземление
	ON (Питание включено)
	OFF (Питание выключено)
	Утилизировать в соответствии с установленными правилами

2. Маркировка транспортной тары

Образец нанесения этикетки и манипуляционных знаков на упаковку



Образец нанесения манипуляционных знаков на упаковку



Маркировка Анализатора, расположенная на упаковочной коробке (таре)

		
Хрупкое. Осторожно	Вверх	Беречь от влаги

Образец маркировки Анализатора, расположенной на упаковочной таре:

Вариант исполнения: Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15

Clima MC-15 с/н 0001

Вариант исполнения: Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 со сканером радиочастотной метки (RFID)

Clima MC-15 с RFID с/н
0001

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС», Россия



 **Т.Ю. Корзун**

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«РАЛ Текника пара эль Laboratorio,
С.А.», Испания

RAL

TECNICA PARA EL LABORATORIO, S.A

р.р.

МП

 **Хавьер Галлего**

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе
с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия
по назначению**

Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15

**производства «РАЛ Текника пара эль Лабораторио, С.А.», Испания
место производства АО «ДИАКОН-ДС», Россия**

2020

Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15

Варианты исполнения:

I. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15:

1. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15.
2. Противопылевой чехол (Dust cover) (при необходимости).
3. Мультикюветные кассеты (Multicuvette racks) (при необходимости).
4. Сетевой кабель (Power cable) (при необходимости).
5. Бумага для принтера (Printer paper) (при необходимости).
6. Фотометрическая лампа (Photometric lamp) (при необходимости).
7. Предохранители (Fuses) (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации (User's manual).

II. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 со сканером радиочастотной метки (RFID):


1. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 со сканером радиочастотной метки (RFID).
2. Противопылевой чехол (Dust cover) (при необходимости).
3. Мультикюветные кассеты (Multicuvette racks) (при необходимости).
4. Сетевой кабель (Power cable) (при необходимости).
5. Бумага для принтера (Printer paper) (при необходимости).
6. Фотометрическая лампа (Photometric lamp) (при необходимости).
7. Предохранители (Fuses) (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации (User's manual).
9. Набор идентификационных карт (RFID Cards Set) (при необходимости).
10. Набор идентификационных меток (RFID Tag Set) (при необходимости).

I. Анализатор полуавтоматический биохимический Сііма МС-15




II. Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 со сканером радиочастотной метки (RFID)



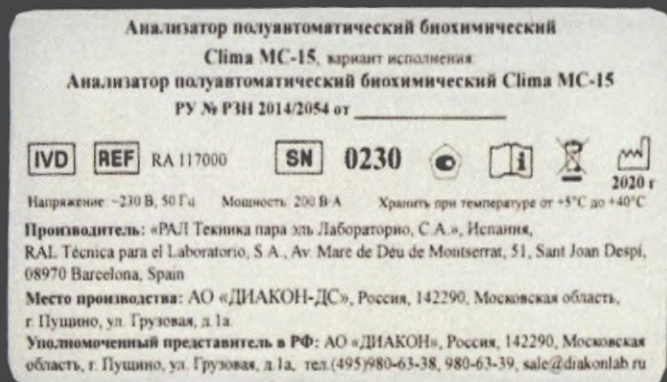

Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 (вид сзади)



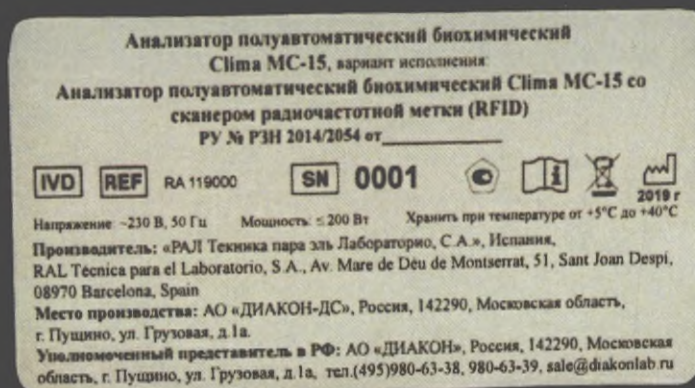


**Анализатор полуавтоматический
биохимический Clima MC-15 со
сканером радиочастотной метки
(RFID) (вид сзади)**




Противопылевой чехол (Dust cover) (при необходимости).



Мультикюветные кассеты (Multicuvette racks) (при необходимости).

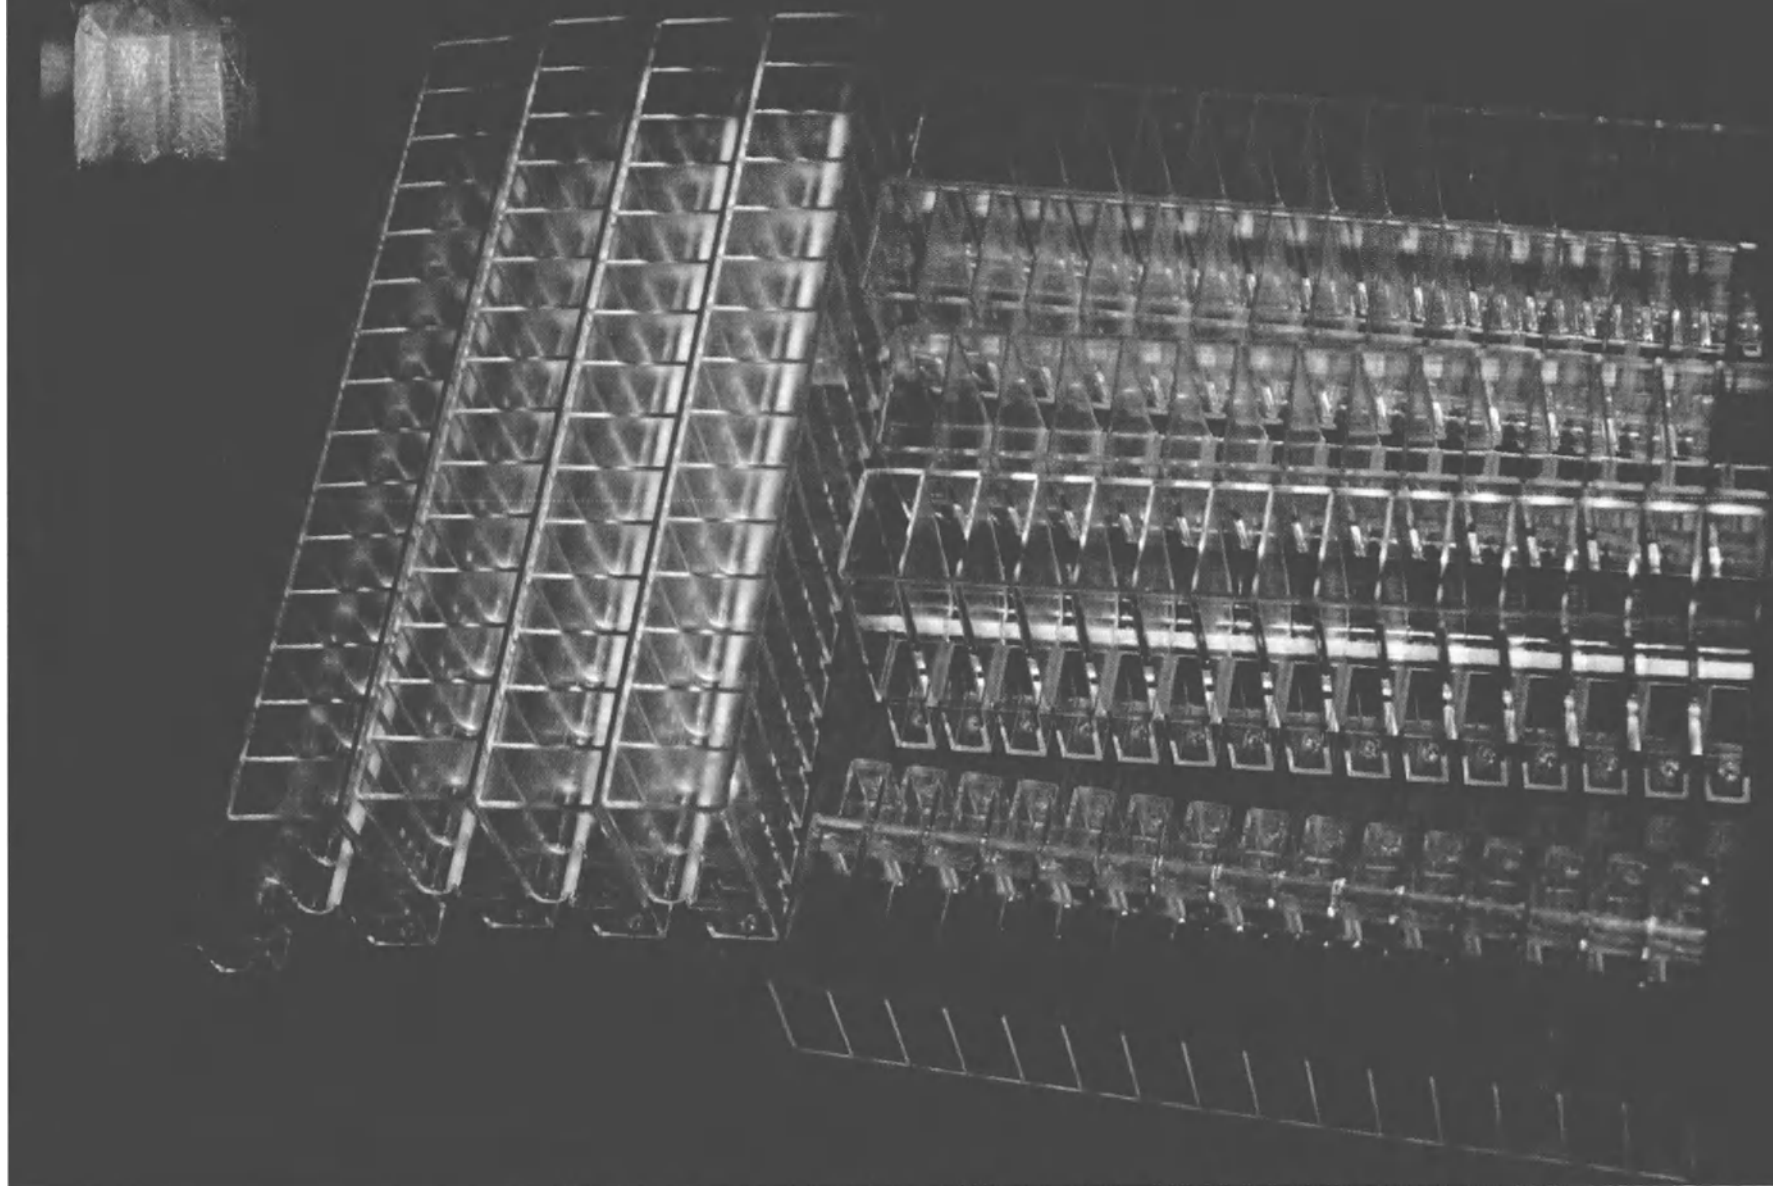


Сетевой кабель (Power cable) (при необходимости).

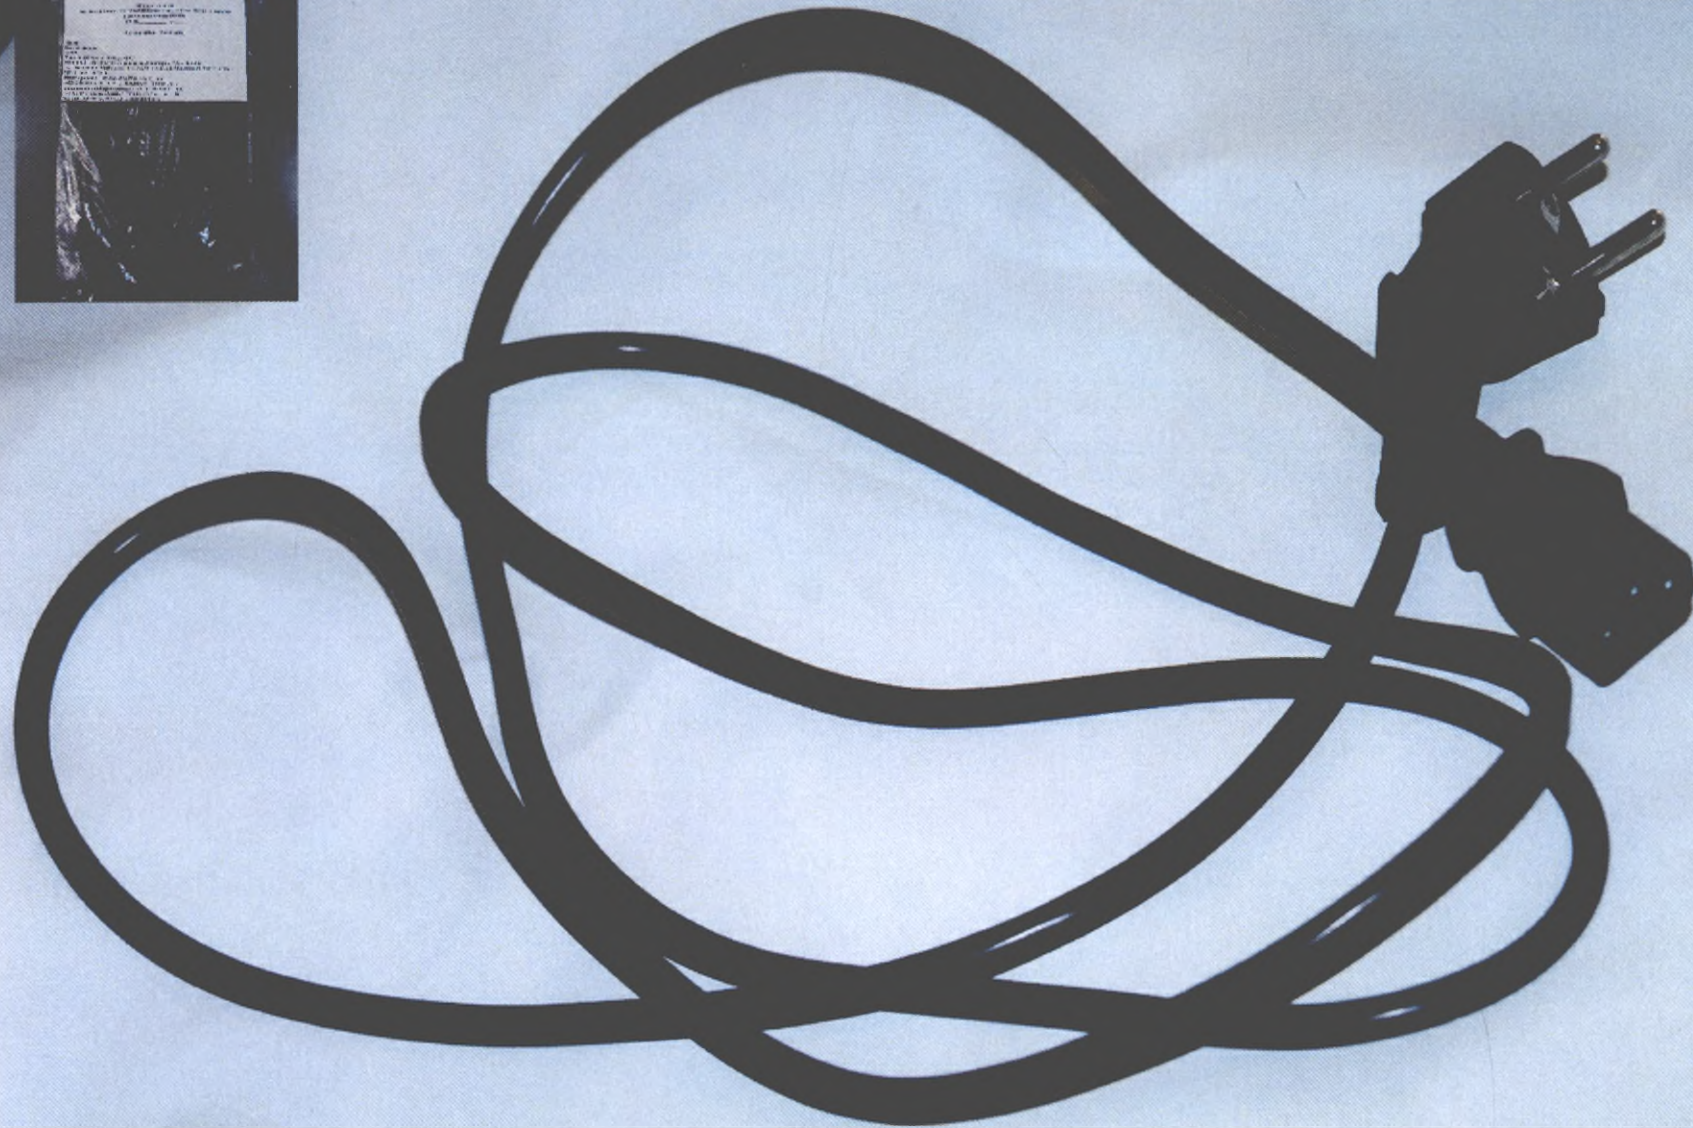


Бумага для принтера (Printer paper) (при необходимости).




Фотометрическая лампа (Photometric lamp) (при необходимости).

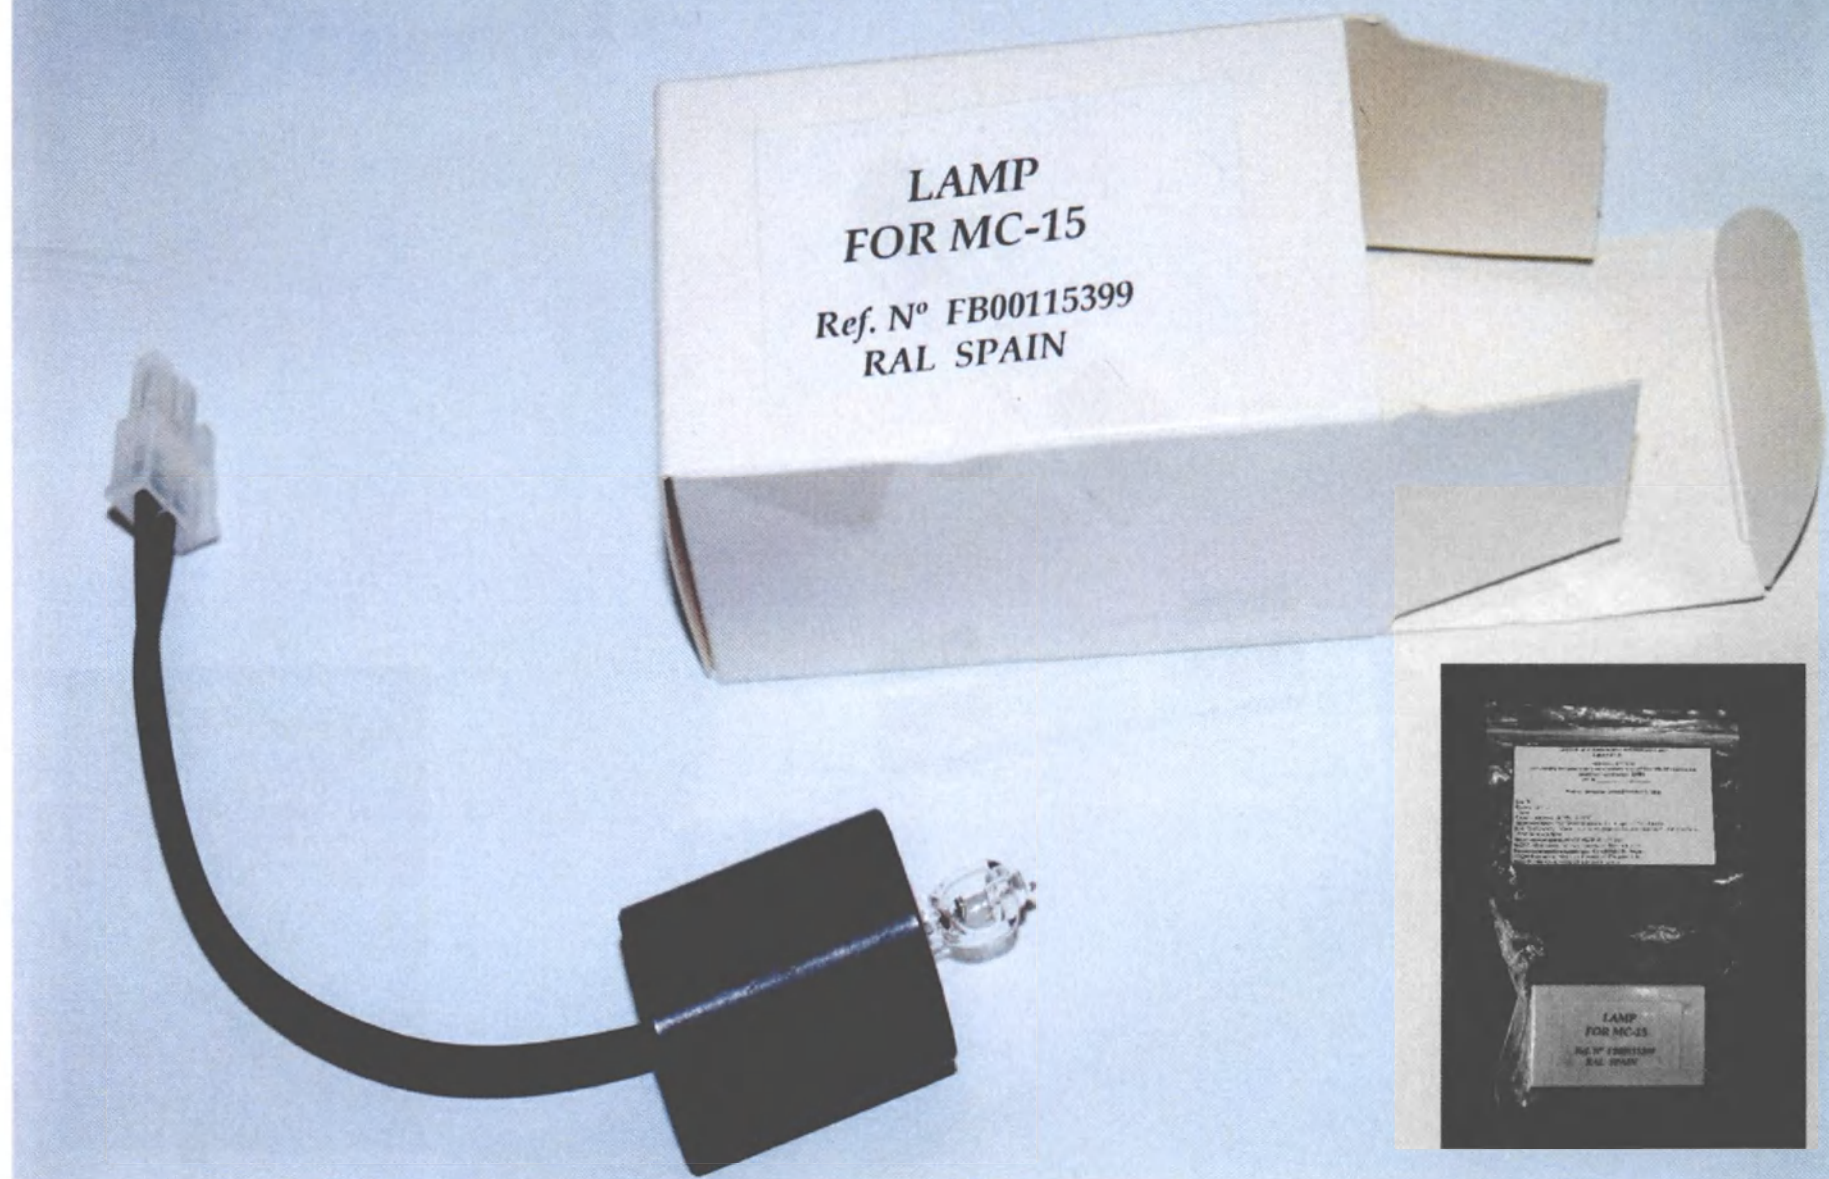



Предохранители (Fuses) (при необходимости).

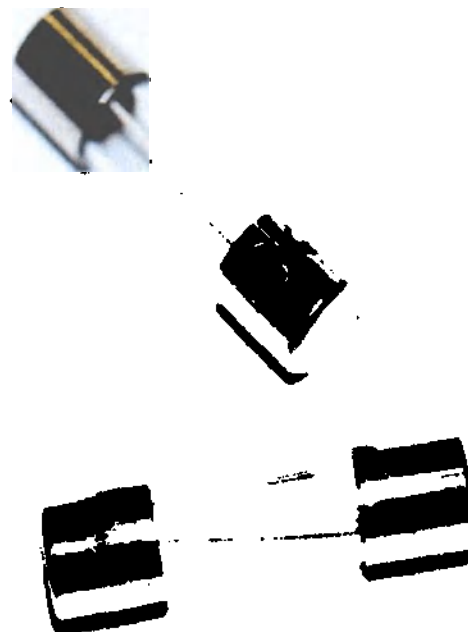


Руководство по эксплуатации (User's manual).

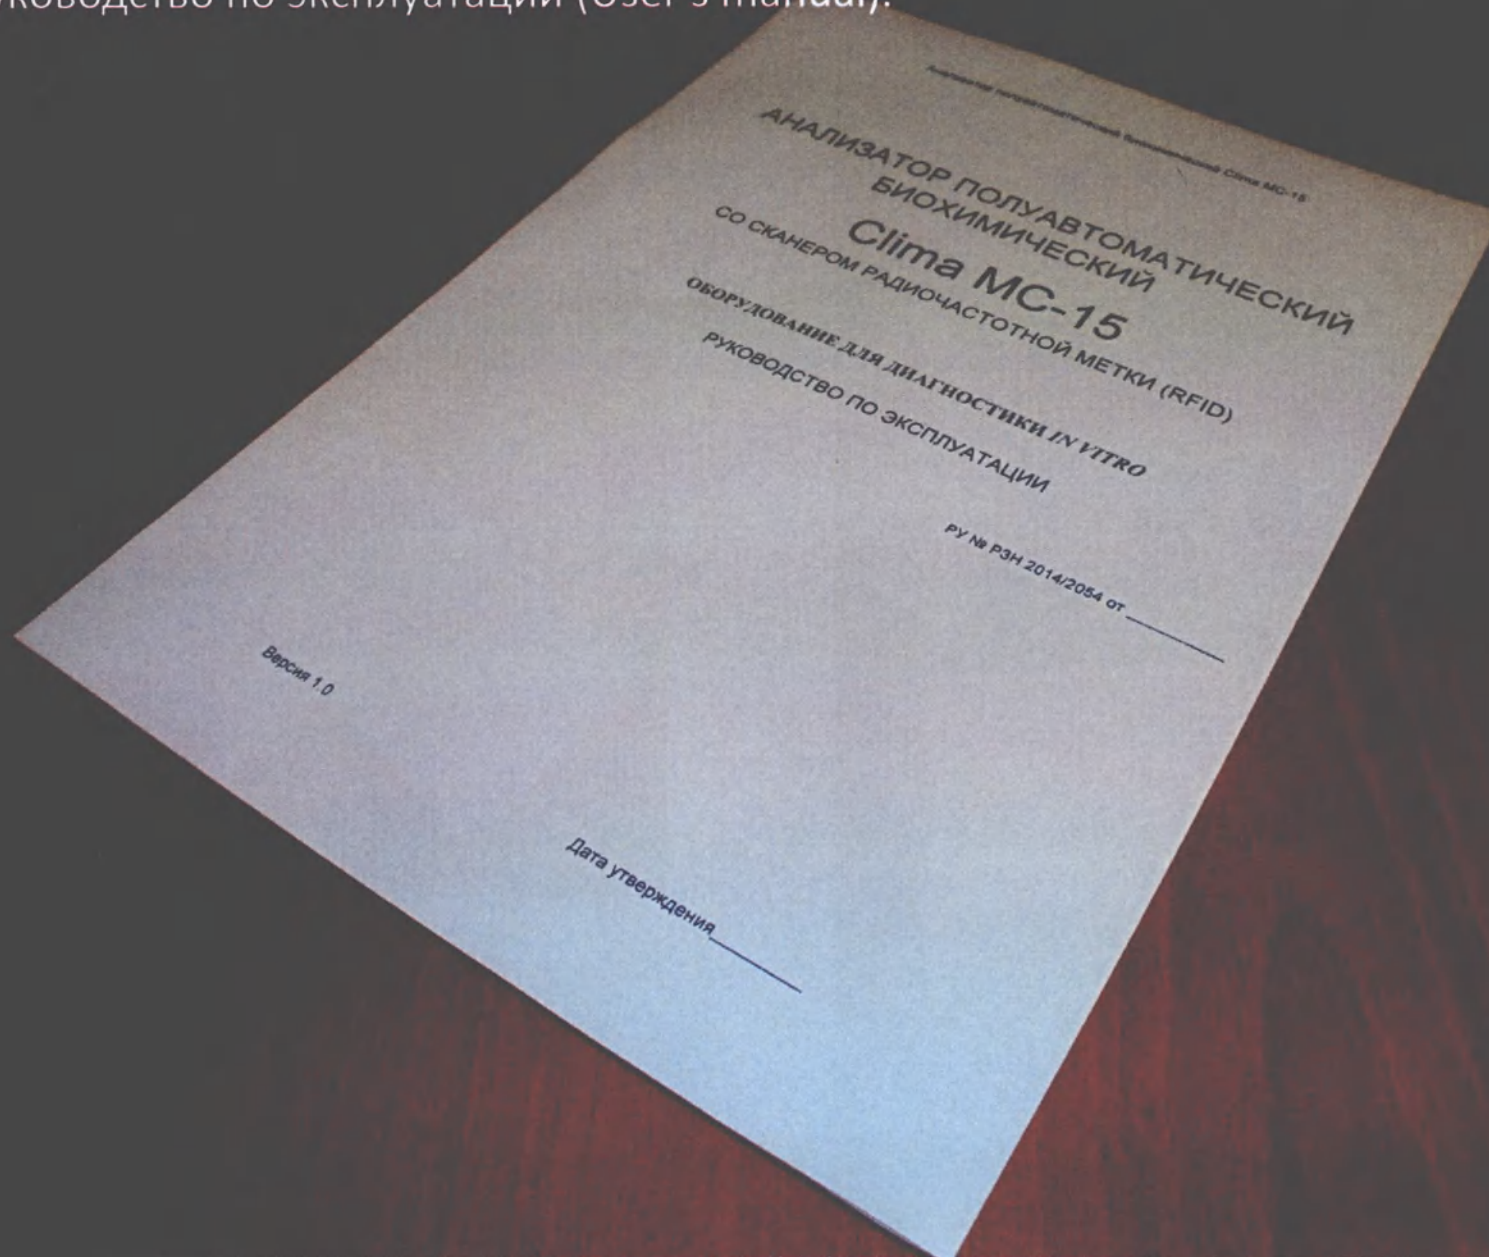

Набор идентификационных карт (RFID Cards Set) (при необходимости).

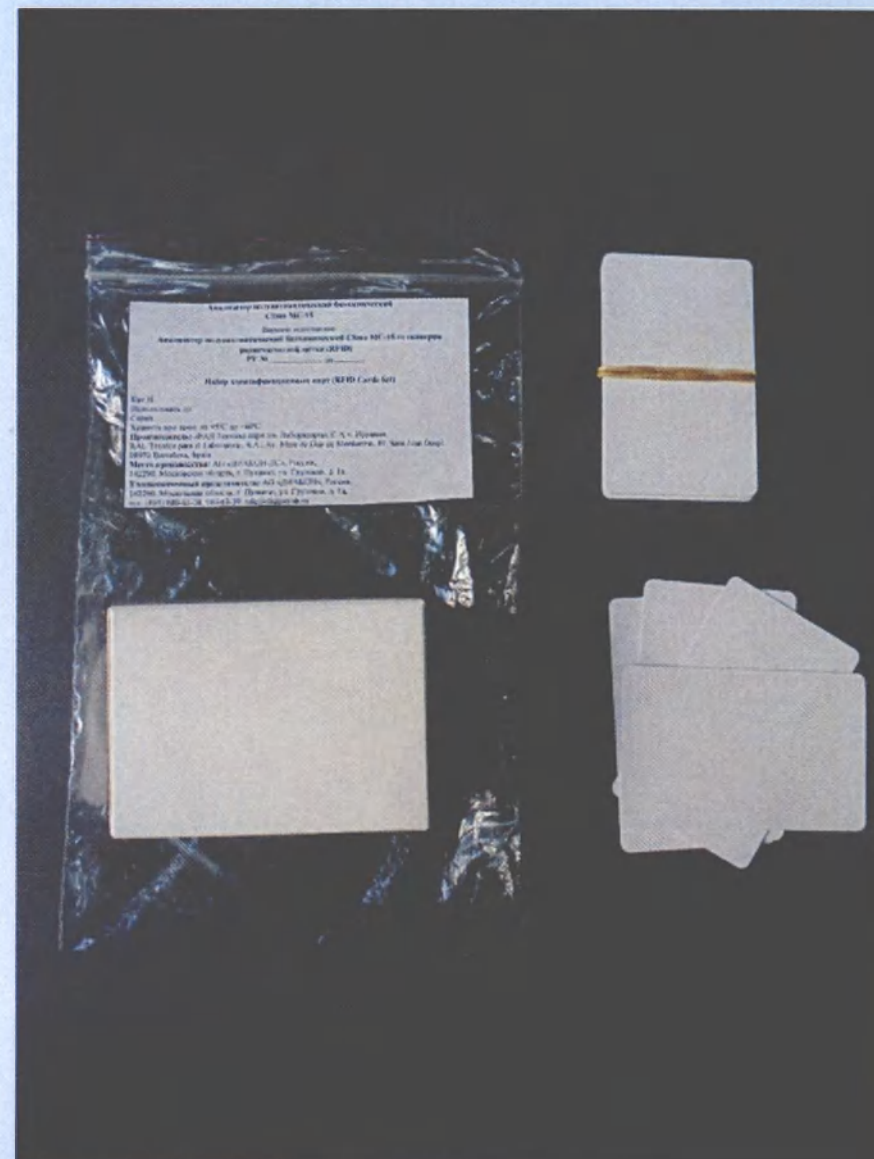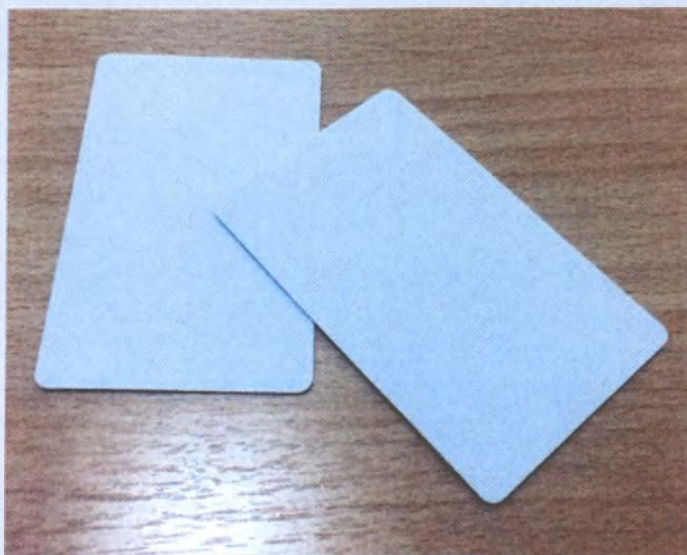

Набор идентификационных меток (RFID Tag Set) (при необходимости).

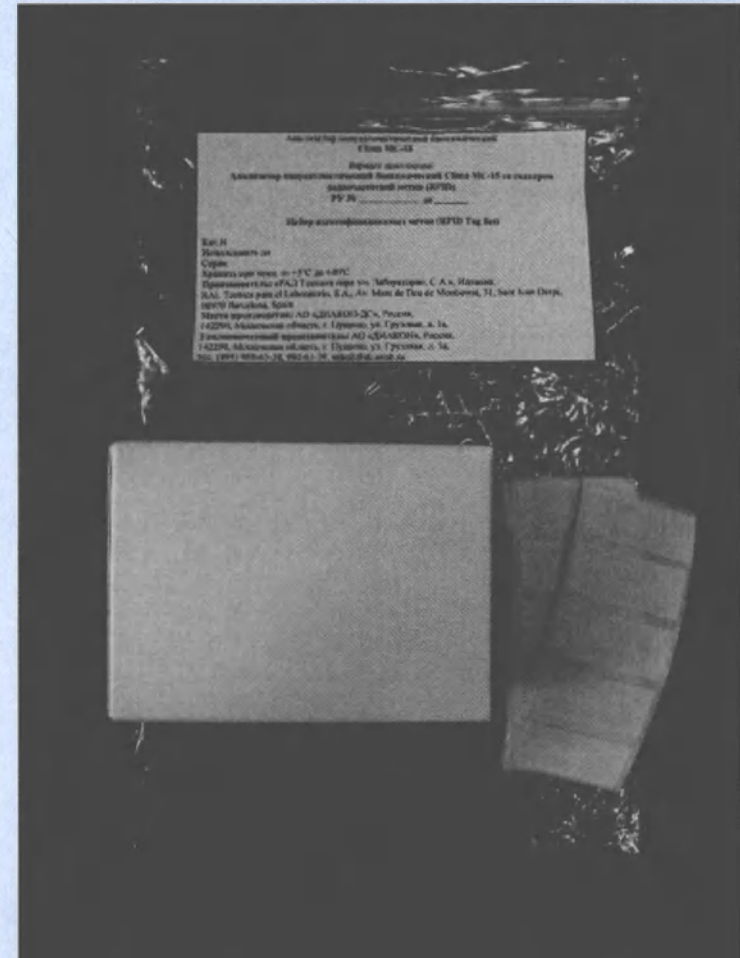



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС», Россия



Т.Ю. Корзун

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«РАЛ Текника пара эль Лабораторио,
С.А.», Испания

RAL

TECNICA PARA EL LABORATORIO, S.A
p.p.

МП

Хавьер Галлего