РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Каталка больничная функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед»

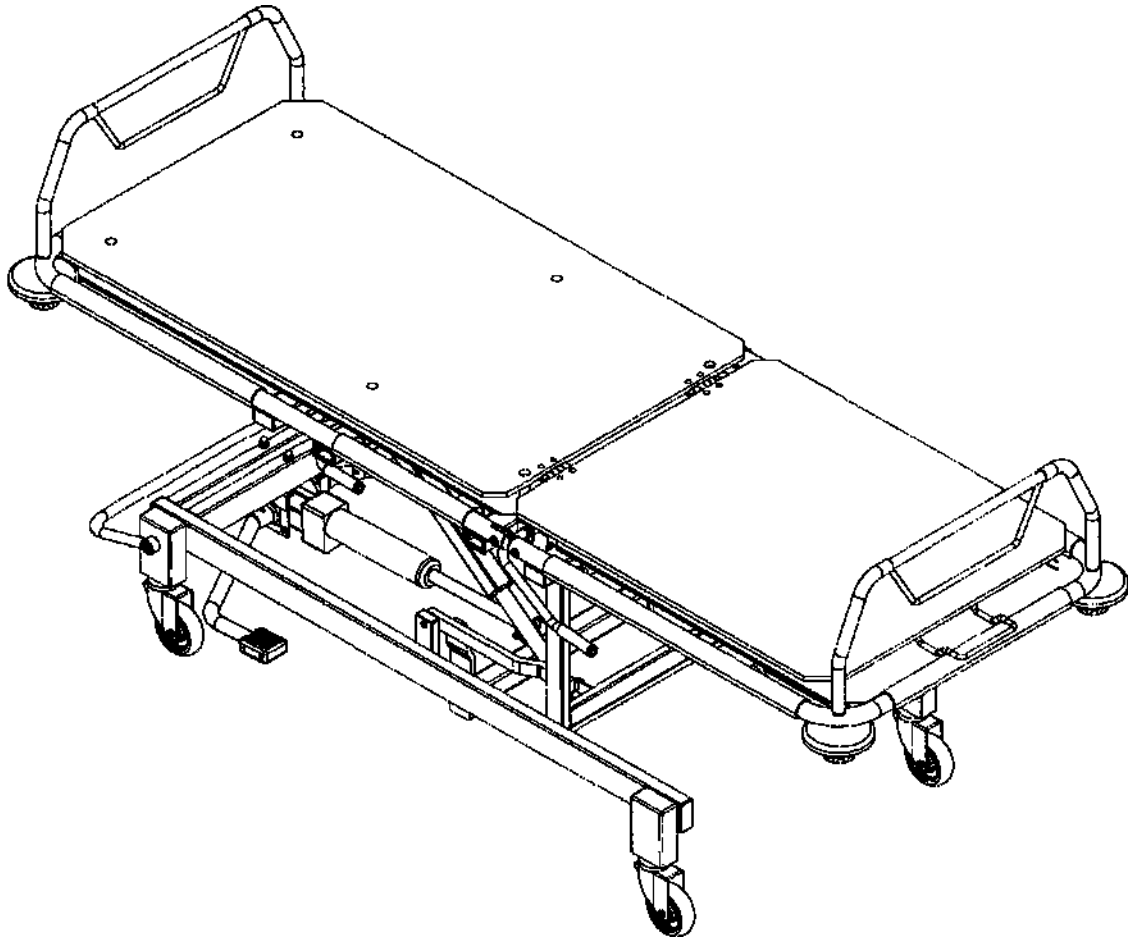

СТАВРОМЕД
Россия, Владимирская обл. Ставрово
WWW.STAVROMED.RU

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ..... 4
2 СПЕЦИФИКАЦИЯ..... 5
2.1 Паспортная табличка..... 5
2.2 Свойства и материалы..... 5
2.2.1 Условия эксплуатации..... 5
2.2.2 Данные классификации..... 6
2.2.3 Основные размеры..... 6
2.2.4 Диапазоны регулировки..... 7
2.2.5 Покрытие..... 7
3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ..... 8
3.1 Особые требования..... 8
3.2 Конструкция и регулировка..... 9
3.2.1 Центральная тормозная система..... 9
3.2.2 Регулировка высоты..... 9
3.2.3 Регулировка ножной секции..... 10
3.2.4 Регулировка спинной секции..... 10
3.2.5 Регулировка положений тренделенбург и антитренделенбург..... 10
3.2.6 Регулировка механизма облегчения усилия регулировки спинной Секции..... 10
4 ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД..... 11
4.1 Обработка..... 11
4.2 Дезинфекция..... 11
4.3 Матрацы..... 11
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ..... 12
5.1 Плановое обслуживание..... 12
5.1.1 Ежедневное техническое обслуживание..... 12
5.1.2 Ежегодное техническое обслуживание..... 12
5.2 Устранение неисправностей..... 13
5.3 Центральная тормозная система и колеса..... 14
5.3.1 Центральный тормоз..... 14
5.3.2 Регулировка тормоза..... 14
5.4 Гидравлическая система..... 15
5.4.1 Демонтаж гидроподъемника..... 15
5.4.2 Демонтаж подушки педали..... 15
5.4.3 Прокачка гидроподъемника..... 15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.5 Газовые пружины..... 16
5.5.1 Демонтаж газовой пружины спинной секции..... 16
5.5.2 Демонтаж газовой пружины из предохранительной трубы..... 16
5.5.3 Демонтаж газовых пружин регулировки положений тренделенбург и ножной секции..... 17
6 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ..... 18
6.1 Варианты исполнения ложа..... 18
6.2 Варианты исполнения рамы..... 20
6.2.1 Рама..... 21
6.2.2 Устройство подъемное..... 22
6.3 Варианты исполнения колесных опор..... 23
6.4 Приспособление для мытья пациента..... 24
6.4.1 Конструкция приспособление для мытья пациента..... 25
7 КОМПЛЕКТНОСТЬ..... 26
7.1 Комплект поставки..... 26
7.2 Дополнительное оборудование..... 26
8 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... 27
8.1 Свидетельство о приемке..... 27
8.2 Гарантия изготовителя..... 27
Гарантийная ведомость..... 27
Гарантийный талон..... 28

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1 ВВЕДЕНИЕ

Для правильной и безопасной эксплуатации, а так же соответствующего технического обслуживания каталки строго соблюдайте данную инструкцию.

Для предупреждения и особого обращения внимания в данной инструкции приняты следующие обозначения:

ОСТОРОЖНО!	Соблюдать с целью обеспечения безопасности пациента
ВНИМАНИЕ!	Соблюдать во избежание повреждения каталки и ее частей
	Смазывать при проведении технического обслуживания и замене частей каталки

Каталка больничная функциональная секционной конструкции "Ставро-Мед" соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, для группы 3 класса Г, ТУ 9451-003-90667469-2012, комплектам конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке

Область применения

Каталка "Ставро-Мед" предназначена для транспортировки пациента внутри отделения, больницы или для межбольничной транспортировки, а так же для проведения плановых и неотложных процедур в стационарах и амбулаторных условиях.

СТАВРОМЕД™ – знак качества!
Разработка и производство медицинской функциональной мебели и средств реабилитации - главное направление работы Ставровского завода медицинского оборудования (ООО "Ставро - Мед"). Постоянная работа по внедрению технических новинок позволяет нашей продукции соответствовать самым современным требованиям высокотехнологичной медицины. Контроль качества на каждом этапе полного производственного цикла позволяет нам превосходить лучшие зарубежные аналоги по соотношению "цена - качество и функционал"

В основе нашего подхода к созданию и последующей эксплуатации изделий лежат основополагающие принципы:
- высокое качество и надежность, эстетичность и функциональность изделий;
- широкий выбор вариантов использования и комплектации дополнительным оборудованием;
- ориентация на потребности клиента;
- забота об удобстве персонала и пациентов;
- оперативное гарантированное и сервисное обслуживание;

Если Вам требуется более подробная информация или изготовление по вашему техническому заданию, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам: (49242) 5-24-04, 5-16-84, 5-16-70.

Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО 13485-2004 производство лицензировано, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения. Технические параметры изделий полностью соответствуют заявленным в описаниях и технических условиях, что подтверждено заключением независимой экспертизы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1 Паспортная табличка

Паспортная табличка находится под спинной секцией

См. инструкцию

Безопасная рабочая нагрузка (с учетом массы пациента, матраца и дополнительных принадлежностей)

2.2 Свойства и материалы

2.2.1 Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	(+10...+35)^{0}C
Внешнее давление	(630...800) мм.рт.ст
Относительная влажность	Не более 80% при t=25^{0}C
Температура при транспортировке	(-45...+45)^{0}C
Температура хранения	(-50...+40)^{0}C
Безопасная рабочая нагрузка (с учетом массы пациента, матраца и доп. принадлежностей)	225 кг
Безопасная рабочая нагрузка (с учетом массы пациента, матраца и доп. принадлежностей) для каталок 2-х секционных механических	170 кг

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.2.2 Данные классификации

Защита от поражения электрическим током	Оборудования класса 1
Степень защиты от поражения электрическим током	Оборудования типа В
Водонепроницаемость	Класс защиты IP54
Обработка и дезинфекция	см п. 4.1 на стр.12
Тип функционирования	периодический

2.2.3 Размеры

Характеристики		Каталка больничная функциональная секционной конструкции		
Количество секций		1	2	3
Ширина А, мм		760	750	750
Длина Б, мм без подрамника с подрамником		2020	2075 2150	2075 2150
Высота С, мм, для колеса диаметром 150 мм.		без регулировки		715
		регулировка гидроподъемником		535-935
		регулировка гидроподъемником с ренгенопрозрачным ложем		600-1000
		регулировка гидроподъемником с приспособлением для мытья пациента		530-960
Масса, кг	нетто	58...110**	58...110**	58...110**
	брутто	160...210**	160...210**	160...210**

** В зависимости от комплектования

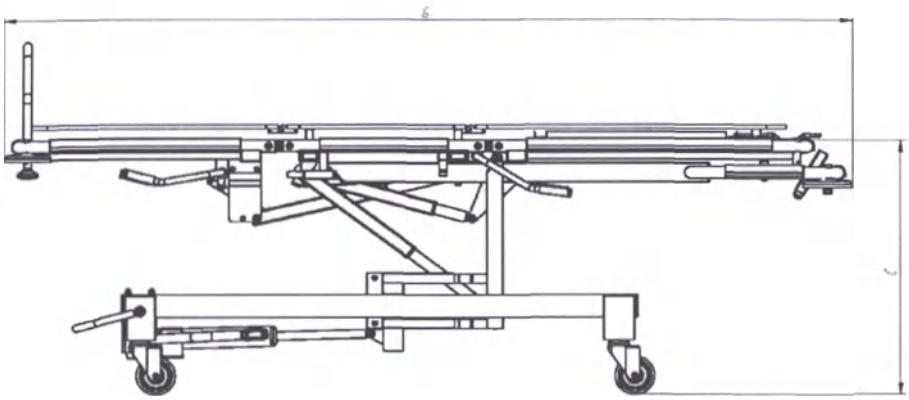

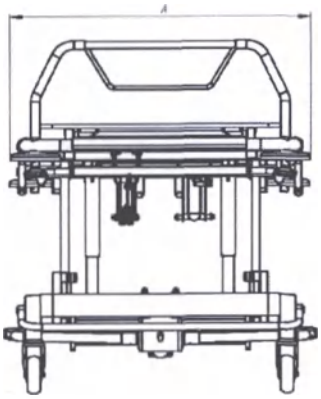

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.2.4 Диапазоны регулировки

Характеристики	Каталка больничная функциональная секционной конструкции		
Количество секций	1	2	3
Регулировка спинной секции, град	нет	в диапазоне от 0...+70	в диапазоне от 0...+70
Регулировка ножной секции, град	нет	нет	в диапазоне от -45...0
Регулировка положения тренделенбург, град	в диапазоне от -6...0	в диапазоне от -14...0	в диапазоне от -14...0
Регулировка положения антитренделенбург, град	в диапазоне от +10...0	в диапазоне от +7...0	в диапазоне от +7...0

2.2.5 Покрытие

Узлы каталки	Покрытие	
	Хромирование	Порошковое напыление
Каркас каталки	нет	Да
Ложе каталки	Да	Да
Рычаги регулировок секций	Да	Да
Педали регулировки высоты	Да	Да
Рычаг центрального тормоза	Да	Да

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Особые требования

Выньте каталку из упаковки, проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке, при необходимости (транспортировка производилась при низких температурах) дайте ей прогреться до комнатной температуры (не менее 4 часов).

Упаковку необходимо утилизировать.

ОСТОРОЖНО!

Максимальная допустимая нагрузка на каталку составляет не более 225 кг.

Безопасная рабочая нагрузка для каталок 2-х секционных механических составляет не более 170 кг.

При перемещении каталки приведите ложе в среднее положение

Для увеличения срока службы каталки всегда следует преодолевать пороги, ступеньки (либо другие препятствия) ножной секцией вперед.

! При регулировке каталки проверьте, чтобы пальцы, кисти рук или другие части тела не попали между подвижными узлами кровати или между дополнительными принадлежностями и каталкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.2 Конструкция и регулировка

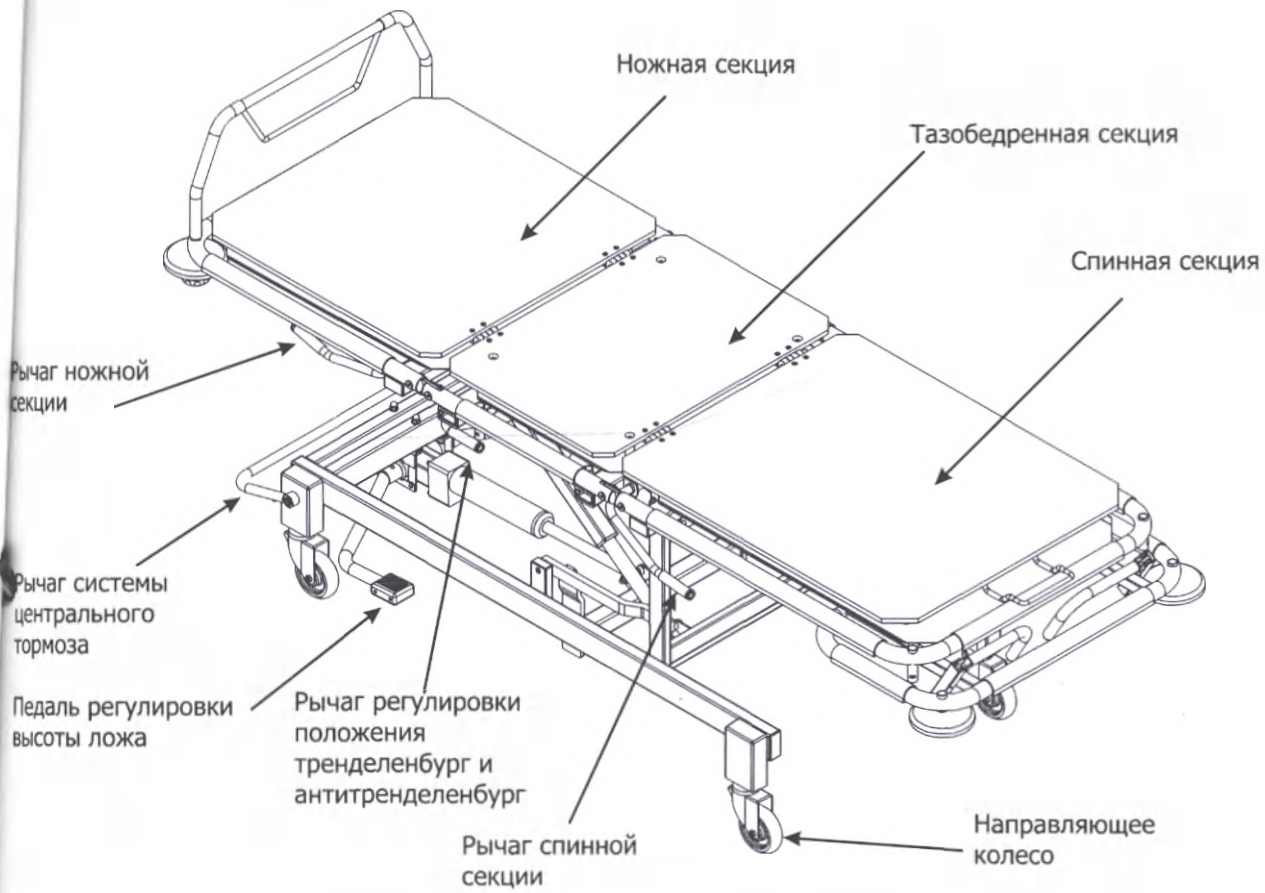

Каталка больничная функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед» с ложем из рентгенопрозрачного пластика

3.2.1 Центральная тормозная система

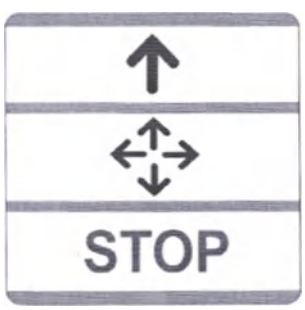

При поднятии рычага направляющее колесо блокируется в положении поворота

При перемещении рычага в среднее положение все колеса поворачиваются

При перемещении рычага в нижнее положение все колеса блокируются

3.2.2 Регулировка высоты

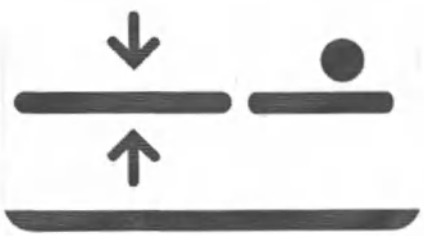

При нажатии педали регулировки высоты ложе поднимается

При подъеме педали ложе опускается

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.2.3 Регулировка ножной секции

Поверните рычаг ножной секции, придерживая каркас ножной секции другой рукой

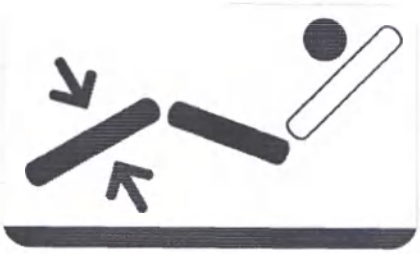

3.2.4 Регулировка спинной секции

Поверните рычаг спинной секции, придерживая каркас спинной секции другой рукой

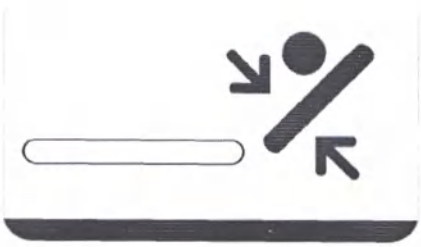

3.2.5 Регулировка положений тренделенбург и антитренделенбург

Поверните рычаг регулировки положений тренделенбург и антитренделенбург, придерживая каркас ножной секции другой рукой

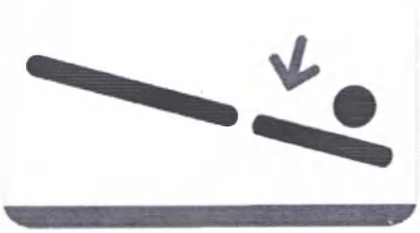

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4 ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД

4.1 Обработка

ВНИМАНИЕ!

Обязательно отключите оборудование от сети переменного тока перед проведением обработки

Снимите все дополнительные принадлежности и матрац

Протрите слабощелочным моющим средством (pH 7-8)

4.2 Дезинфекция

Снимите все дополнительные принадлежности и матрац

Дезинфекцию проводить только при необходимости

Протрите оборудование дезинфицирующим средством для поверхностей, используемым в лечебном учреждении, согласно инструкции производителя.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использовать дезинфицирующие средства, содержащие спирт и фенол, которые могут разъедать пластиковые узлы каталки и матрац

4.3 Матрацы

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с инструкцией по уходу за матрацами

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

5.1 Плановое обслуживание

Сделайте отметку в настоящем руководстве каталки о начале эксплуатации. Эта дата служит началом отсчета для проведения ежегодного технического обслуживания

5.1.1 Ежедневное техническое обслуживание

Проведите обработку каталки. Визуально осмотрите все узлы каталки для выявления ослабления винтов, узлов каталки, наличие трещин, повреждений.

5.1.2 Ежегодное техническое обслуживание

Смажьте машинным маслом все трущиеся соединения

Проверьте состояние газовых пружин

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.2 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Метод устранения
Ложе каталки не поднимается	Воздух в гидросистеме Низкий уровень масла	Прокачайте гидроподъемник
	Гидроподъемник не исправен	Замените гидроподъемник
Ложе каталки не опускается полностью	Воздух в гидросистеме	Прокачайте гидроподъемник
Ложе каталки не остается в отрегулированном положении	Неисправность клапана Негерметичность Загрязнение гидросистемы	Замените гидроподъемник
Каталка наклоняется в одну сторону во время движения	Заклинило колесную опору	Замените колесную опору
Не регулируются по углу наклона секции	Повреждение газовой пружины Неправильная установка газовой пружины	Замените газовую пружину

Внимание!

! Газовые пружины заполнены газом под высоким давлением. Разборка газовых пружин строго запрещается.

Внимание!

Замена узлов каталки может осуществляться только представителем сервисной службы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.3 Центральная тормозная система

5.3.1 Центральный тормоз

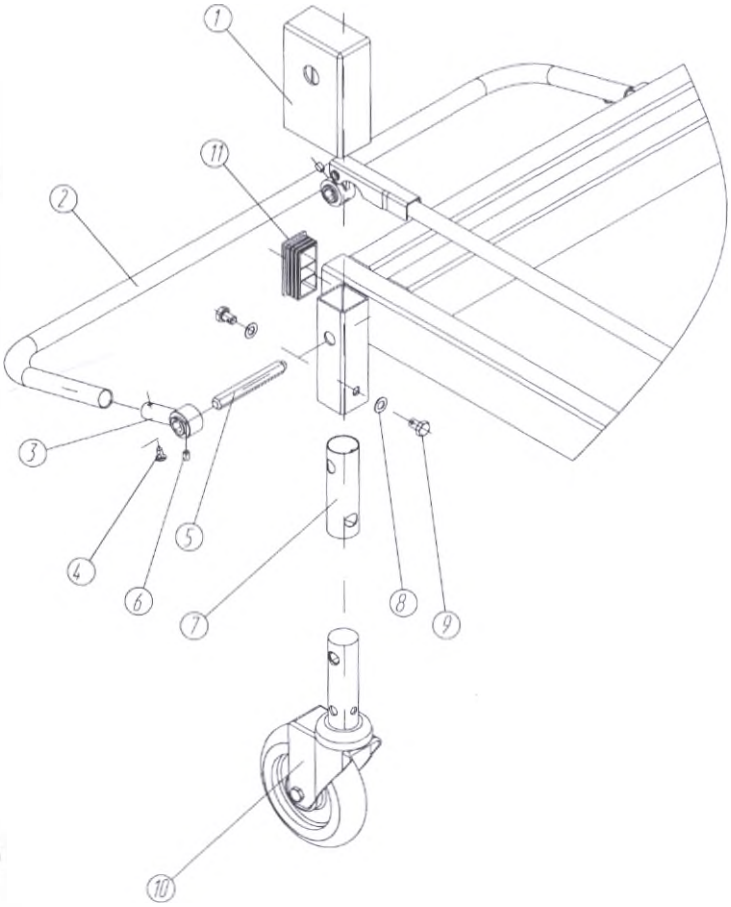

1) Приведите рычаг тормоза (поз.2) в свободное положение (по центру)
2) Снимите винт (поз.4)
3) Снимите рычаг (поз.2) с пальца (поз.3)
4) Снимите заглушку (поз.11)
5) Ослабьте установочный винт (поз.6)
6) Извлеките палец (поз.3) и ось (поз.5)
7) Снимите панель (поз.1)
8) Открутите болт (поз.9) снимите шайбу (поз.8)
9) Извлеките колесную опору (поз.10)

Установка колесной опоры производится в обратном порядке

5.3.2 Регулировка тормоза

1) Нажмите рычаг тормоза (поз.2)
2) Снимите винт (поз.4)
3) Снимите рычаг (поз.2) с пальца (поз.3)
4) Снимите заглушку (поз.11)
5) Ослабьте установочный винт (поз.6)
6) Извлеките палец (поз.3) и ось (поз.5)
7) Снимите панель (поз.1)
8) Открутите болт (поз.9) снимите шайбу (поз.8)
9) Придерживайте каталку таким образом, чтобы регулируемая колесная опора находилась над полом.

10) Тормозное усилие возрастает при повороте колеса по часовой стрелке на половину оборота за один раз

ВНИМАНИЕ!

Направляющая колесная опора находится по правую сторону от секции головы.

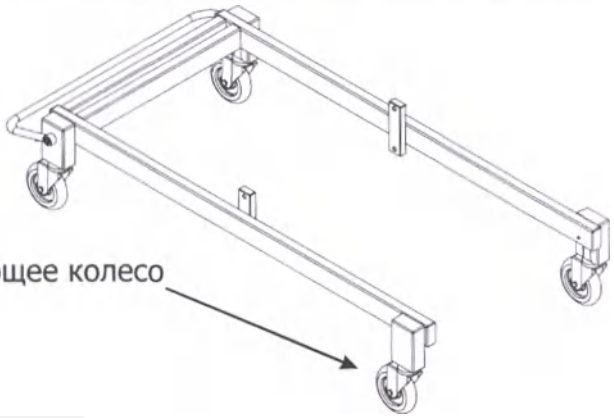

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.4 Гидравлическая система

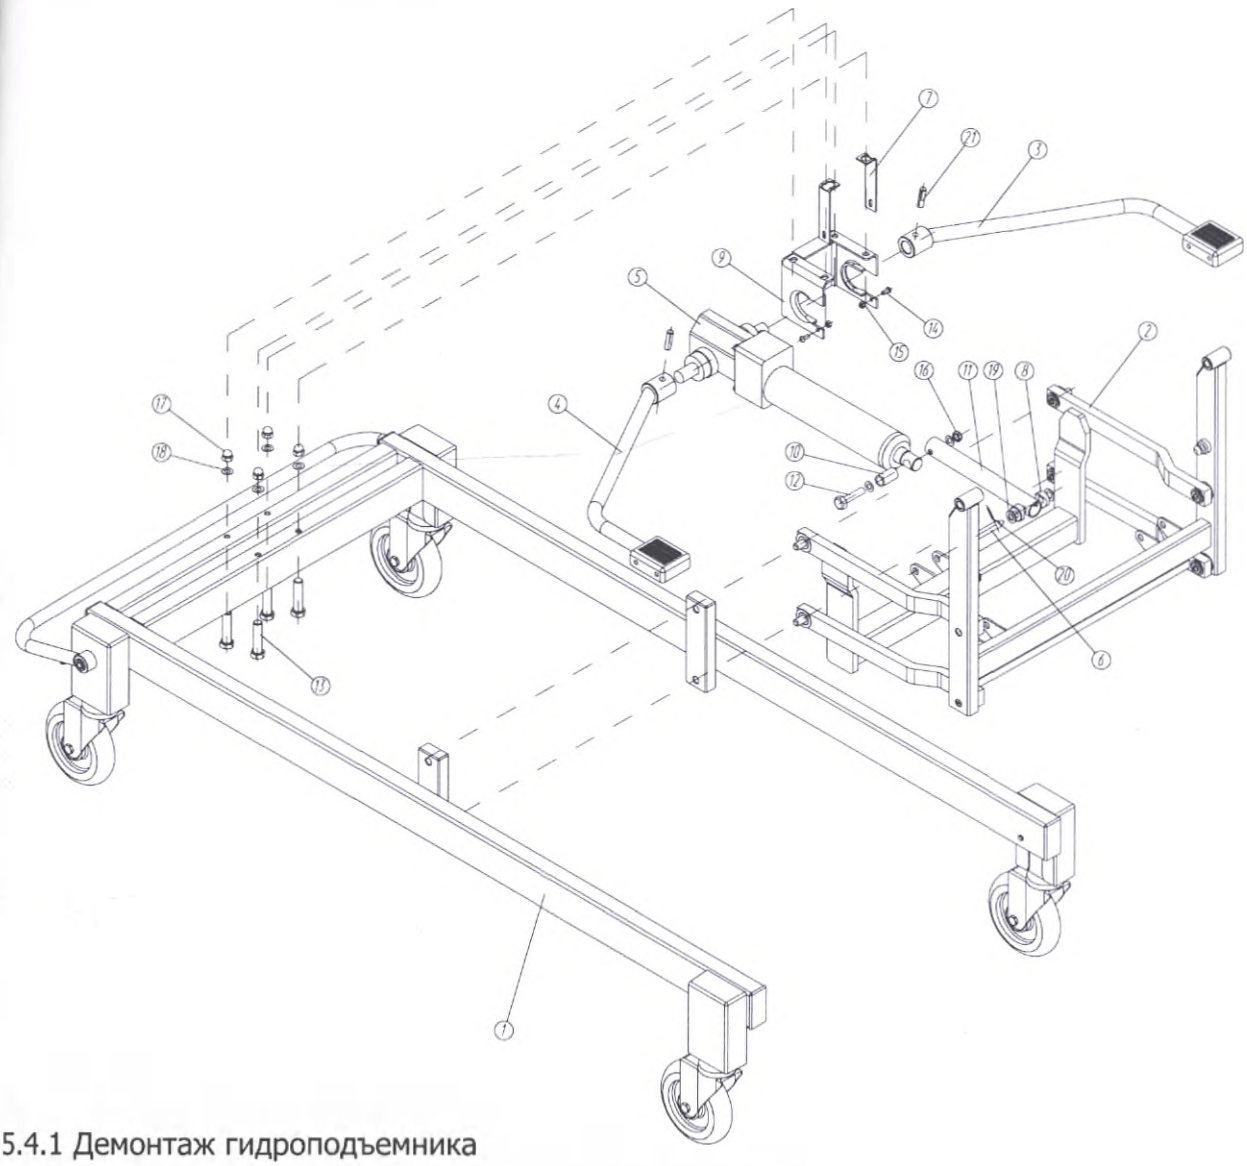

5.4.1 Демонтаж гидроподъемника

1) Приведите ложе каталки в вертикальное положение
2) Снимите стопорное кольцо (поз.20)
3) Снимите ось (поз.6), шайбы (поз.19) и втулки (поз.8)
4) Открутите винты (поз.14) и гайки (поз.15)
5) Извлеките гидроподъемник (поз.5) из коробки (поз.9)

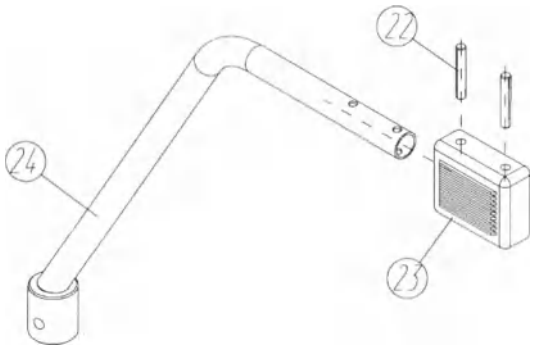

5.4.2 Демонтаж подушки педали

1) Снимите стопорный винт (поз.21)
2) Снимите штифты (поз.22)
3) Снимите подушку (поз.23) с рычага педали (поз.24)

5.4.3 Прокачка гидроподъемника

1) Приведите ложе каталки в вертикальное положение
2) Сделайте еще 2-4 нажатия
3) Опустите ложе в рабочее положение

Гидроподъемник оснащен механизмом автоматической прокачки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.5 Газовые пружины

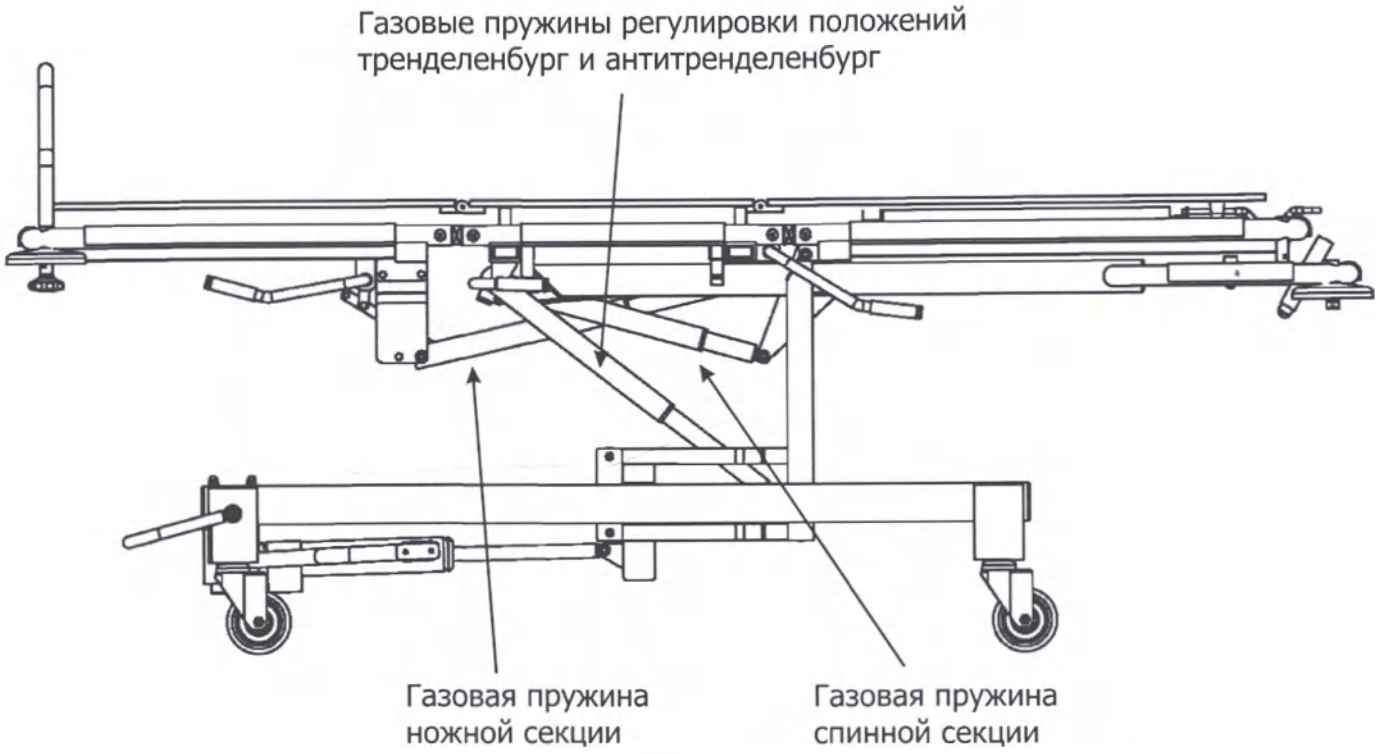

5.5.1 Демонтаж газовой пружины спинной секции

Приведите спинную секцию в вертикальное положение, подставив под нее упор

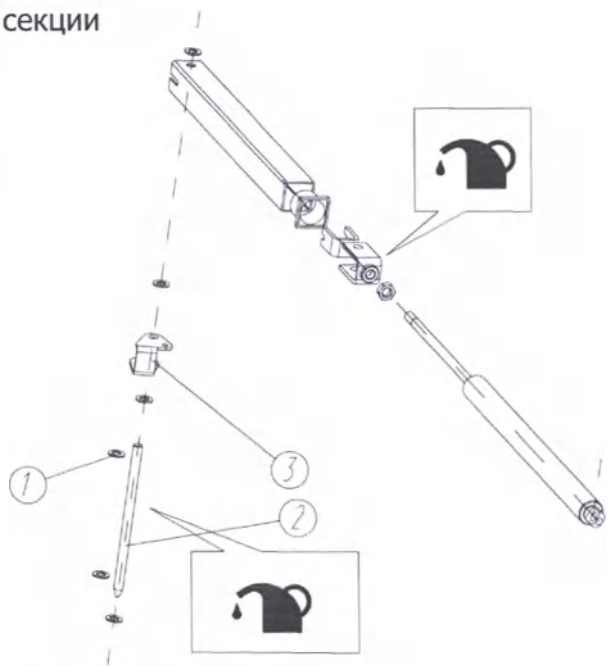

1) Снимите стопорное кольцо (поз.1)
2) Снимите скобу (поз.3)
3) Демонтируйте ось (поз.2)

5.5.2 Демонтаж газовой пружины из предохранительной трубы

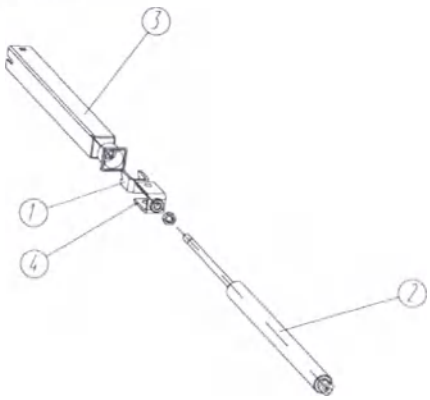

1) Снимите крепление газовой пружины (поз.1)
2) Выньте газовую пружину (поз.2) из трубы (поз.3)
3) Открутите скобу (поз.4)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.5.3 Демонтаж газовых пружин регулировки положений тренделенбург и ножной секции

Приведите каталку в положение тренделенбурга, подставив под нее упор

1) Снимите стопорное кольцо (поз.5)
2) Демонтируйте ось (поз.4)
3) Демонтируйте втулки (поз.3)
4) Снимите стопорное кольцо (поз.1)
5) Демонтируйте ось (поз.2)

Демонтаж газовых пружин из предохранительной трубы см п.5.5.2 настоящей инструкции

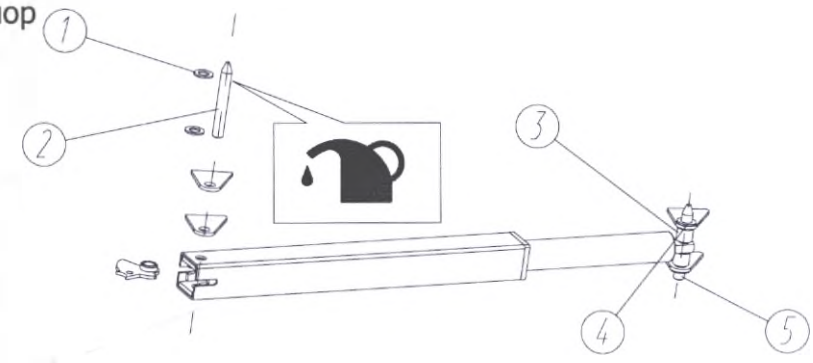

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

6.1 Варианты исполнения ложа

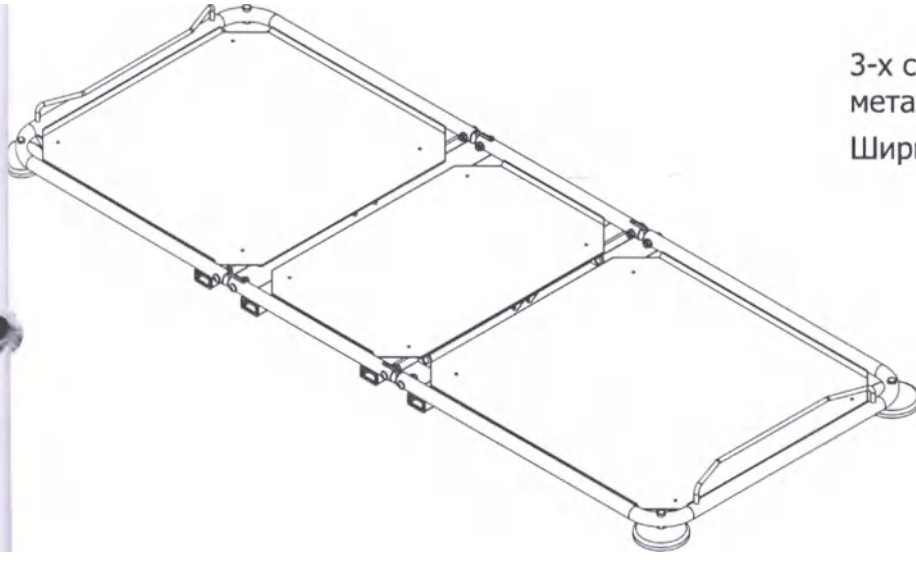

3-х секционное ложе с металлическими листами

Ширина ложа 700 мм

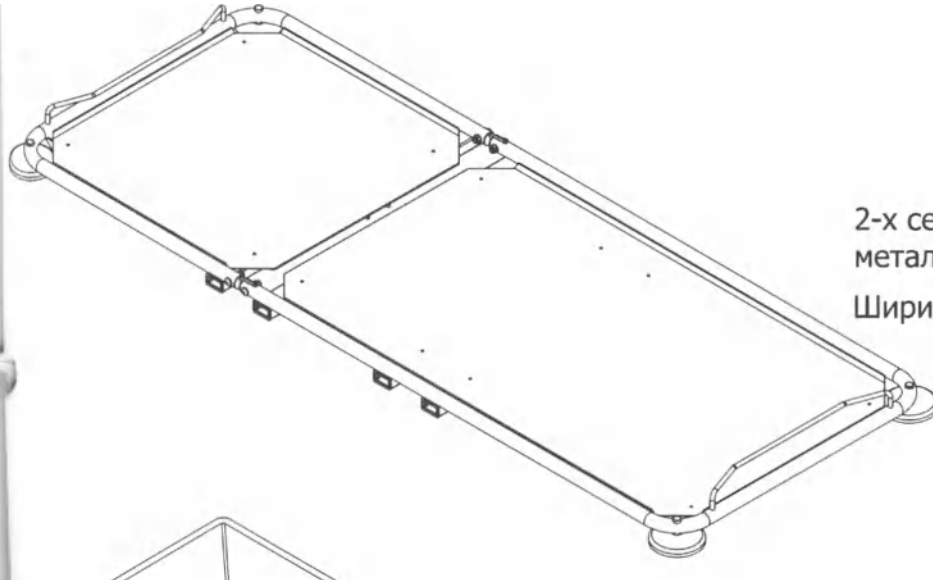

2-х секционное ложе с металлическими листами

Ширина ложа 700 мм

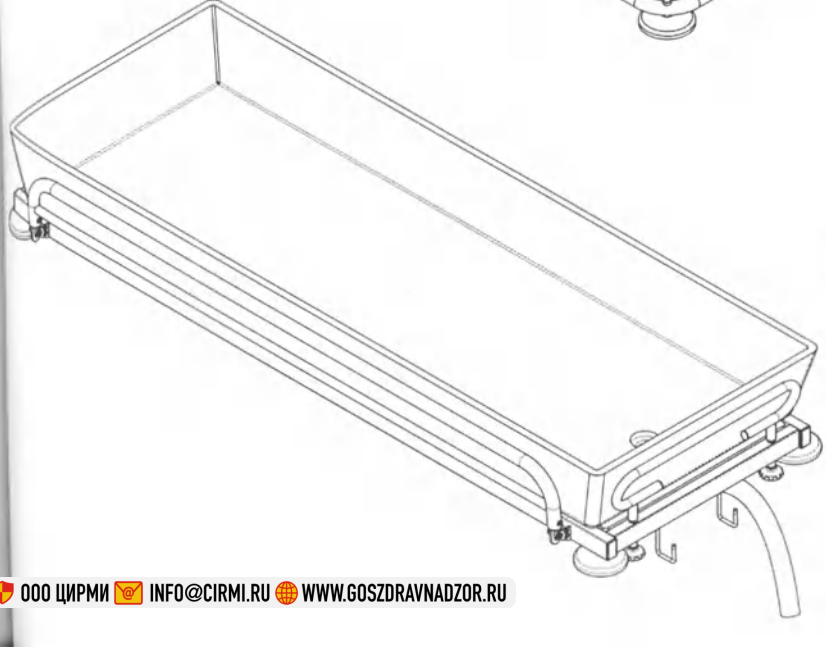

1 секционное ложе с приспособлением для мытья пациента

Ширина ложа 660 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

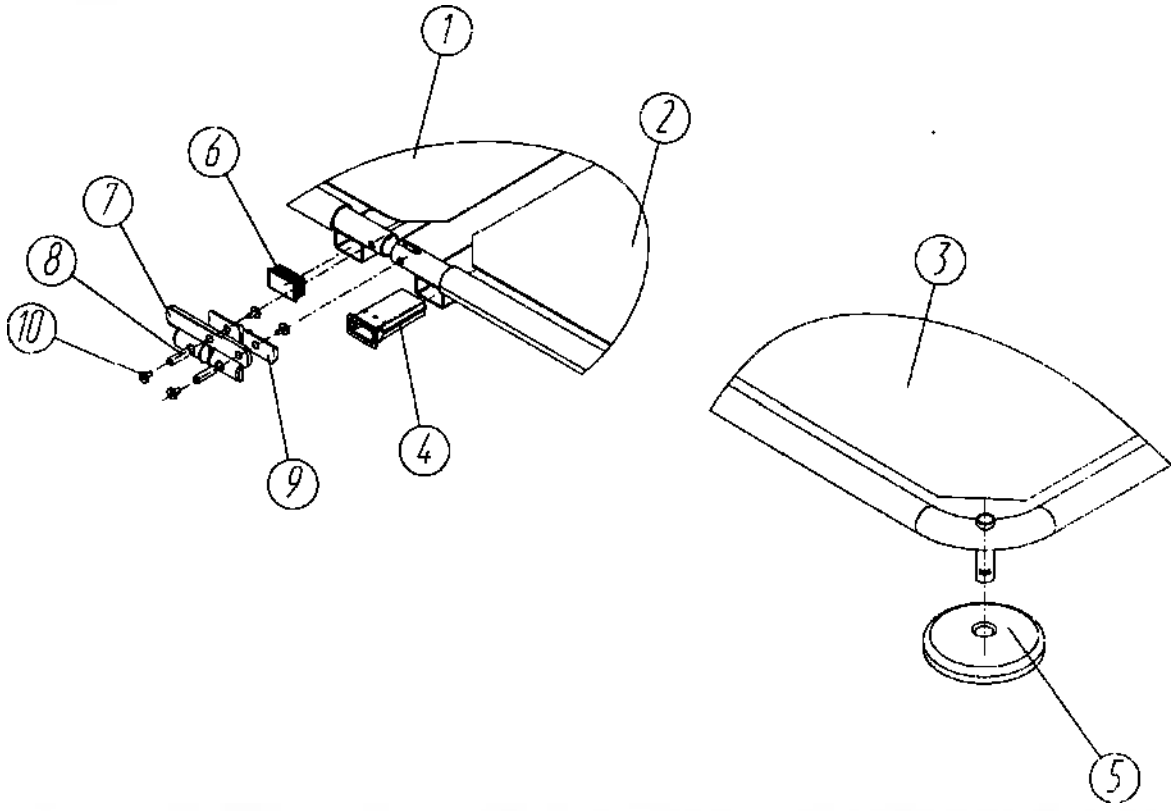

Поз.	Наименование детали	Обозначение детали	Количество деталей	
			2-е секции	3-и секции
1	Лист	480.03.01.003		1
2	Лист	480.03.01.002		1
2	Лист	420.03.01.002	1	
3	Лист	420.03.01.001	1	1
4	Крышка	120.03.01.006	4	4
5	Буфер	120.03.01.005	4	4
6	Заглушка		2	4
7	Штанга	120.03.01.003	2	4
8	Втулка резьбовая	120.03.01.010	4	8
9	Пробка	120.03.01.004	8	16
10	Винт М6х12		8	16

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2 Варианты исполнения рамы

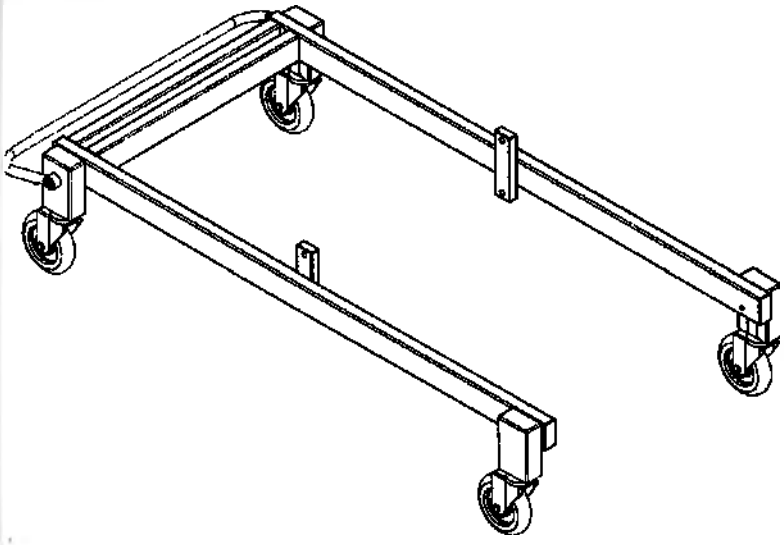

Рама без механизма подъема ложа

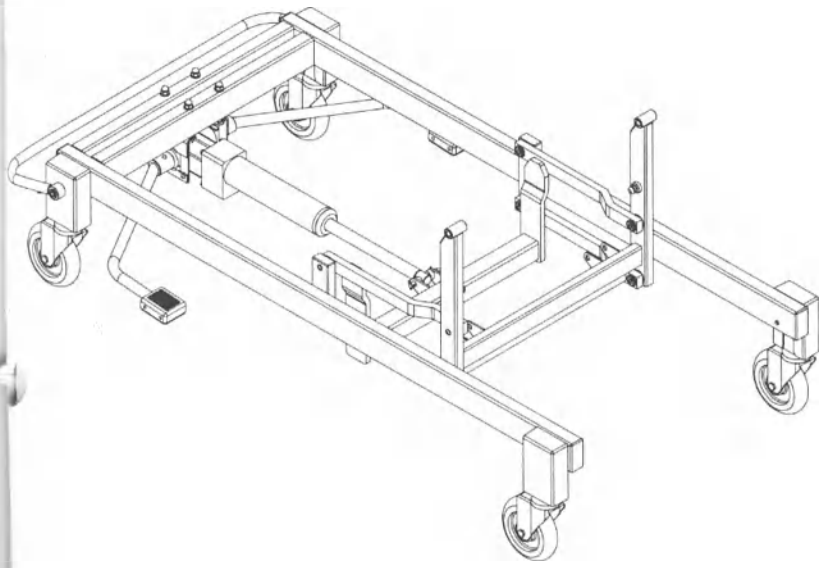

Рама с гидравлическим механизмом подъема ложа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2.1 Рама

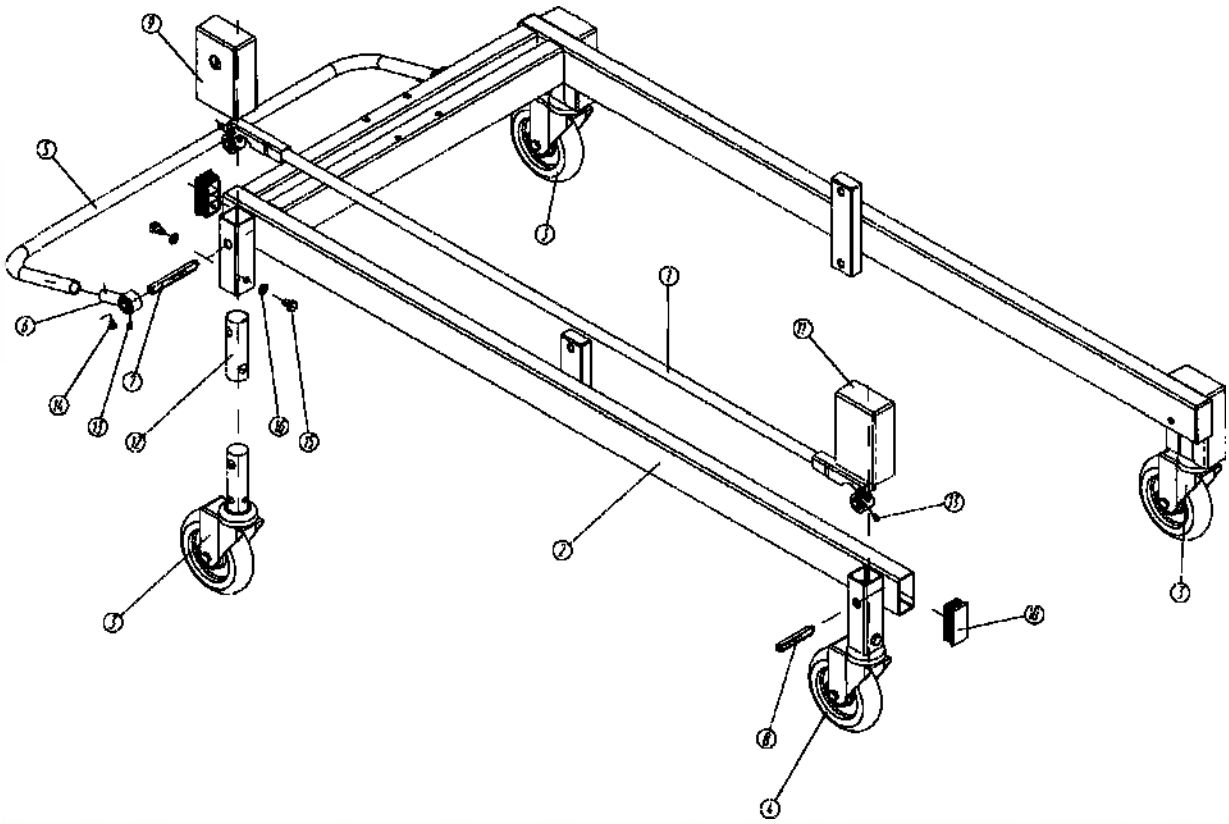

Поз.	Наименование детали	Обозначение детали	Количество деталей
1	Тяга в сборе	120.01.02.000	2
2	Каркас	180.01.01.100	1
3	Колесная опора	серия 2476 PJO	3
4	Колесная опора	серия 2474 PJO	1
5	Рычаг	120.01.00.001	1
6	Палец	120.01.00.002	2
7	Вал	120.01.00.003	2
8	Вал	120.01.00.004	2
9	Панель	120.01.00.005	2
10	Заглушка	120.01.00.006	4
11	Панель	120.01.00.007	2
12	Втулка	127.00.00.001	4
13	Винт установочный М6х8	DIN 914	6
14	Винт М5х12	ГОСТ 17473-80	2
15	Болт М8х12	ГОСТ 7798-70	8
16	Шайба стопорная 8	DIN 6798	8

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2.2 Устройство подъемное

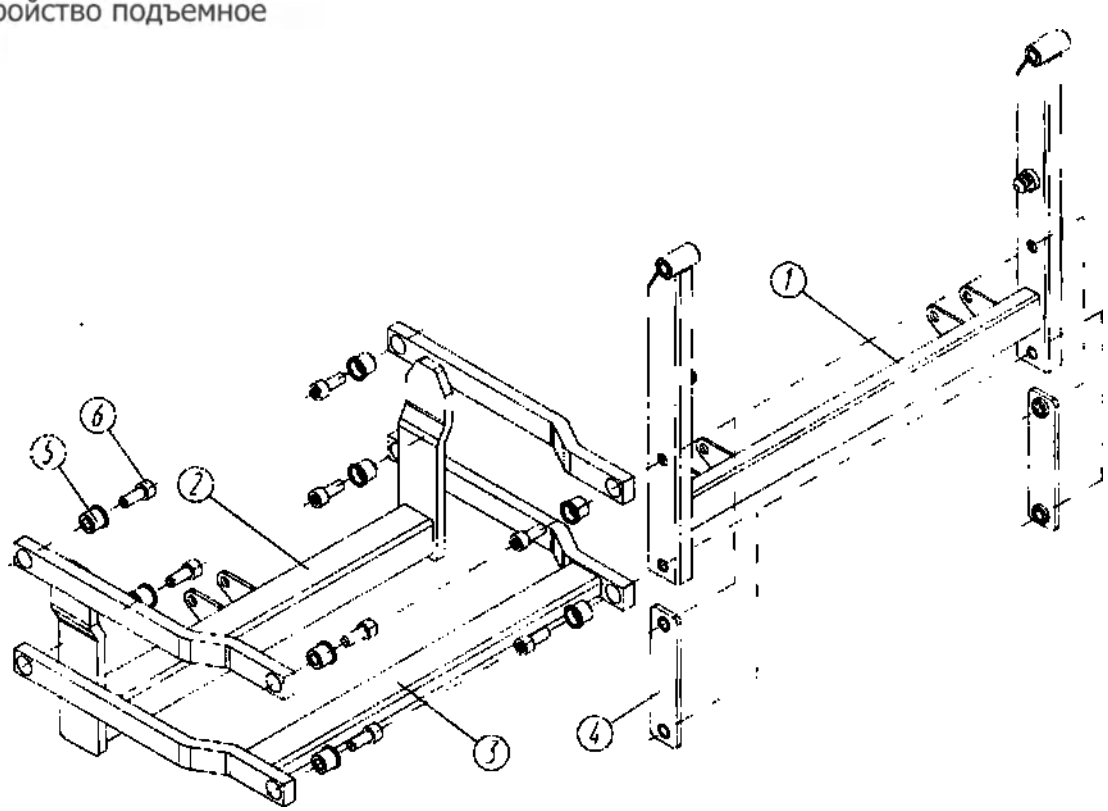

Поз.	Наименование детали	Обозначение детали	Количество деталей
1	Опора в сборе	420.02.01.000	1
2	Рама подъемная	180.02.02.000	1
3	Рычаг упорный	180.02.03.000	1
4	Фиксатор в сборе	120.02.00.100	2
5	Втулка опорная	DSC 0101-08-25/1	8
6	Винт М10х25	DIN 912	8

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.3 Варианты исполнения колесных опор

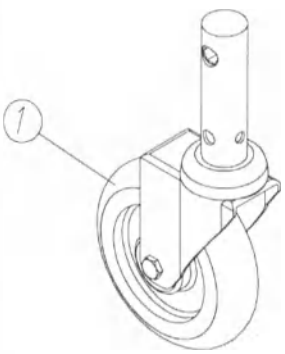

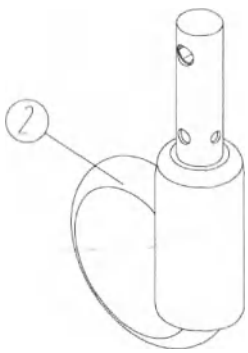

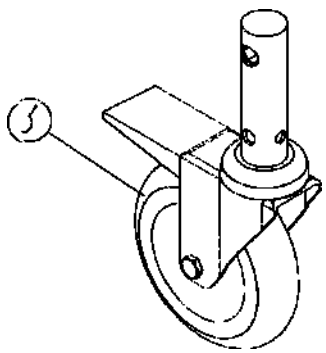

Поз.	Наименование детали	Обозначение детали	Диаметр колеса, мм
1	Направляющее колесо	2474 PJO 100 R26-28S 45	∅ 100
	Направляющее колесо	2474 PJO 125 R26-28S 45	∅ 125
	Направляющее колесо	2474 PJO 150 R26-28S 45	∅ 150
	Поворотное колесо	2476 PJO 100 R26-28S 45	∅ 100
	Поворотное колесо	2476 PJO 125 R26-28S 45	∅ 125
	Поворотное колесо	2476 PJO 150 R26-28S 45	∅ 150
2	Направляющее колесо	2044 UAP 100 R26-28S 45	∅ 100
	Направляющее колесо	2044 UAP 125 R26-28S 45	∅ 125
	Направляющее колесо	2044 UAP 150 R26-28S 45	∅ 150
	Поворотное колесо	2046 UAP 100 R26-28S 45	∅ 100
	Поворотное колесо	2046 UAP 125 R26-28S 45	∅ 125
	Поворотное колесо	2046 UAP 150 R26-28S 45	∅ 150
3	Поворотное колесо	2470 PJP 100 R05	∅ 100
	Поворотное колесо	2470 PJP 125 R05	∅ 125
	Поворотное колесо	2470 PJP 150 R05	∅ 150
	Поворотное колесо с тормозом	2477 PJP 100 R05	∅ 100
	Поворотное колесо с тормозом	2477 PJP 125 R05	∅ 125
	Поворотное колесо с тормозом	2477 PJP 150 R05	∅ 150

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.4 Приспособление для мытья пациента

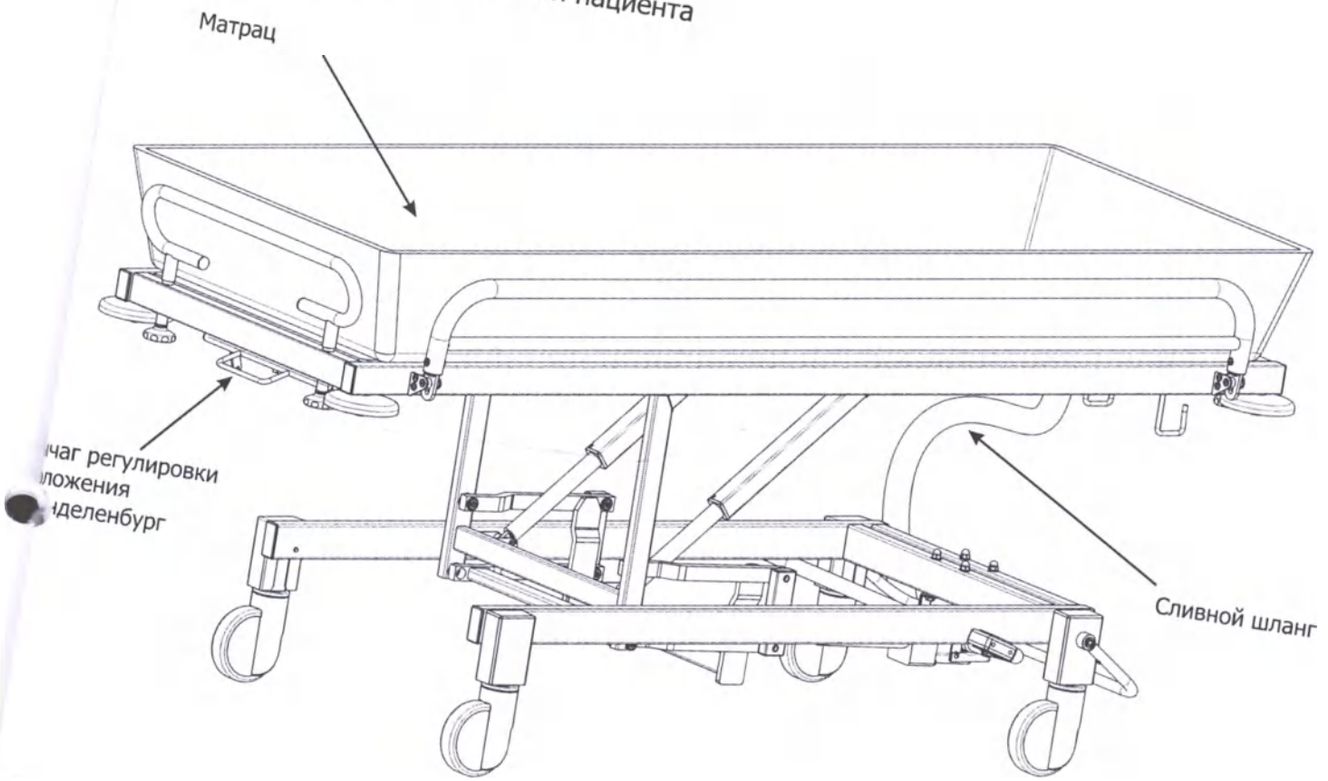

Каталка больничная функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед» с приспособлением для мытья пациента

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.4.1 Конструкция приспособление для мытья пациента

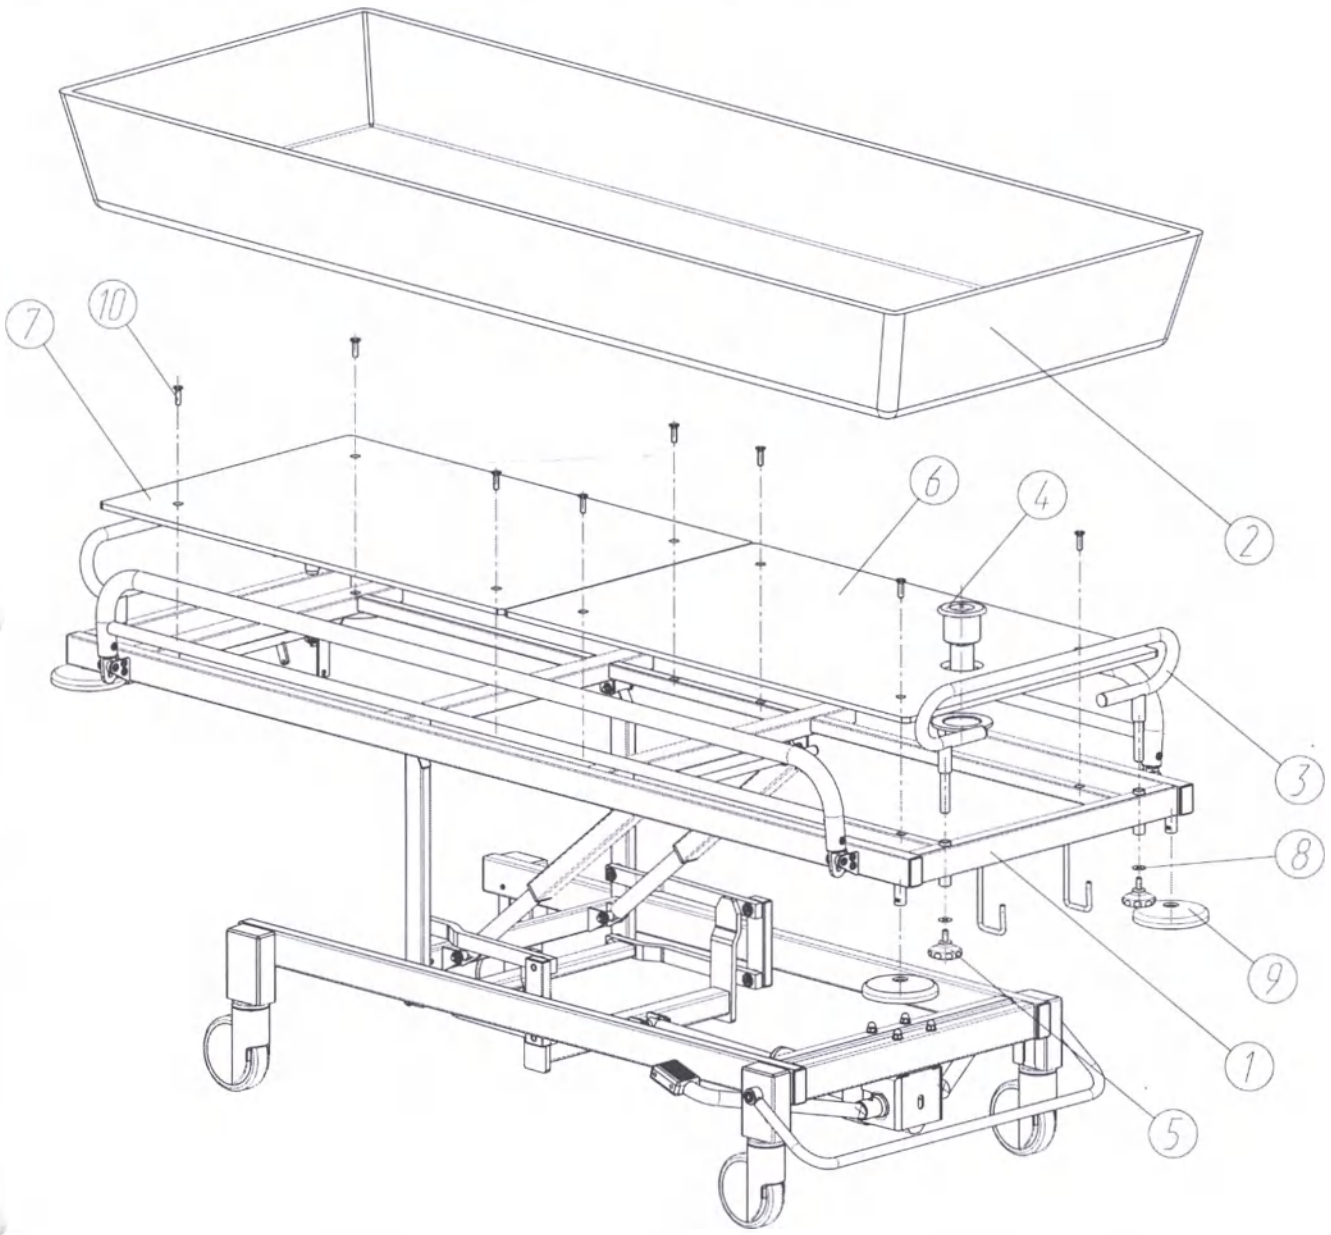

Поз.	Наименование детали	Обозначение детали	Количество деталей
1	Каркас ложа	420.19.03.100	1
2	Матрац	420.19.04.100	1
3	Рукоятка	420.19.06.100	2
4	Разъем водосброса		1
5	Маховик зажимной	R3.40001-80	4
6	Лист HPL	420.19.07.002	1
7	Лист HPL	420.19.07.001	1
8	Шайба 8	DIN 9021	4
9	Буфер	120.03.01.005-Ж	4
10	Винт M8x30	DIN7991 A2	16

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

7.1 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

Каталка больничная функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед»	1 шт.
Руководство по эксплуатации и обслуживанию	1 шт.

7.2 Комплект принадлежностей

По требованию потребителя каталки комплектуются дополнительными принадлежностями (комплектно и по отдельности) согласно конструкторской документации:

- матрац	1 шт.
- пара боковых ограждений	1 шт.
- складывающаяся рукоятка для перемещения	1 шт.
- стойка для вливаний	1 шт.
- держатель стойки для вливаний	1 шт.
- держатель для кислородных баллонов	1 шт.
- держатель рентгеновской кассеты	1 шт.
- корзины для принадлежностей	1 шт.
- лотки для принадлежностей	1 шт.
- решетчатая корзина	1 шт.
- опоры для рук	1 шт.
- рельсы для крепления принадлежностей	1 шт.
- рукоятки для перемещения	1 шт.
- подставка для монитора	1 шт.
- держатель рулона бумаги	1 шт.
- комплект ремней для пациента	1 шт.
- приспособление для мытья пациента	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Свидетельство о приемке

Каталка больничная функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед»

Заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ9451-003-90667469-2012 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____

М.П.

_____

(личные подписи (оттиски личных клейм)
должностных лиц предприятия,
ответственных за комплектацию изделия)

8.2 Гарантия изготовителя

8.2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каталки требованиям ТУ9451-003-90667469-2012 при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

8.2.2 Гарантийный срок эксплуатации месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более месяцев со дня продажи (отгрузки) производителем. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет каталку или ее узлы по предъявлению гарантийного талона.

8.2.3 Пересылка каталок, подлежащих гарантийному ремонту, производится за счет предприятия-изготовителя.

8.2.4 При направлении каталки на гарантийный ремонт необходимо приложить гарантийный талон.

8.2.5 Средний срок службы каталки составляет 5 лет.

8.2.6 Предприятие-изготовитель вправе вносить незначительные изменения (не влияющие на основные свойства каталки) в конструкцию каталки, при этом не уведомлять потребителя, а так же не вносить изменения в настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию

8.3 Сведения о рекламациях

8.3.1 В случае неисправности каталки в период действия гарантийных обязательств, а так же обнаружения некомплектности при ее первичной приемке, владелец каталки должен направить рекламации в адрес предприятия-изготовителя, а в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- Заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;
- Гарантийную ведомость;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Гарантийная ведомость

Дата возникновения поломки (неисправности)	Продолжительность работы каталки до возникновения поломки	Краткое содержание поломки или неисправности	Меры, принятые по рекламации	Приме чание

Гарантийный талон

Корешок талона № _____

На гарантийный ремонт каталки больничной
функциональной секционной конструкции «Ставро-Мед» _____

Изъят "___" _____ 20__ г. Сервисная служба _____
личная подпись

(линия отреза)

ООО "Ставро-Мед"

601220, РФ, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул.Октябрьская, 118

ТАЛОН №_____

Каталка больничная функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед» _____
(обозначение)

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

Дата изготовления _____

Заводской номер № _____

Продана магазином _____
(наименование)

Дата продажи "____" _____ 20__ г.

_____
(подпись) М.П.

Владелец и его адрес _____

_____
(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей _____

_____

_____

Наименование сервисной службы _____

"____" _____ 20__ г.

Сервисная служба _____
(подпись) М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано
скреплено печатью 28 листа (ов).

Коммерческий директор

/ Бжезинский С.А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU