

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

Н.А. Горшкова
«16» мая 2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Реагент дополнительный для T3/T4/VB12 для анализаторов иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM T3/T4/VB12 Ancillary Reagent (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

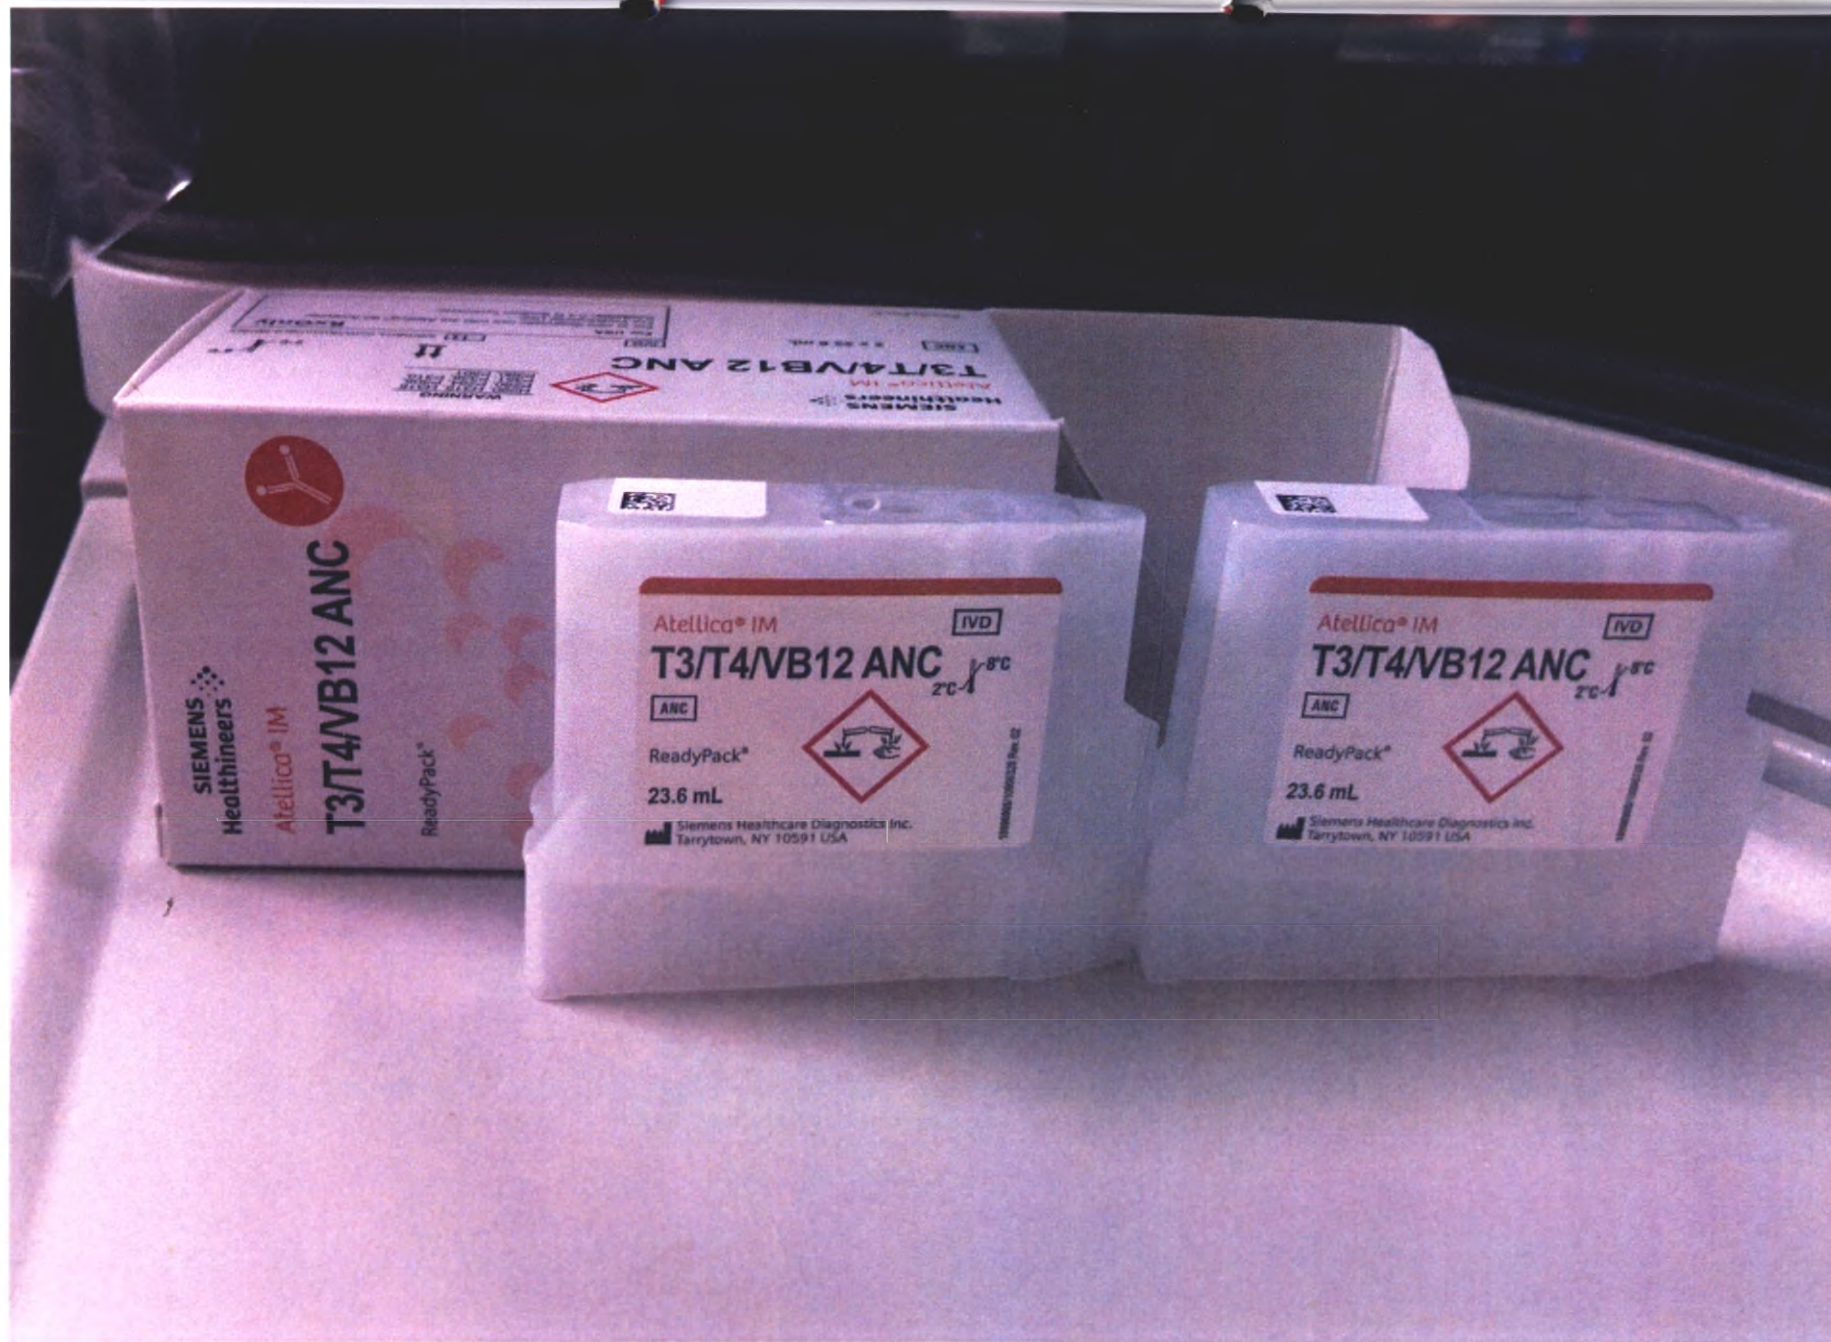


Рисунок 1. Реагент дополнительный для T3/T4/VB12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM T3/T4/VB12 Ancillary Reagent (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC)):

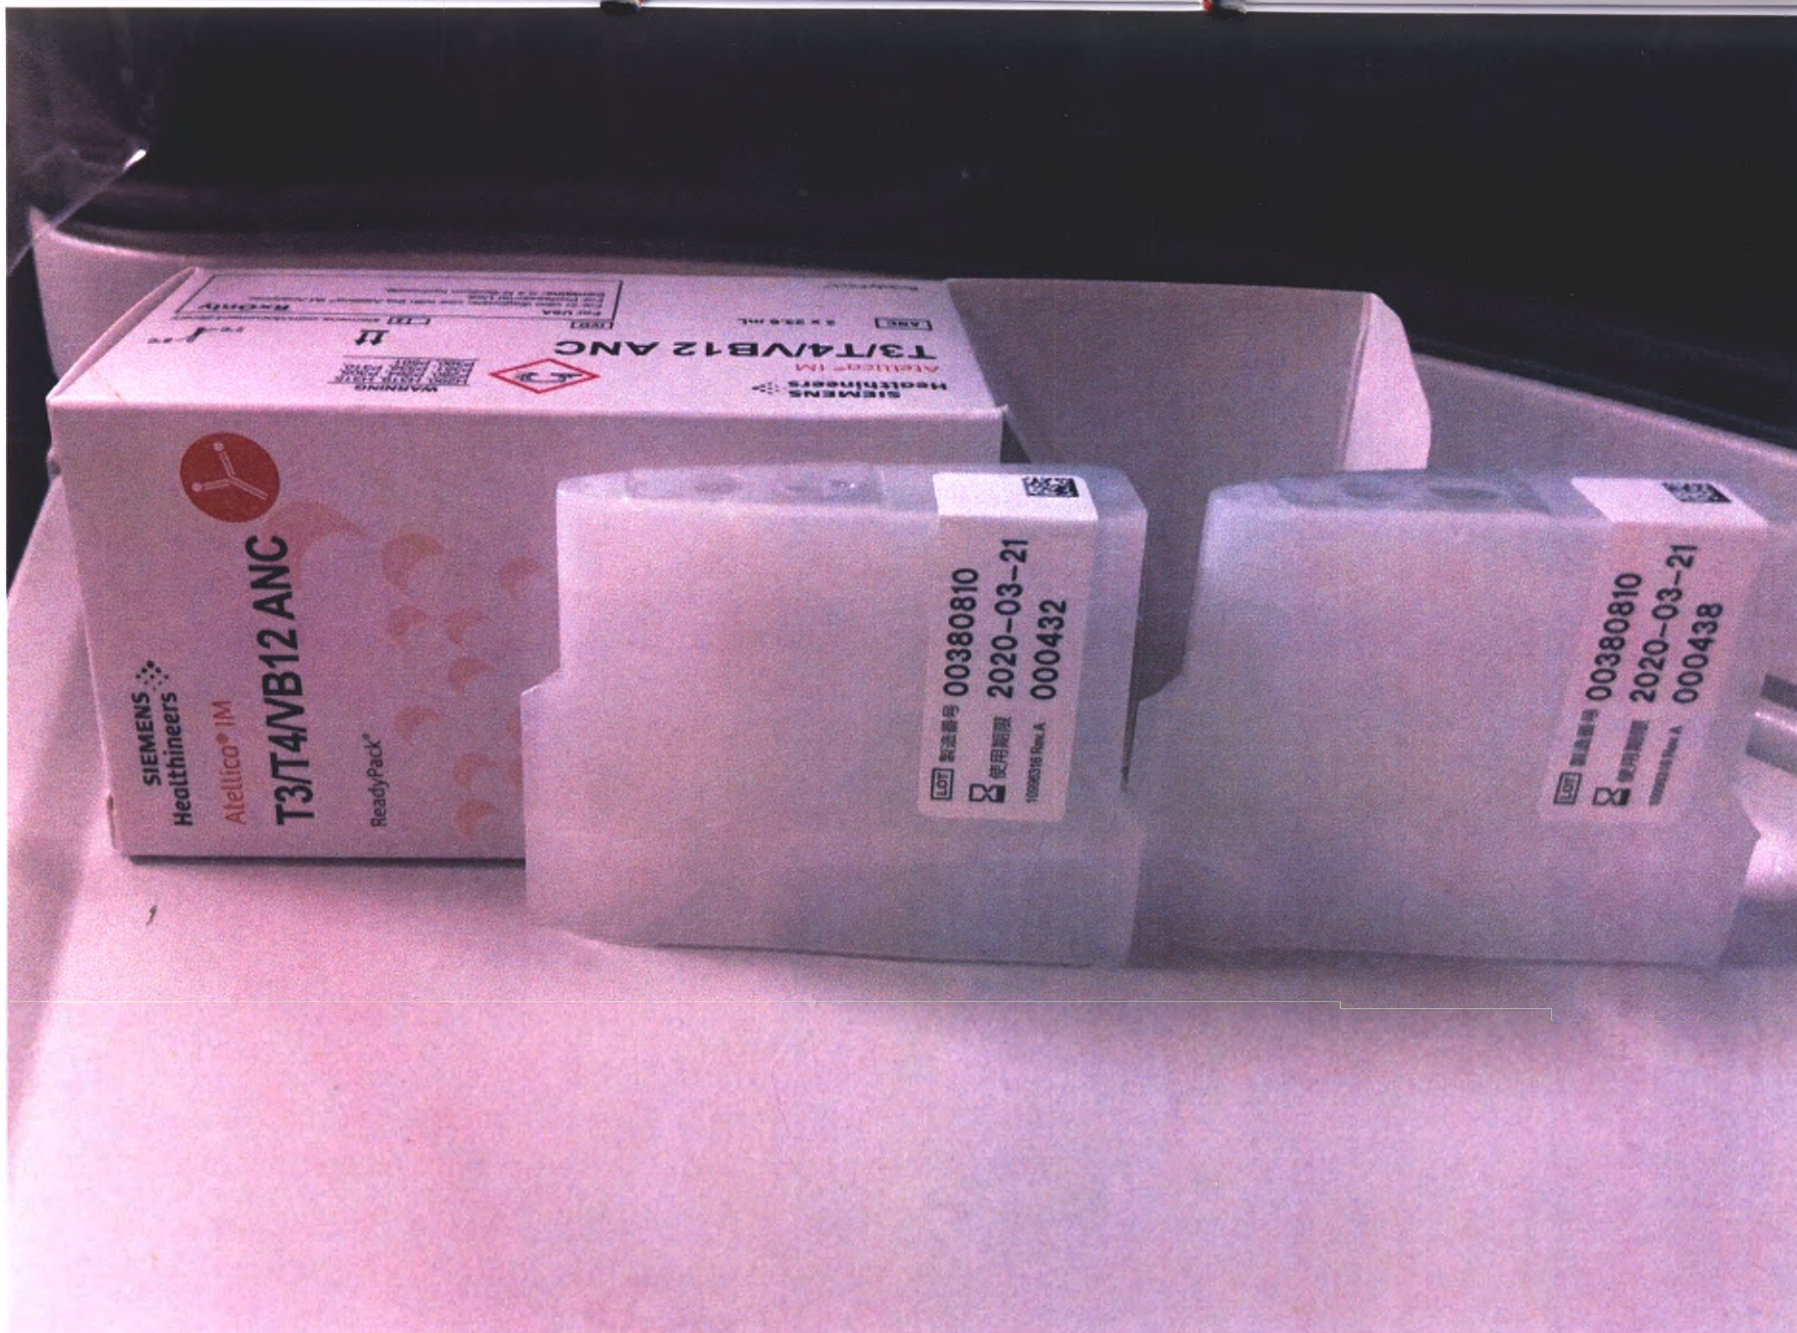


Рисунок 2. Реагент дополнительный для T3/T4/VB12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM T3/T4/VB12 Ancillary Reagent (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC)):

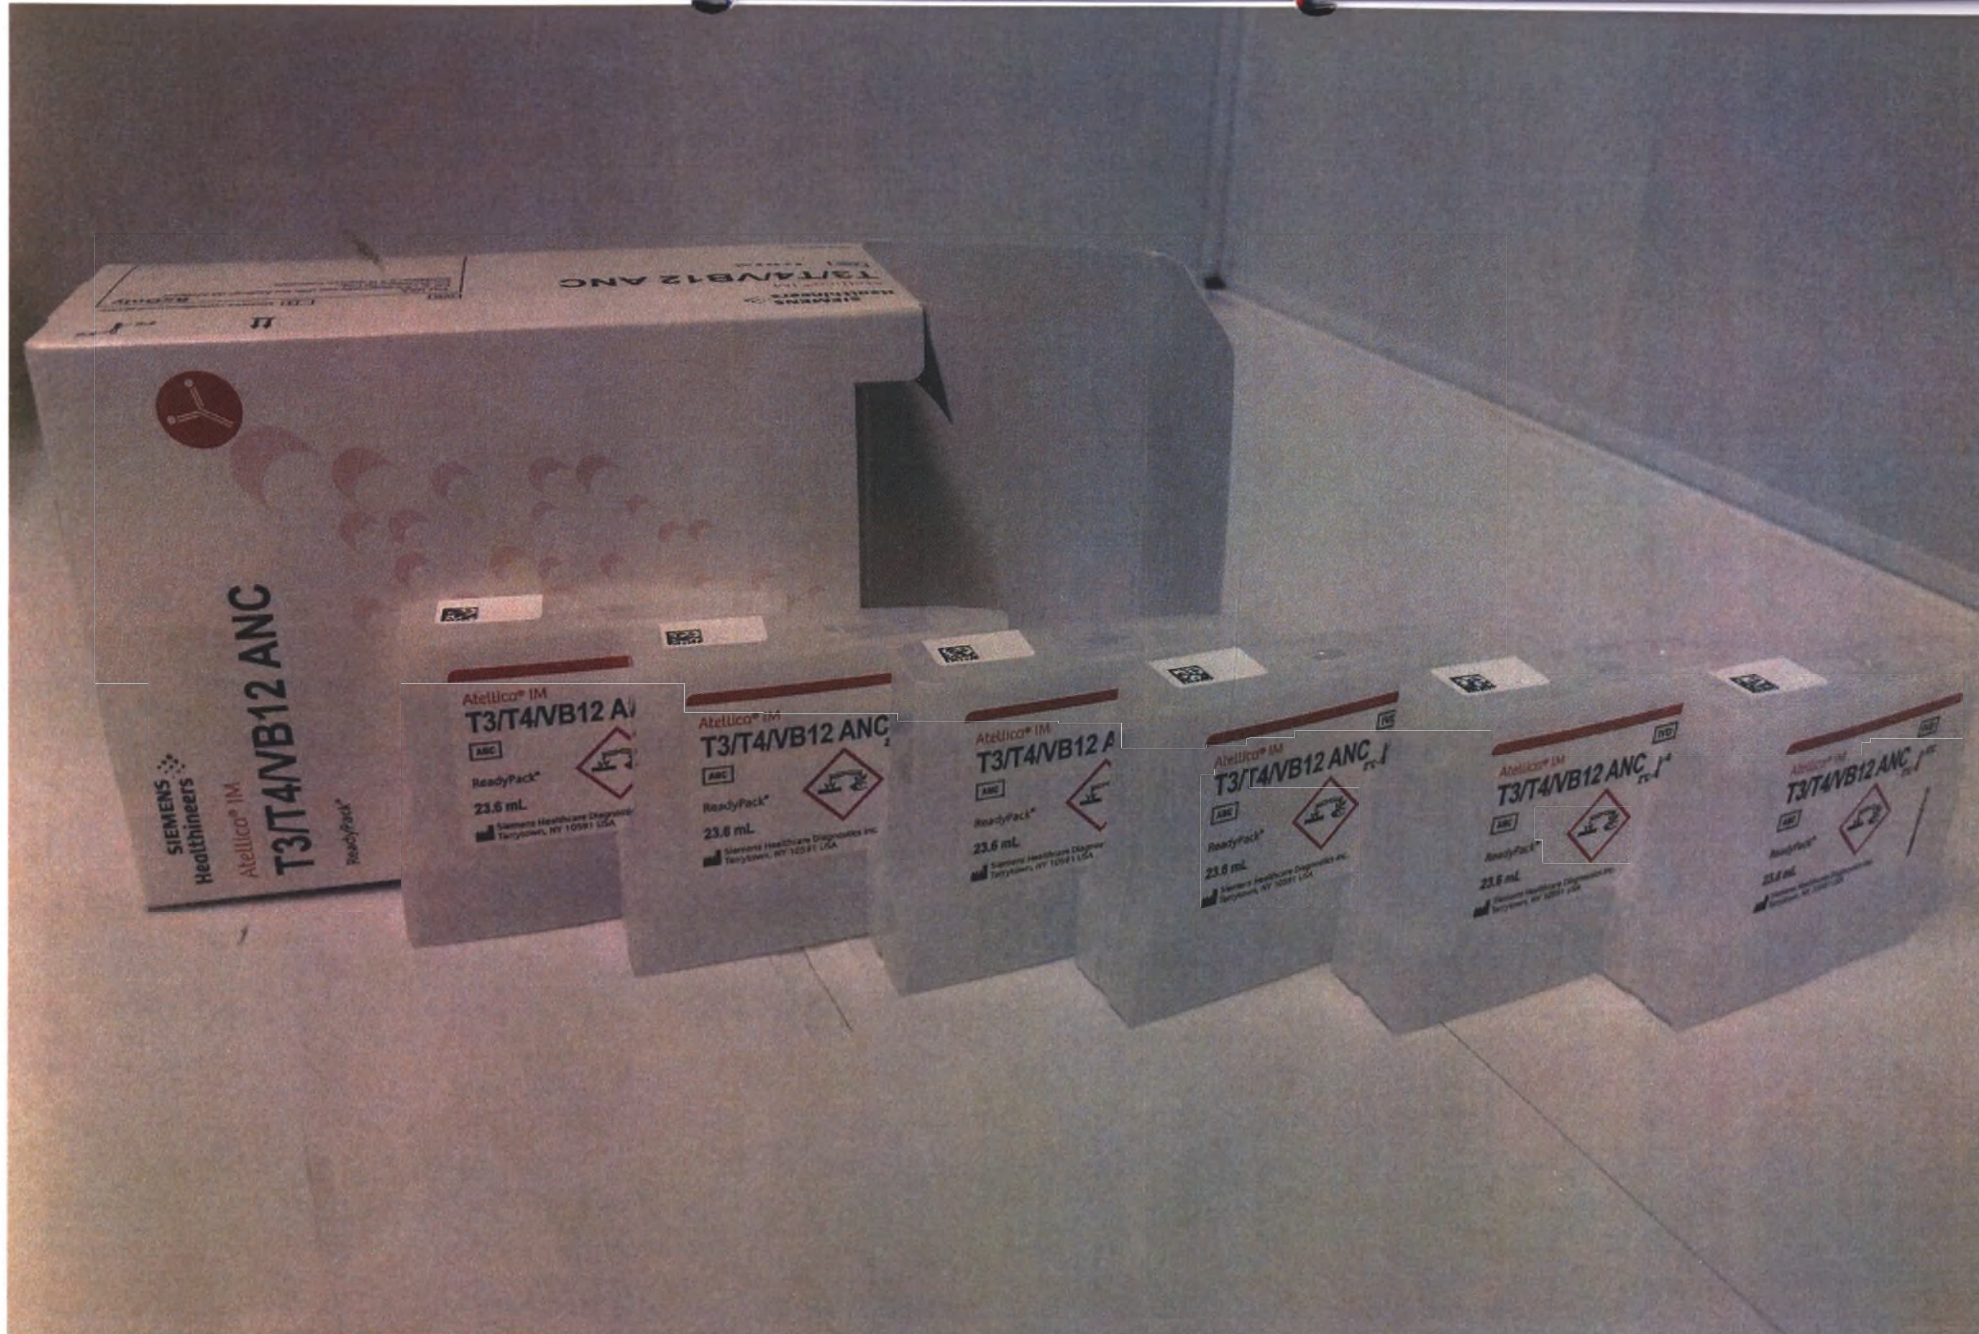


Рисунок 3. Реагент дополнительный для T3/T4/VB12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM T3/T4/VB12 Ancillary Reagent (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC));
Фасовка 2. Общий вид



Рисунок 4. Реагент дополнительный для Т3/Т4/ВВ12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Т3/Т4/ВВ12 Ancillary Reagent (Atellica IM Т3/Т4/ВВ12 АNC)):

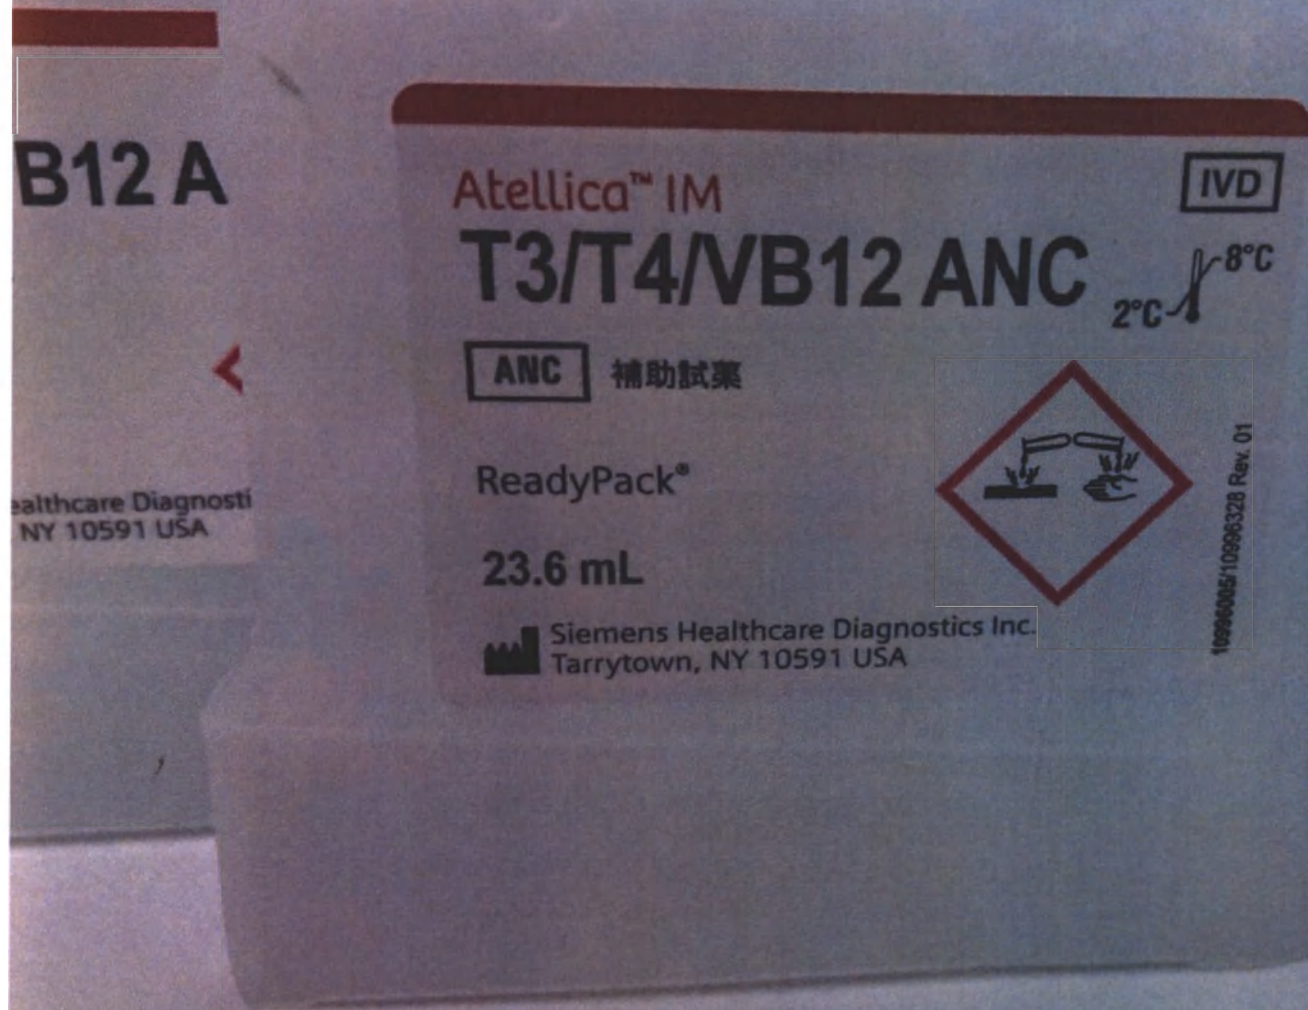


Рисунок 5. Реагент дополнительный для T3/T4/VB12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM T3/T4/VB12 Ancillary Reagent (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC));
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Atellica IM T3/T4/VB12 ANC) – 23,6 мл/упаковка

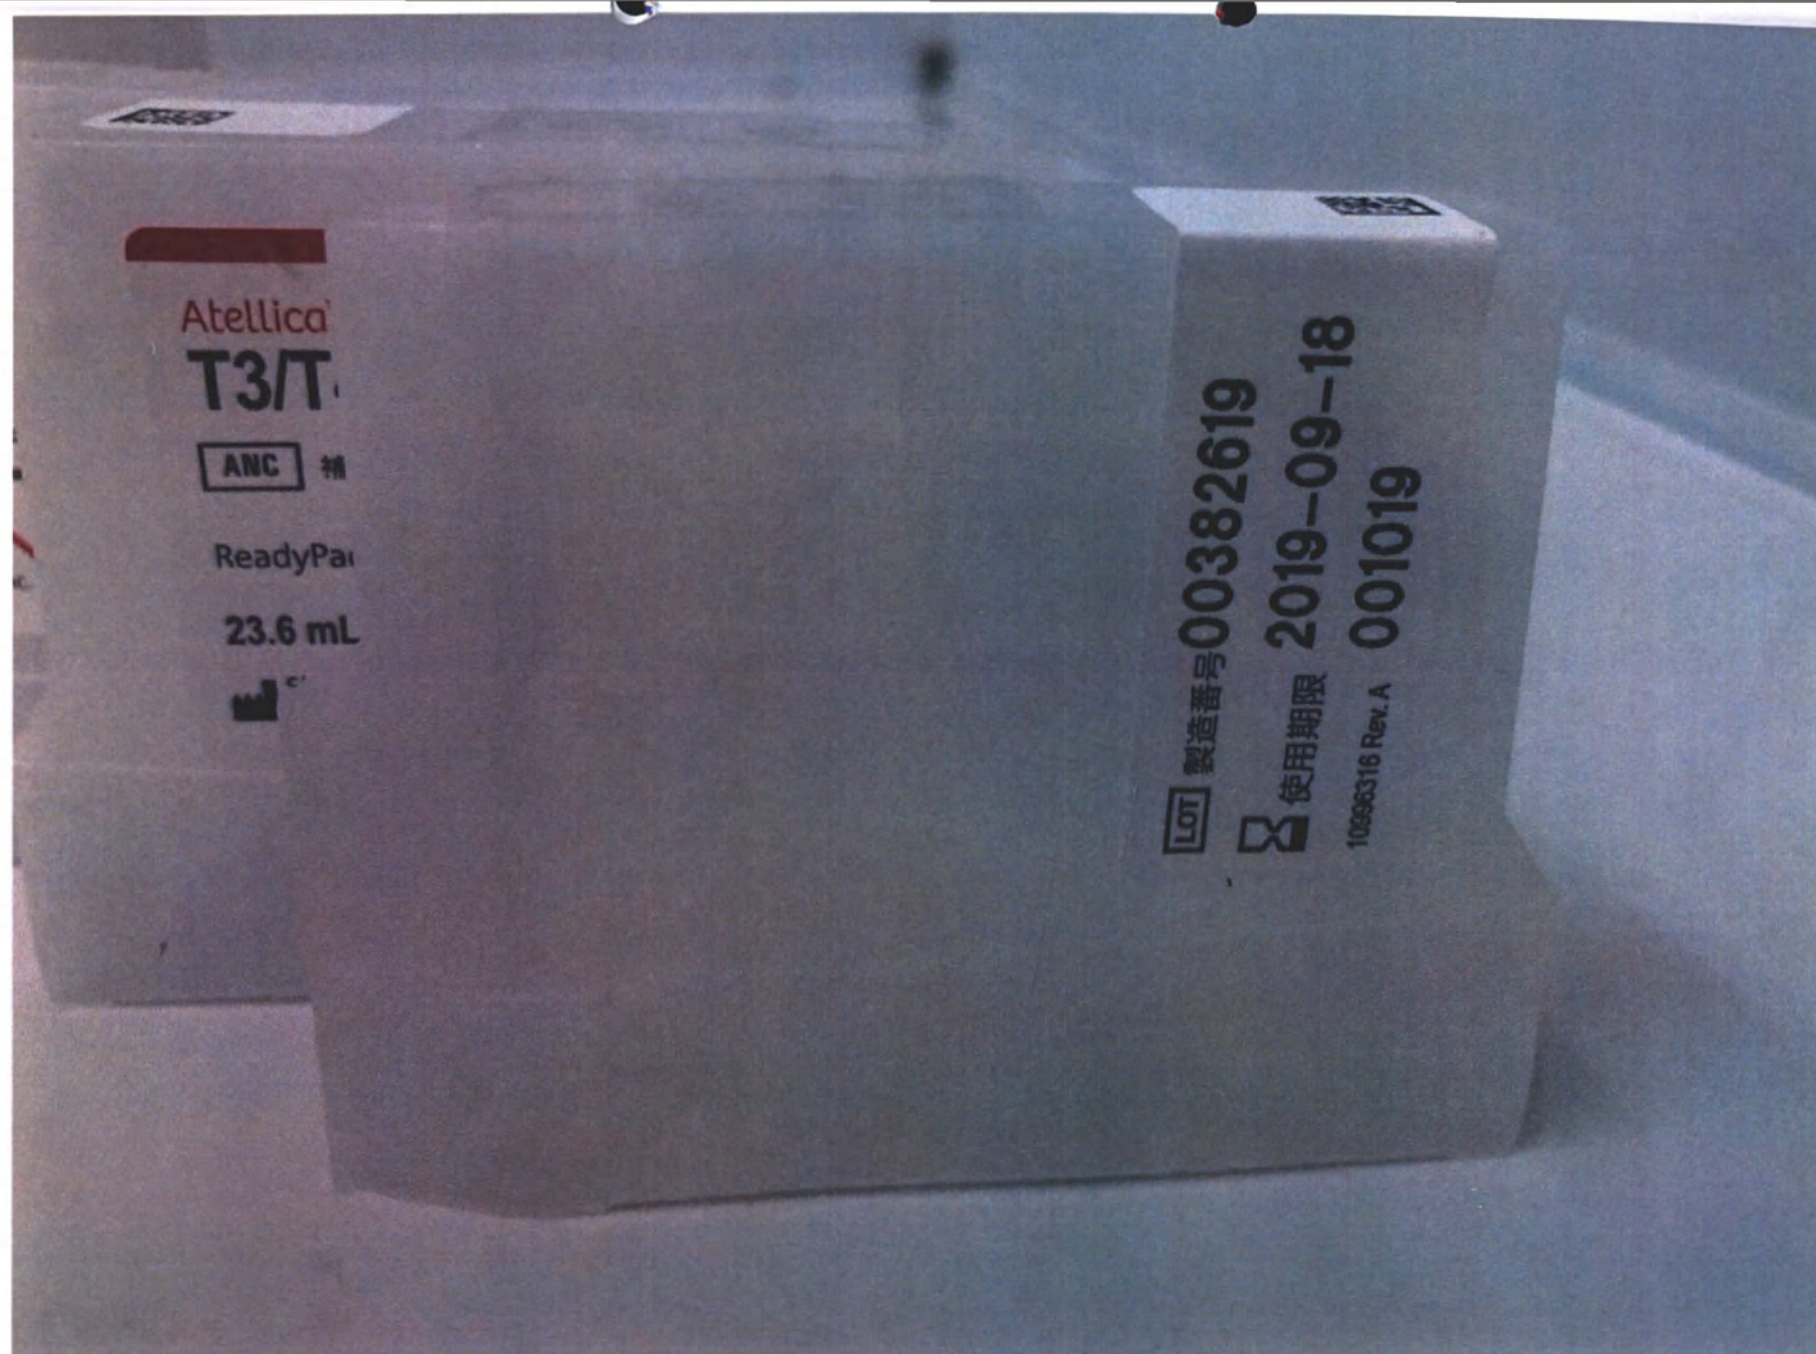


Рисунок 6. Реагент дополнительный для Т3/Т4/ВВ12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM T3/T4/VB12 Ancillary Reagent (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC)):
Реагент дополнительный для Т3/Т4/ВВ12 (Atellica IM T3/T4/VB12 ANC) – 23,6 мл/упаковка

Всего прошито и пронумеровано

7

листа(ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

