



Генеральный директор  
ООО «ЛАБИКС»

  
Скоморохова С.В.

" 23 " июня 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

**Анализатор автоматический для определения скорости оседания  
эритроцитов MIX-RATE X20  
в составе, с принадлежностями**

г. Москва, 2020

## Оглавление


|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов MIX-RATE X20 в составе, с принадлежностями: ..... | 3  |
| I. Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов MIX-RATE X20, в составе: .....                 | 3  |
| 1. Анализатор .....                                                                                                       | 3  |
| 2. Кабель питания .....                                                                                                   | 4  |
| 3. Адаптер сетевой .....                                                                                                  | 5  |
| 4. Держатель бумаги для встроенного принтера .....                                                                        | 6  |
| 5. Ограничитель держателя бумаги для встроенного принтера .....                                                           | 7  |
| 6. Модуль флэш-памяти на USB с документацией .....                                                                        | 8  |
| 7. Пробирки MONOSED вакуумные для определения СОЭ .....                                                                   | 9  |
| 8. Контроль СОЭ Accu-Sed Plus норма .....                                                                                 | 10 |
| 9. Контроль СОЭ Accu-Sed Plus патология .....                                                                             | 11 |
| II. Принадлежности: .....                                                                                                 | 12 |
| - Бумага в рулоне для встроенного принтера .....                                                                          | 12 |

**Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов MIX-RATE X20 в составе, с принадлежностями:**

1. Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов MIX-RATE X20, в составе:




1. Анализатор

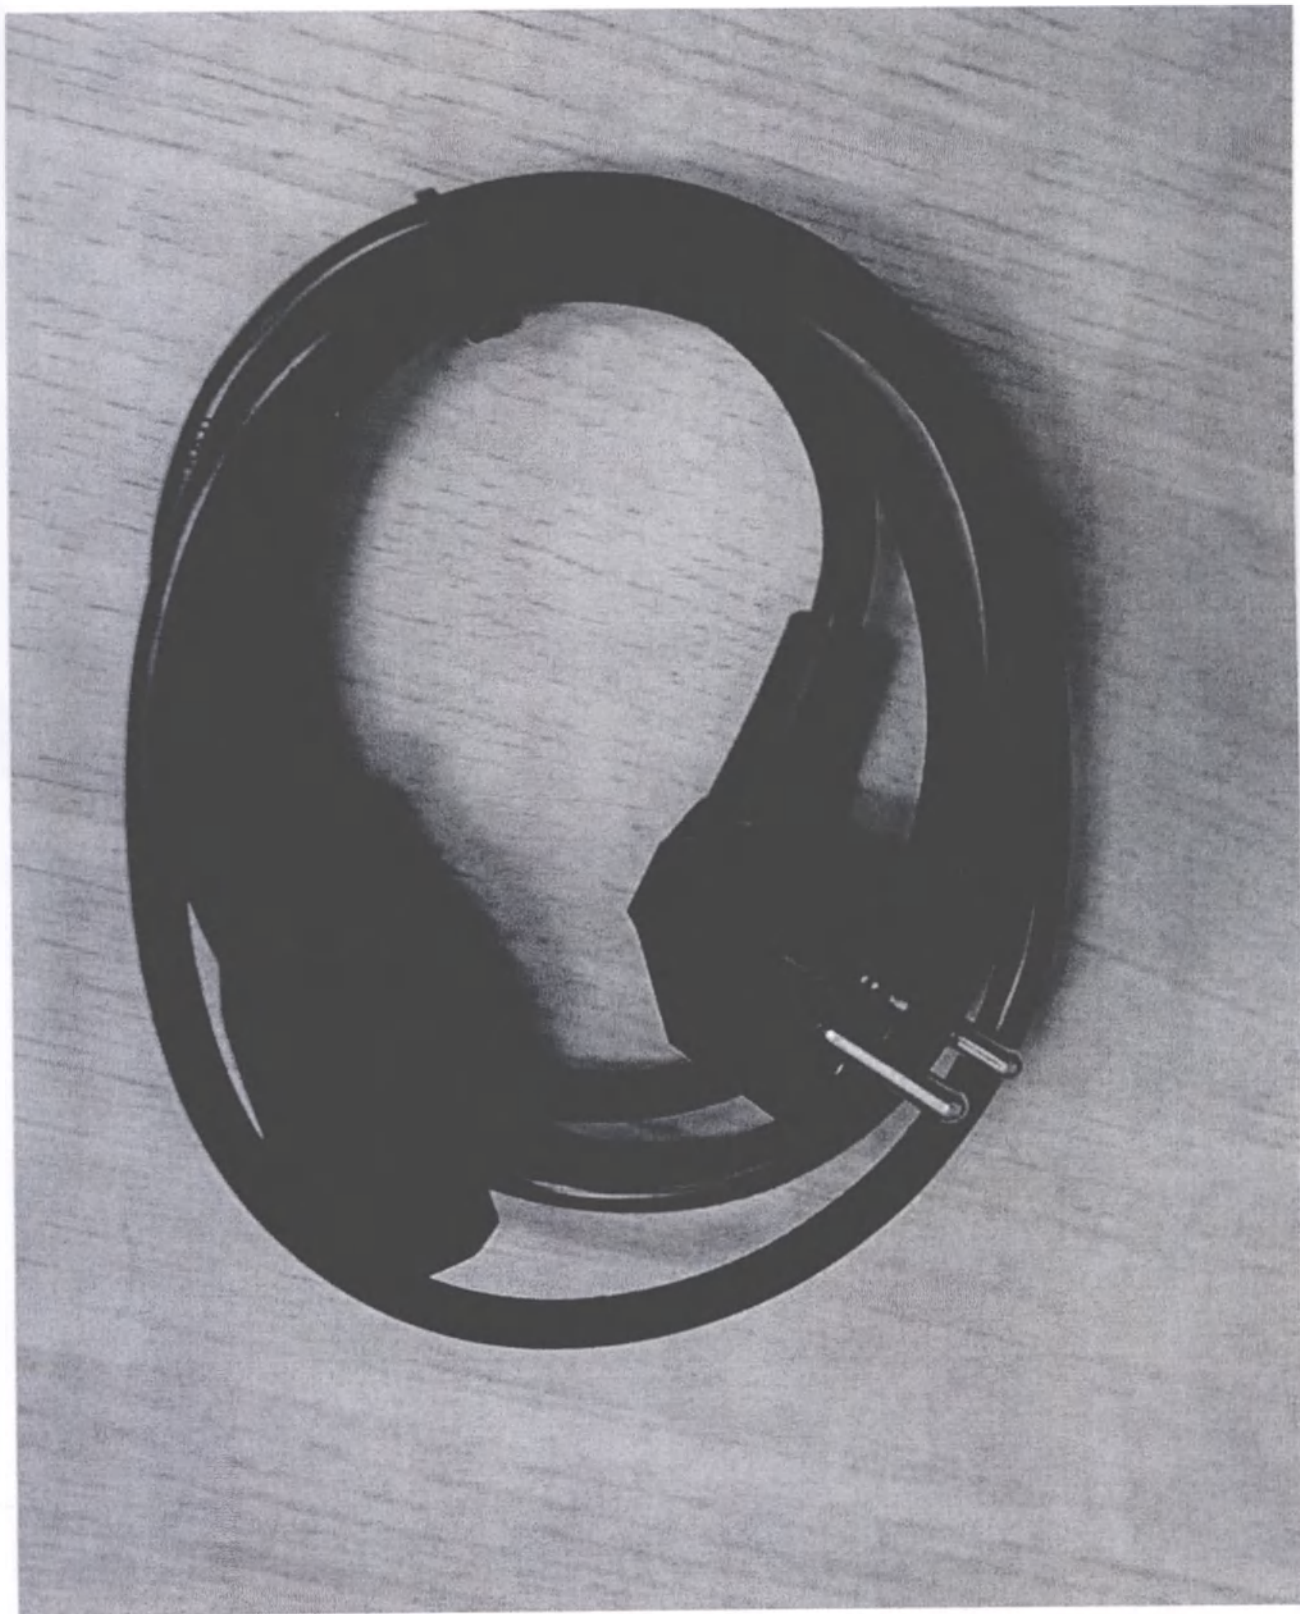


2. Кабель питания




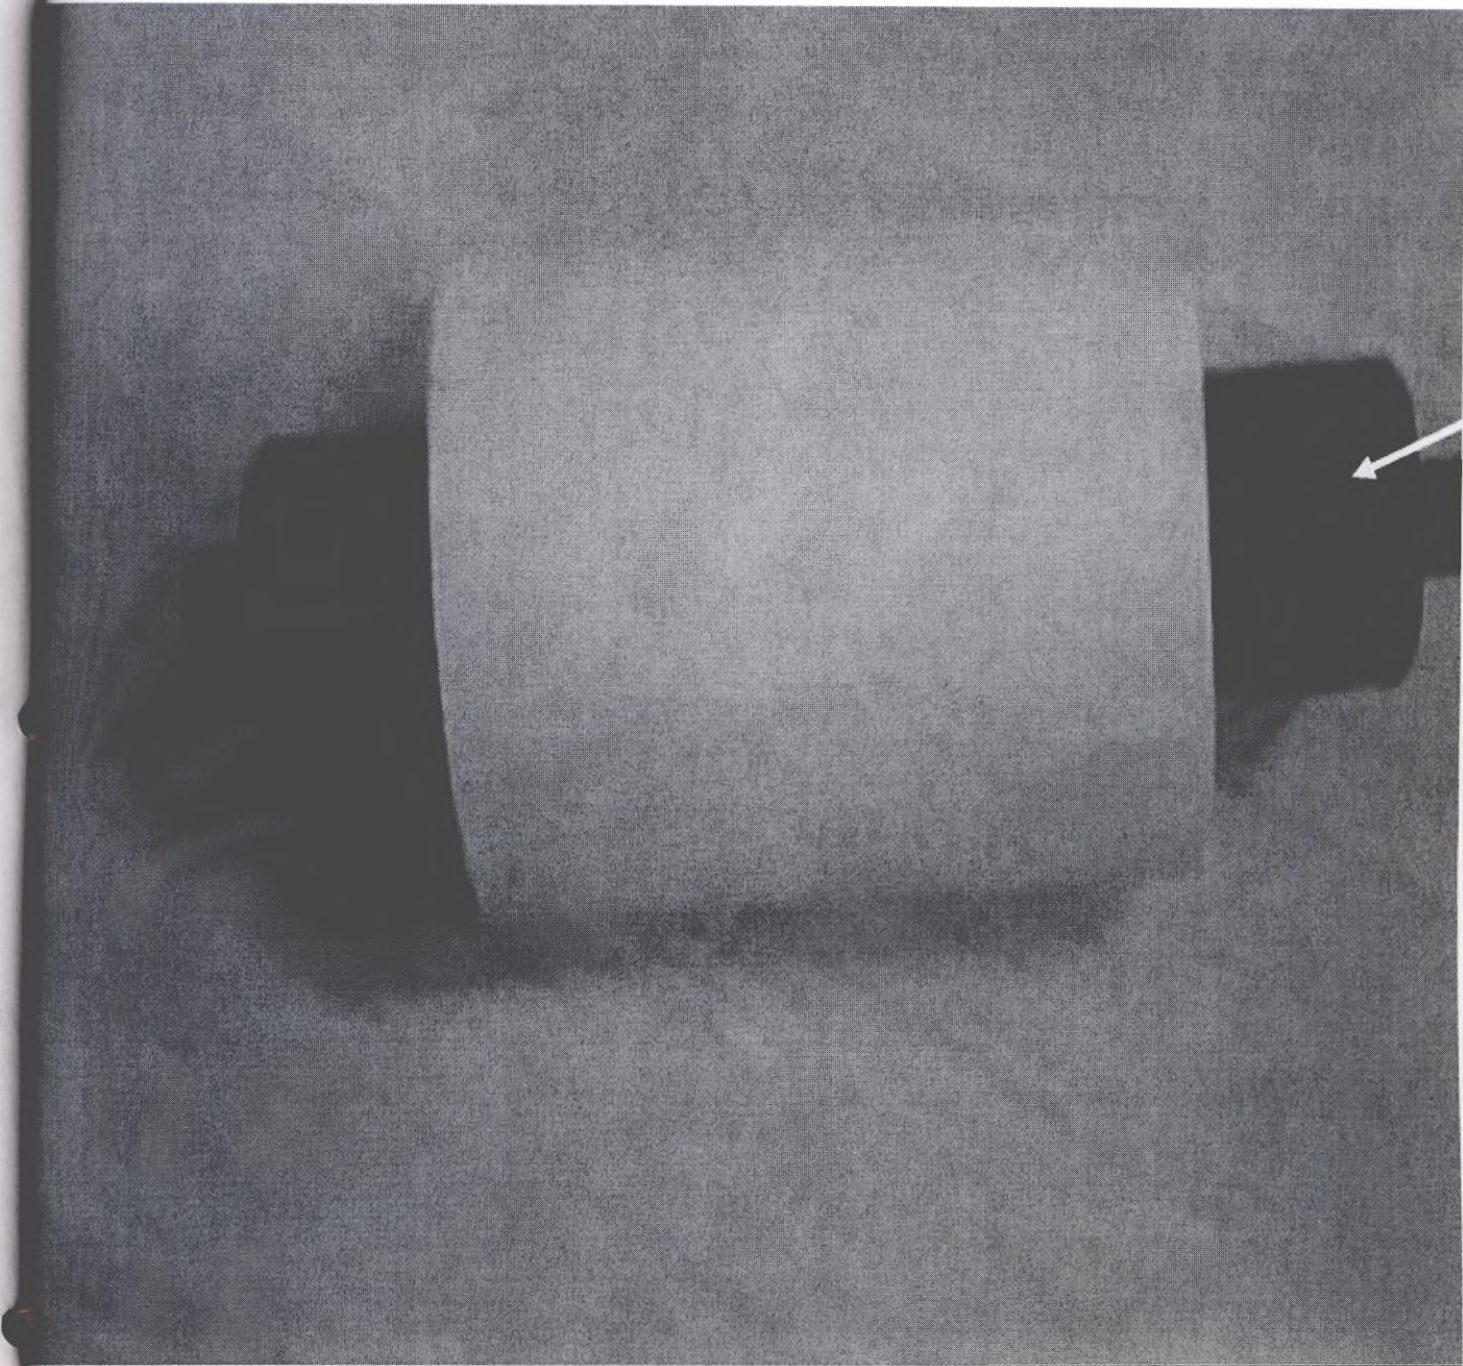


4. Держатель бумаги для встроенного принтера

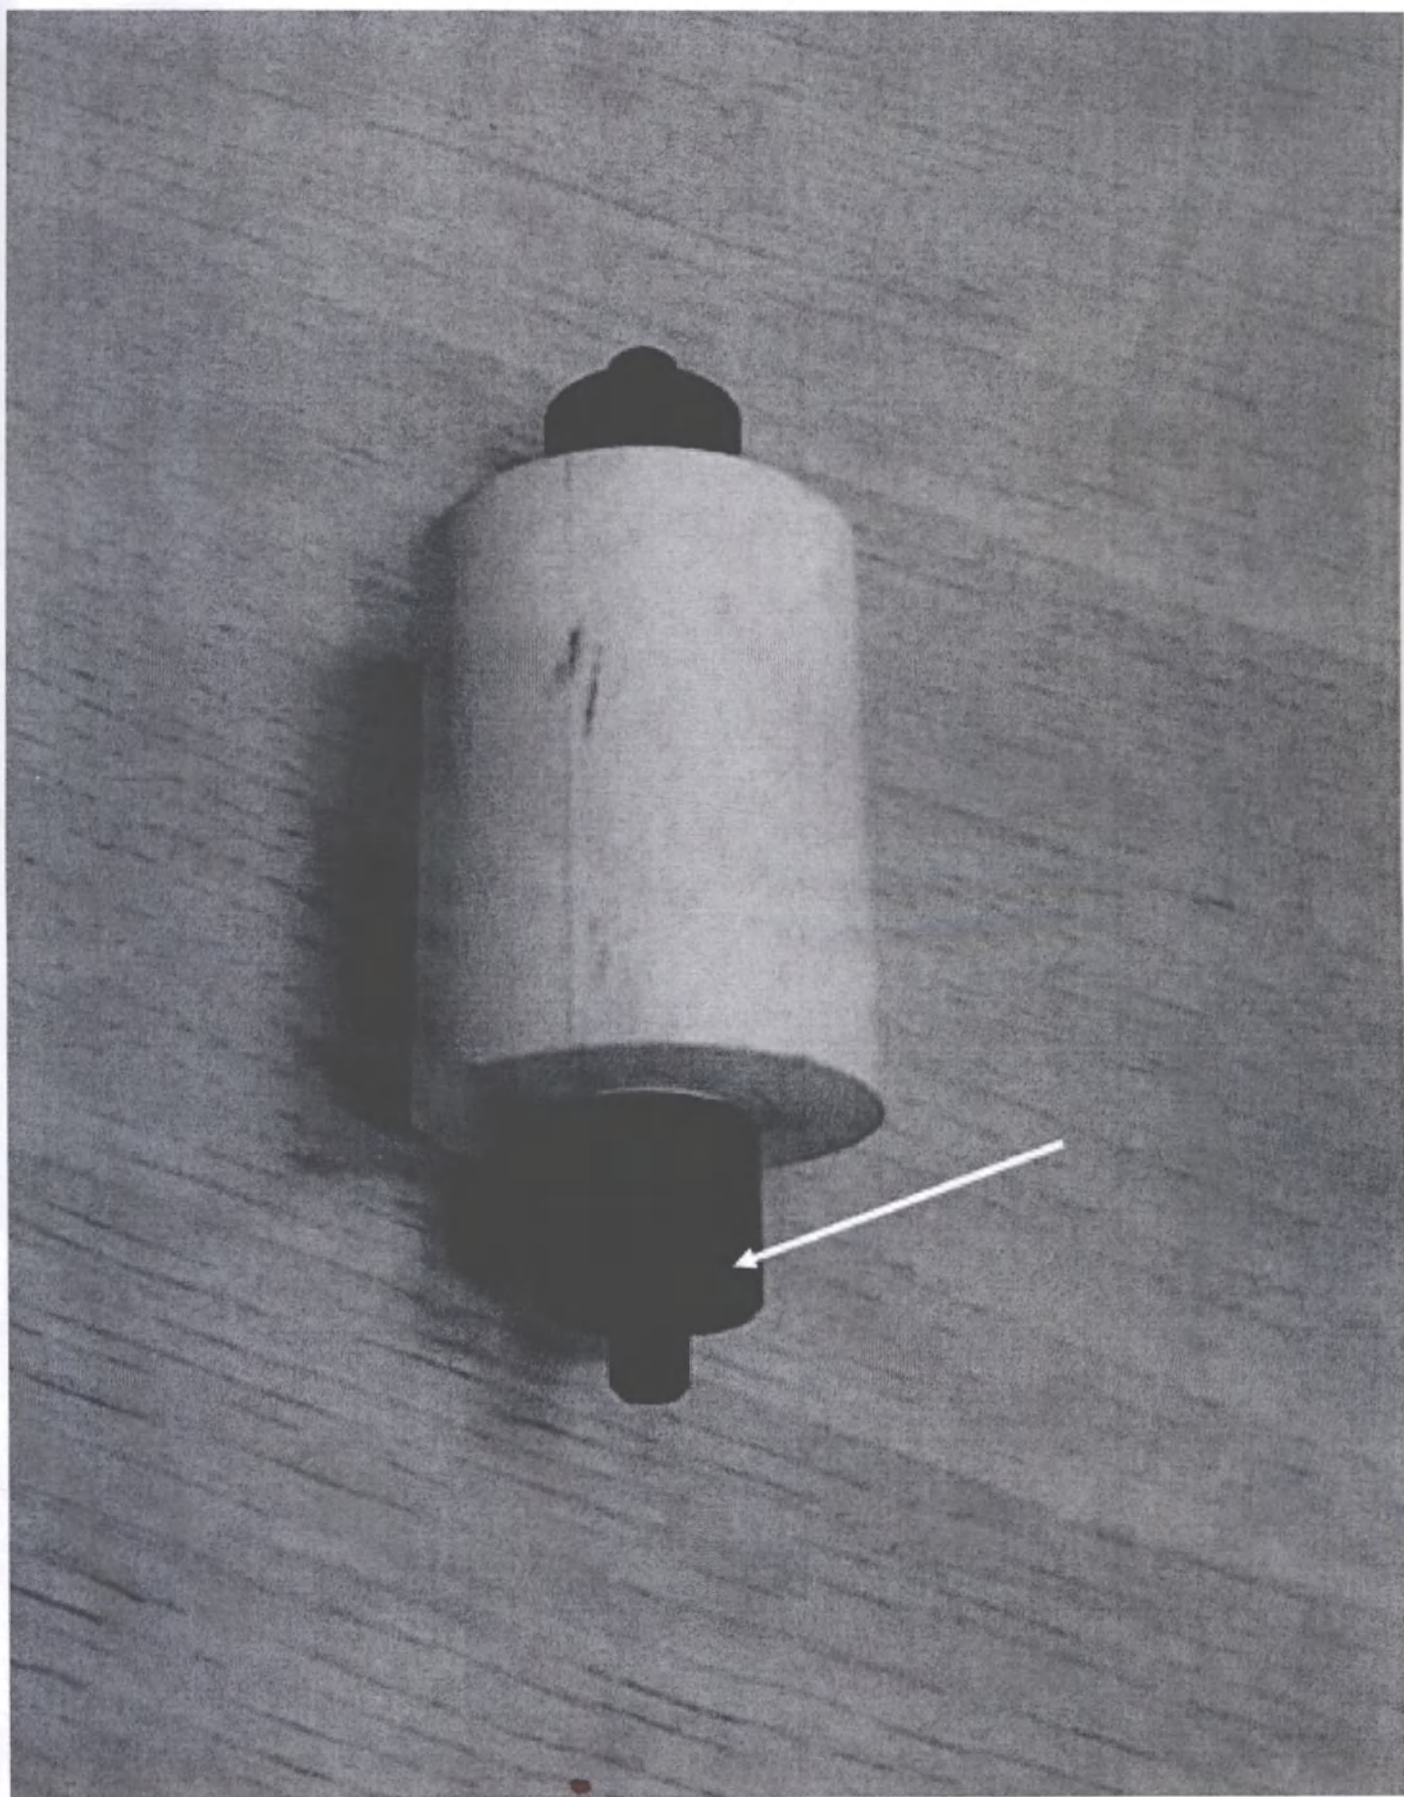


5. Ограничитель держателя бумаги для встроенного принтера

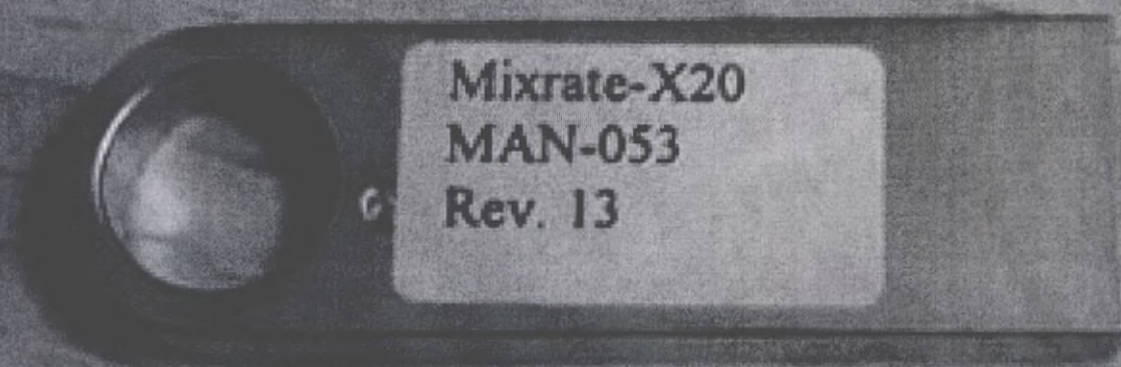

6. Модуль флэш-памяти на USB с документацией

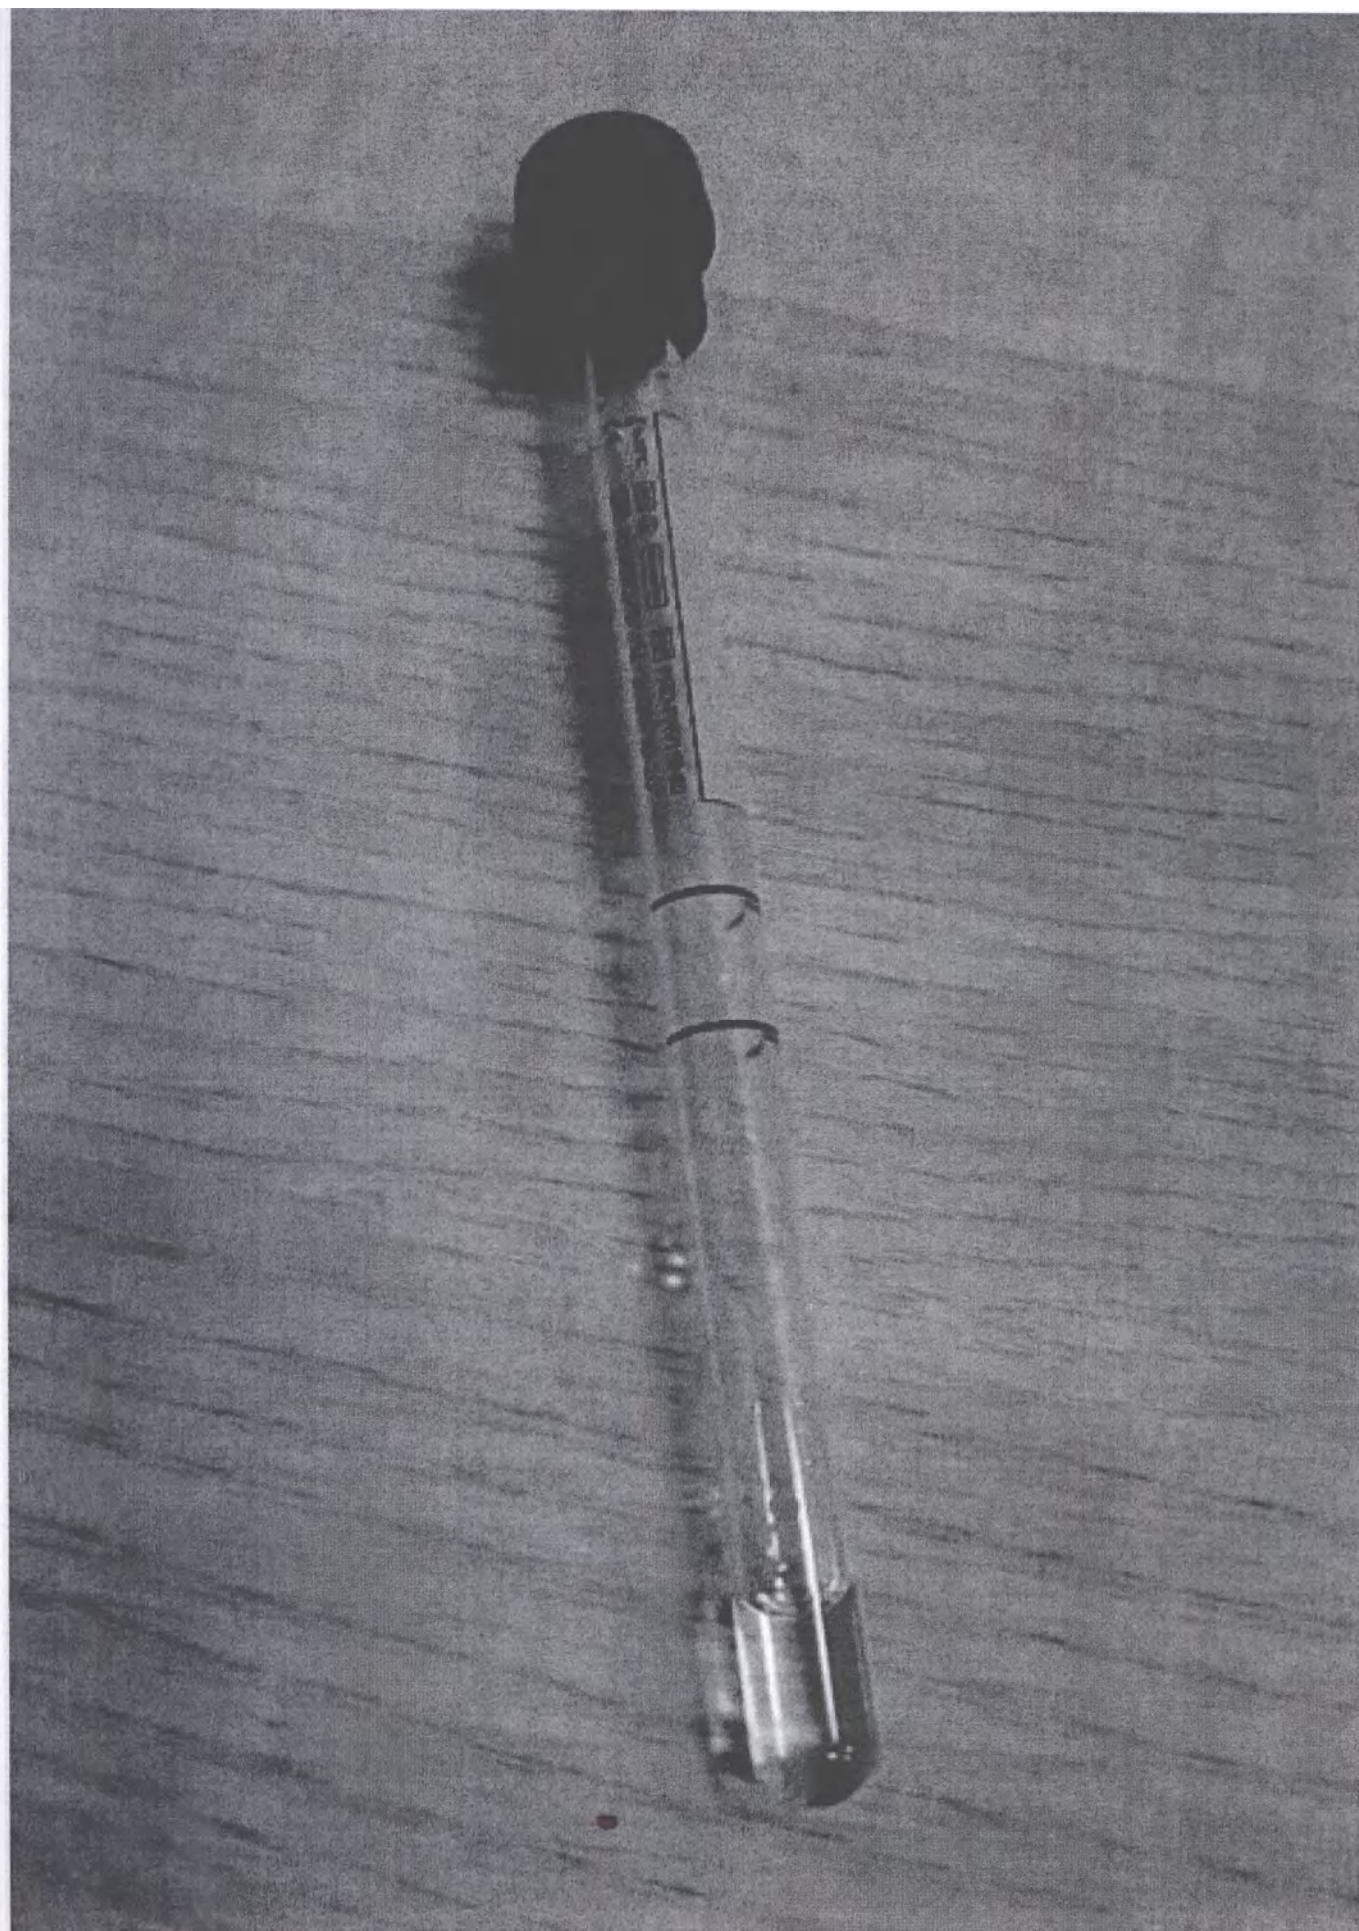


7. Пробирки MONOSED вакуумные для определения СОЭ

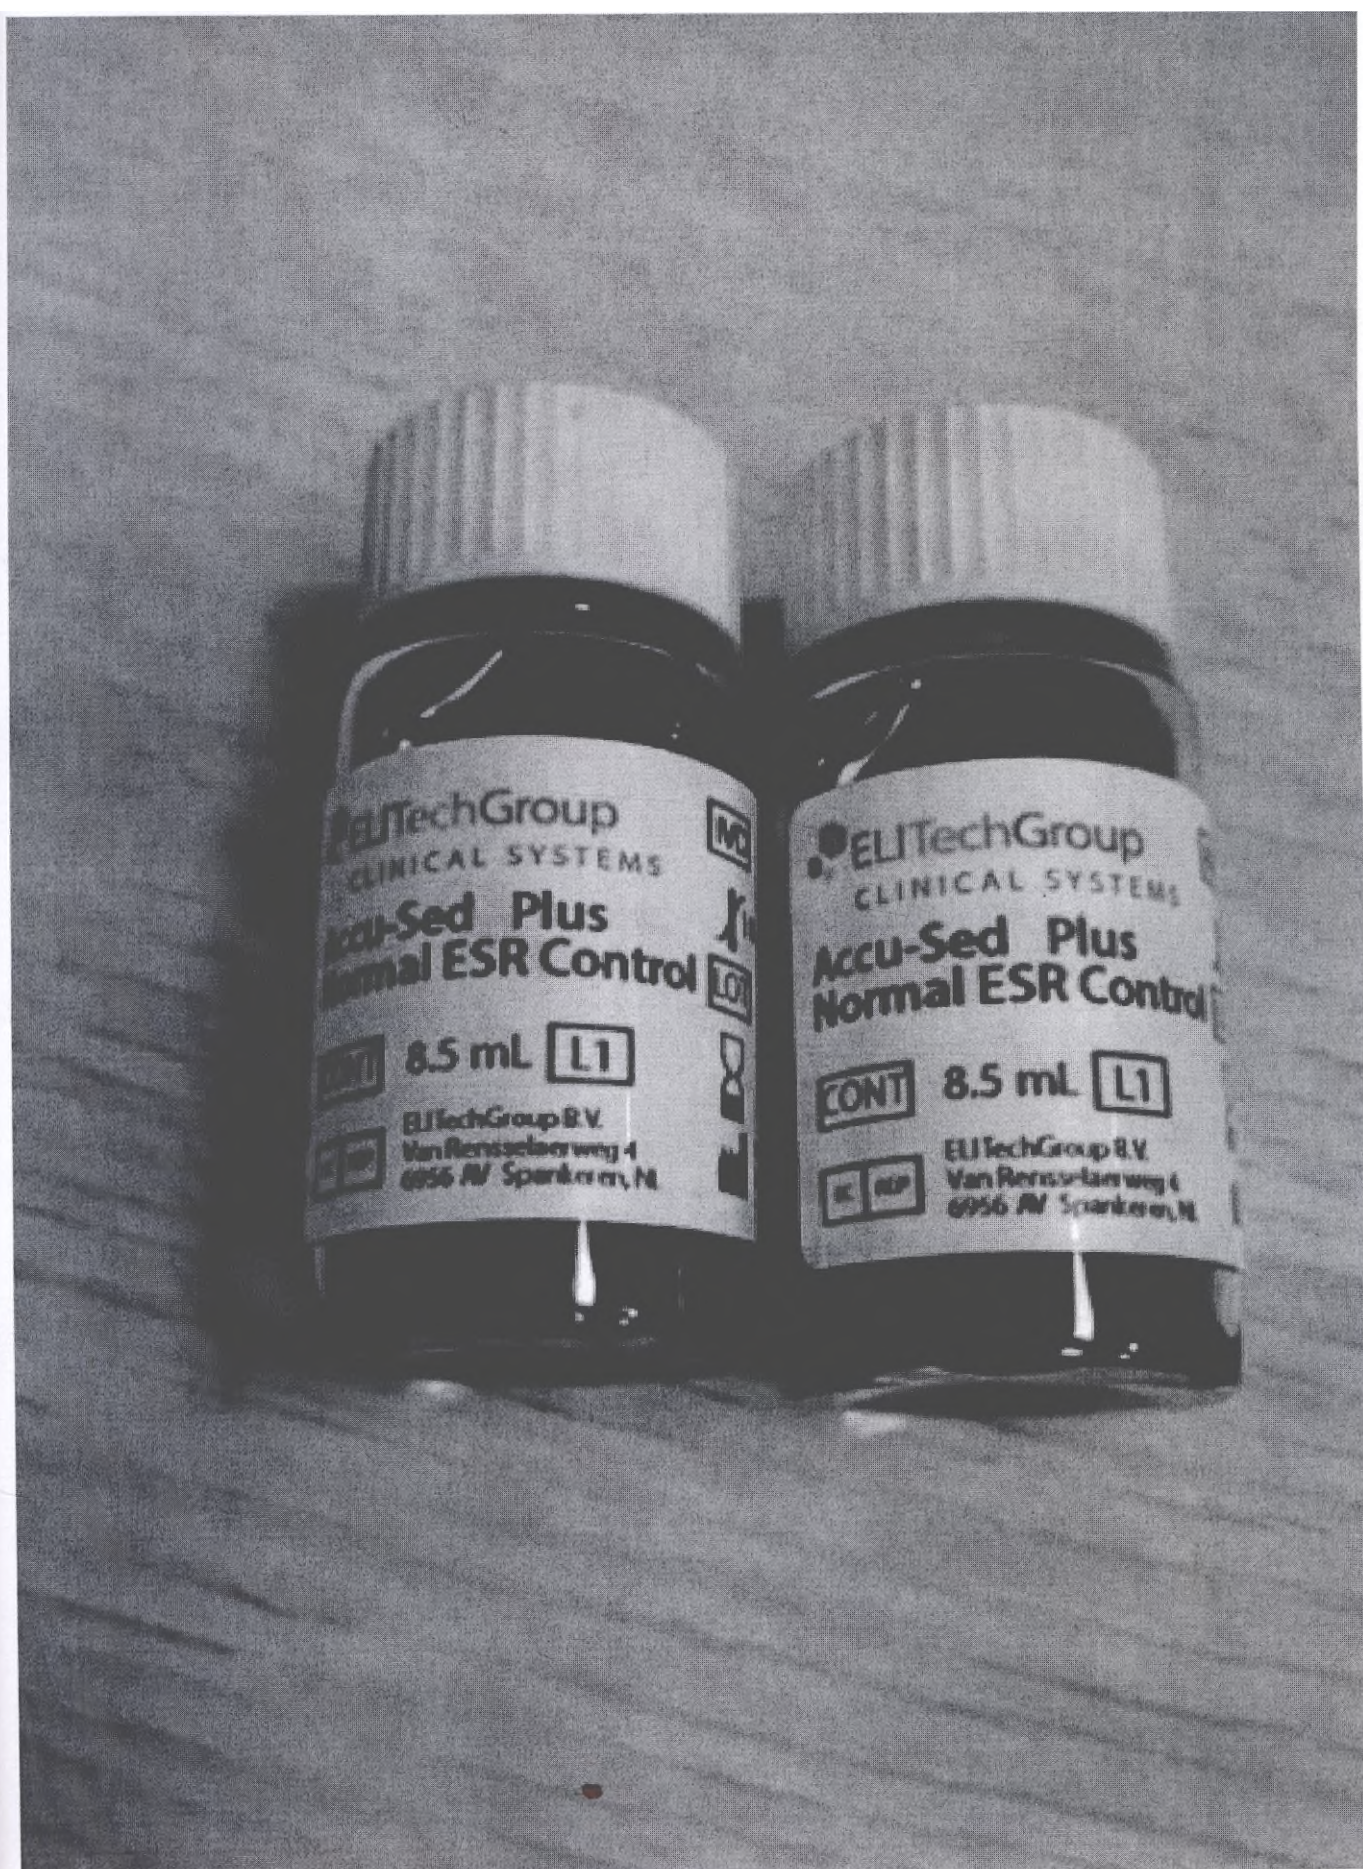

8. Контроль СОЭ Ассу-Сед Плюс норма



9. Контроль СОЭ Accu-Sed Plus патология

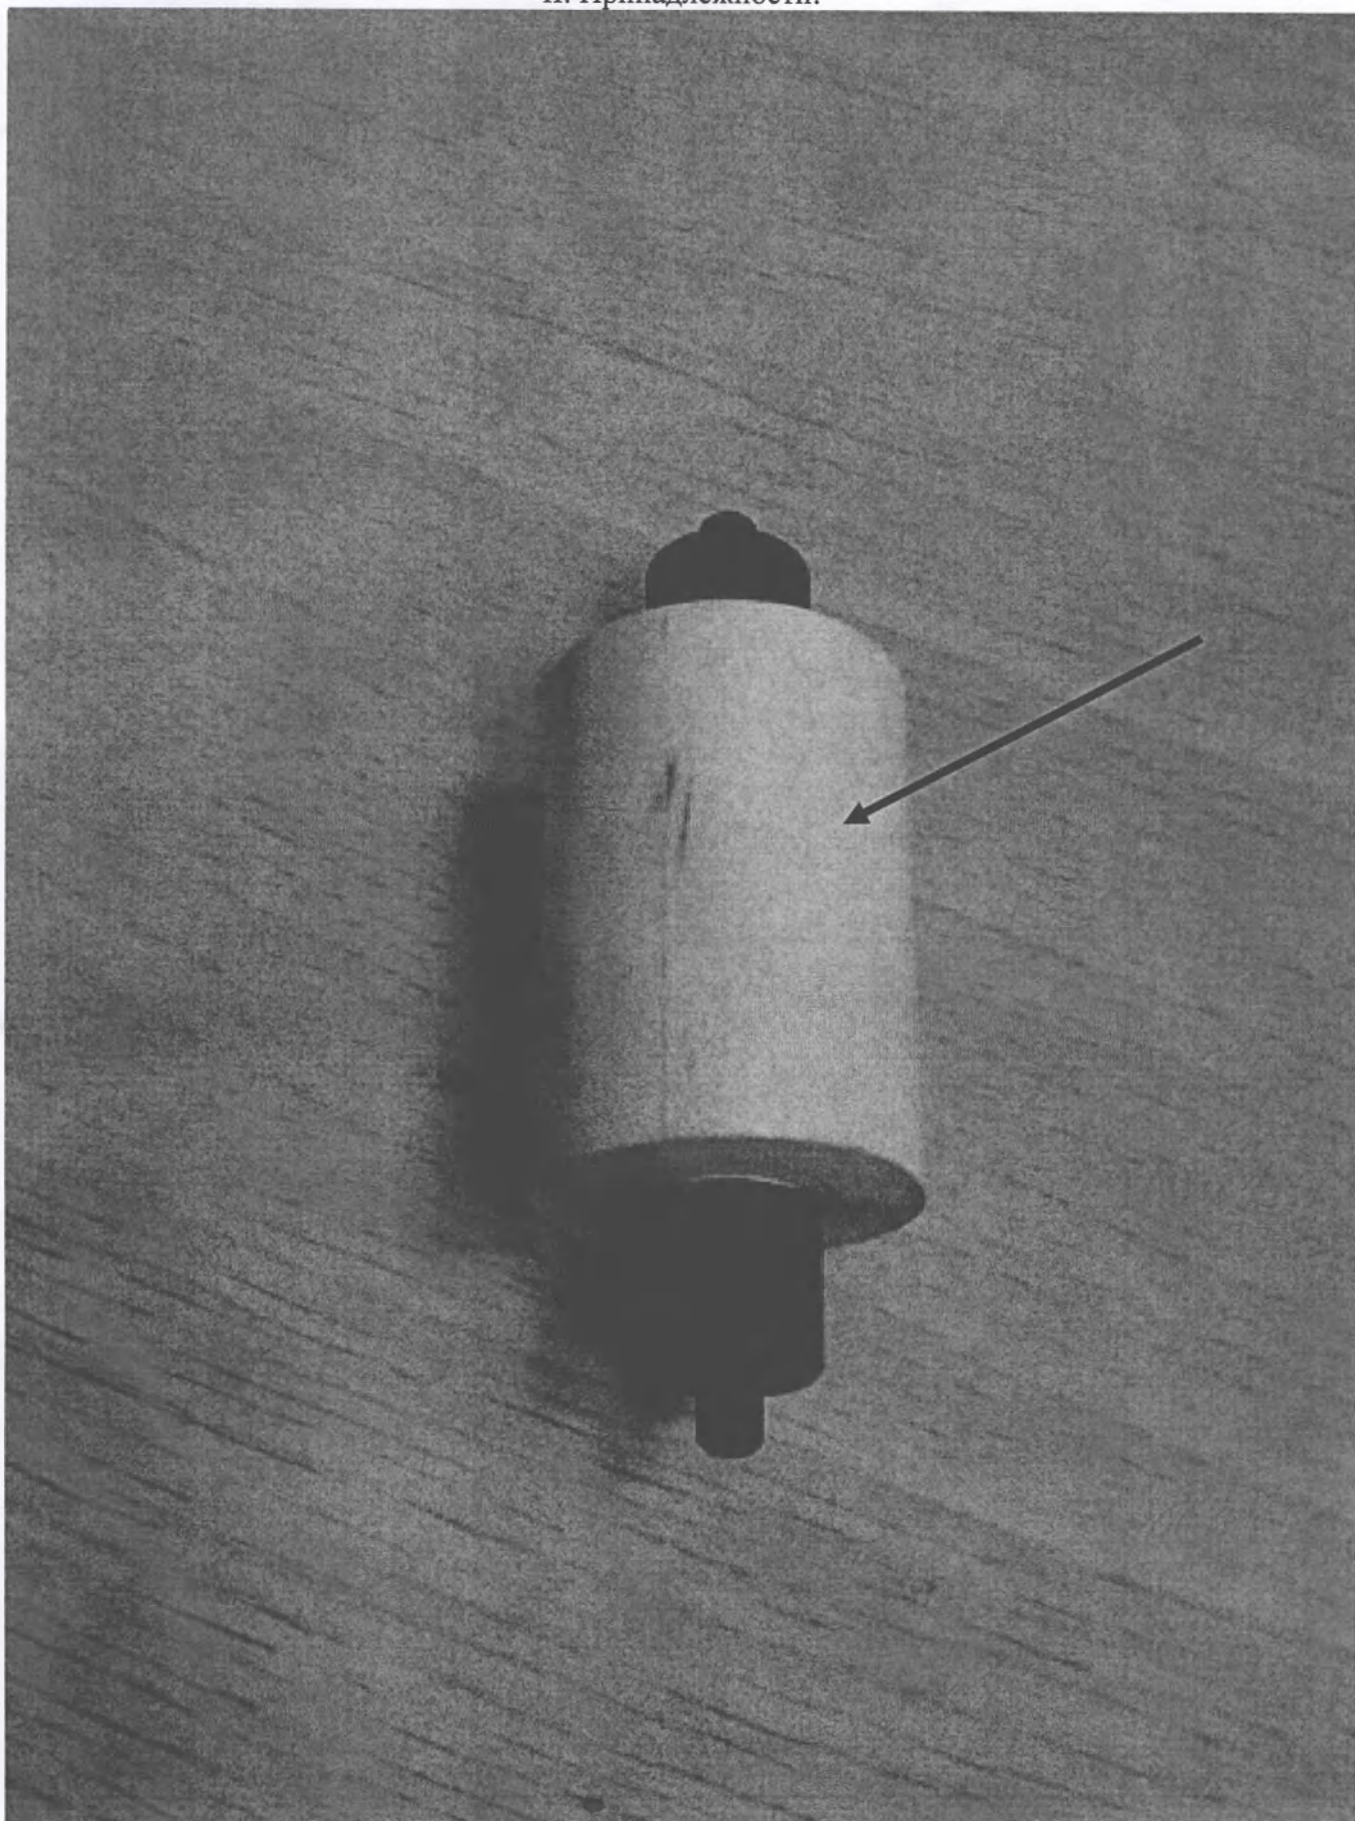

- Бумага в рулоне для встроенного принтера

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 12 (двенадцать) листа(ов)  
Генеральный директор ООО «ЛАБИКС»

С.В. Скоморохова

