




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab Seven, MyLab X5, MyLab X6, MyLab X7 с принадлежностями

Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab Seven




Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab X5

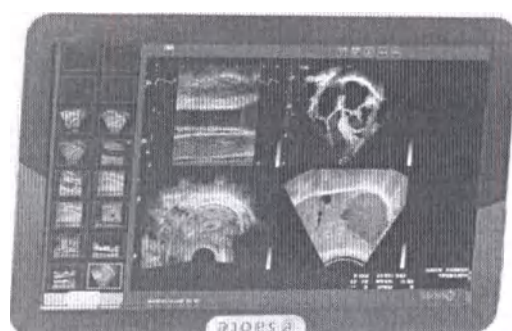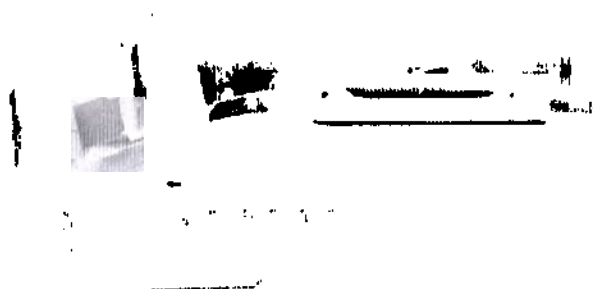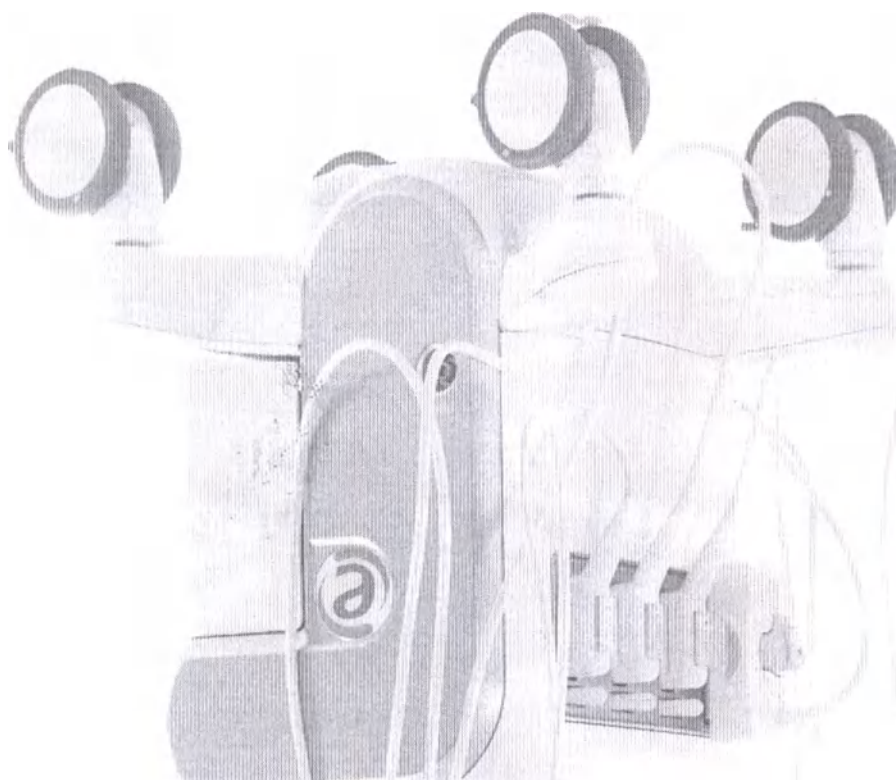

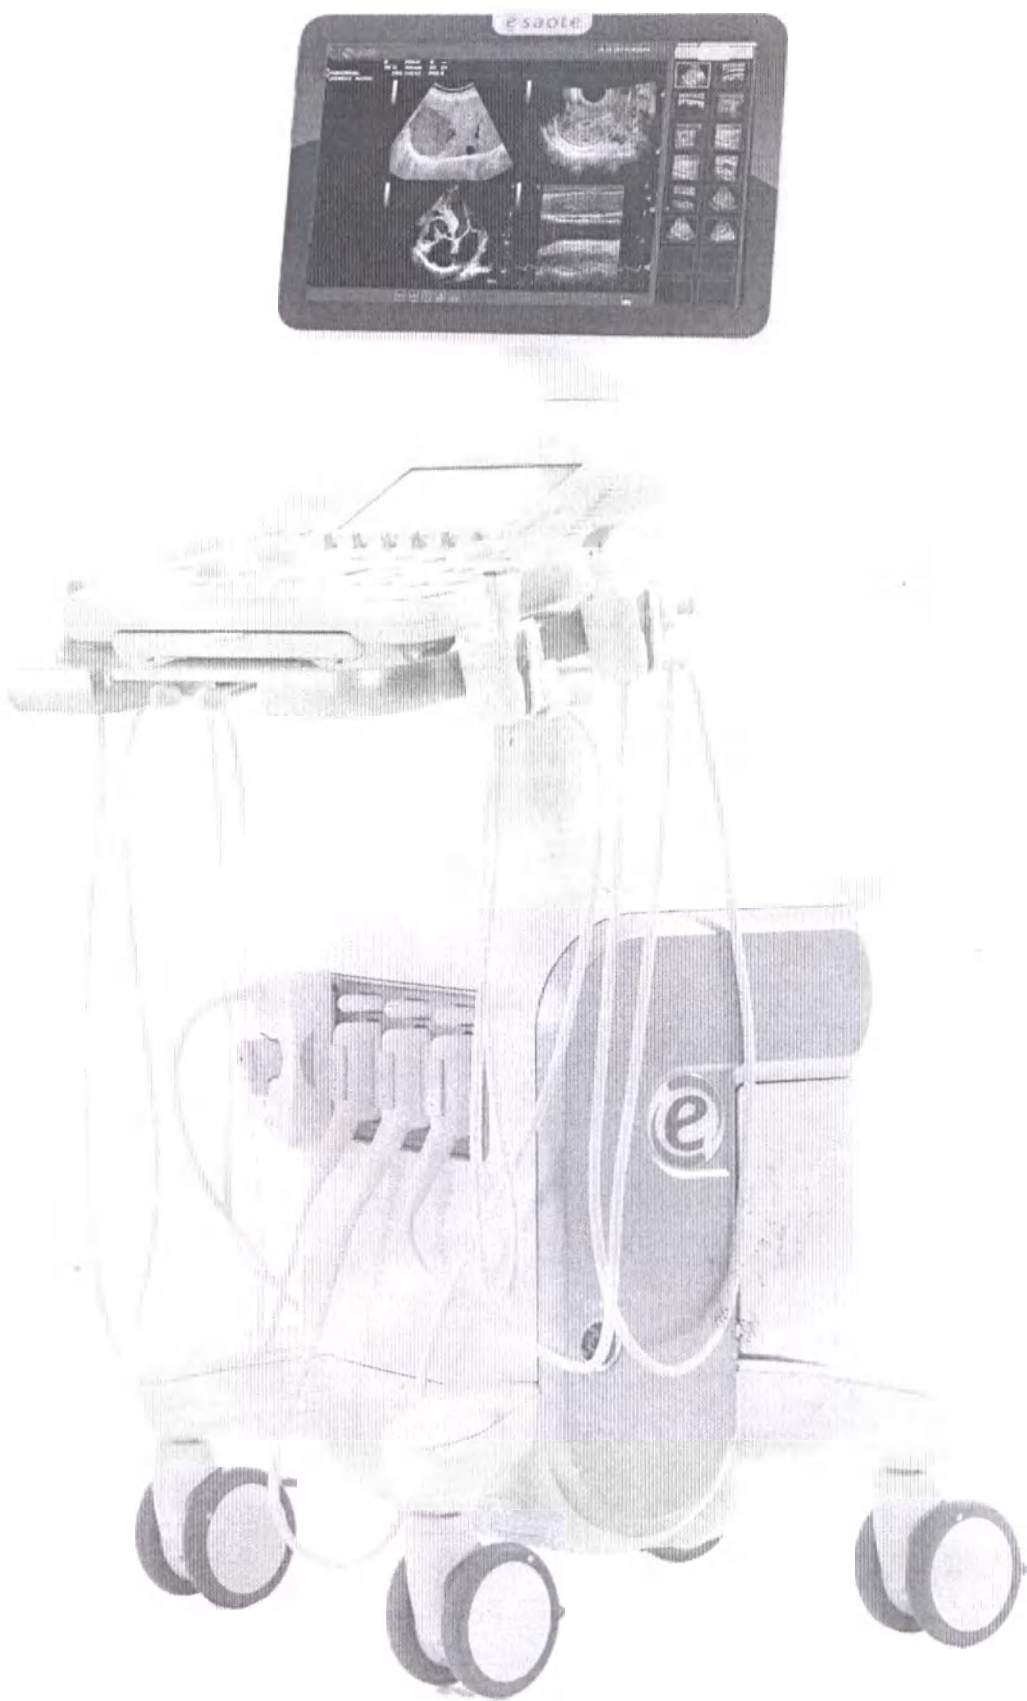

Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab X6

Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab X7

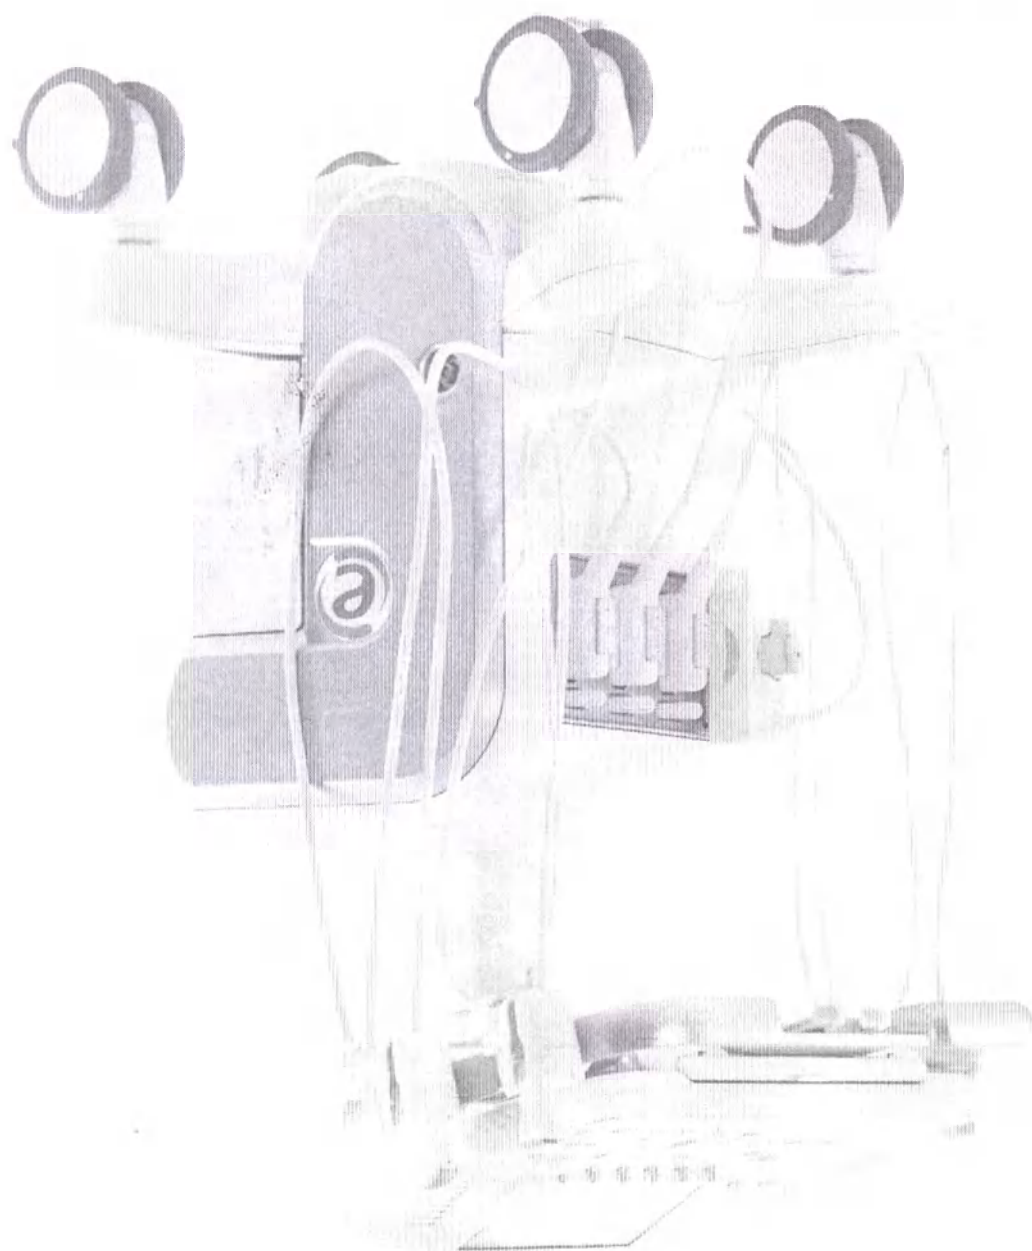


I. Датчики:

1. С фазированной электронной решеткой:

SP2430


SP2442

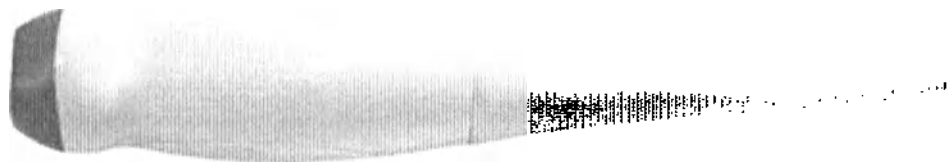


P 1-5,



P 2-9

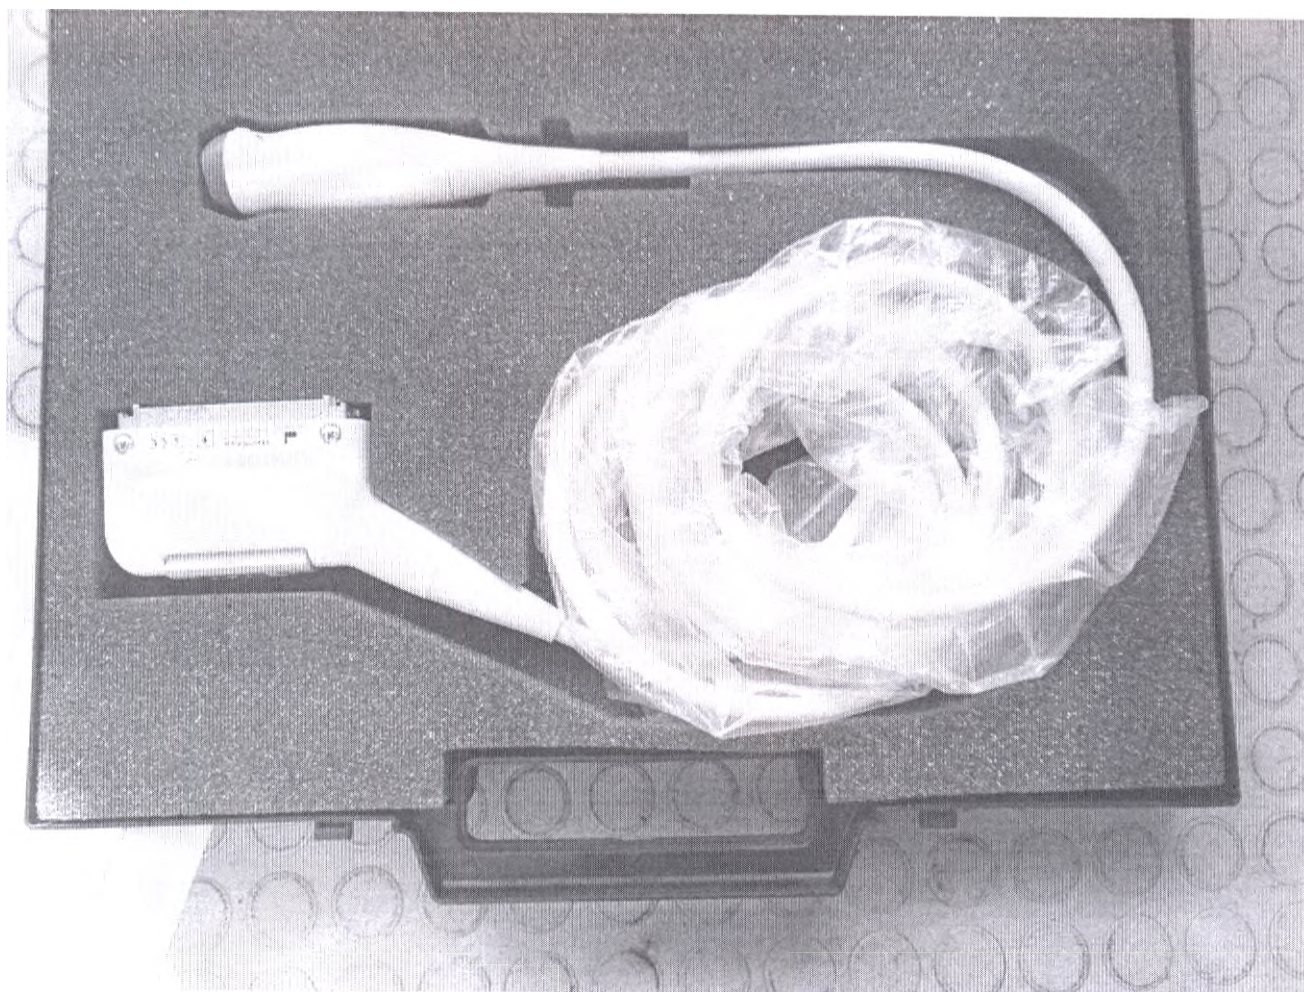

P2 3-11

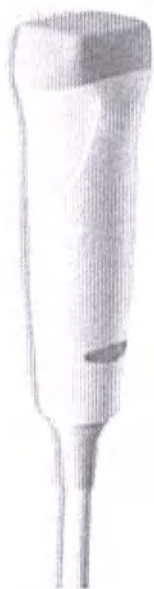

P2 5-13



SP2730



2. С электронной решеткой:

2.1. Конвексные


AC2541




CA541



CA631

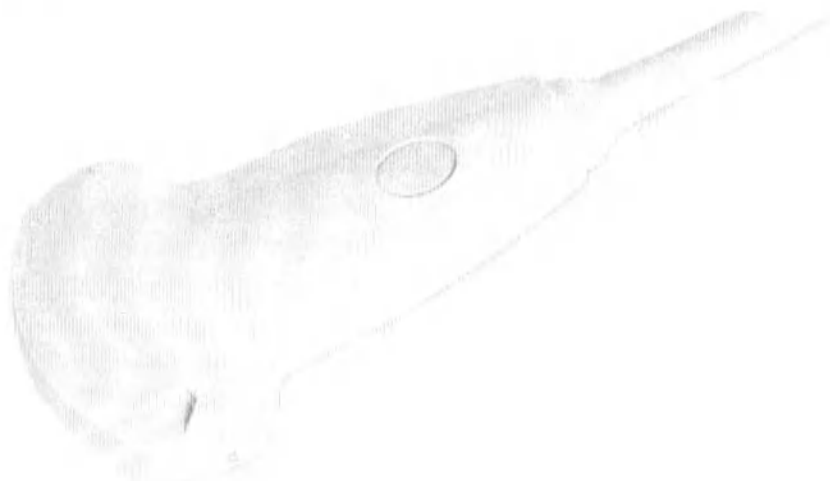

CA430E

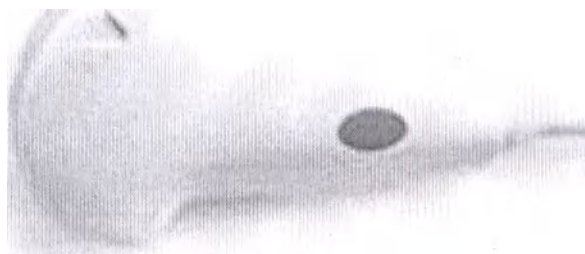


SC3123



SC3421



mC 3-11.

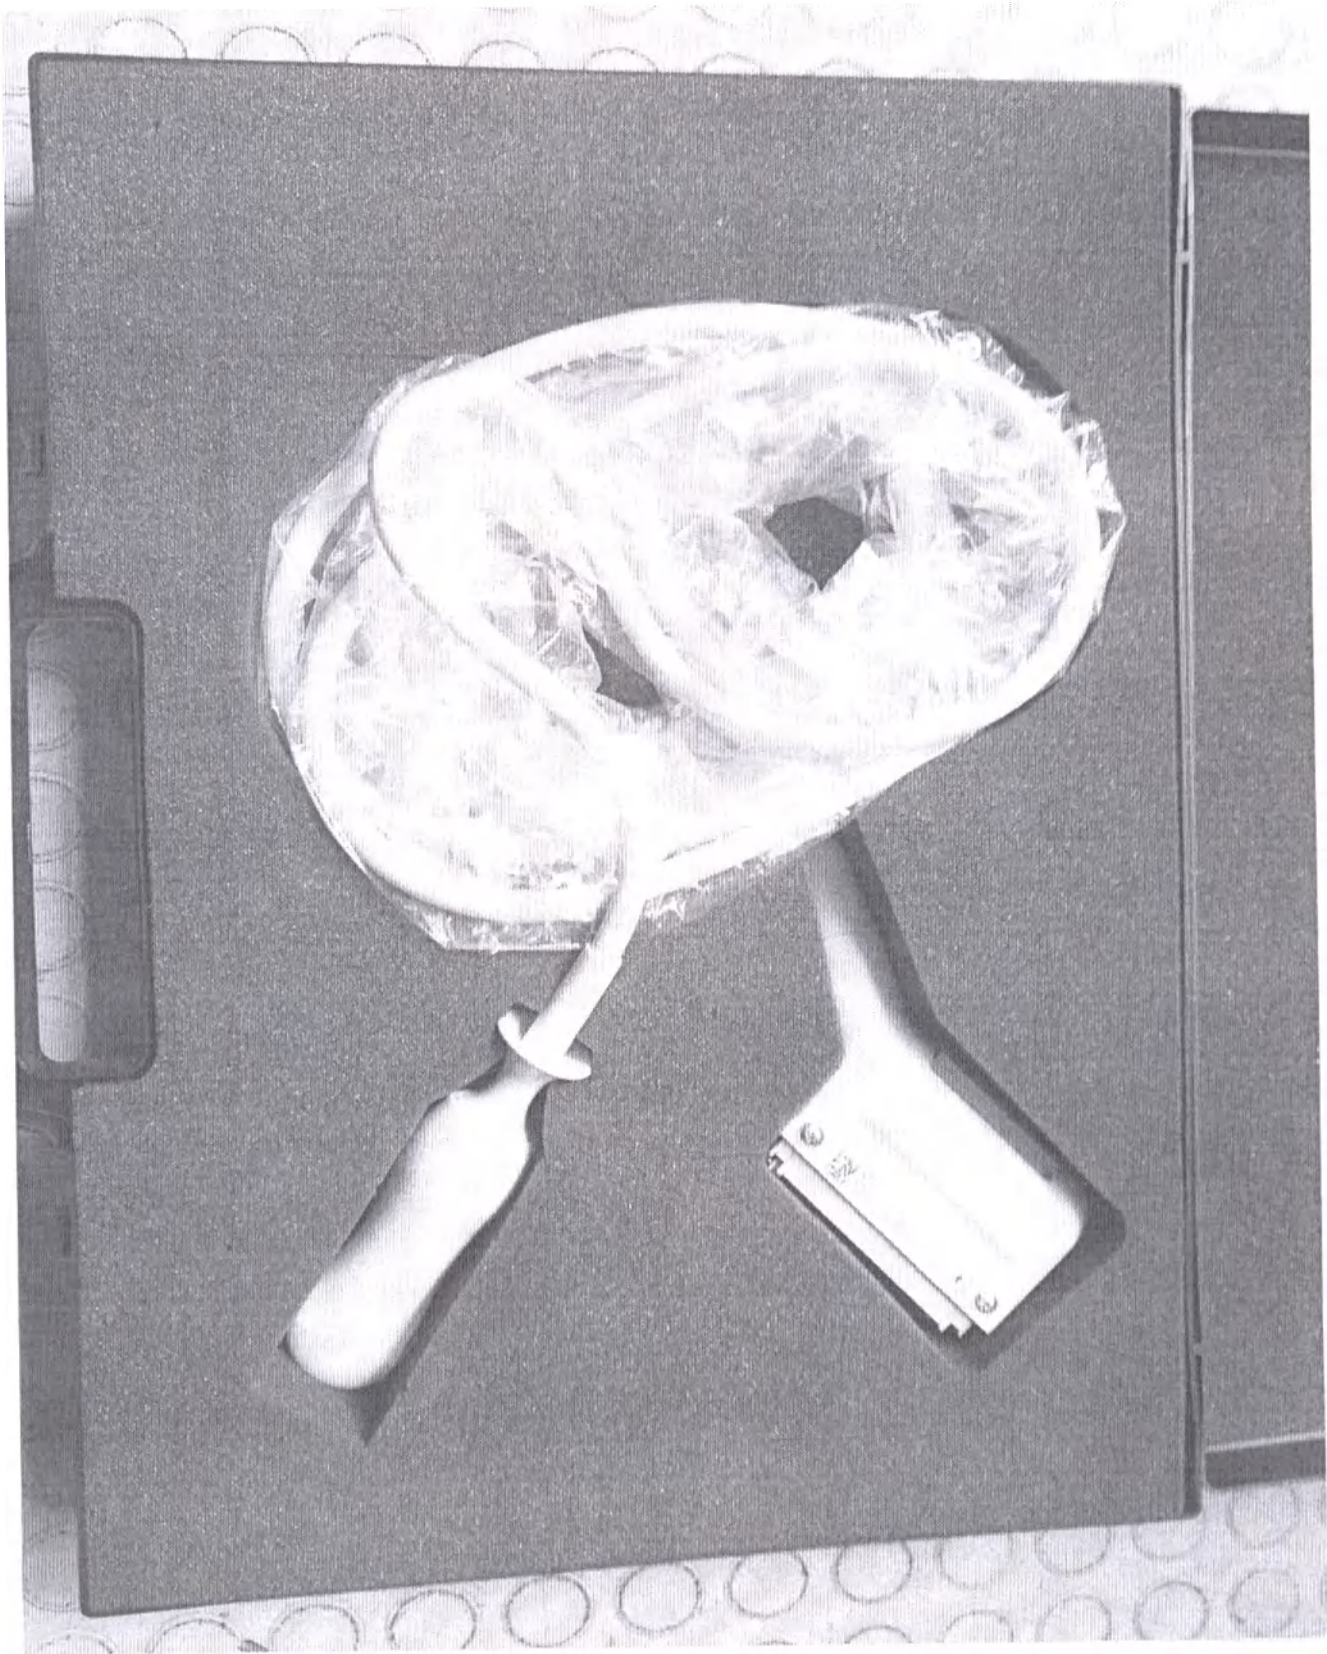

EC1123 – внутриполостной

SE3123 – внутриполостной


SE3133 – внутриполостной.

2.2. Линейные:


LA332E



LA435

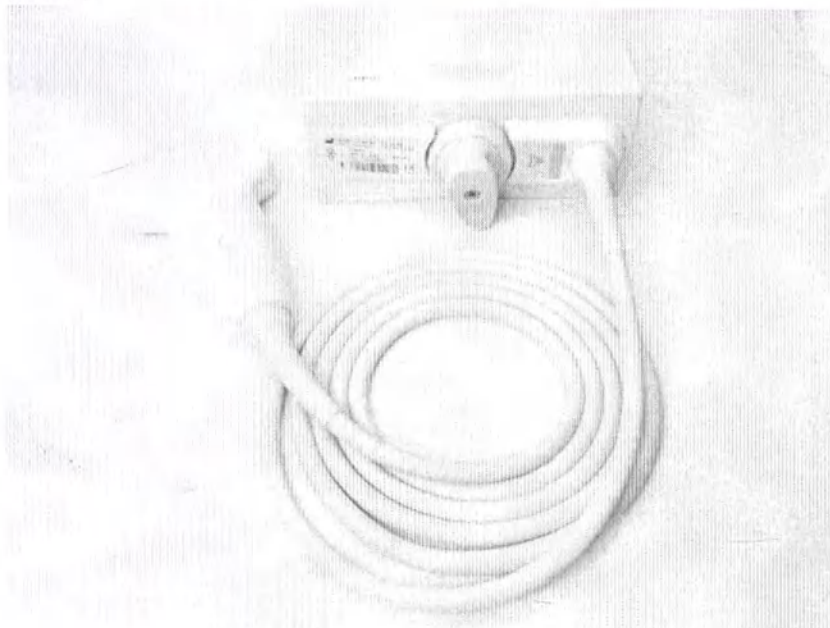

LA523

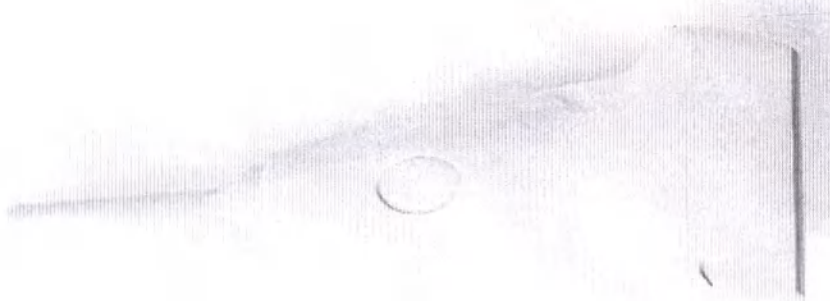

LA533



AL2442




AL2443




AL2445


L 3-11

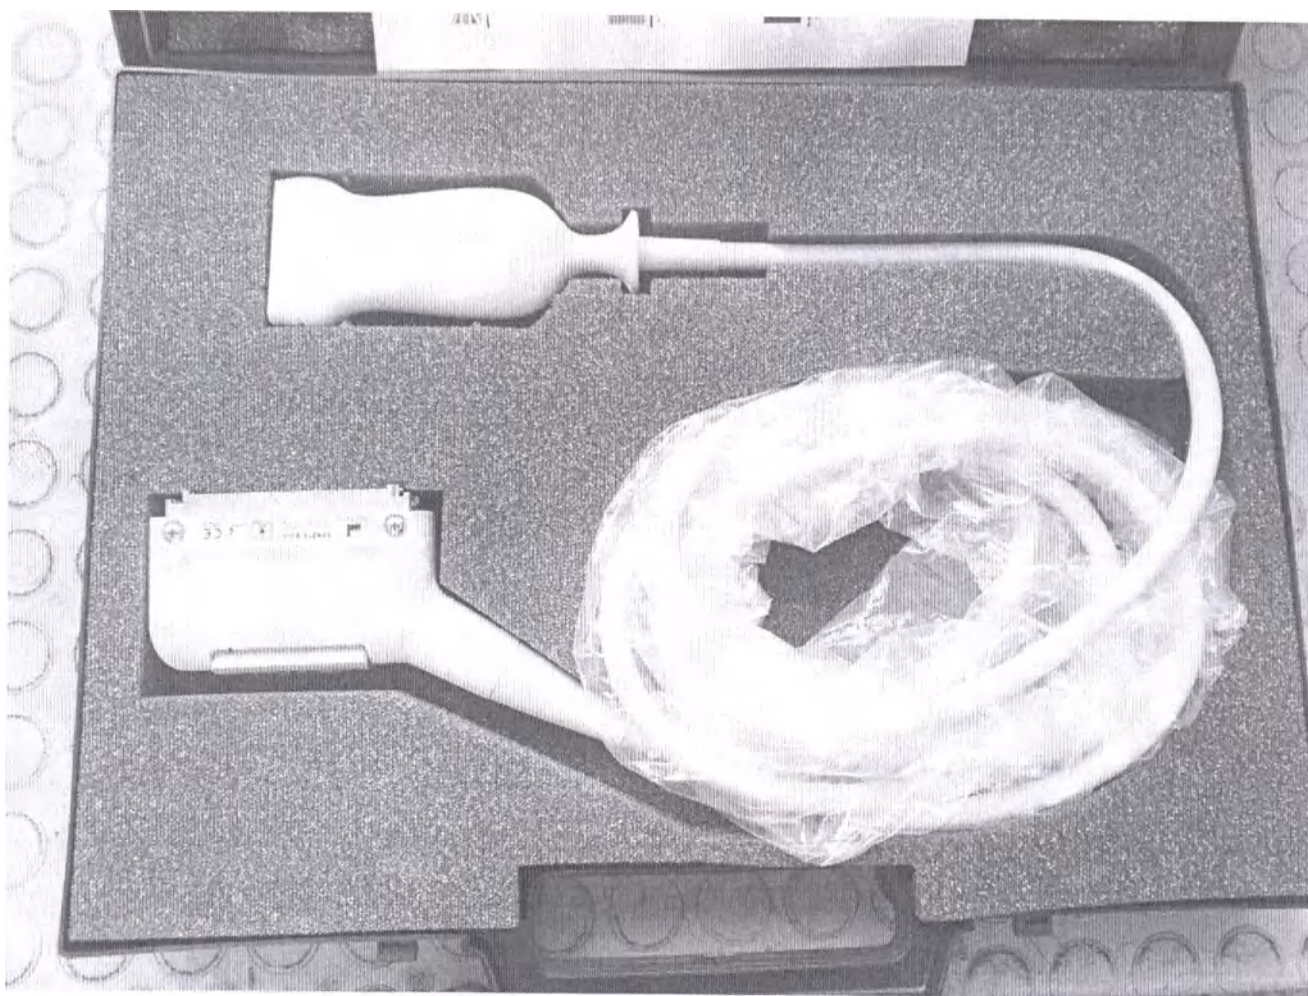

SL1543

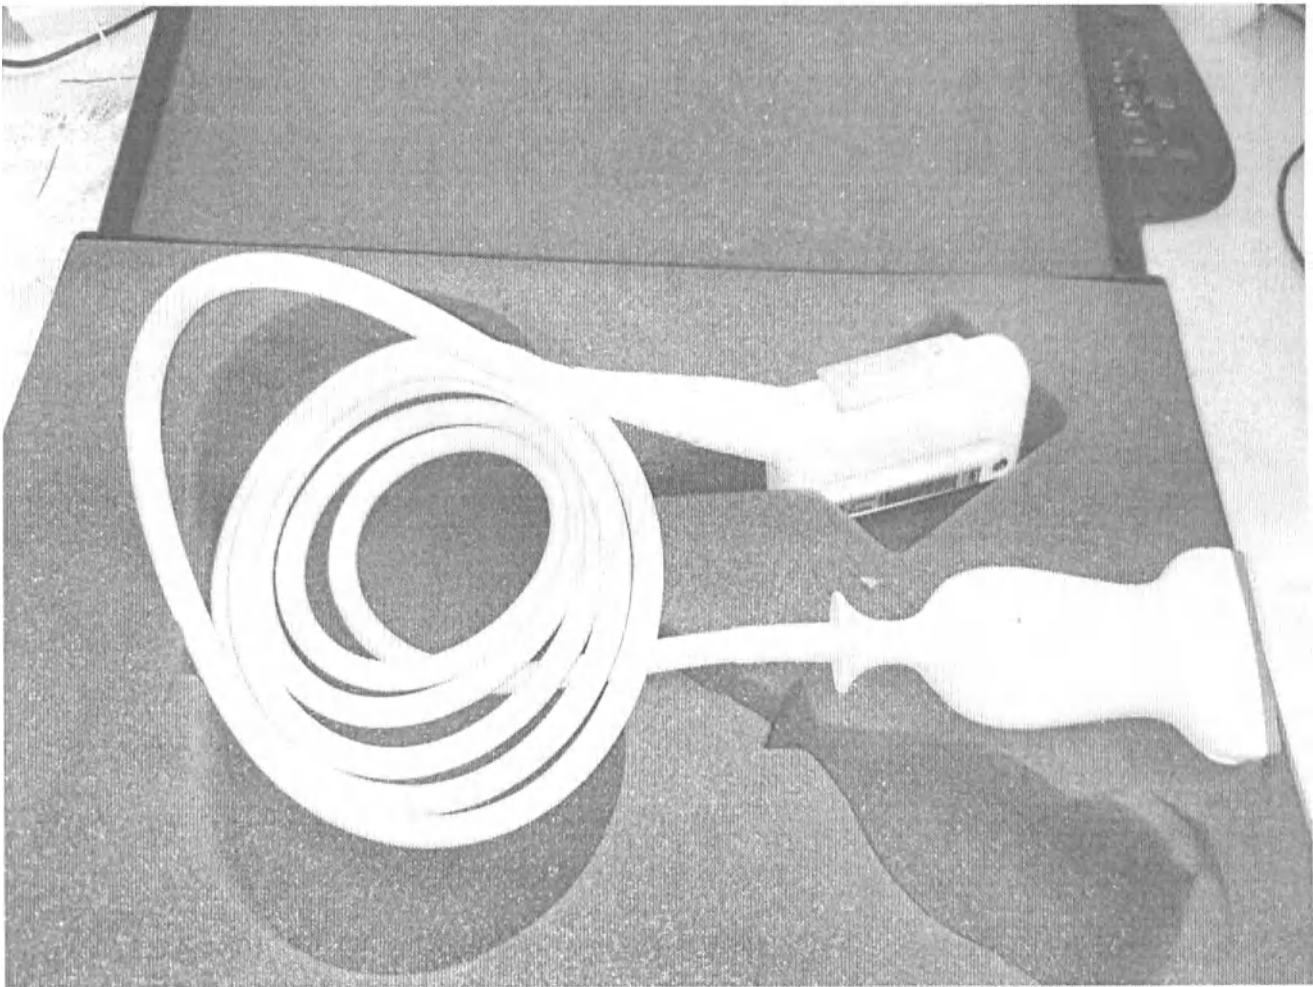

SL3116

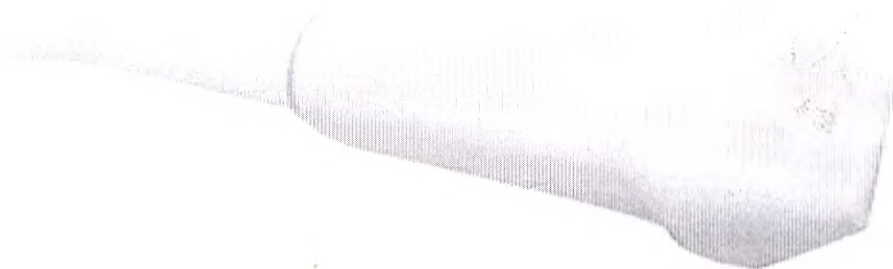

SL2325



SL3235



SL3323



SL3332

.....

2.3. Специальные Датчики:


ST2612



ST2613



ИОТ332

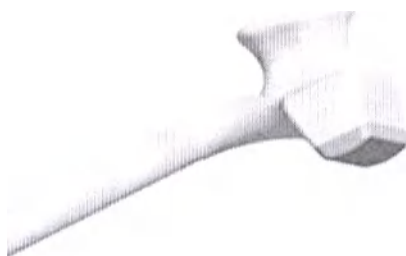


ИОТ342


ИОЕ323 – интраоперационный.



2.3.6. ИИ 6-18 – интраоперационный.

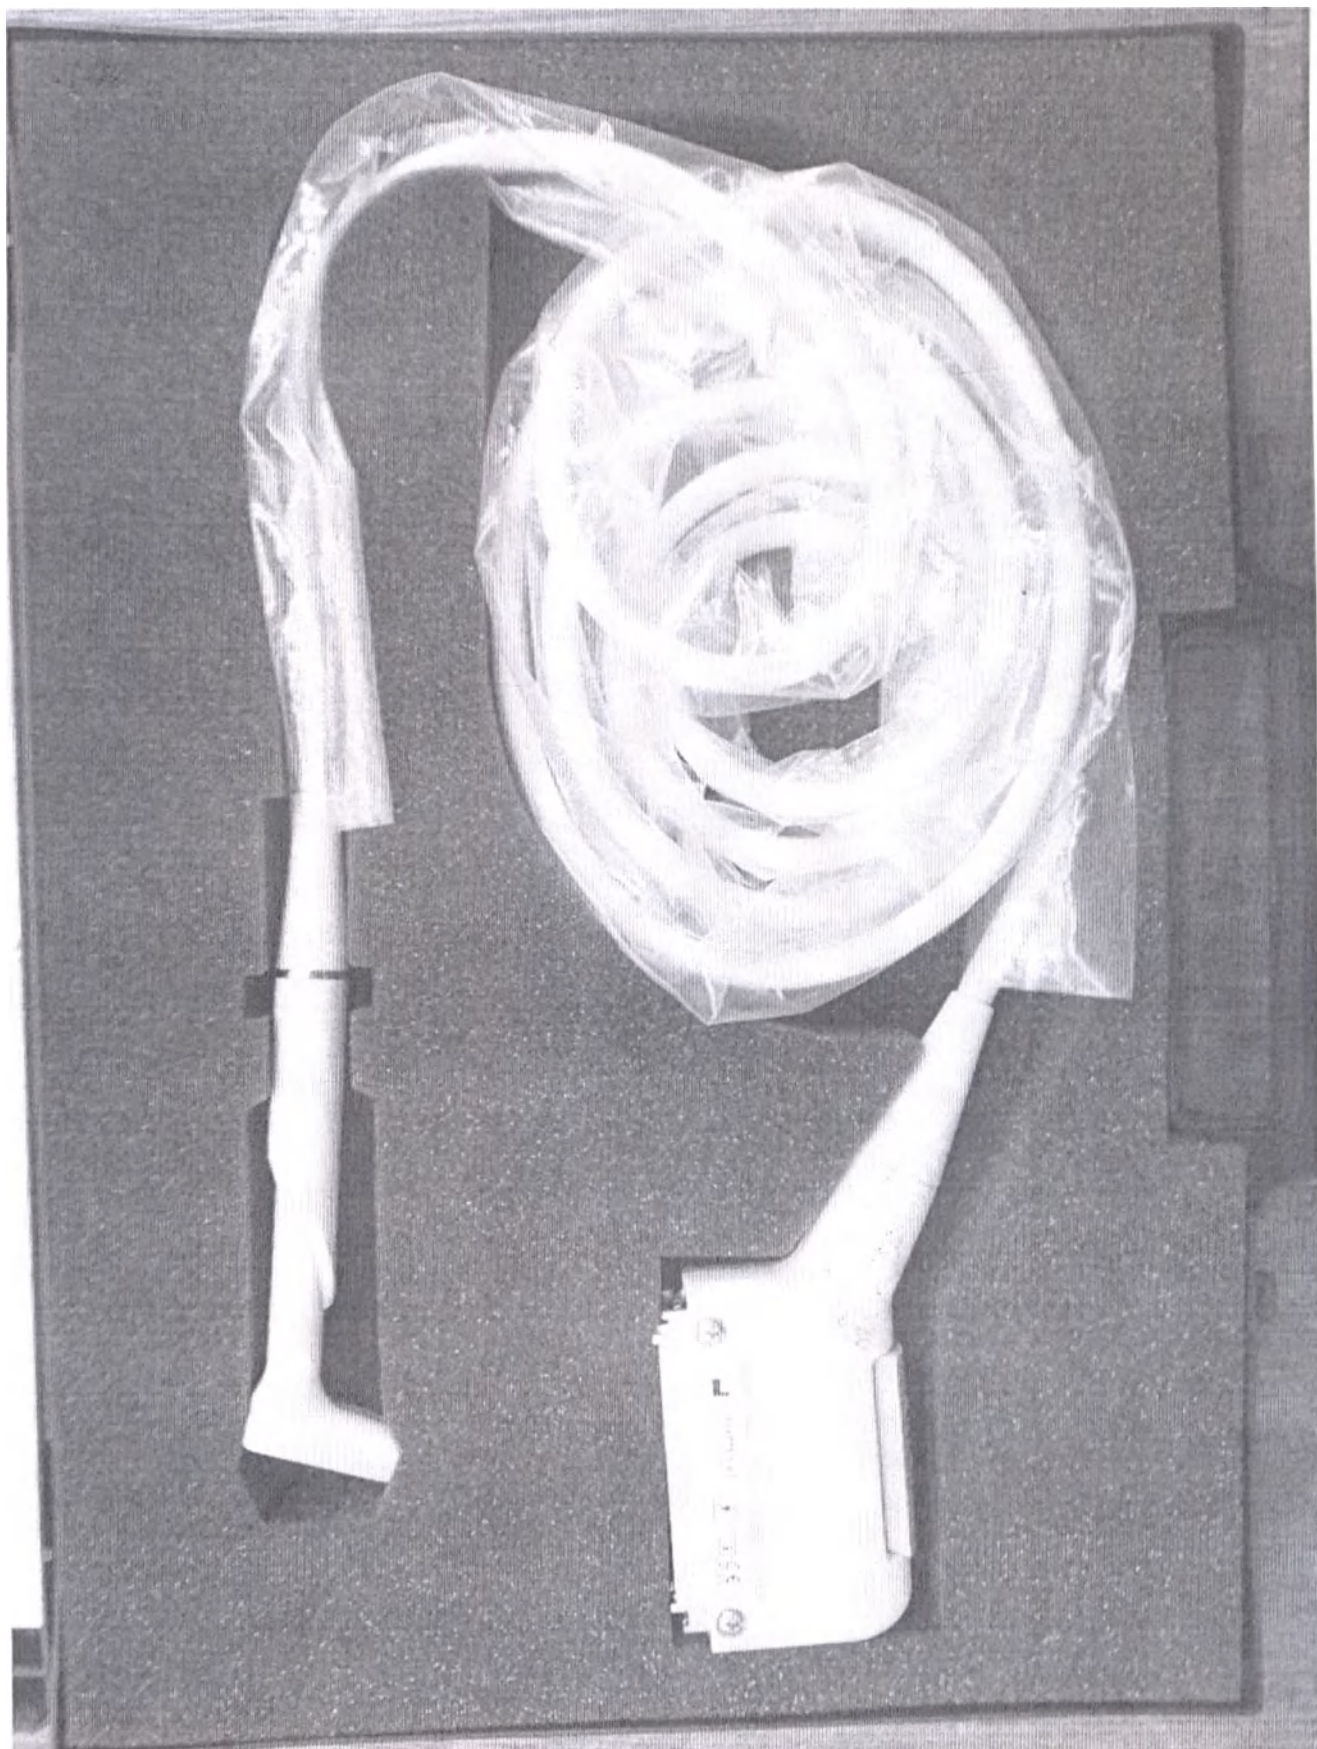

2.3.8. LP 4-13 – лапароскопический.

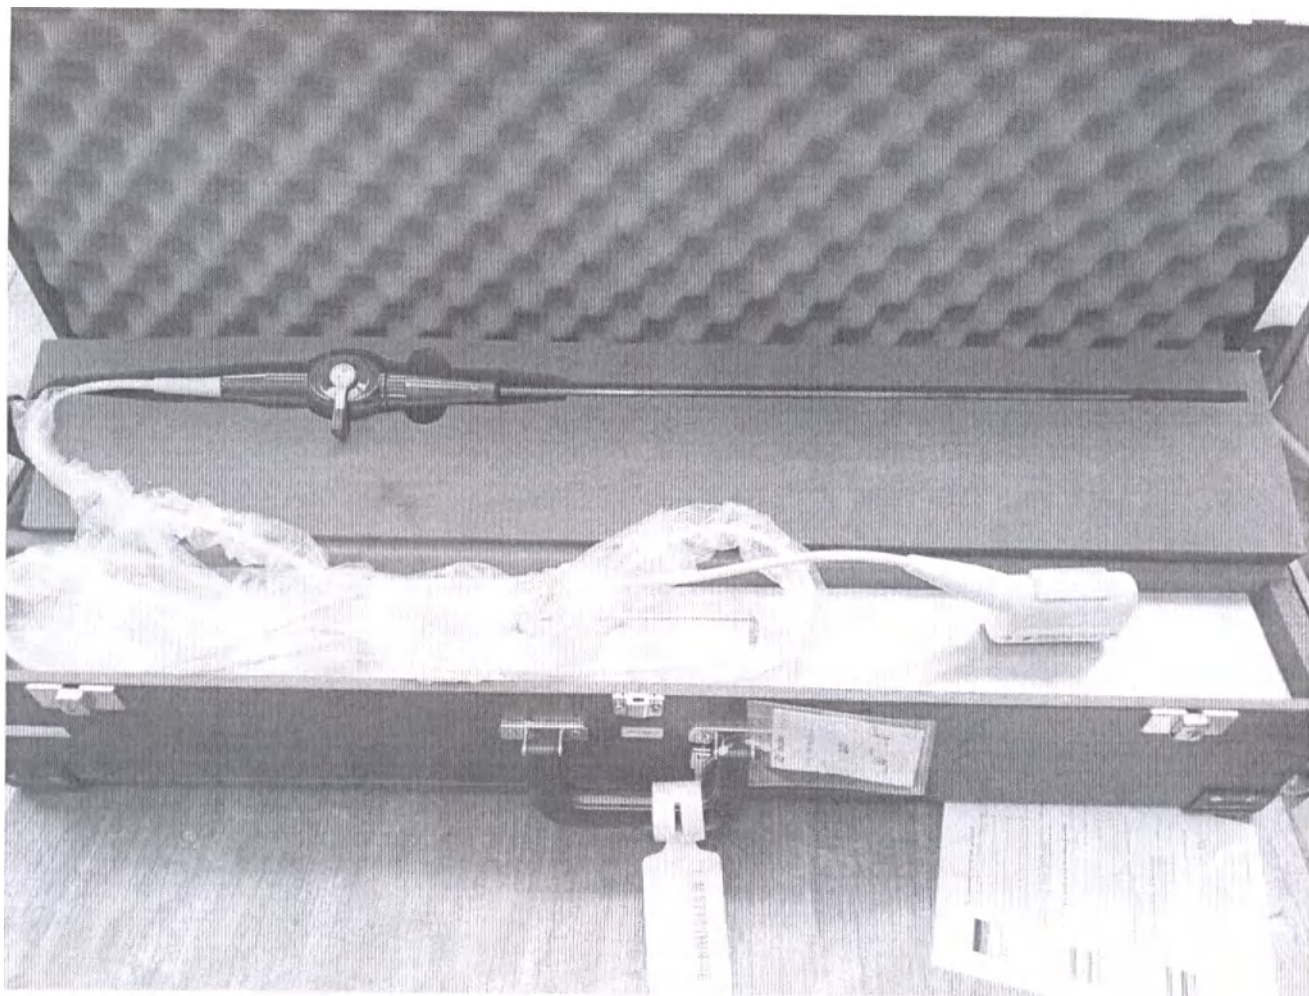

LP323



BL433




BC441




BC431



SB2C41 – конвексный для 4D.

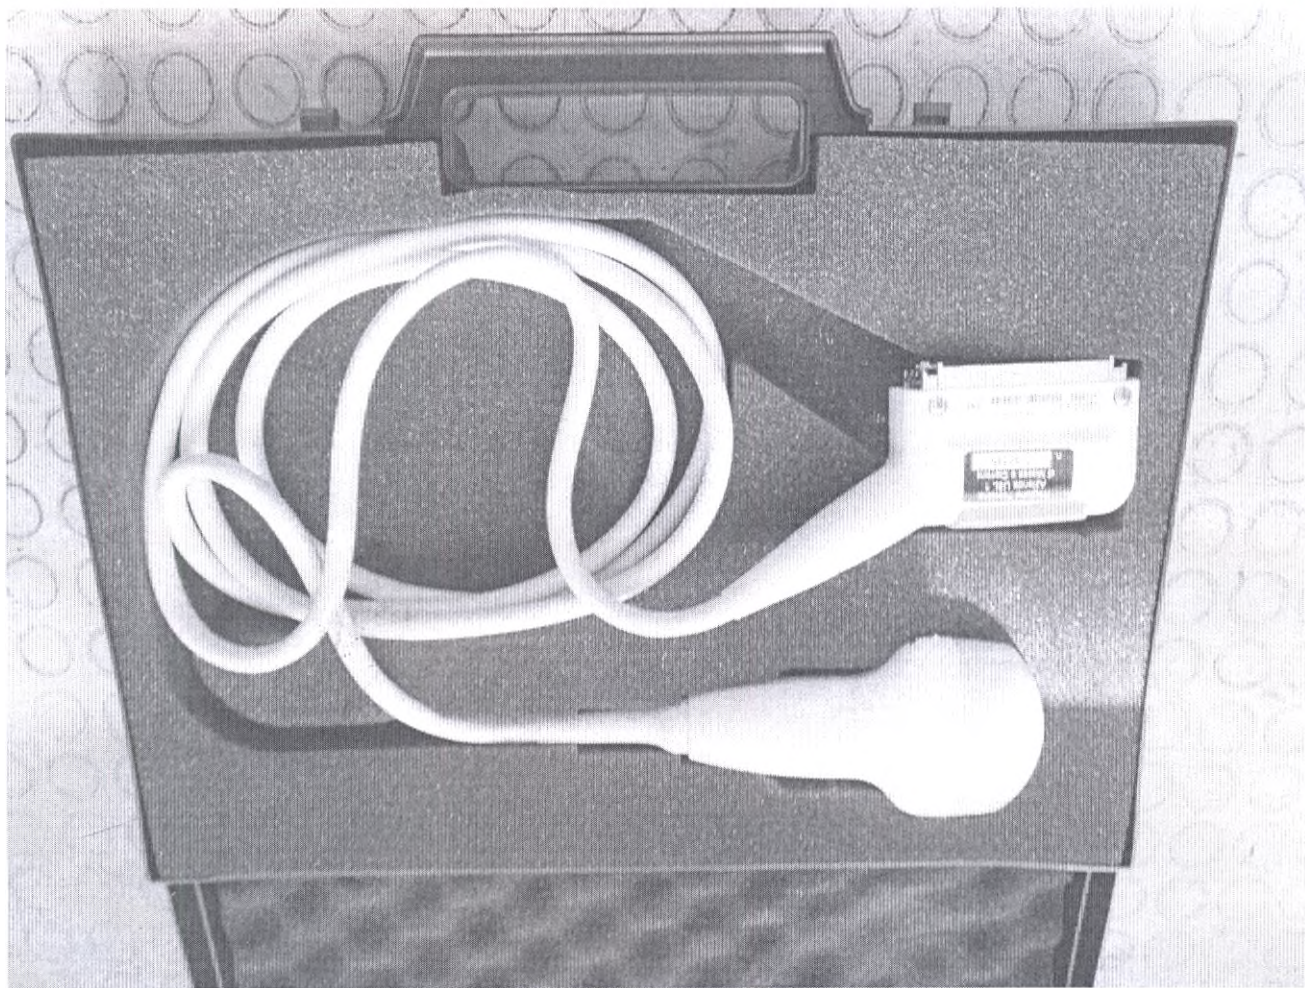

SI2C41 – конвексный с центральной биопсией

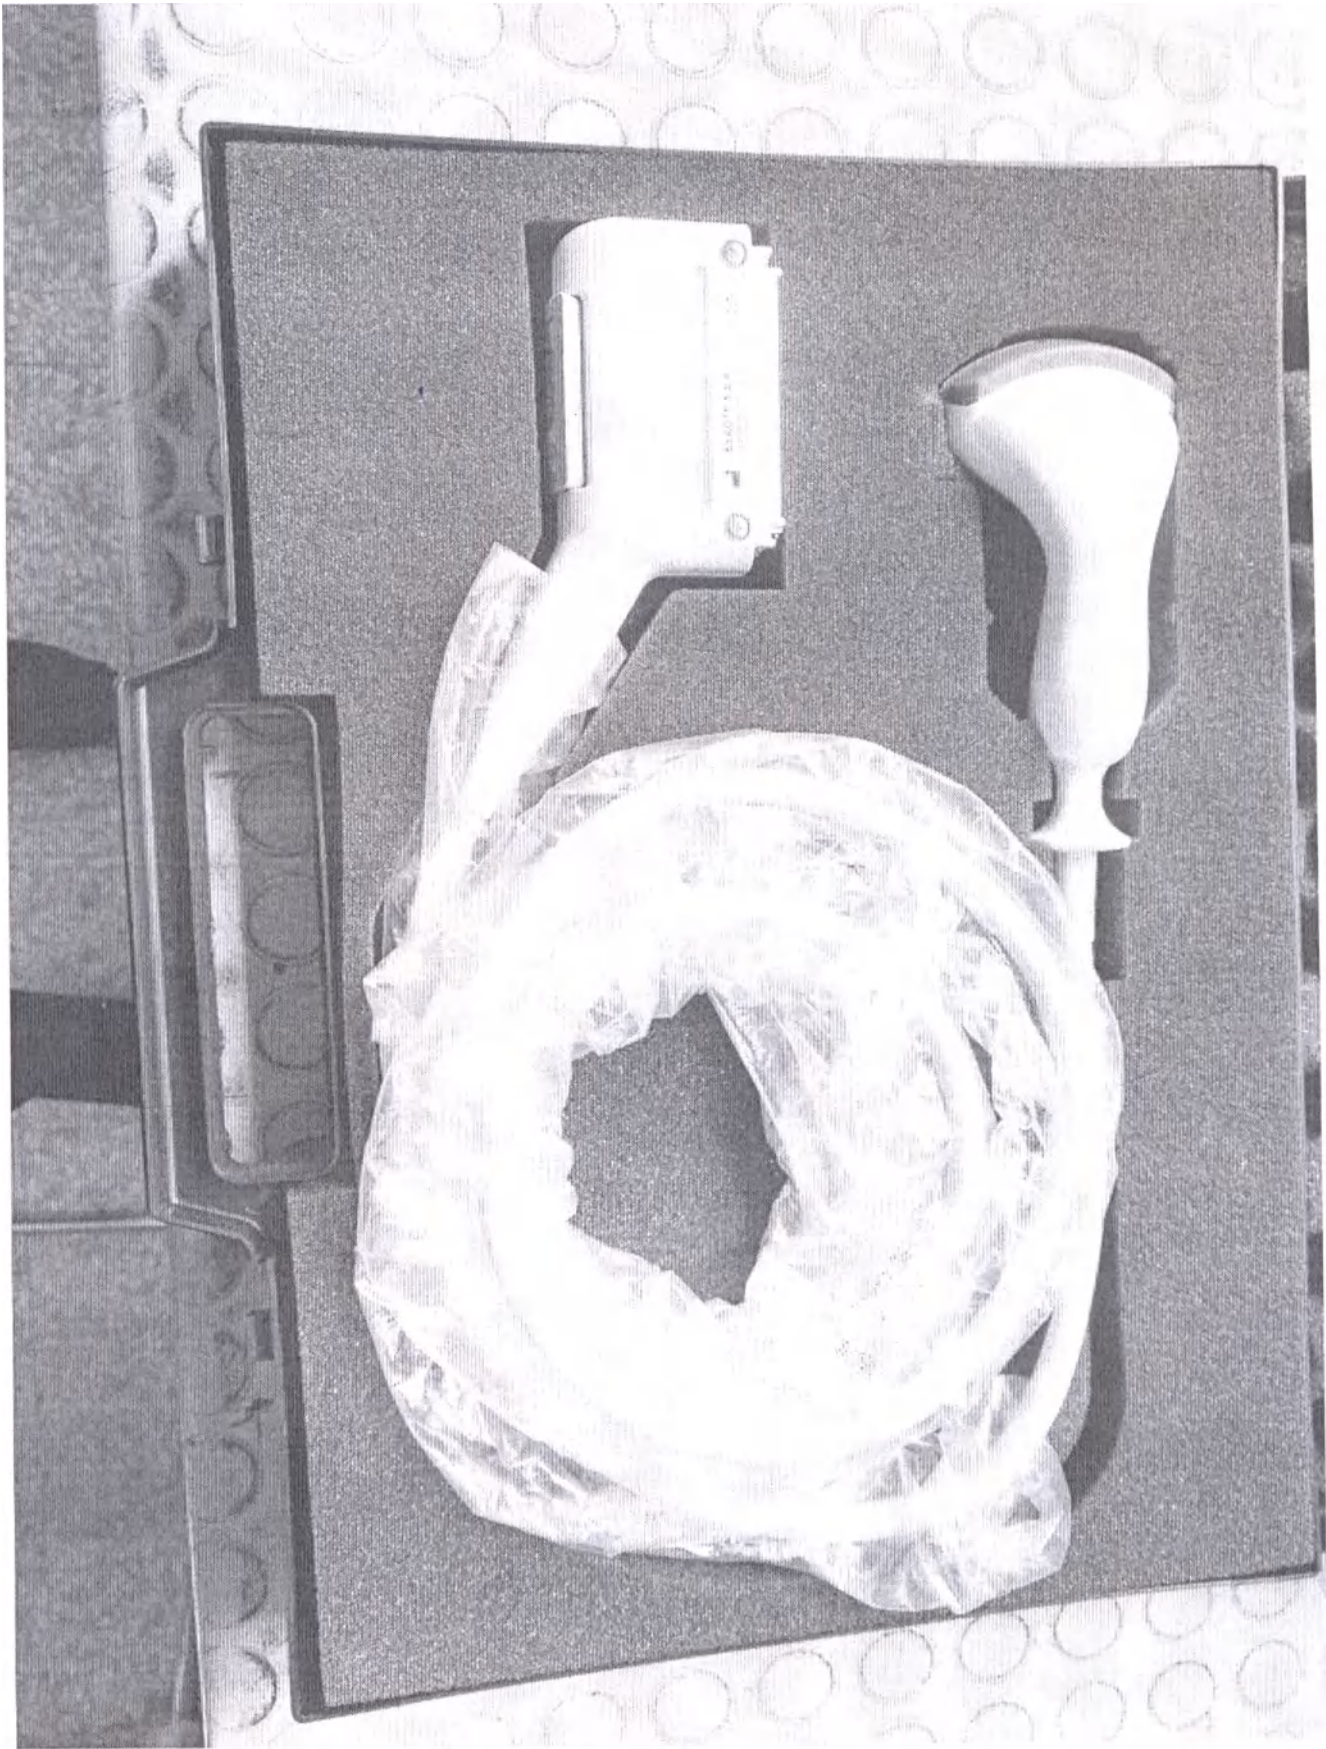


BE1123 – внутрисполостной для 4D


SB3123 – внутрисполостной для 4D

TRT33 – биплановый ректальный.


TLC 3-13 – биплановый ректальный.

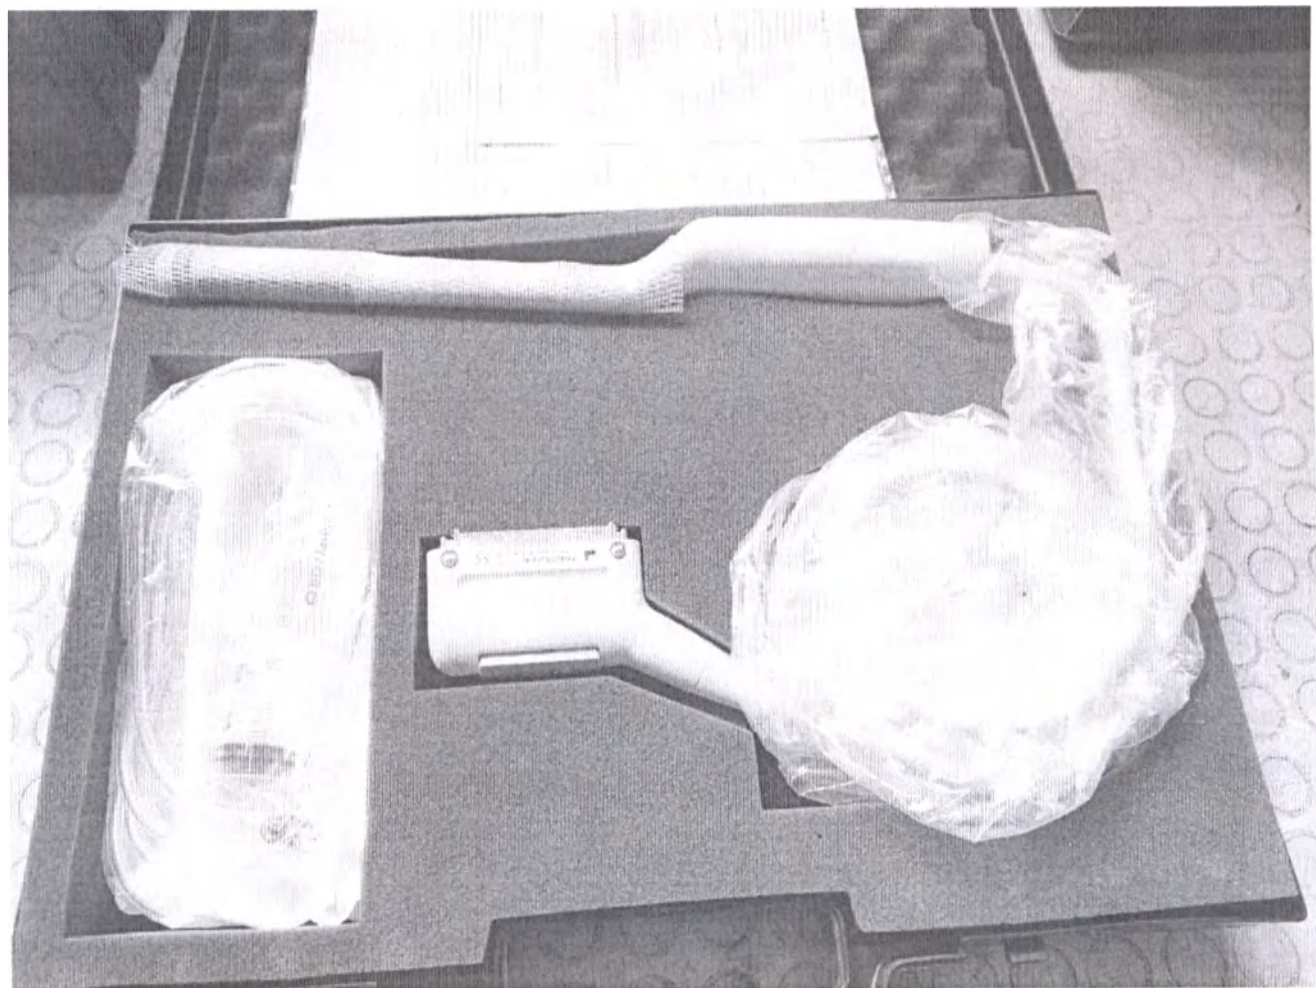

S2MPW Доплеровский датчик.

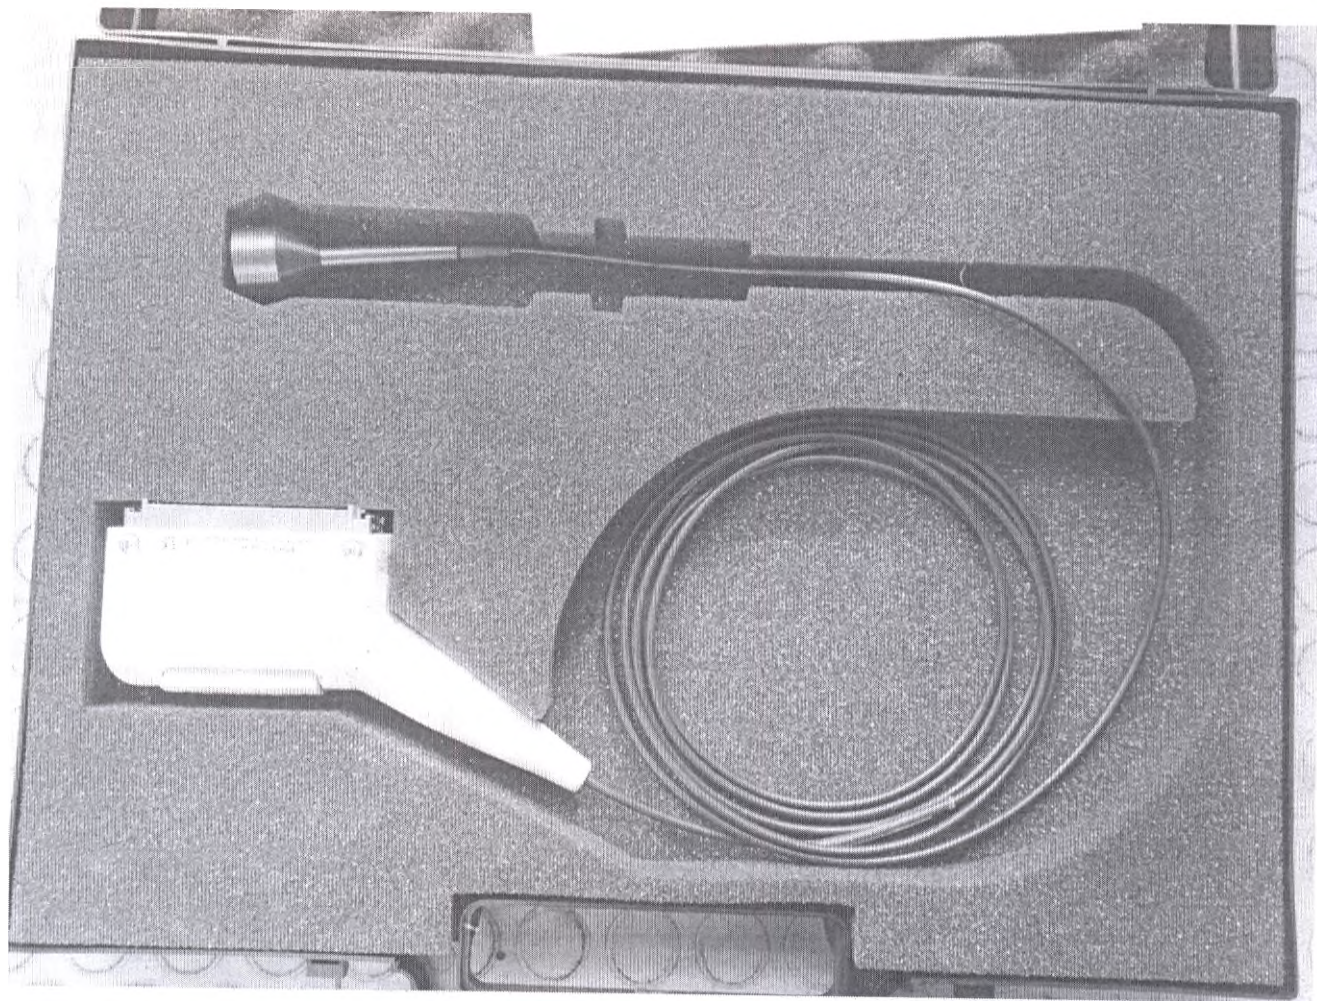

S2MCV

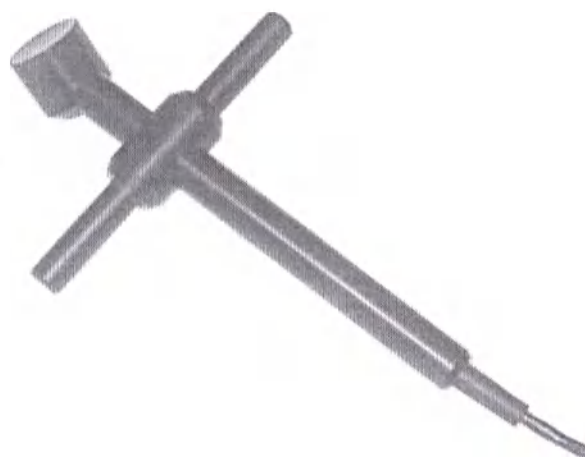

S5MCW



SHFCW




II. Насадки для датчиков:

1. Биопсийные насадки:

Для фазированных датчиков (не более 10 шт.).

КС


1.2. Для конвексных, в т.ч. внутриполостных датчиков (не более 10 шт.).

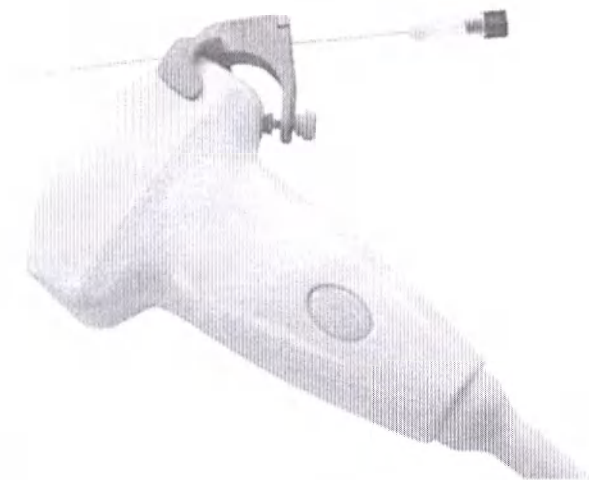


Для линейных датчиков (не более 10 шт.).




1.4. Для специальных датчиков (не более 10 шт.).

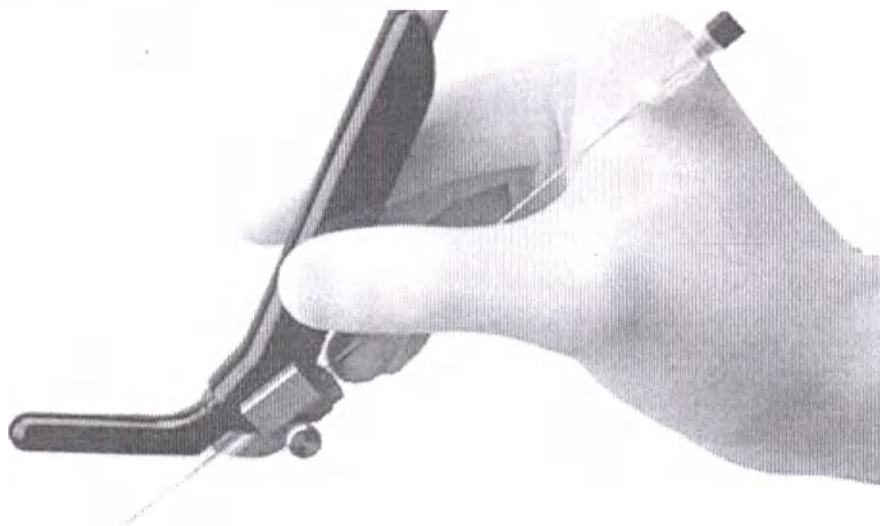


IV. Лицензии:
1. Cardio.

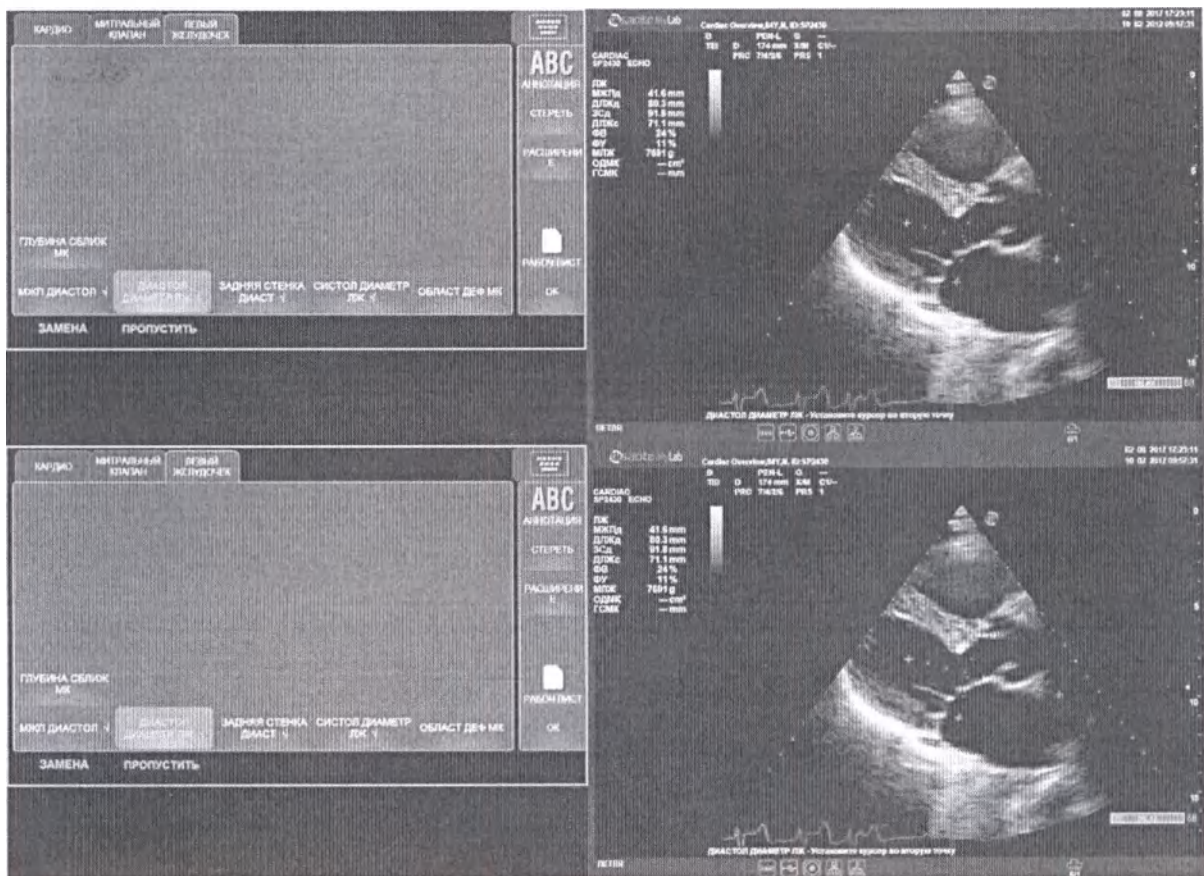


2. Advanced Cardio (Strain rate + Stress).

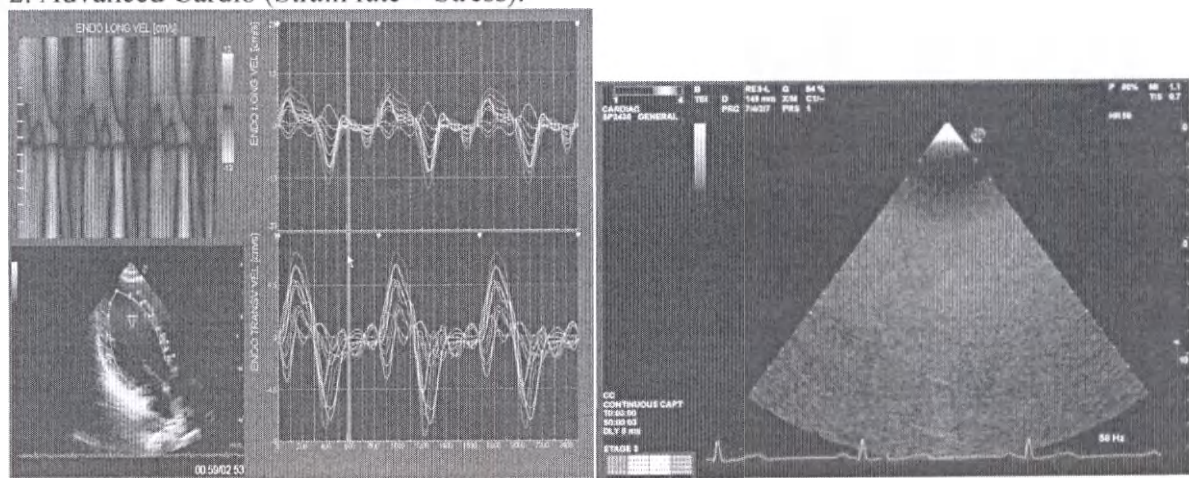

3. Vascular.

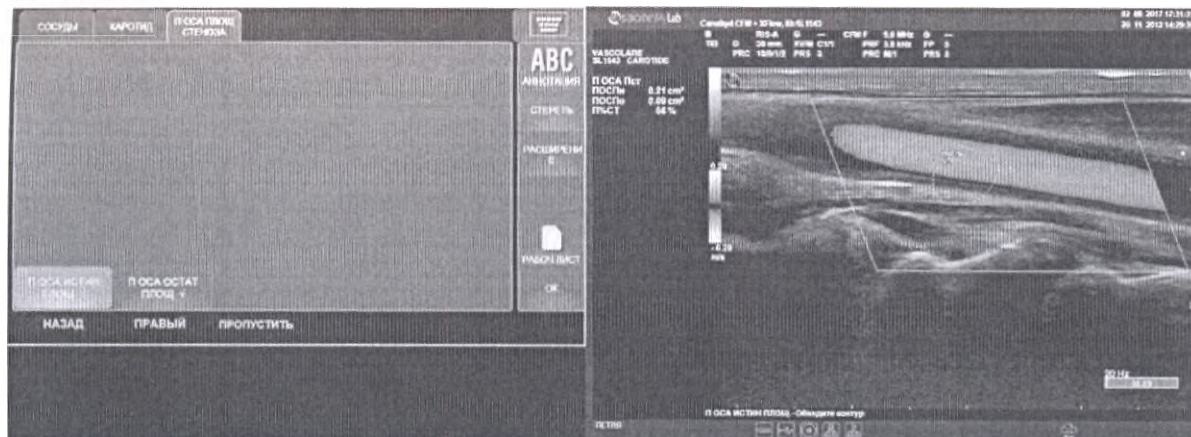


4. Women's Health (Ob/Gyn).

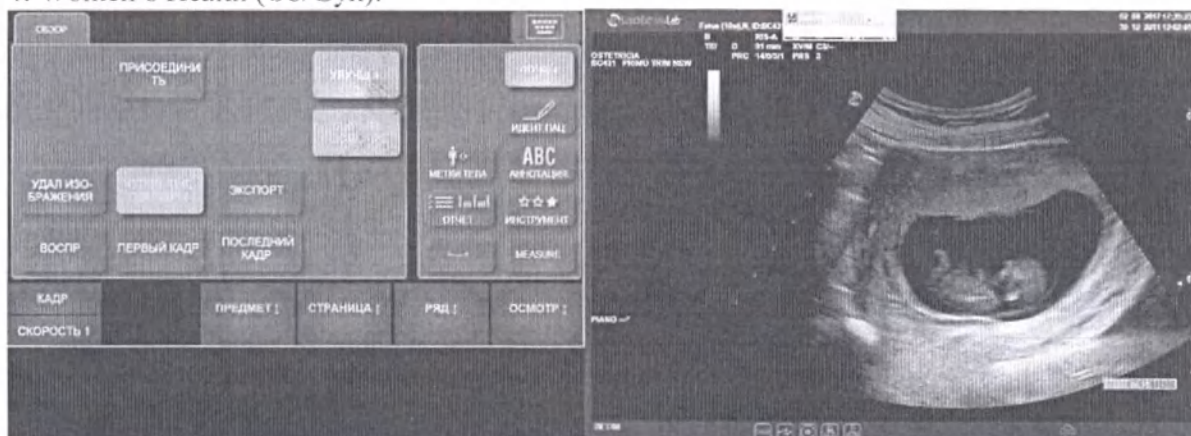


5. Urology.



6. Breast.

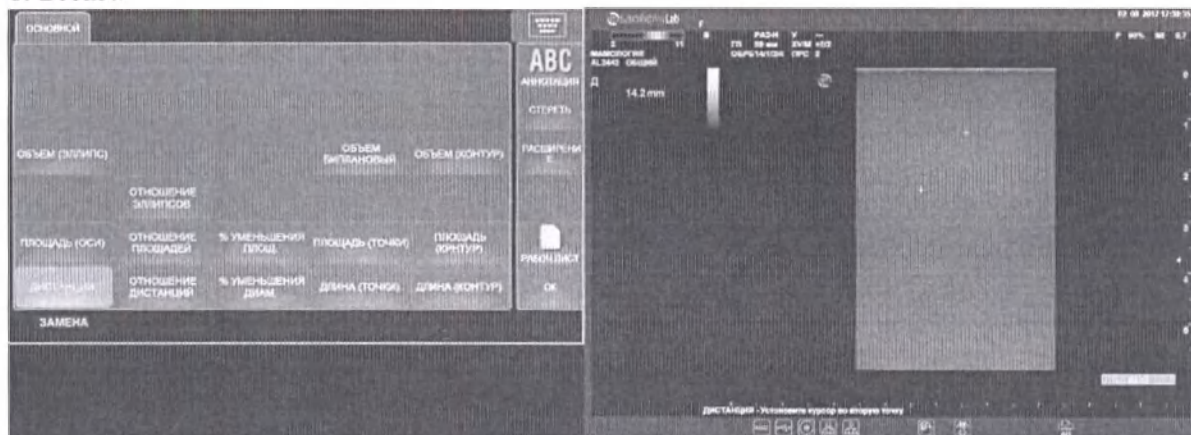

7. Musk/Skeleton.

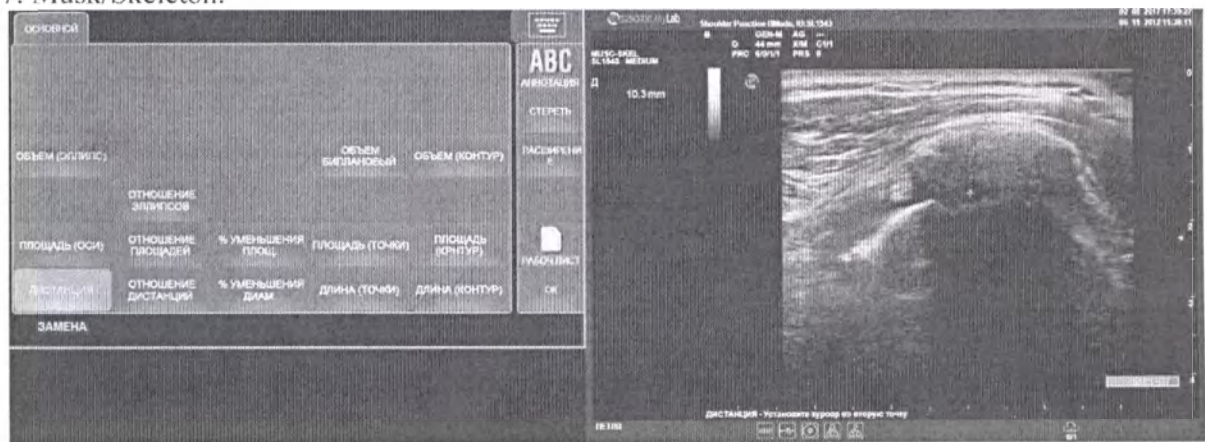


8. Thyroid.




9. TEI.

Thyroid Mass CFM, XFlow, ID:SL1543				
B	GEN-M	G	—	
TEI	D	37 mm	XV/M	C1/1
	PRC	10/0/2/1	PRS	3


10. Clips Archiving.

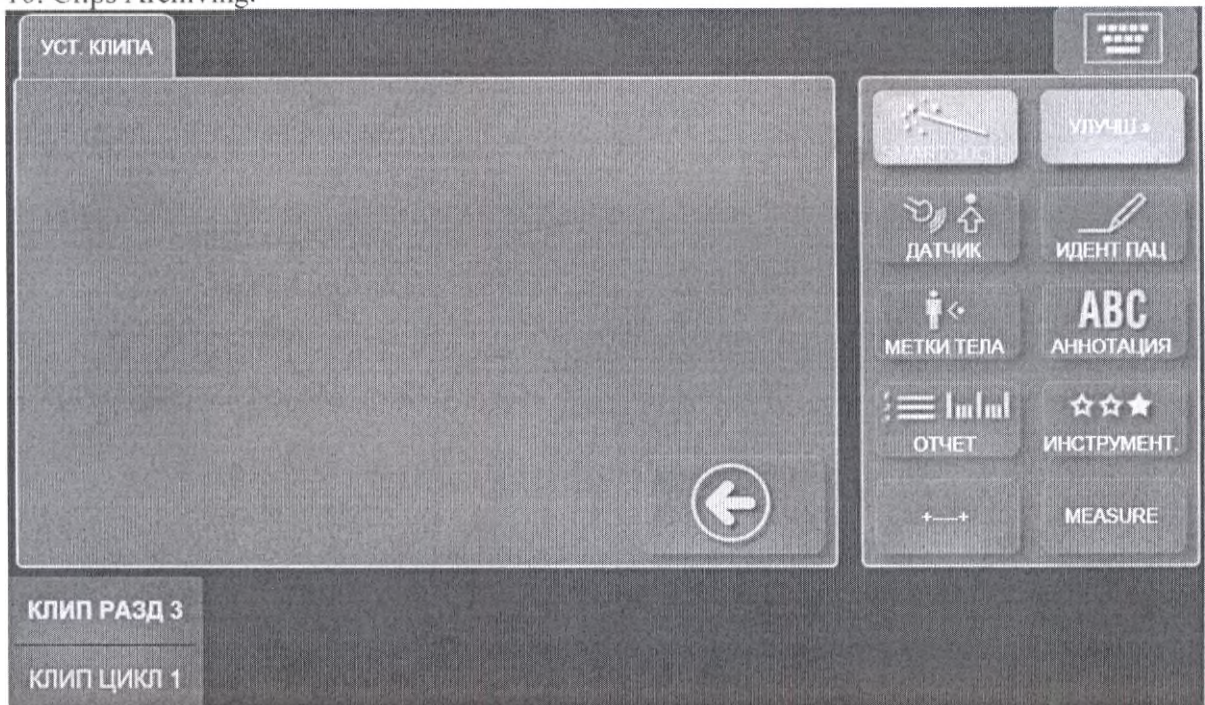

11. DICOM.

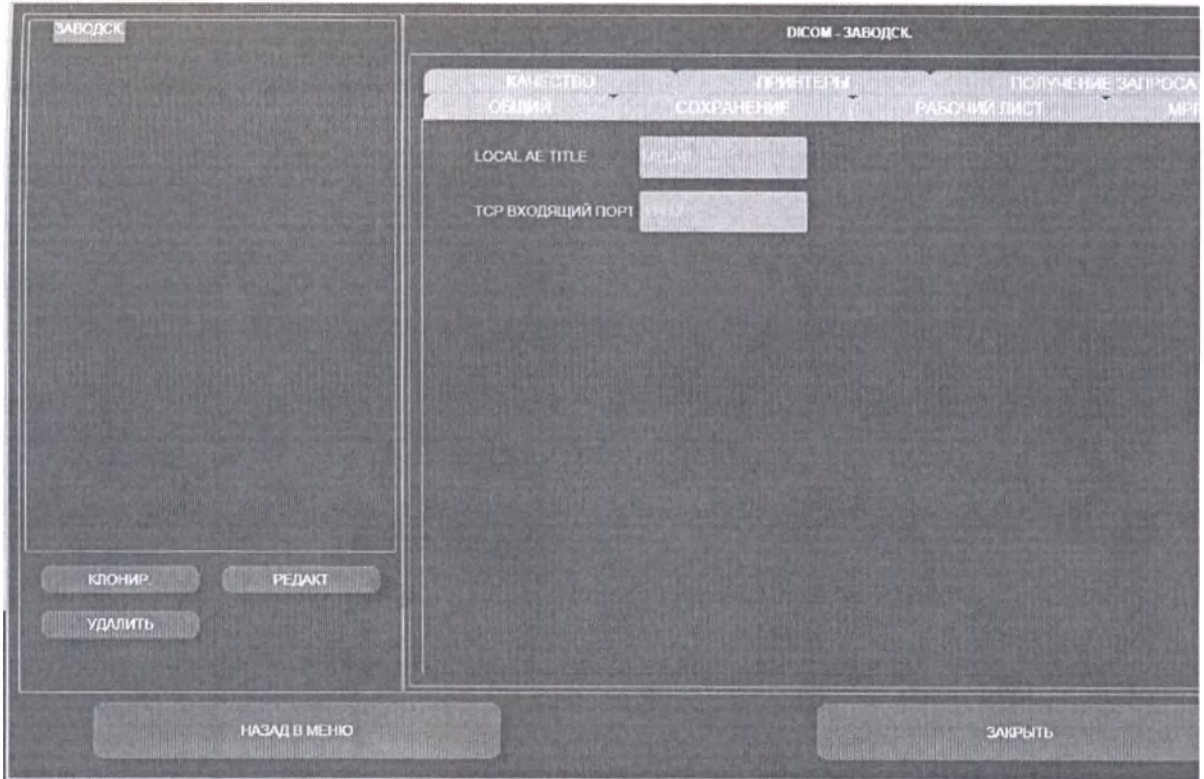


12. X-Flow.

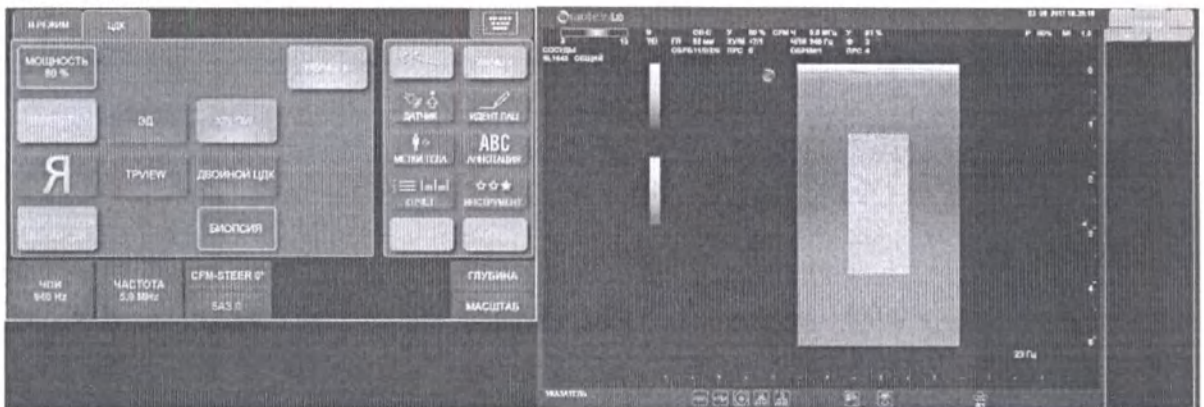


13. Doppler.




14. CFM.

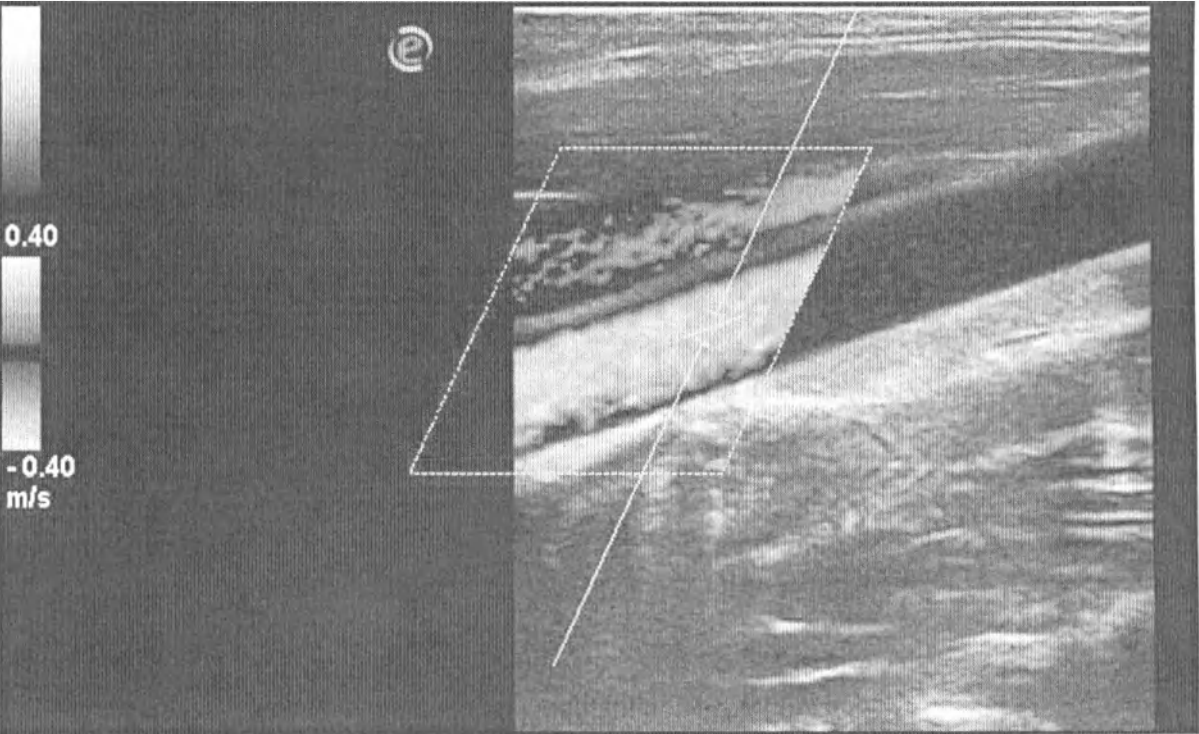


15. PW.

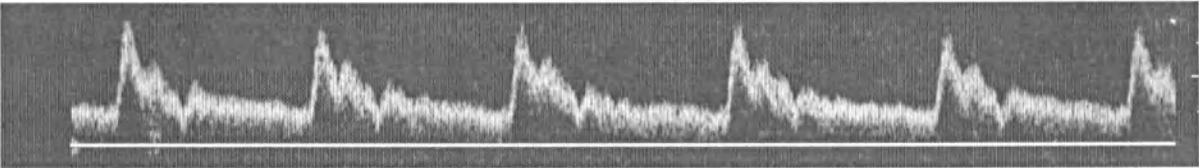


16. CW.

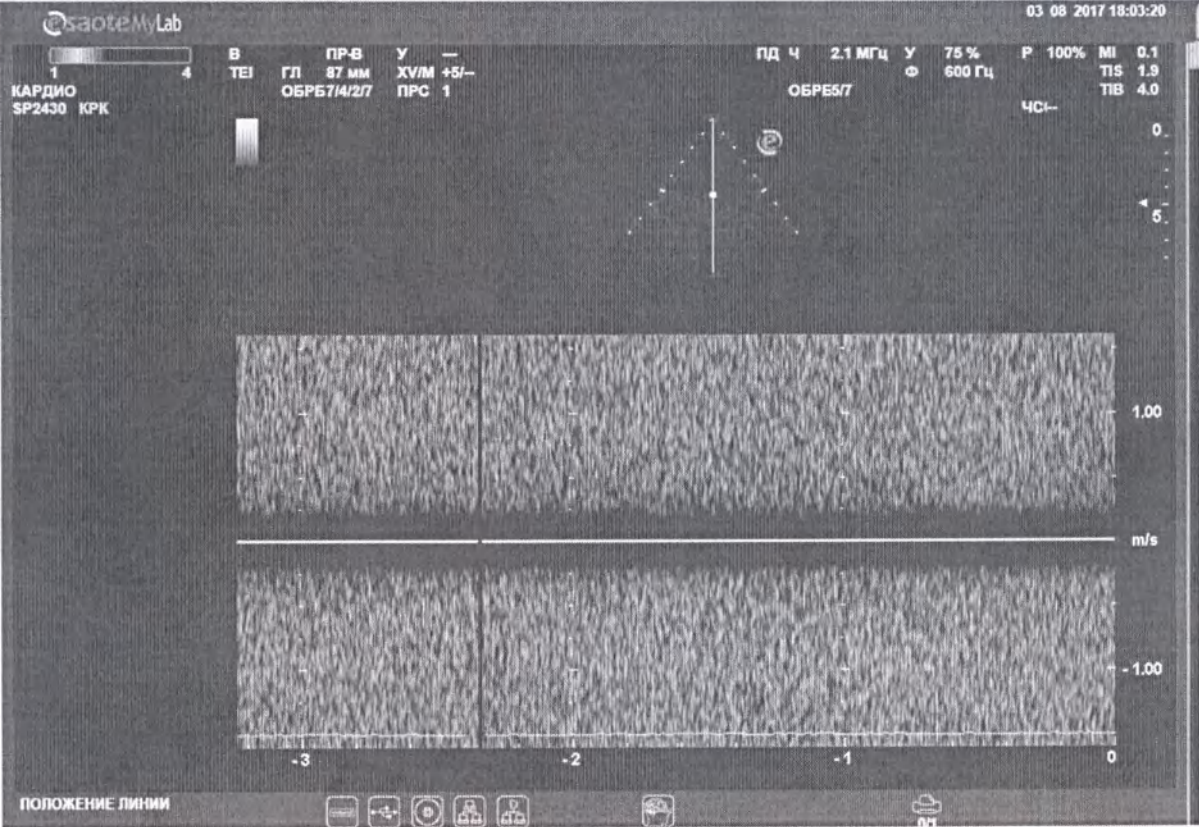


17. V-PAN.

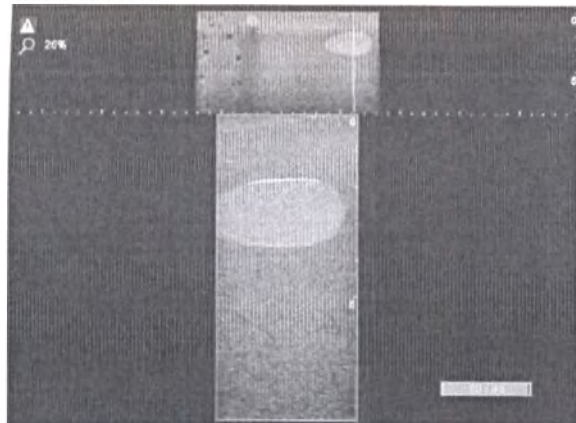


18. QIMT.

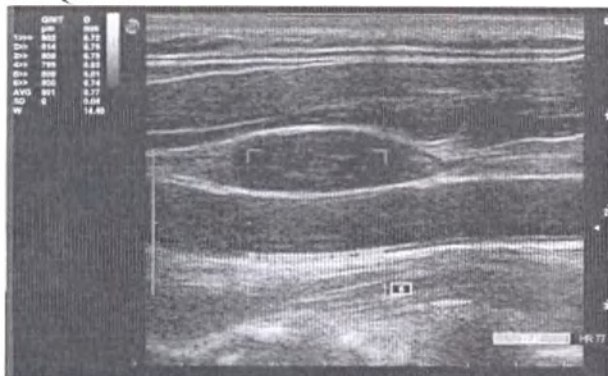

19. X-Strain.

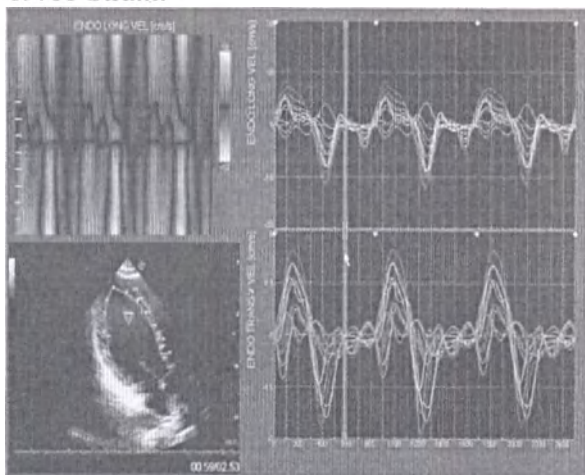


20. CMM.

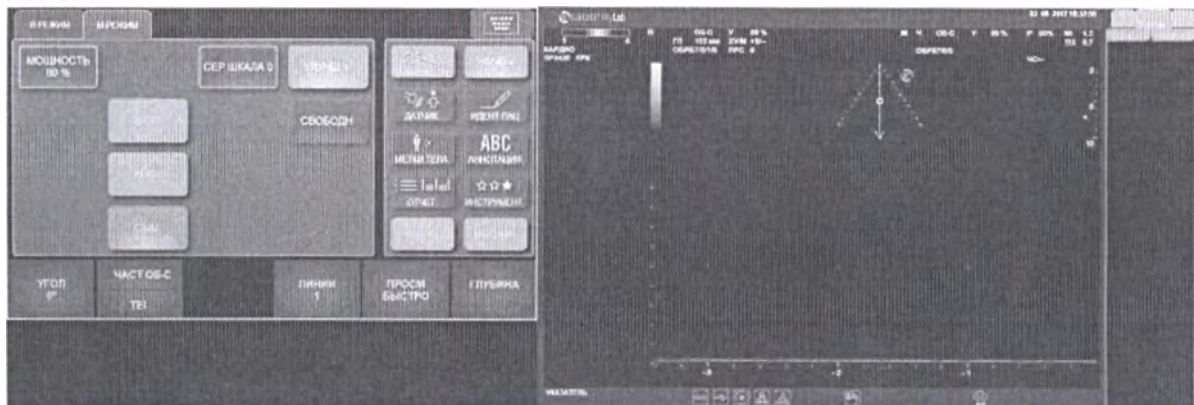

21. TVM.


24. CNTI.

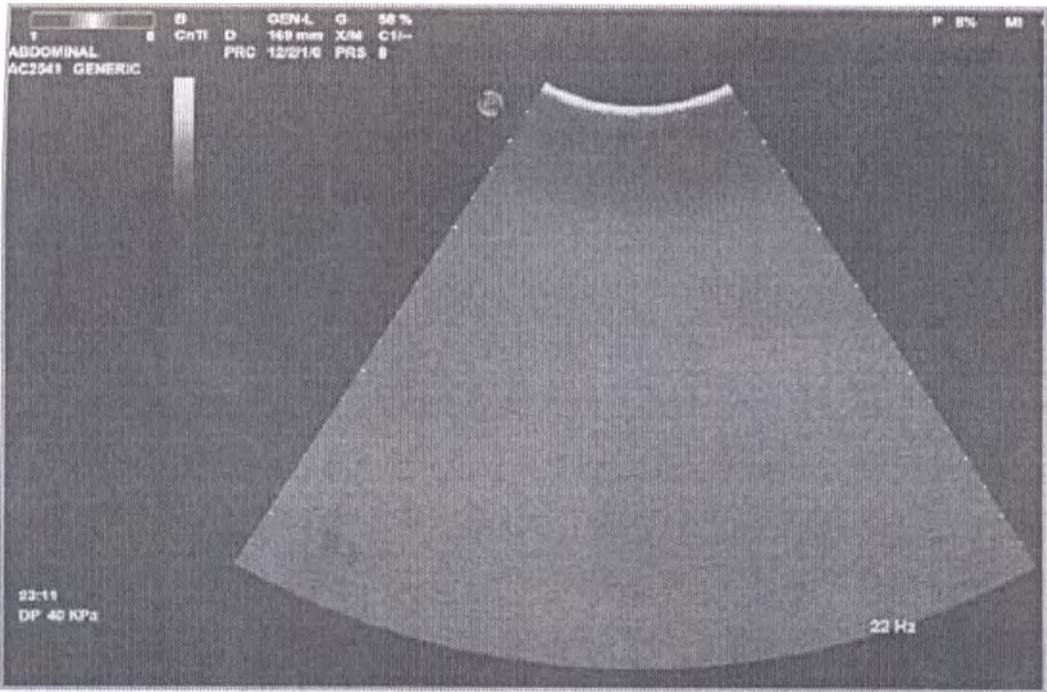


25. QAS.




26. Automatic Gain and TGC.

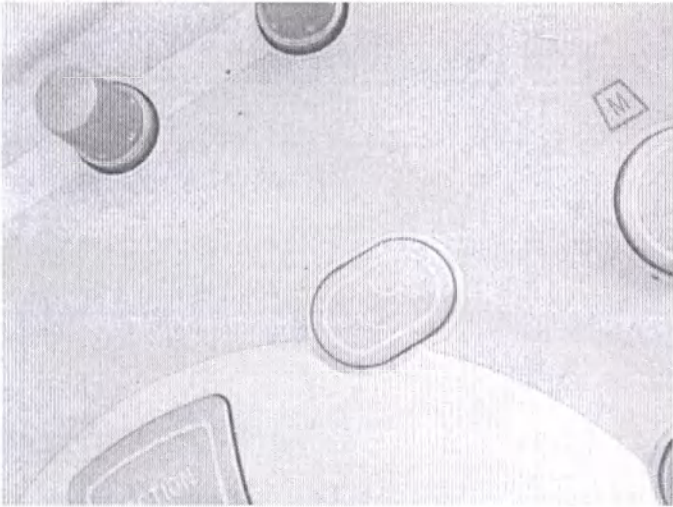


27. TP-View.

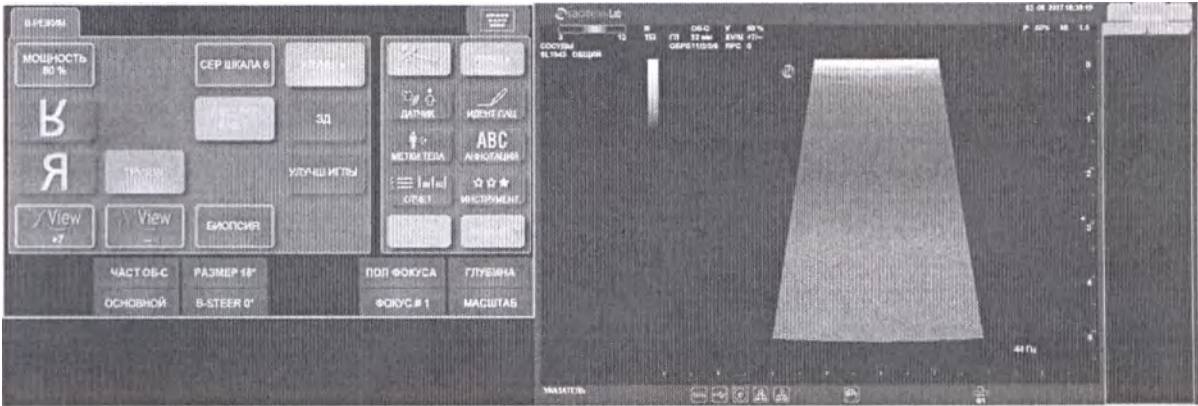

28. Elastosonography.

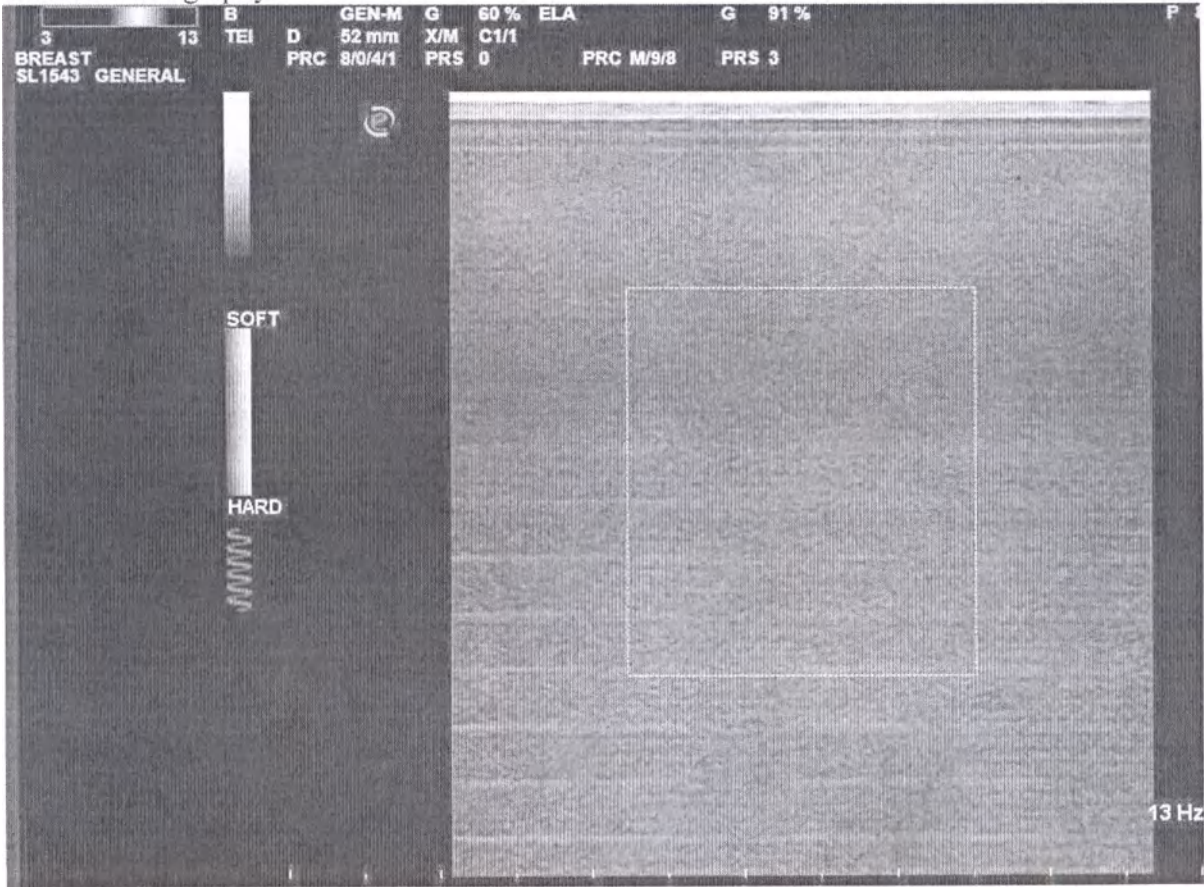


29. Elastosonography measurement

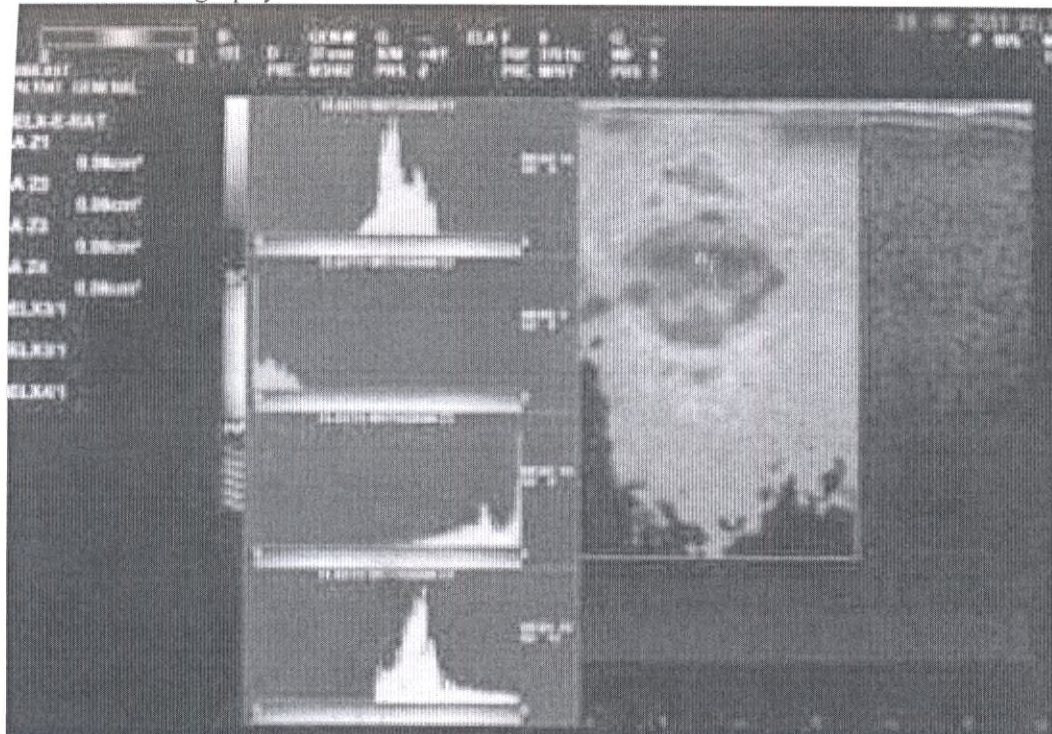


V. Принадлежности:

Держатель-пантограф для монитора (с комплектом кабелей).

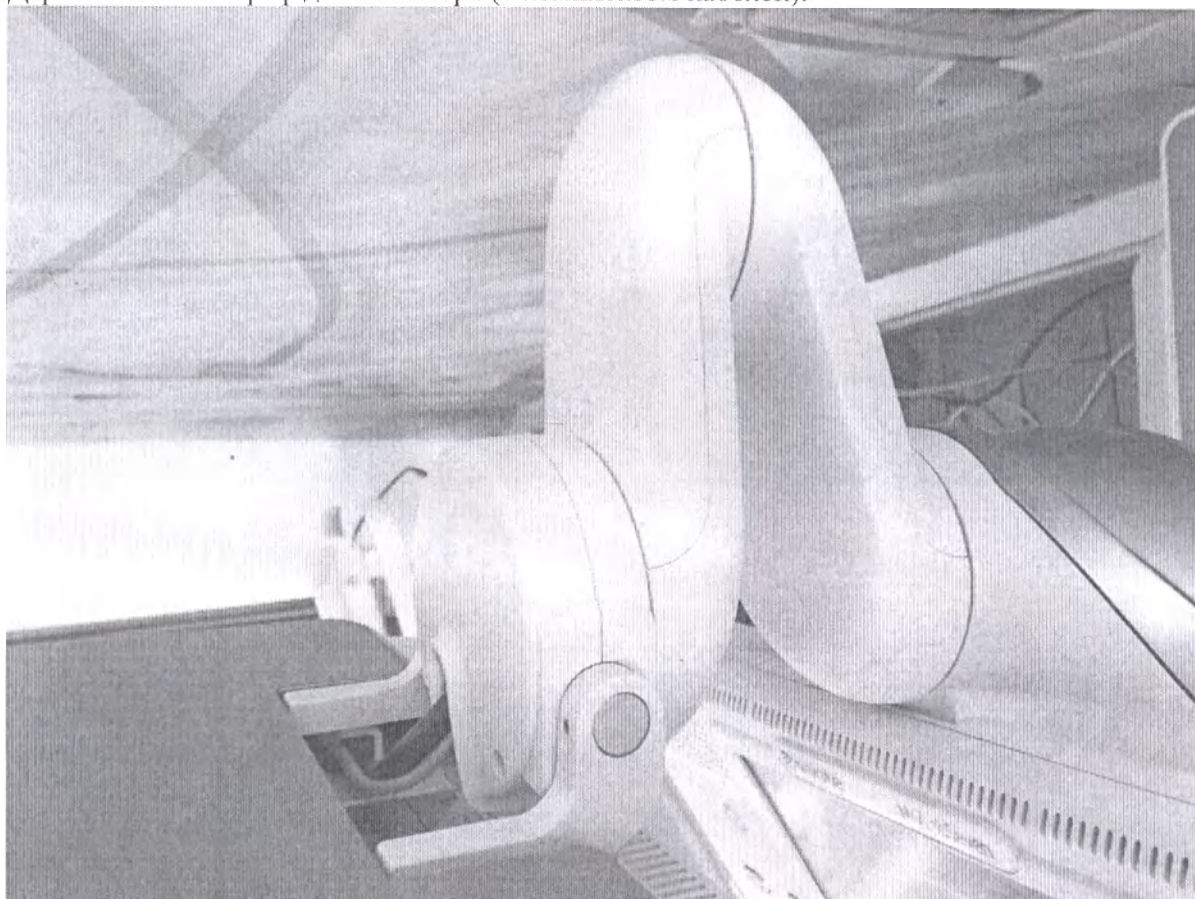


Монитор 18,5; 19; 21 или 21,5 дюйма.

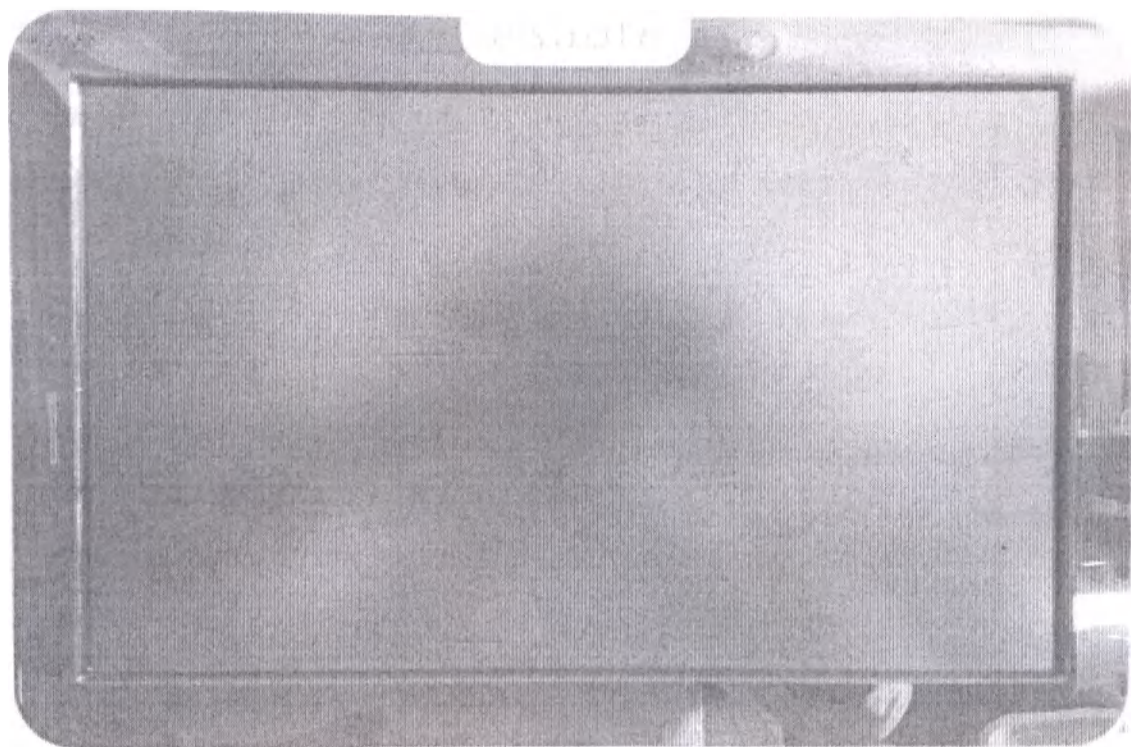


Ультразвуковой гель (не более одной упаковки – 250 г).



Инструкция пользователя на бумажных и/или цифровых носителях.

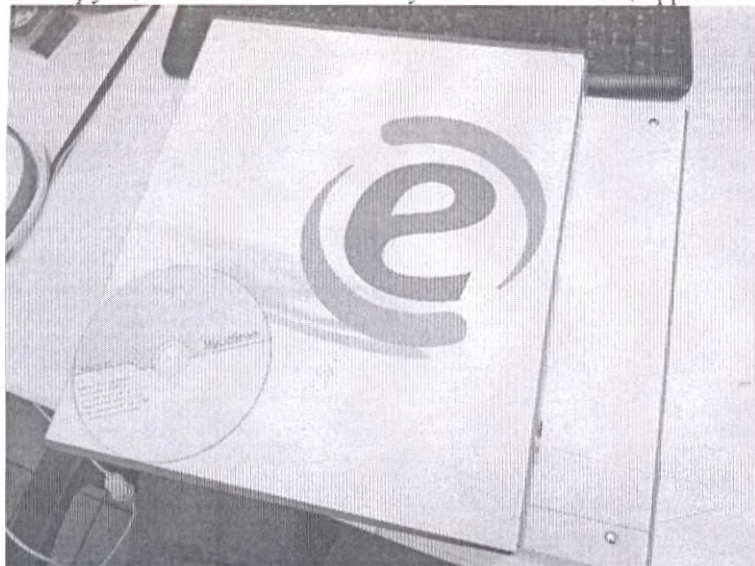

6. Сервисный и/или лицензионный ключ USB (не более 3-х шт.).

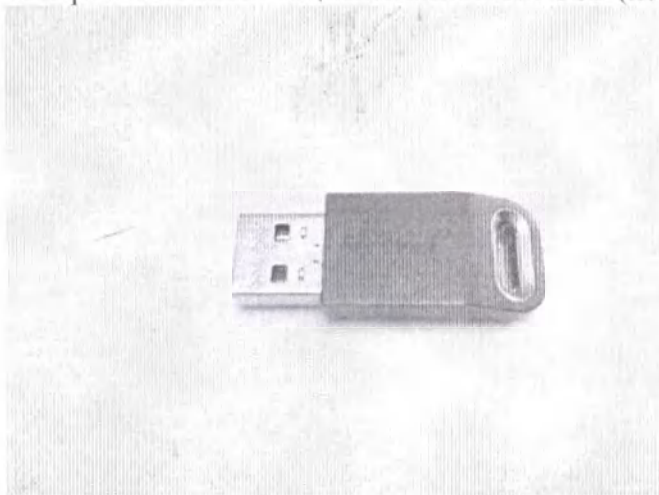


7. Карта памяти (USB-flash/USB-накопитель) (не более 1 шт.).



Ножная педаль для дистанционного управления.




Коннектор/адаптер для подключения датчиков.

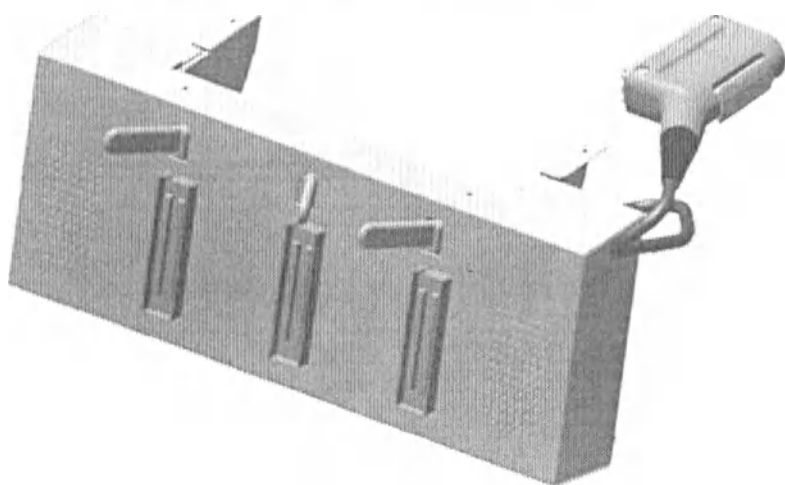

Кабели для подключения питания и периферийных устройств (не более 5 шт.).



Кабель ЭКГ (взрослый и/или педиатрический).

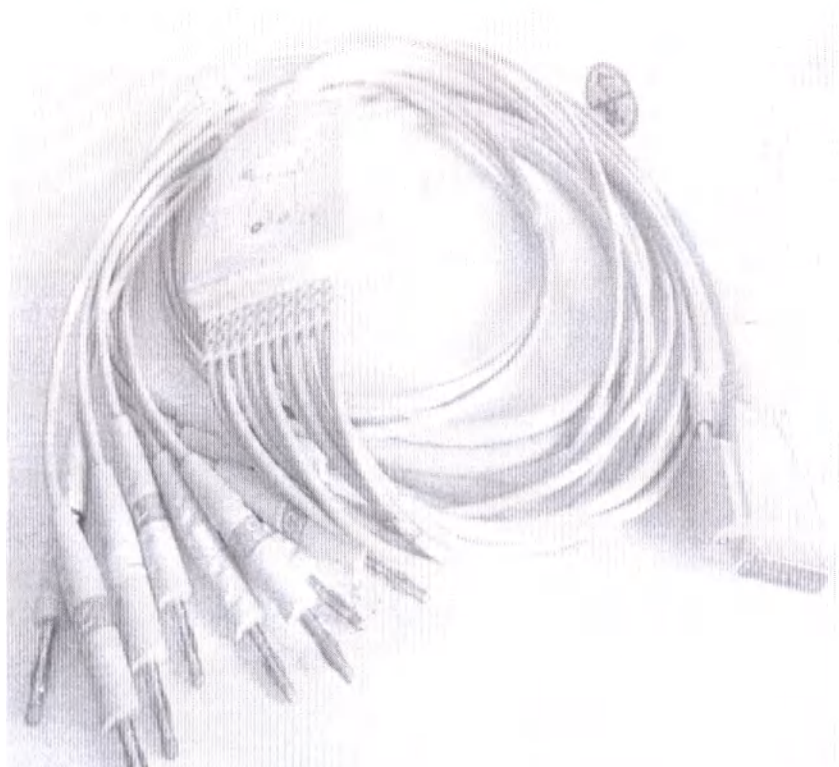

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

