

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»



Н.А. Горшкова
2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Дилуэнт для хорионического гонадотропина человека для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total hCG Diluent (Atellica IM ThCG DIL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Дилуэнт для хорионического гонадотропина человека для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total hCG Diluent (Atellica IM ThCG DIL)). Фасовка 2 упаковки. Общий вид

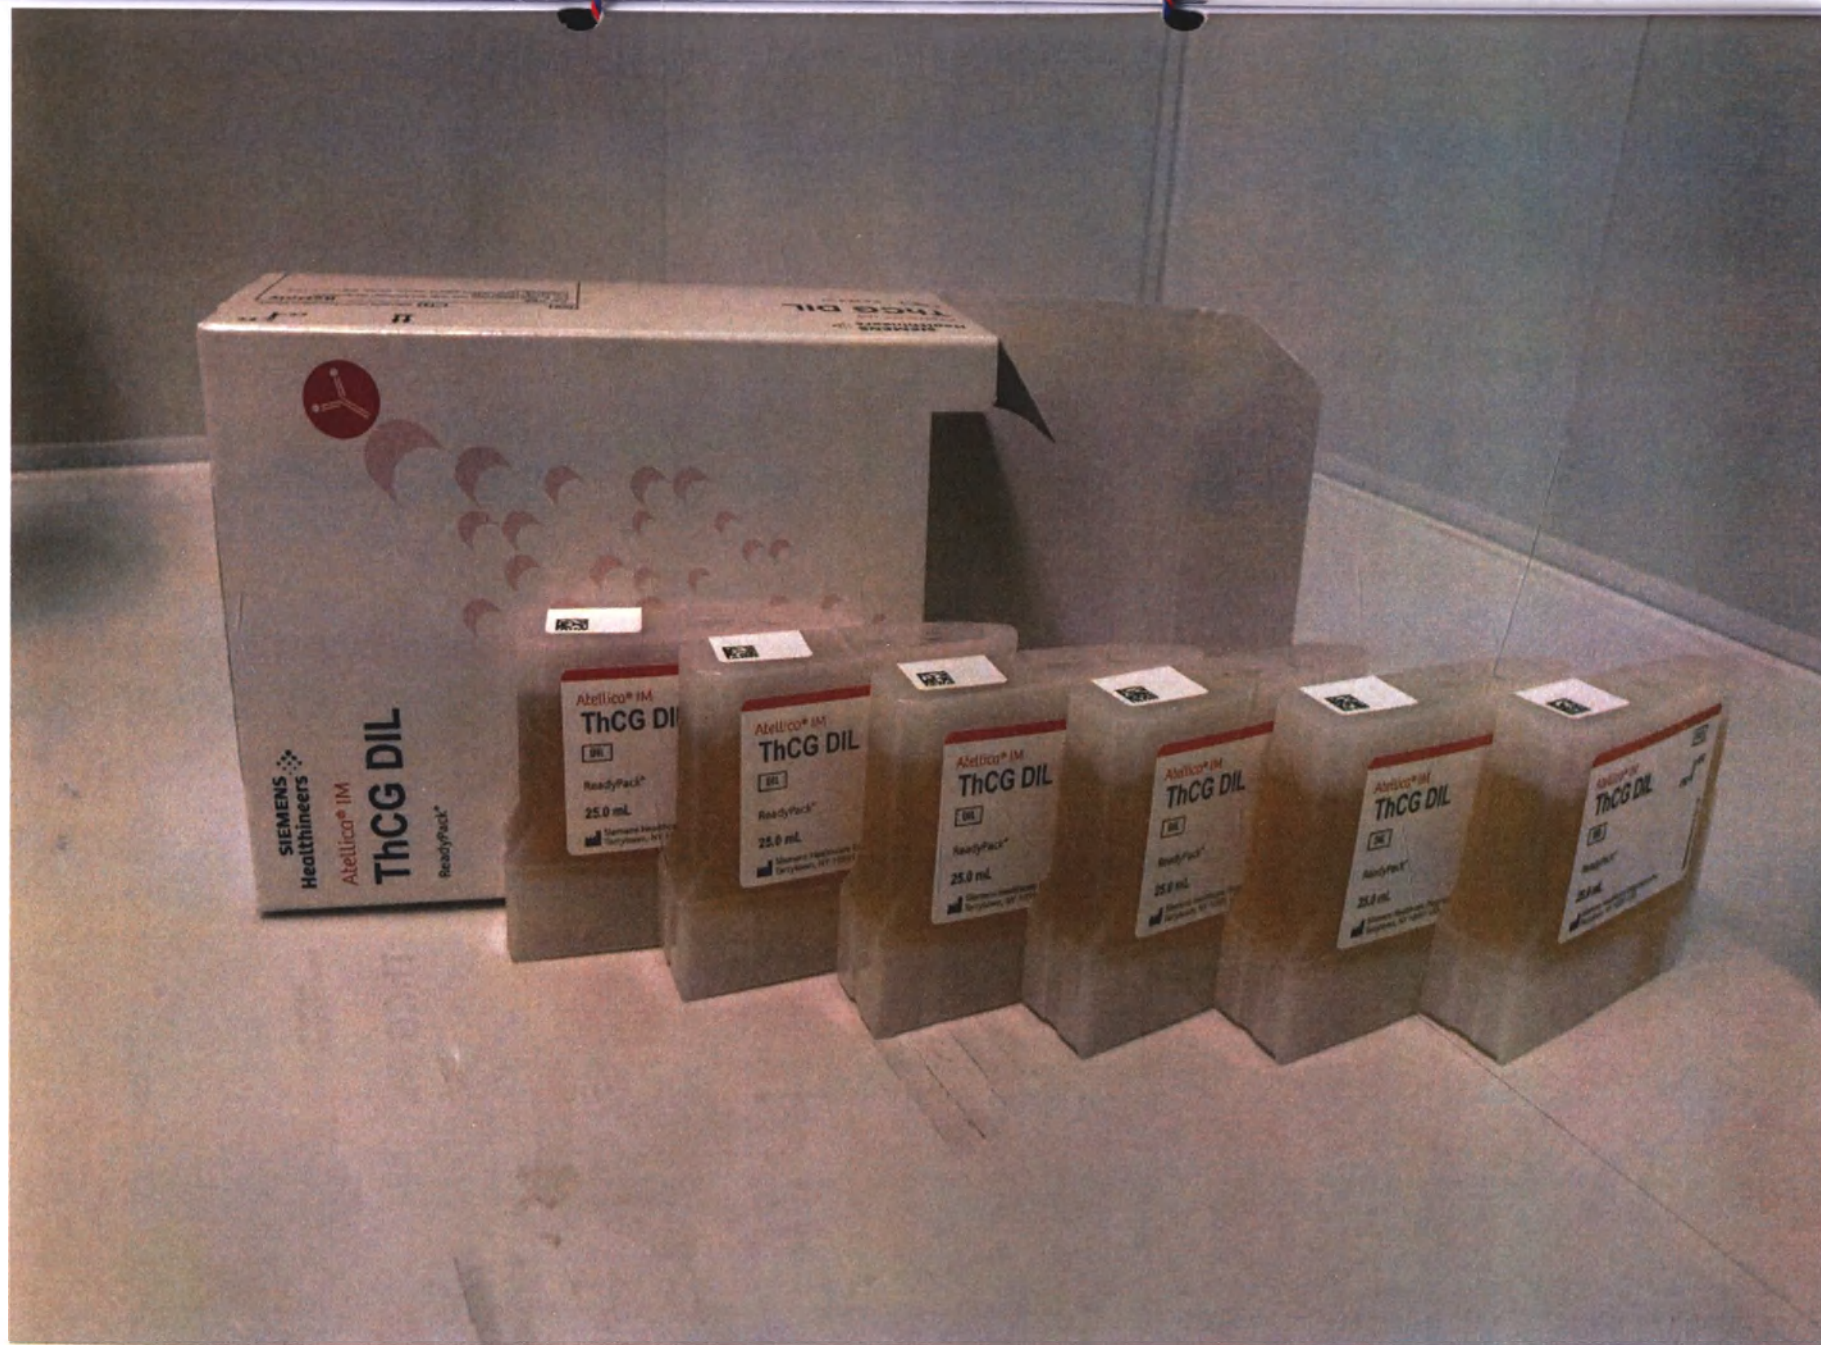


Рисунок 2. Дилуэнт для хорионического гонадотропина человека для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total hCG Diluent (Atellica IM ThCG DIL)).
Фасовка 6 упаковок. Общий вид

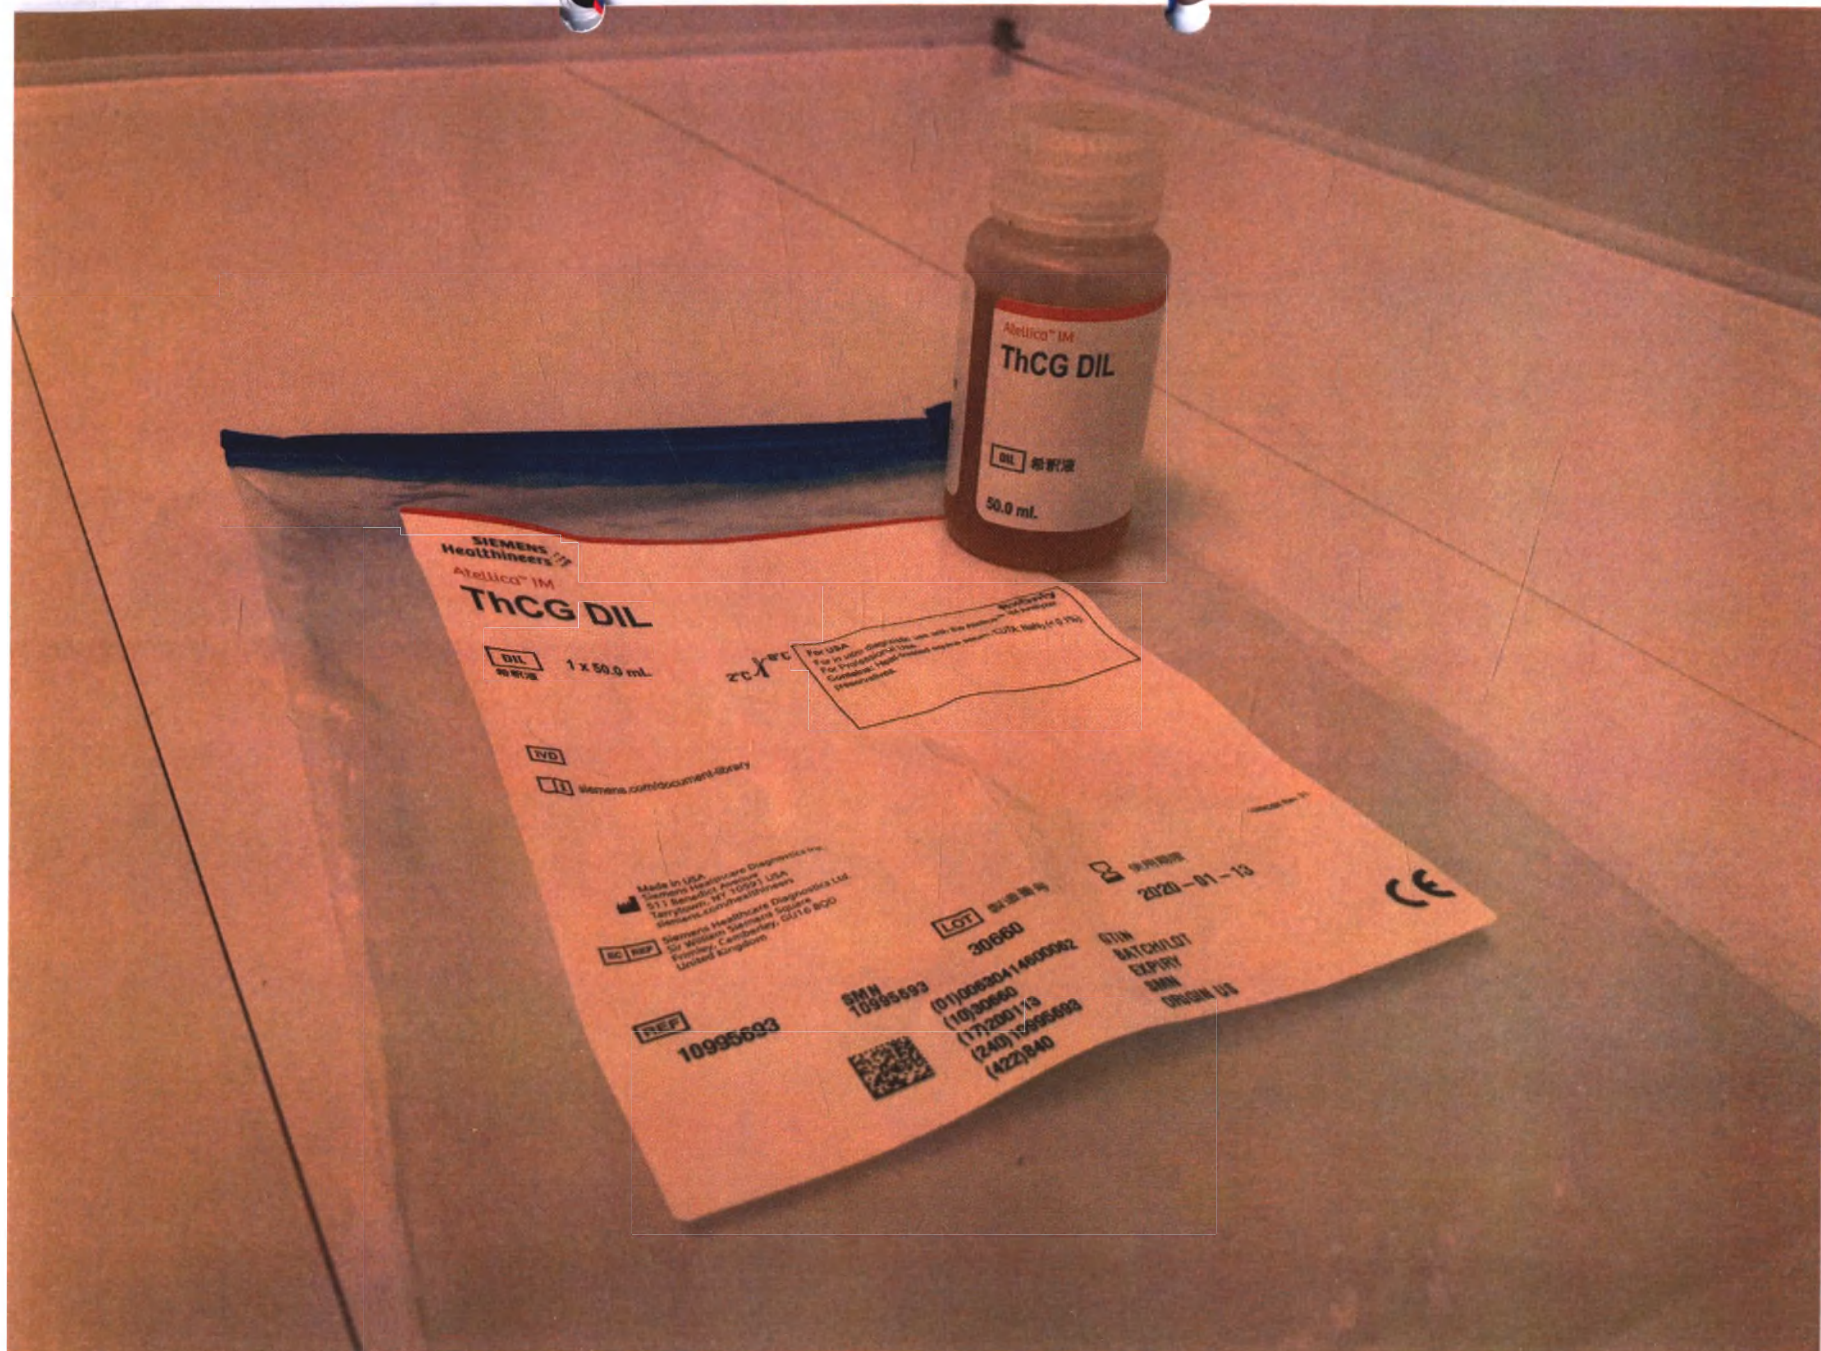


Рисунок 3. Дилуент для хорионического гонадотропина человека для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total hCG Diluent (Atellica IM ThCG DIL)).
Фасовка флакон. Общий вид

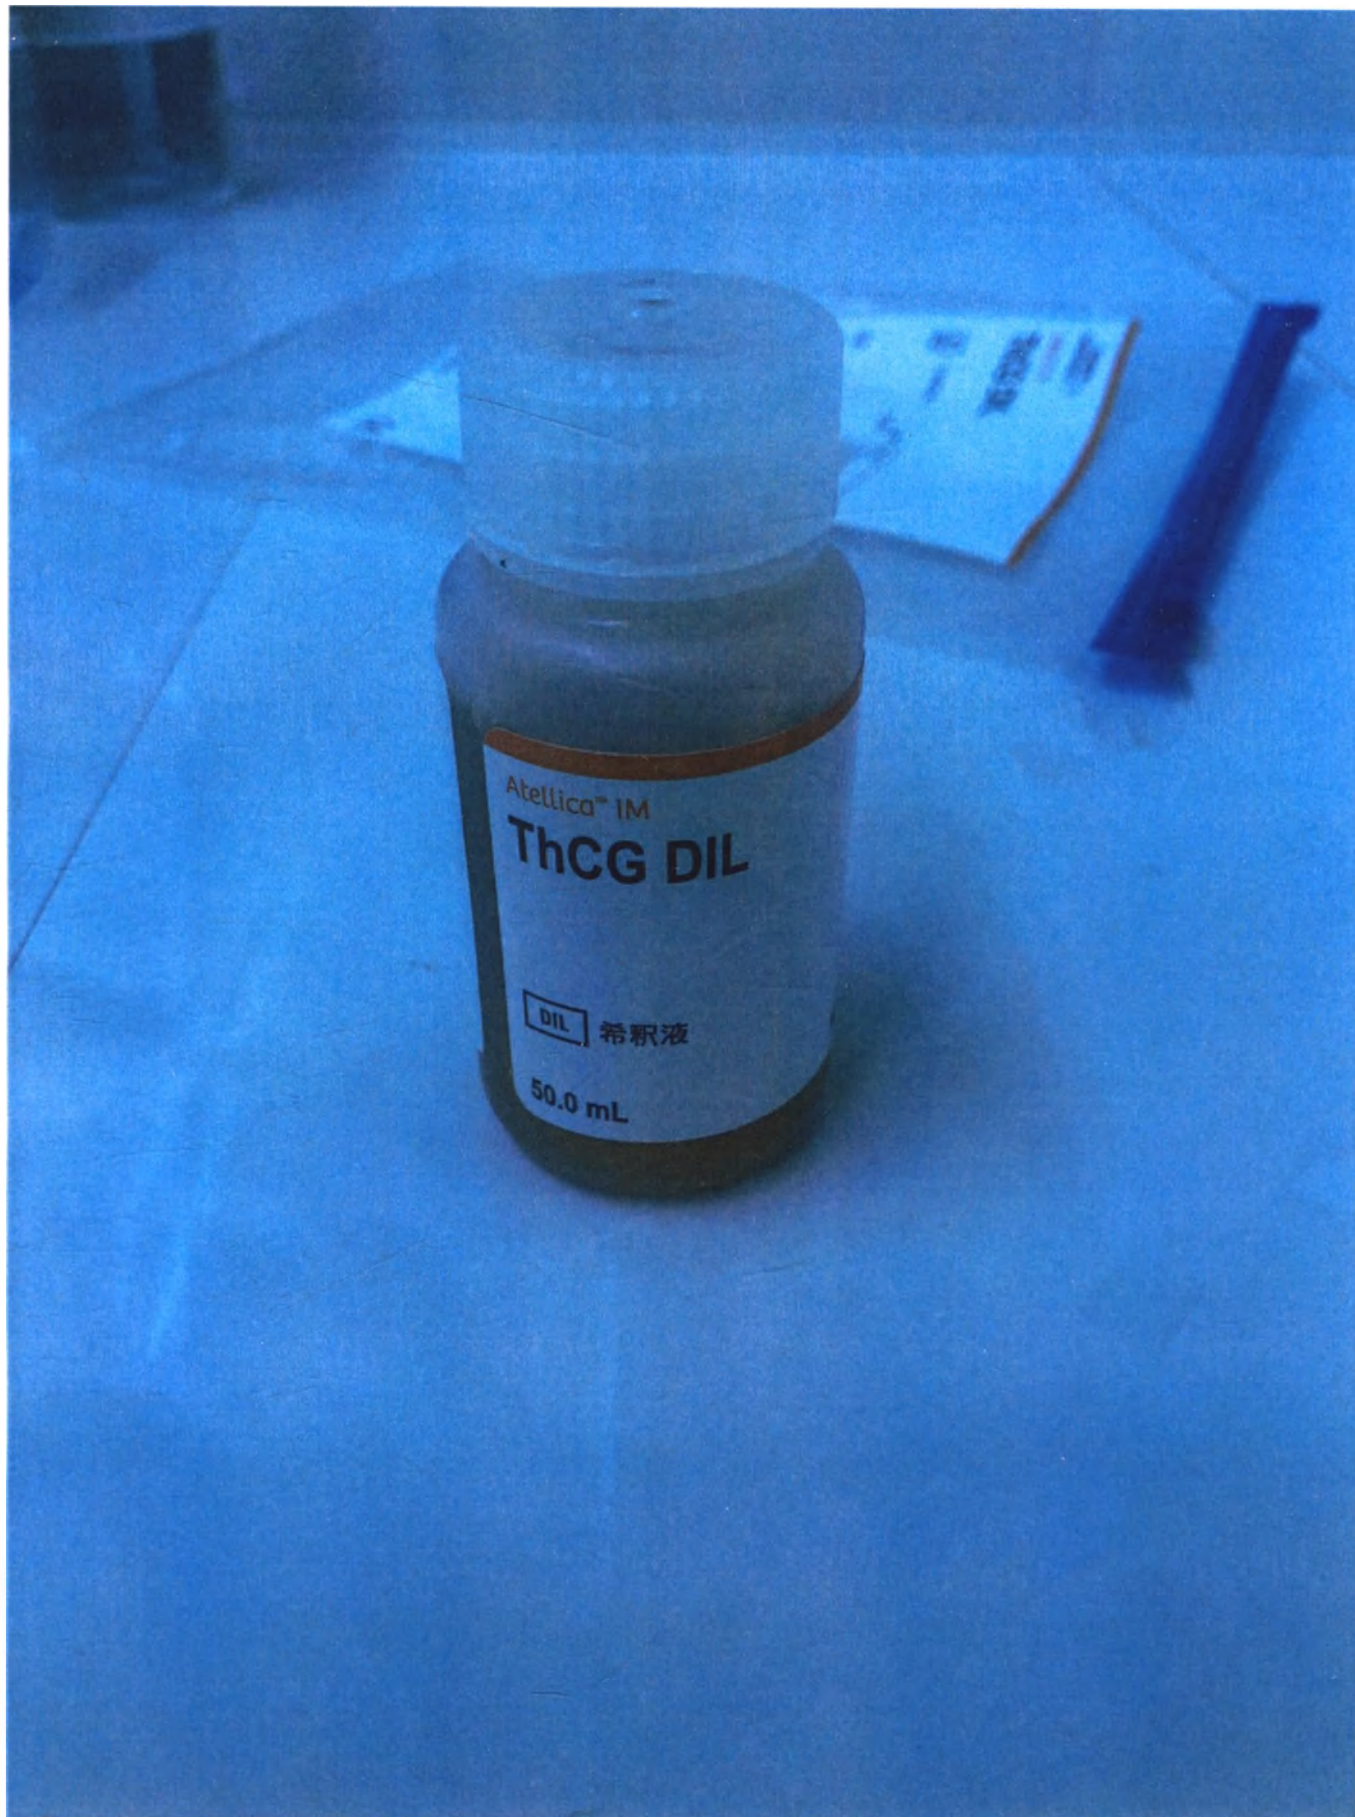


Рисунок 5. Дилуэнт для хорионического гонадотропина человека для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total hCG Diluent (Atellica IM ThCG DIL)). Фасовка 2 упаковки, Фасовка флакон. Дилуэнт для хорионического гонадотропина человека (Atellica IM Total hCG Diluent (Atellica IM ThCG DIL)) – 50,0 мл/флакон

Всего прошито и пронумеровано _____ листа (ов)

ООО «Сименс Здравоохранение»

