

ООО «Терумо Рус»
Бизнес-Центр «Северная Башня»
123112, г. Москва, Россия,
ул. Тестовская, дом 10, этаж 13,
помещение I, офис 5
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739
www.terumo-europe.com

Фотографические изображения медицинского изделия
«Система для лечения онкологических
заболеваний с помощью термической абляции
ТАТО2»

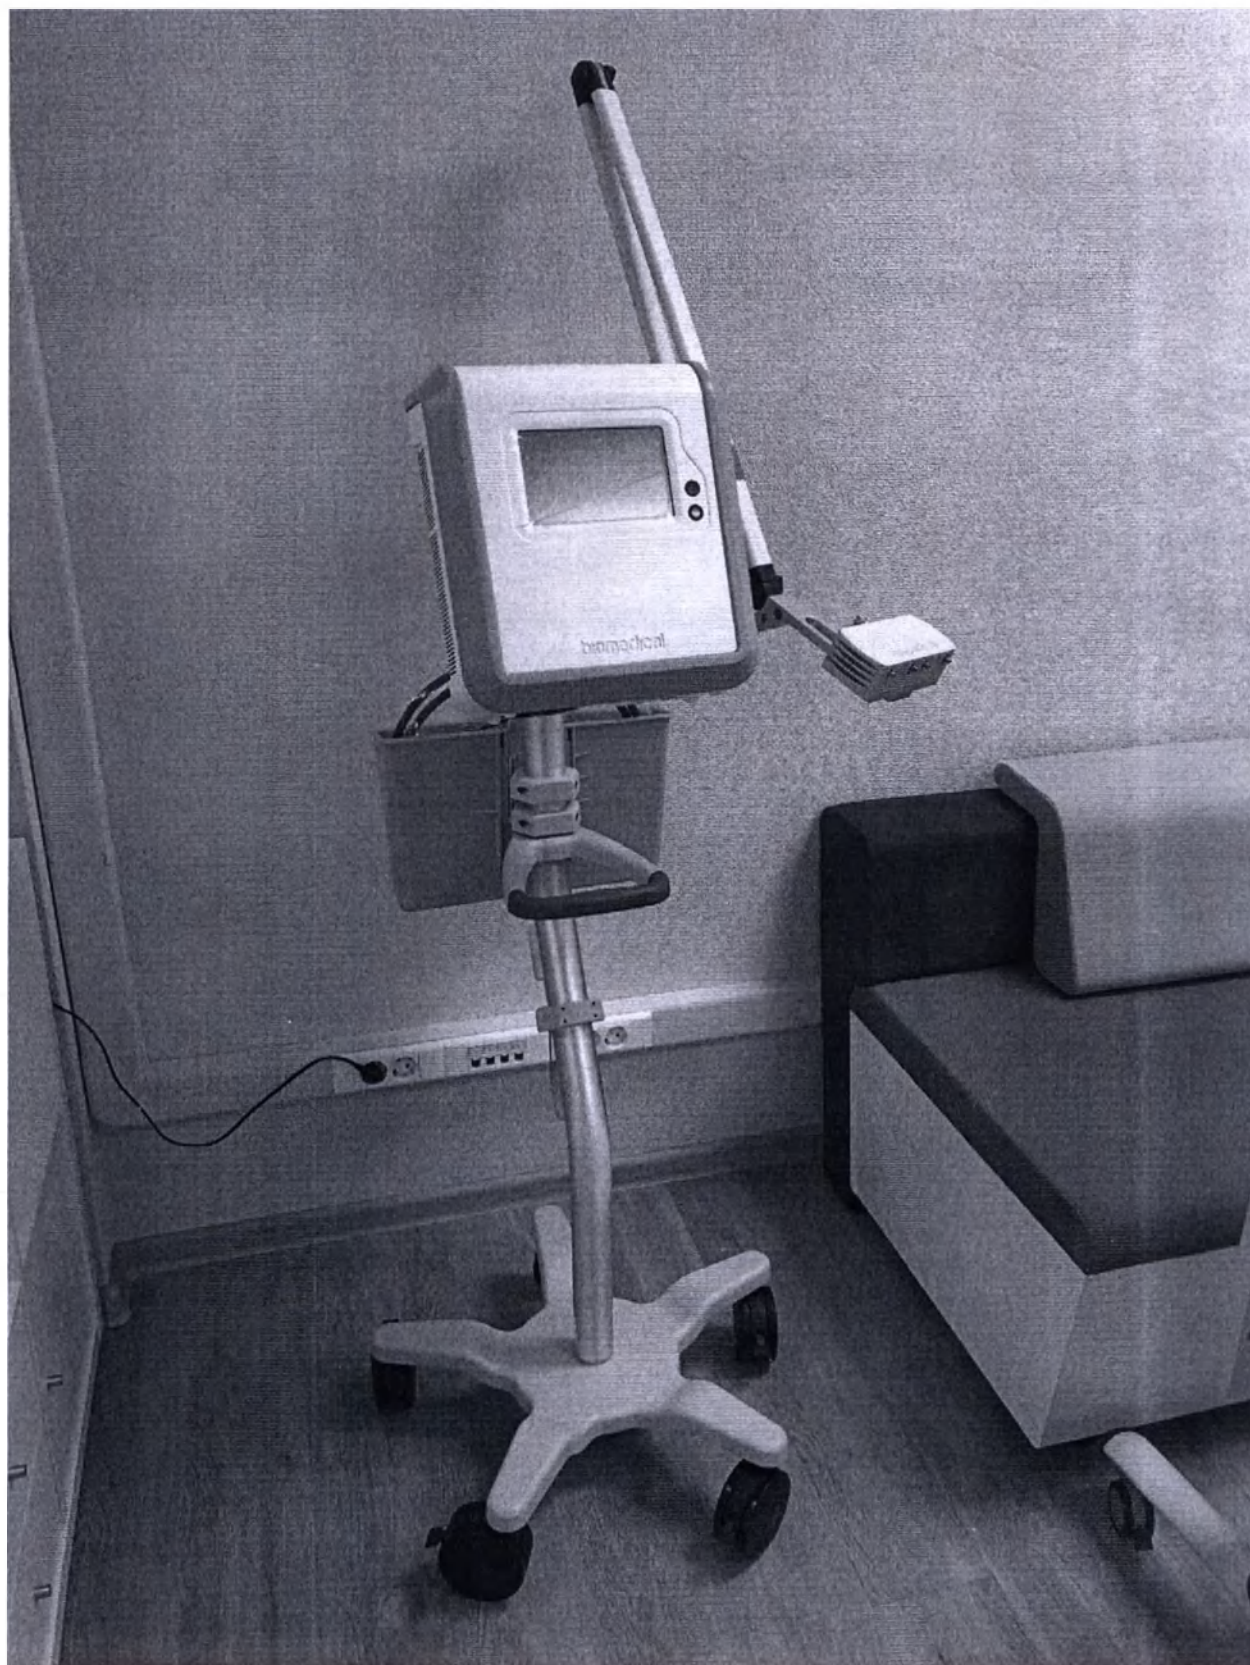


Рис.1. Система для лечения онкологических заболеваний с помощью термической абляции TATO2, вариант исполнения с опорой на колёсиках. Общий вид медицинского изделия.

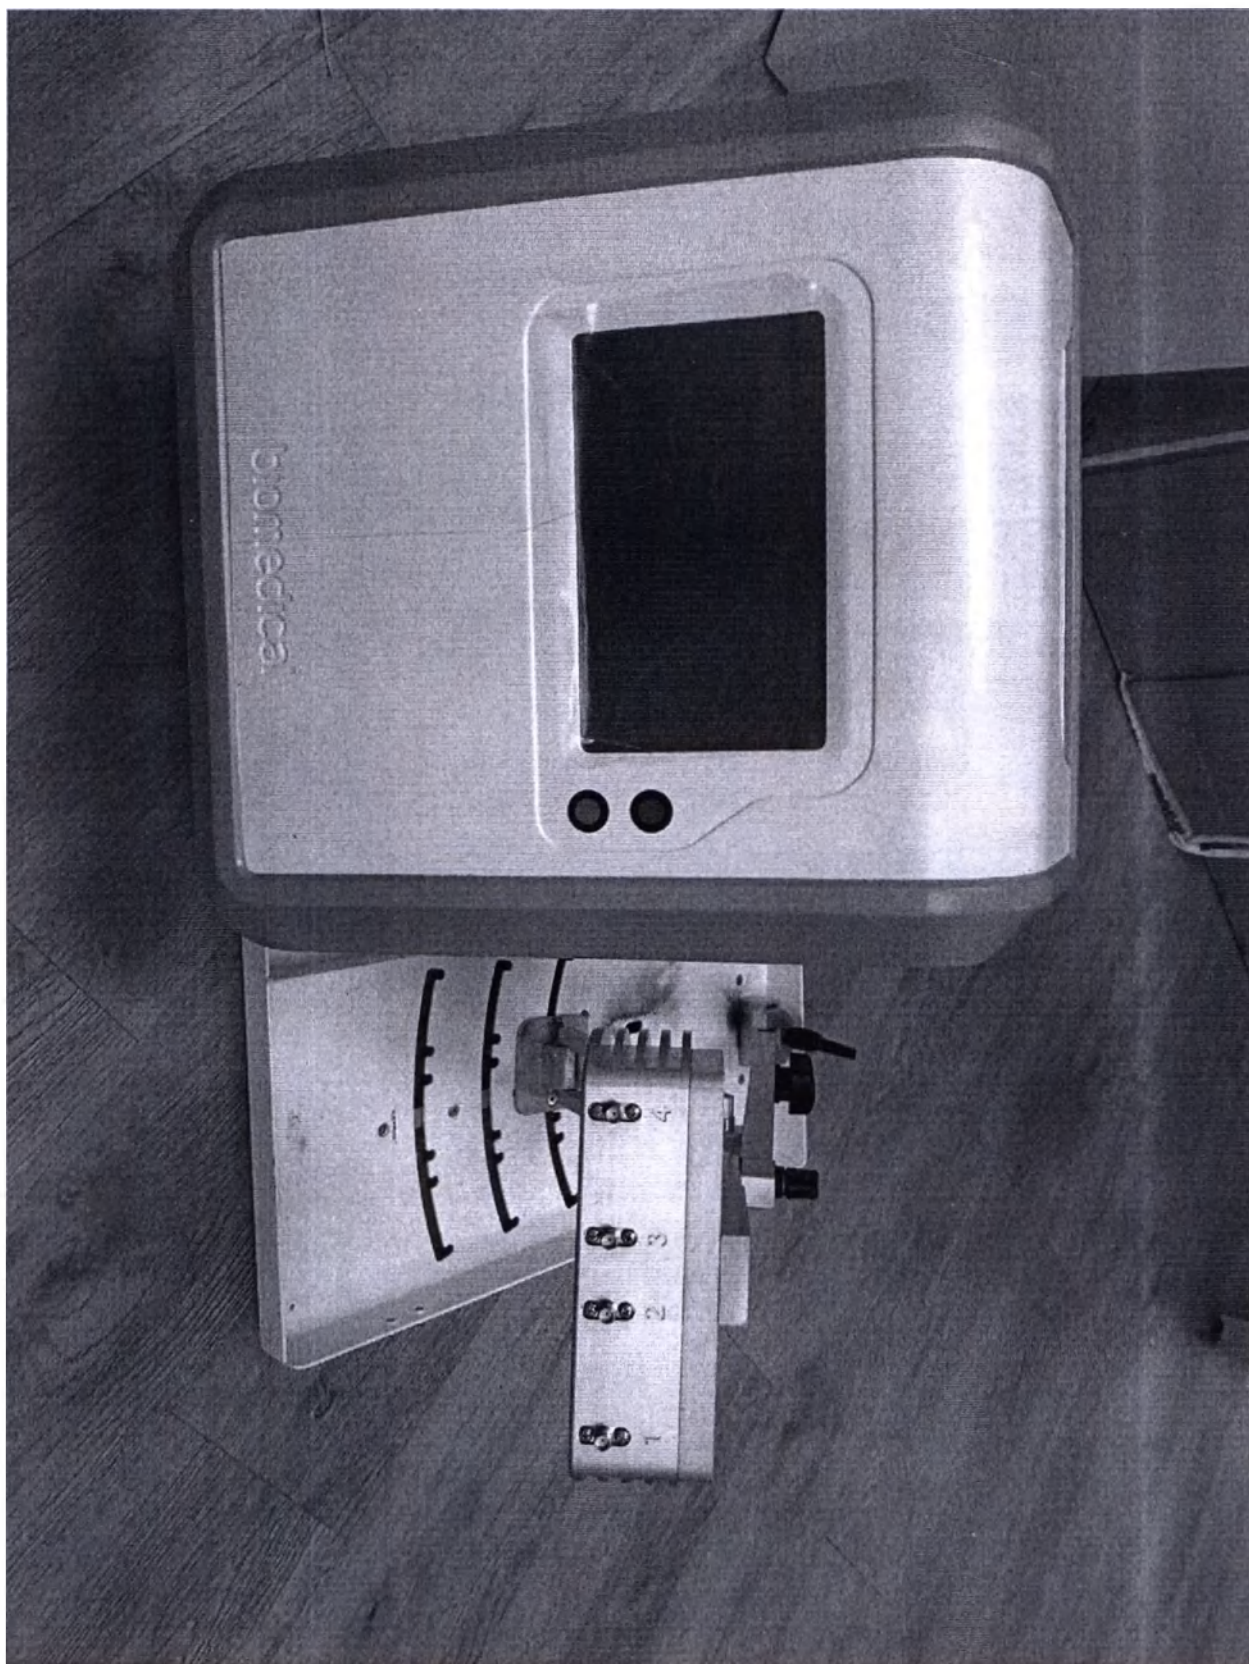


Рис.2. Система для лечения онкологических заболеваний с помощью термической абляции TATO2, вариант исполнения с подставкой. Общий вид медицинского изделия.

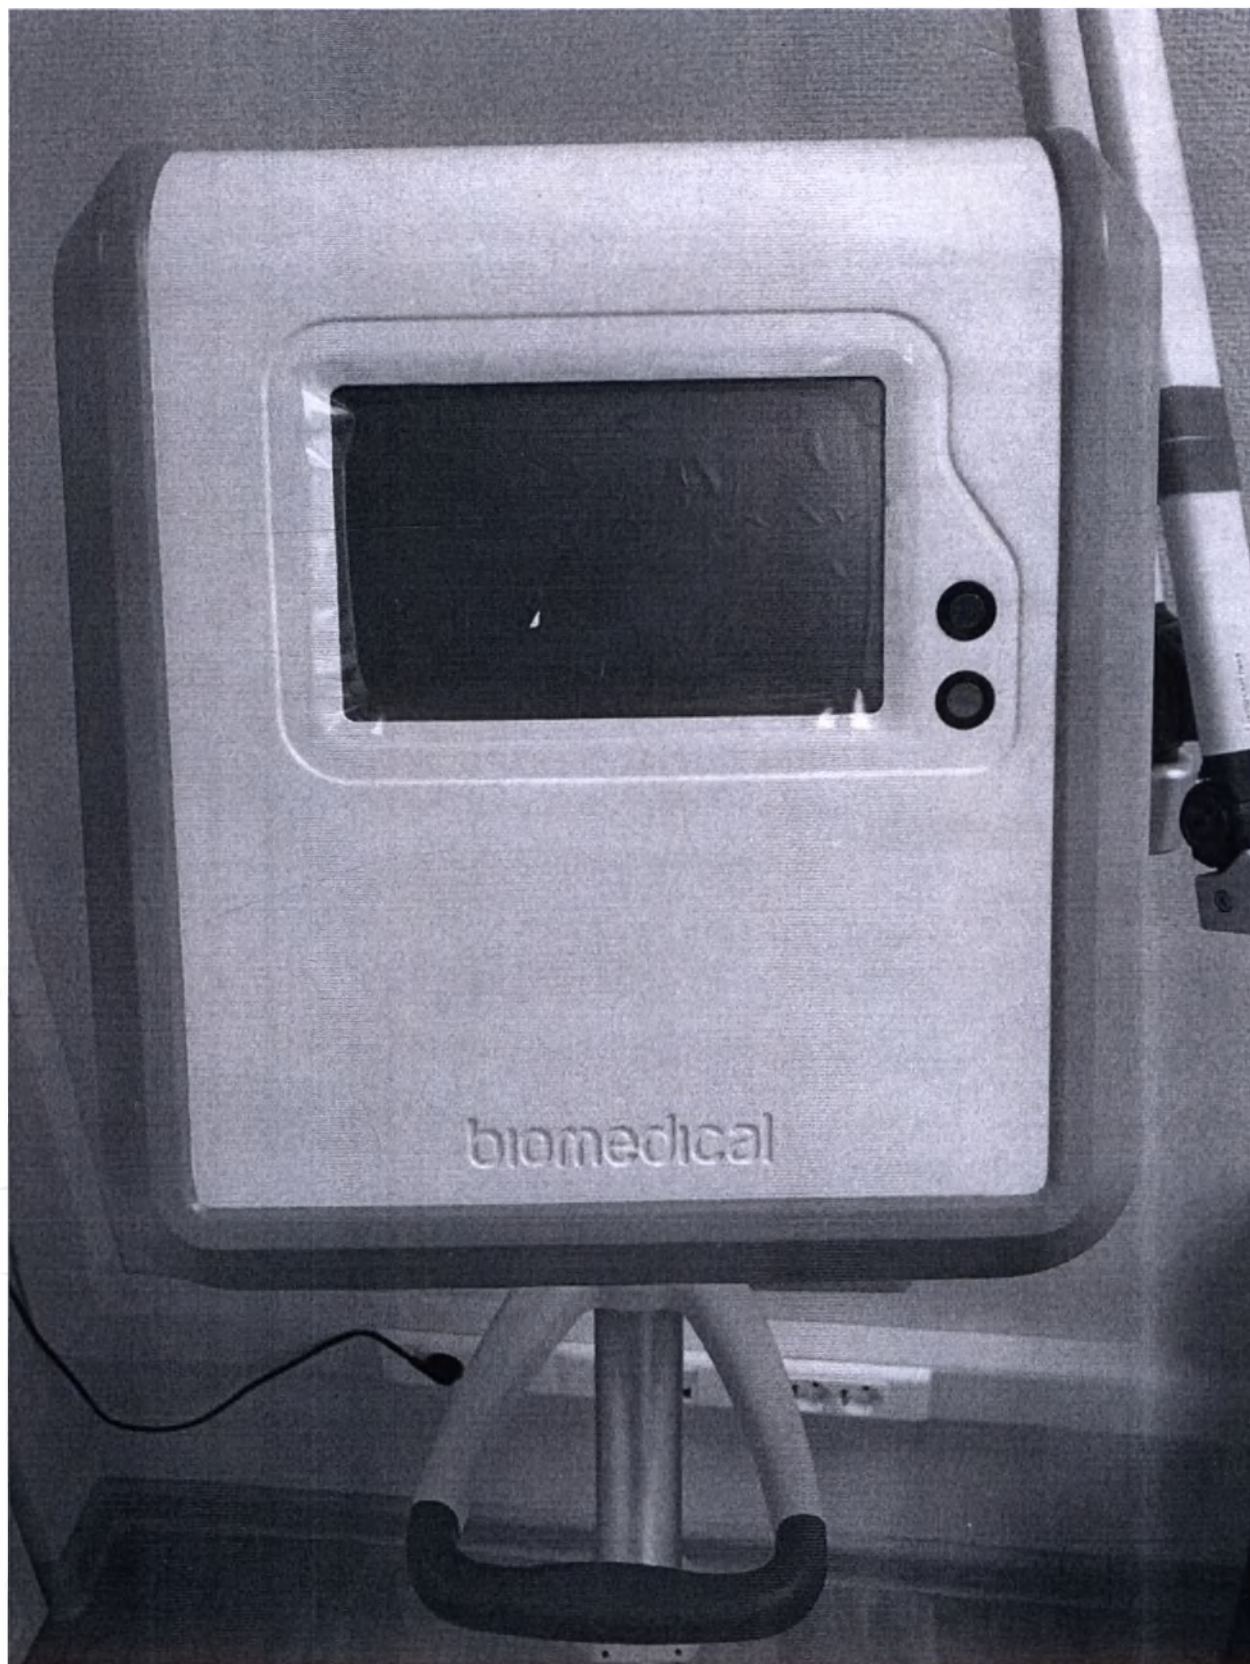


Рис.3. Основной блок



Рис.4. Блок коммутации

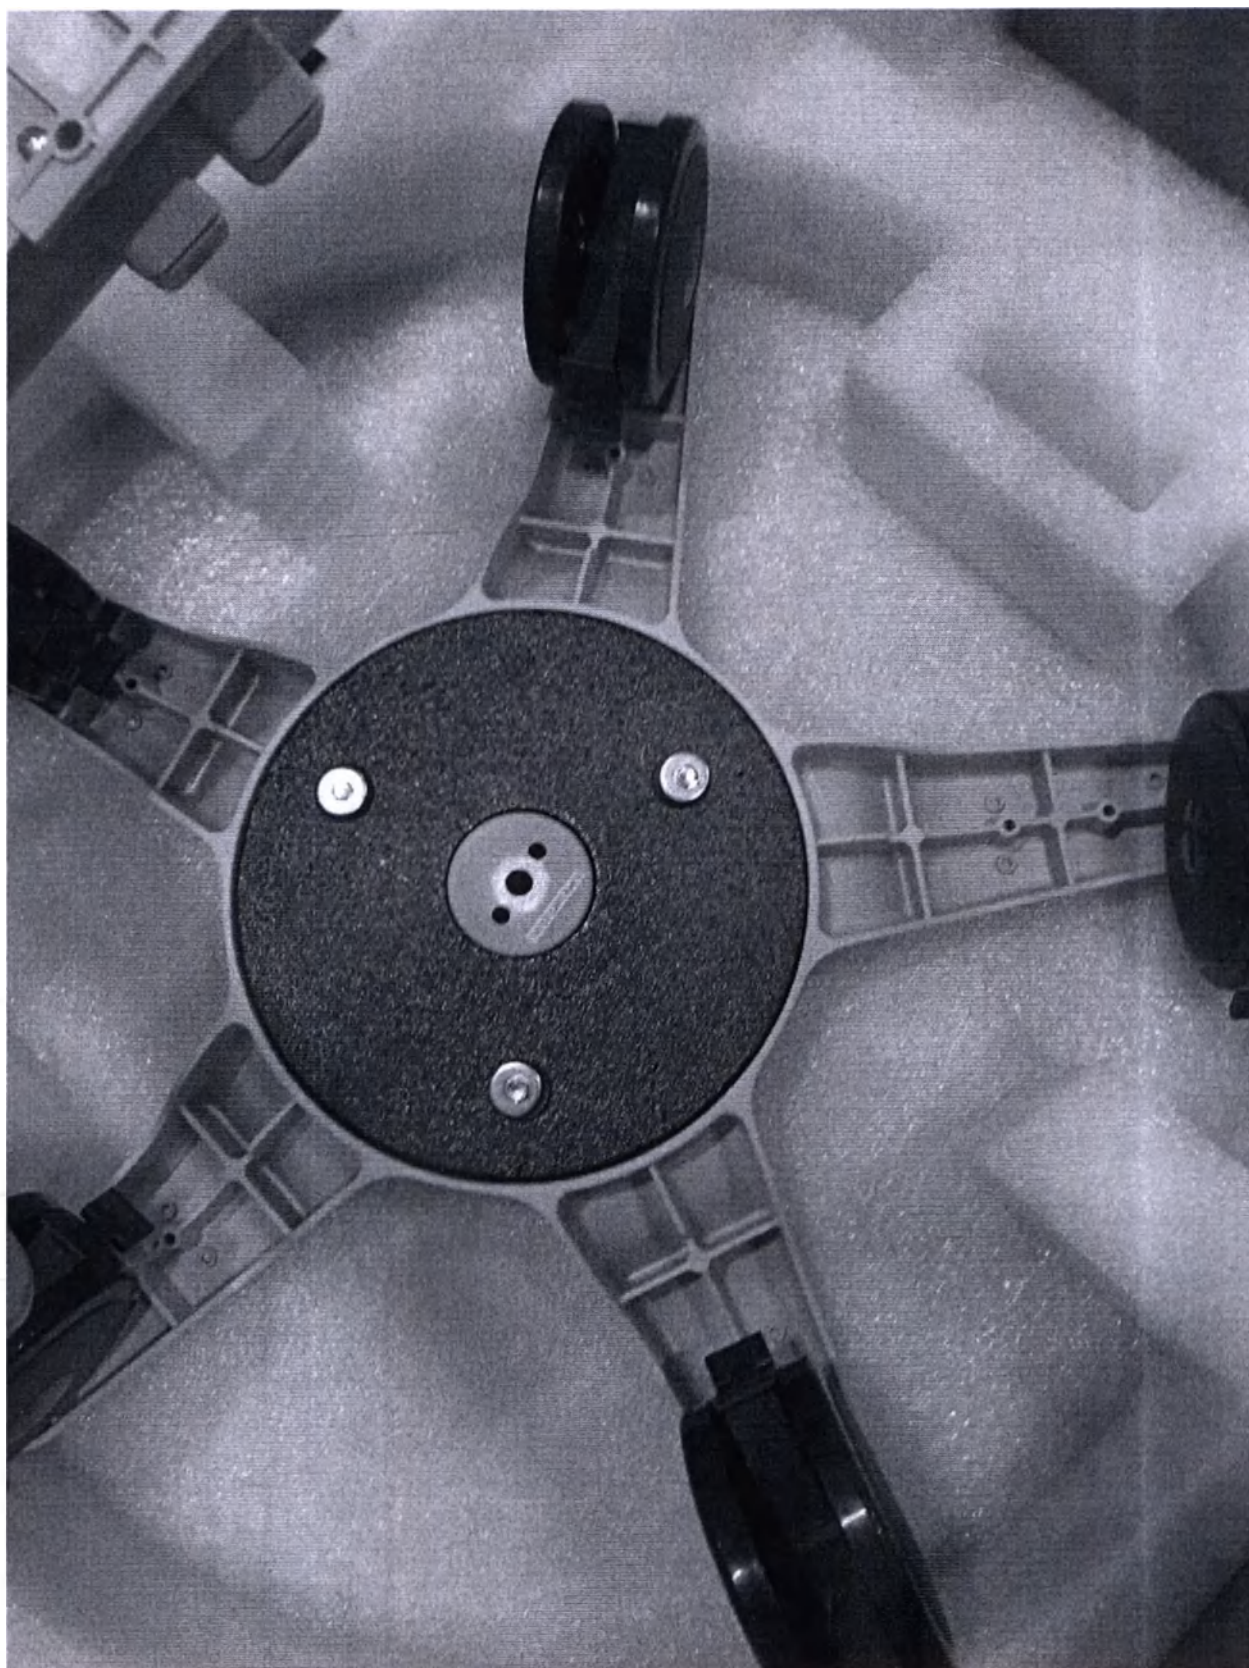


Рис.5.1. Стойка опоры на колёсиках с манипулятором (вид опоры на колесиках) (для варианта исполнения с опорой на колёсиках)

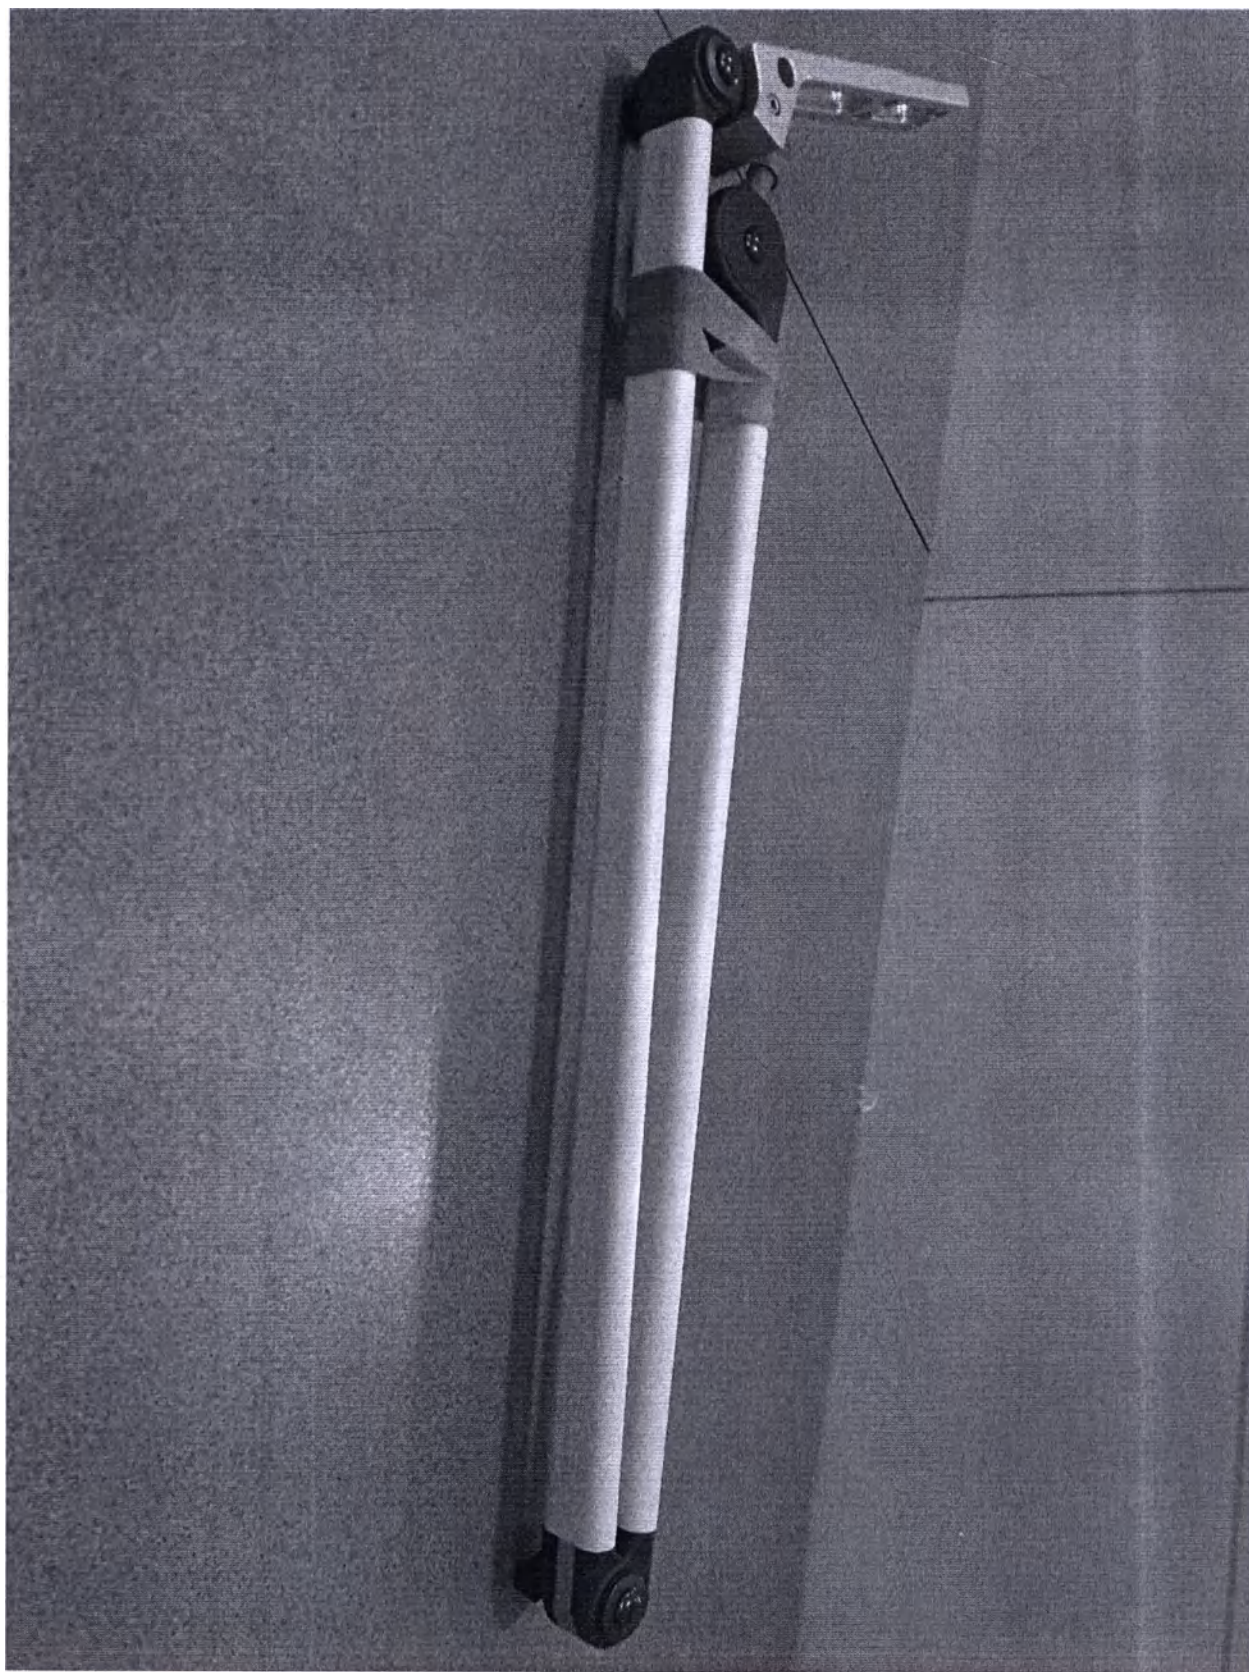


Рис.5.2. Стойка опоры на колёсиках с манипулятором (вид манипулятора) (для варианта исполнения с опорой на колёсиках)

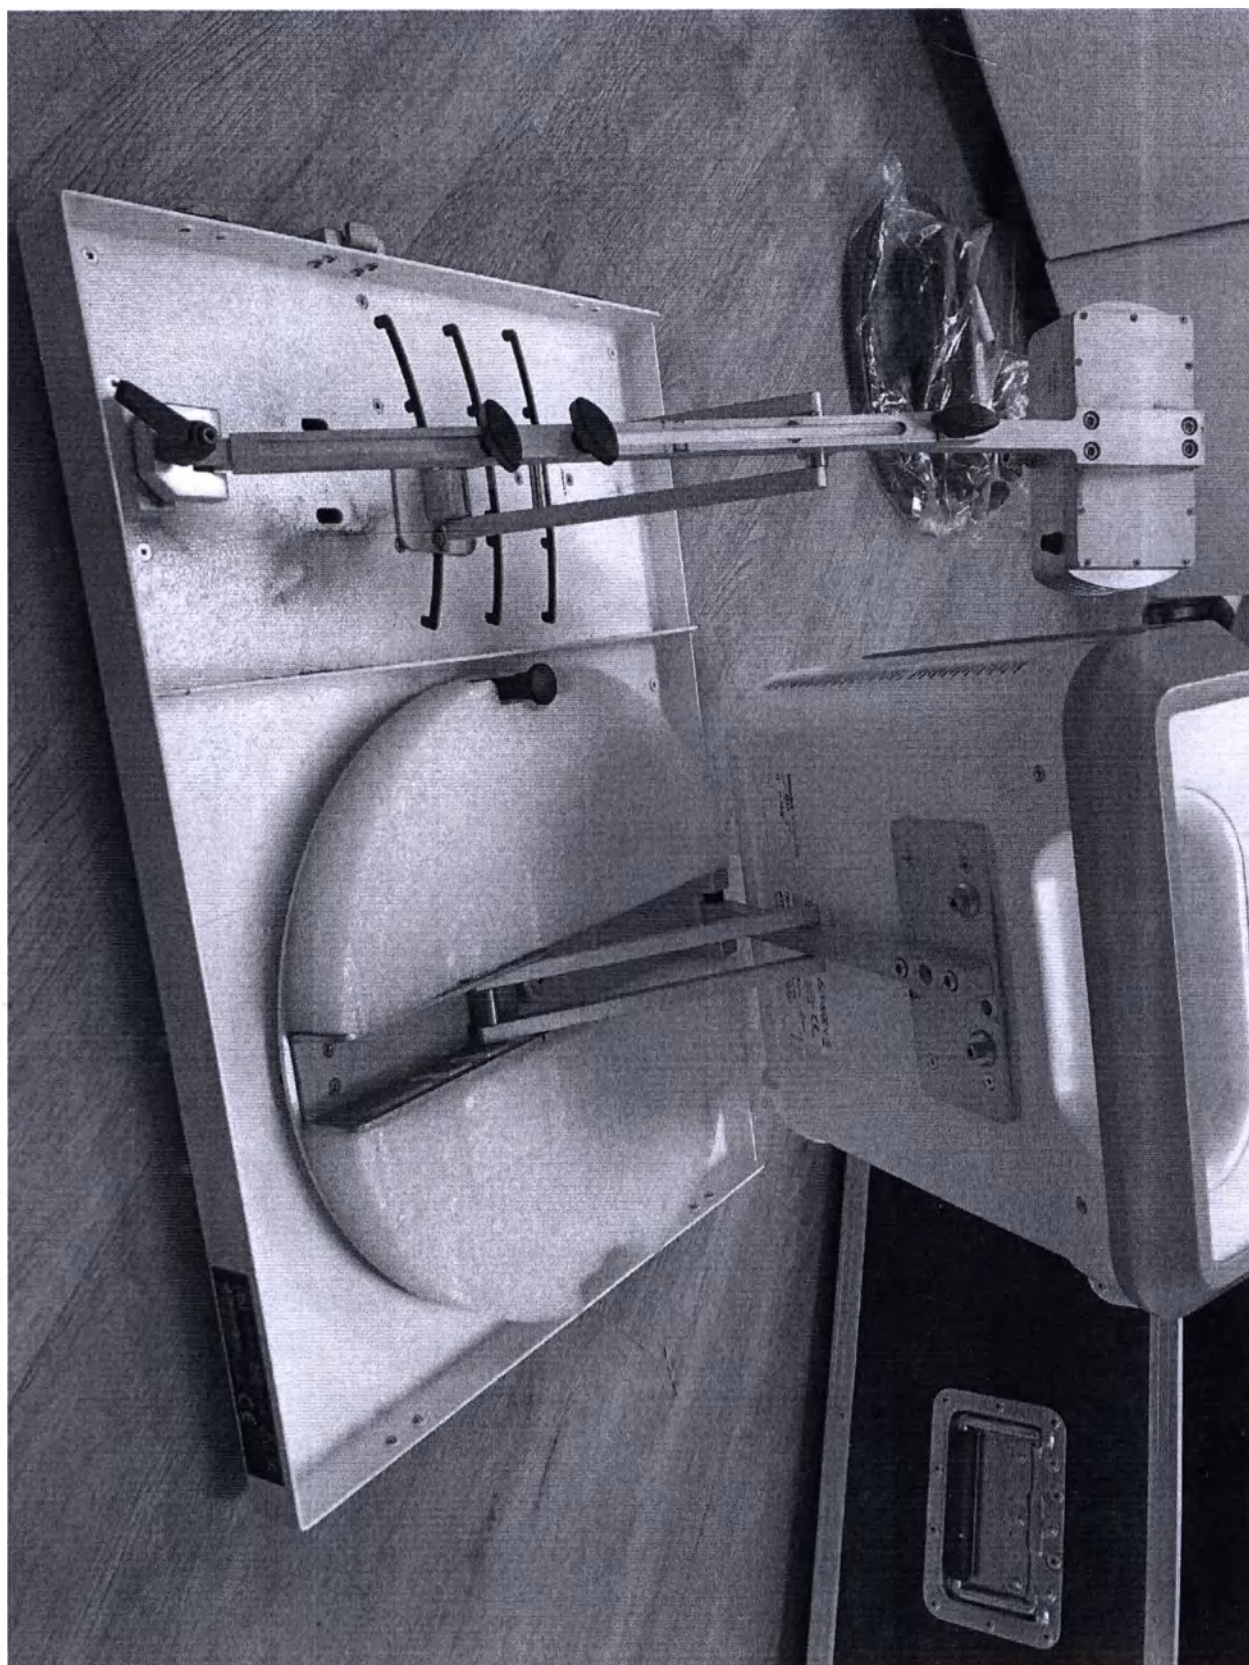


Рис.6. Подставка с манипулятором (для варианта исполнения с подставкой)

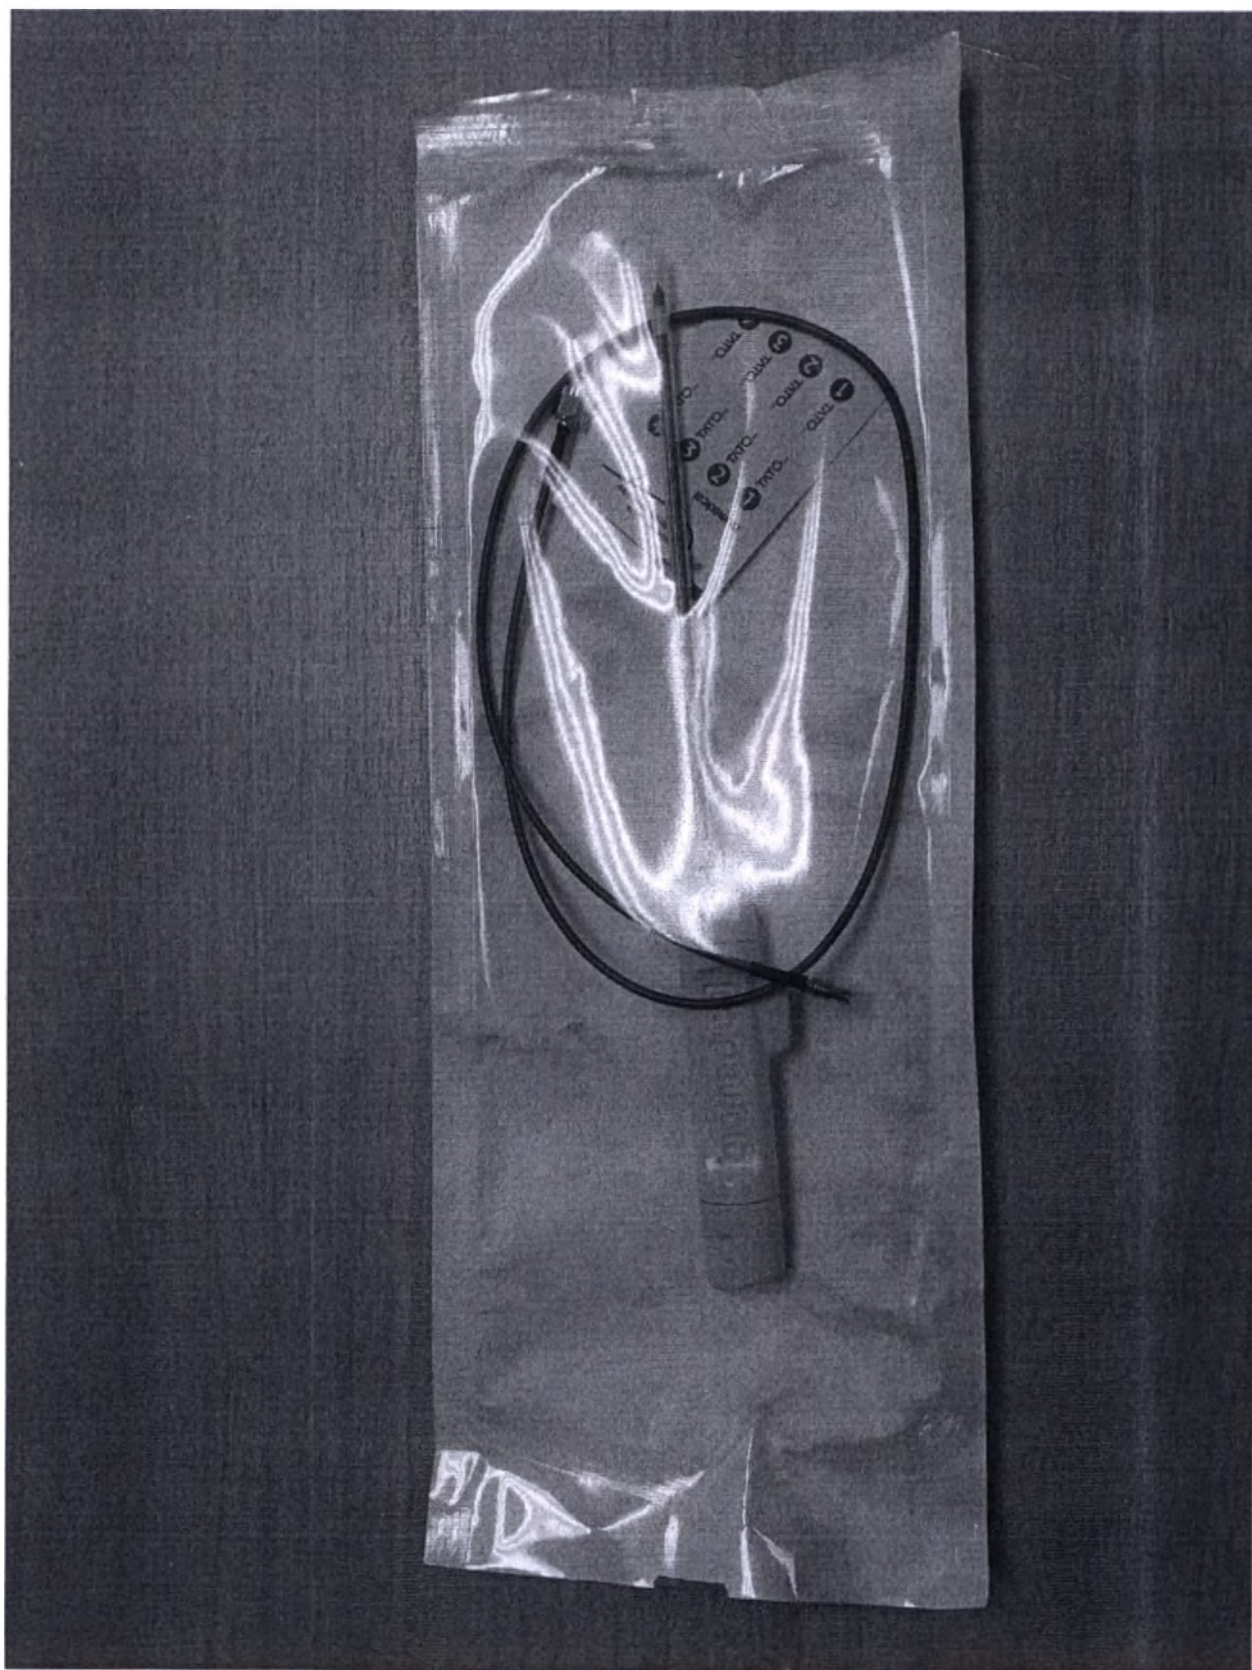


Рис.7. Аппликаторы TATopro TTP1115CD-CM, TTP1120CD-CM размер 11G, длина 15 см, 20 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке (На примере аппликатор TATopro TTP1115CD-CM размер 11G, длина 15 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке)

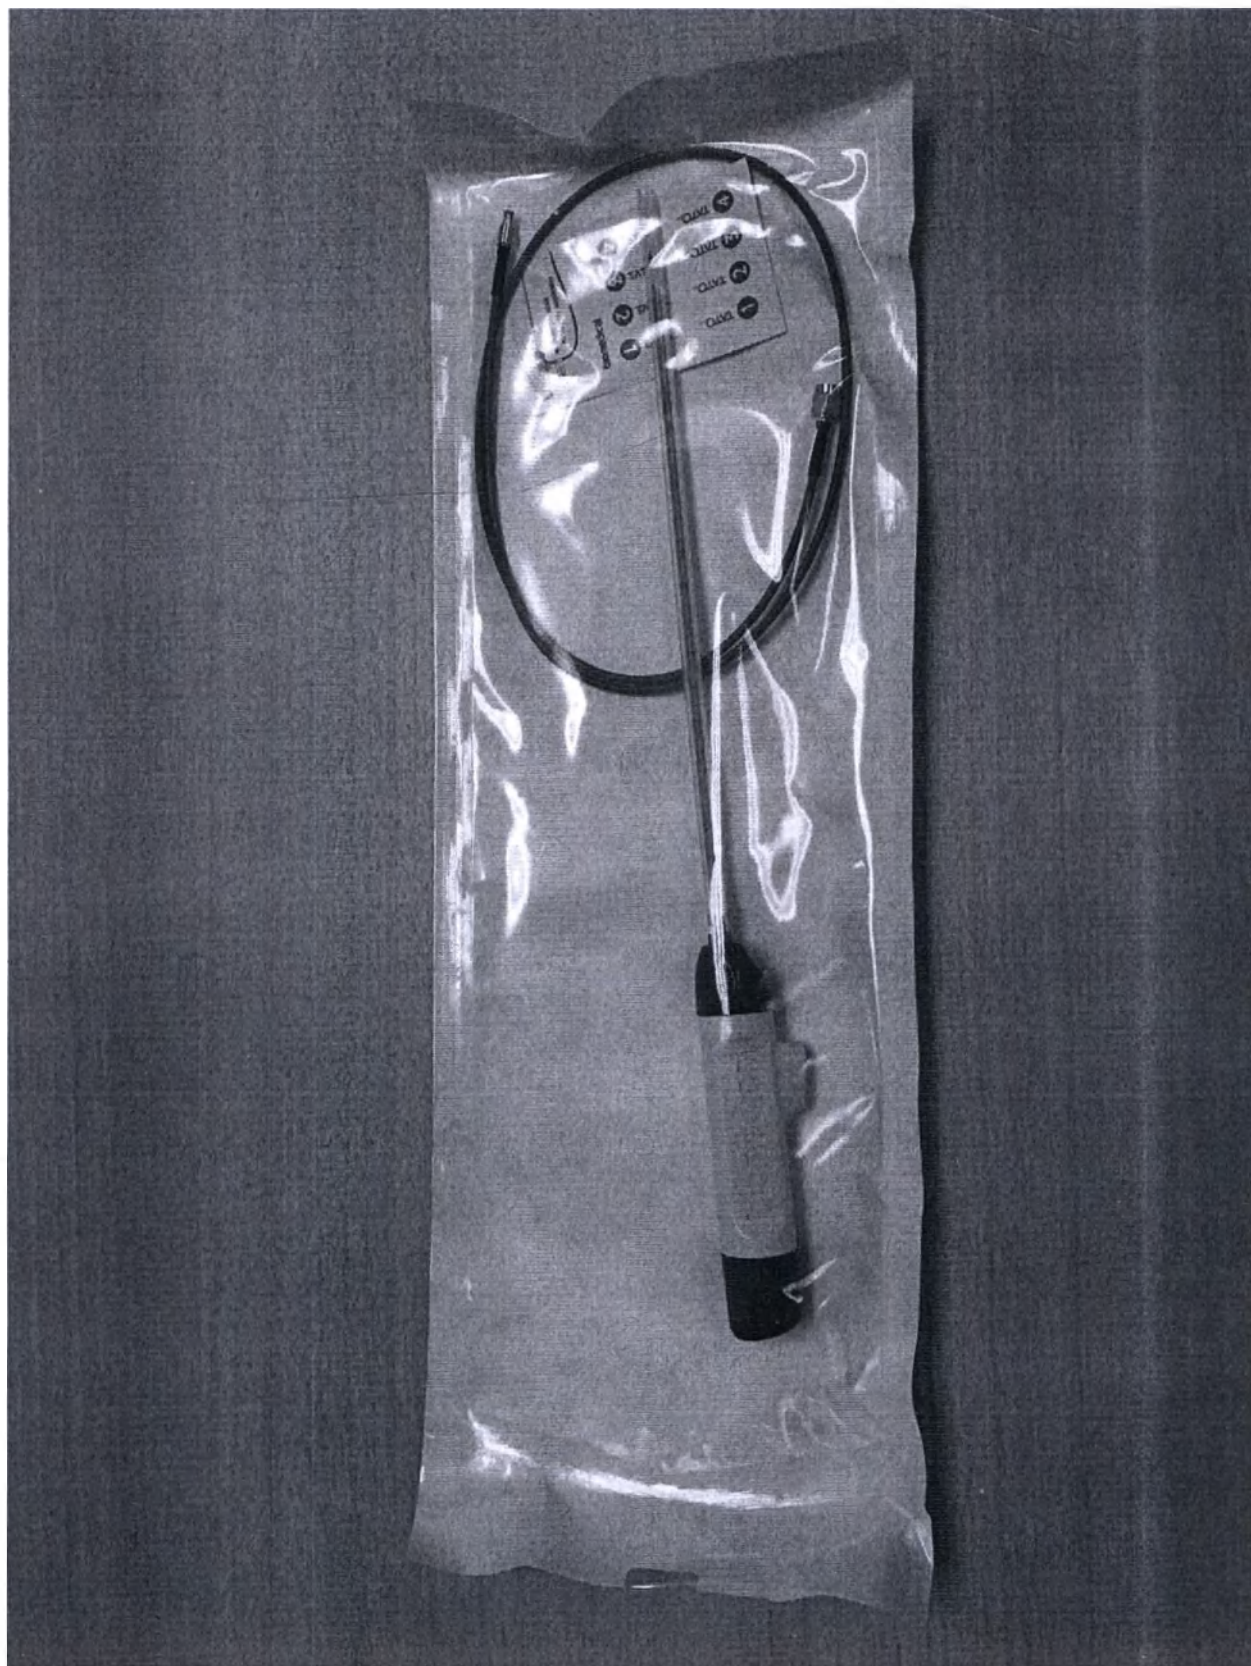


Рис.8. Аппликаторы TATOpro TTP1415CD-CM, TTP1420CD-CM, TTP1425CD-CM, размер 14G, длина 15 см, 20, см, 25 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке (На примере аппликатор TATOpro TTP1415CD-CM, размер 14G, длина 15 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке)

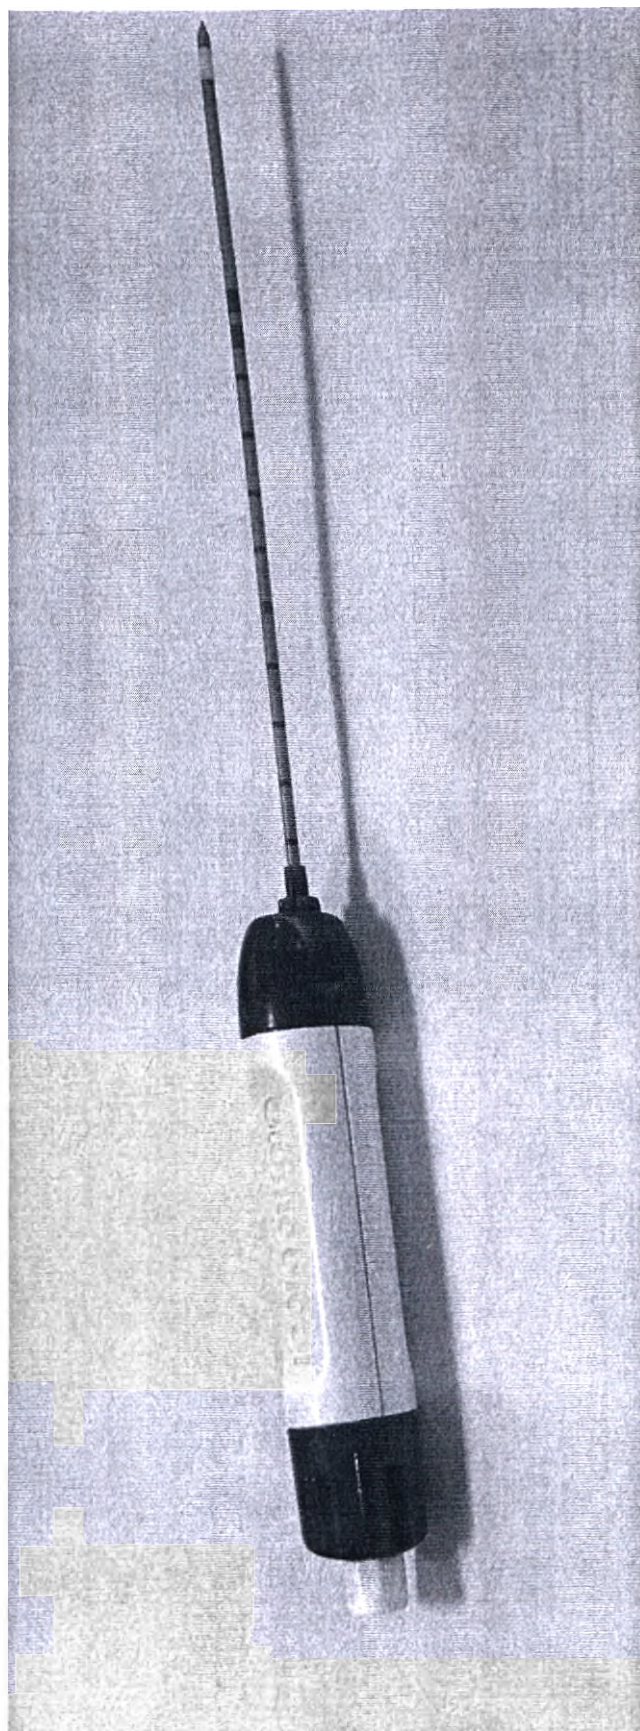


Рис.9. Аппликаторы TATOrgo TTP1410CDL-CM, TTP1415CDL-CM, TTP1420CDL-CM, TTP1425CDL-CM, размер 14G, длина 10 см, 15 см, 20, см, 25 см, с креплением типа Люэр-Лок для введения жидкостей, в комплекте с отсоединяемым кабелем (На примере аппликатор TATOrgo TTP1410CDL-CM, размер 14G, длина 10 см, с креплением типа Люэр-Лок для введения жидкостей, в комплекте с отсоединяемым кабелем)

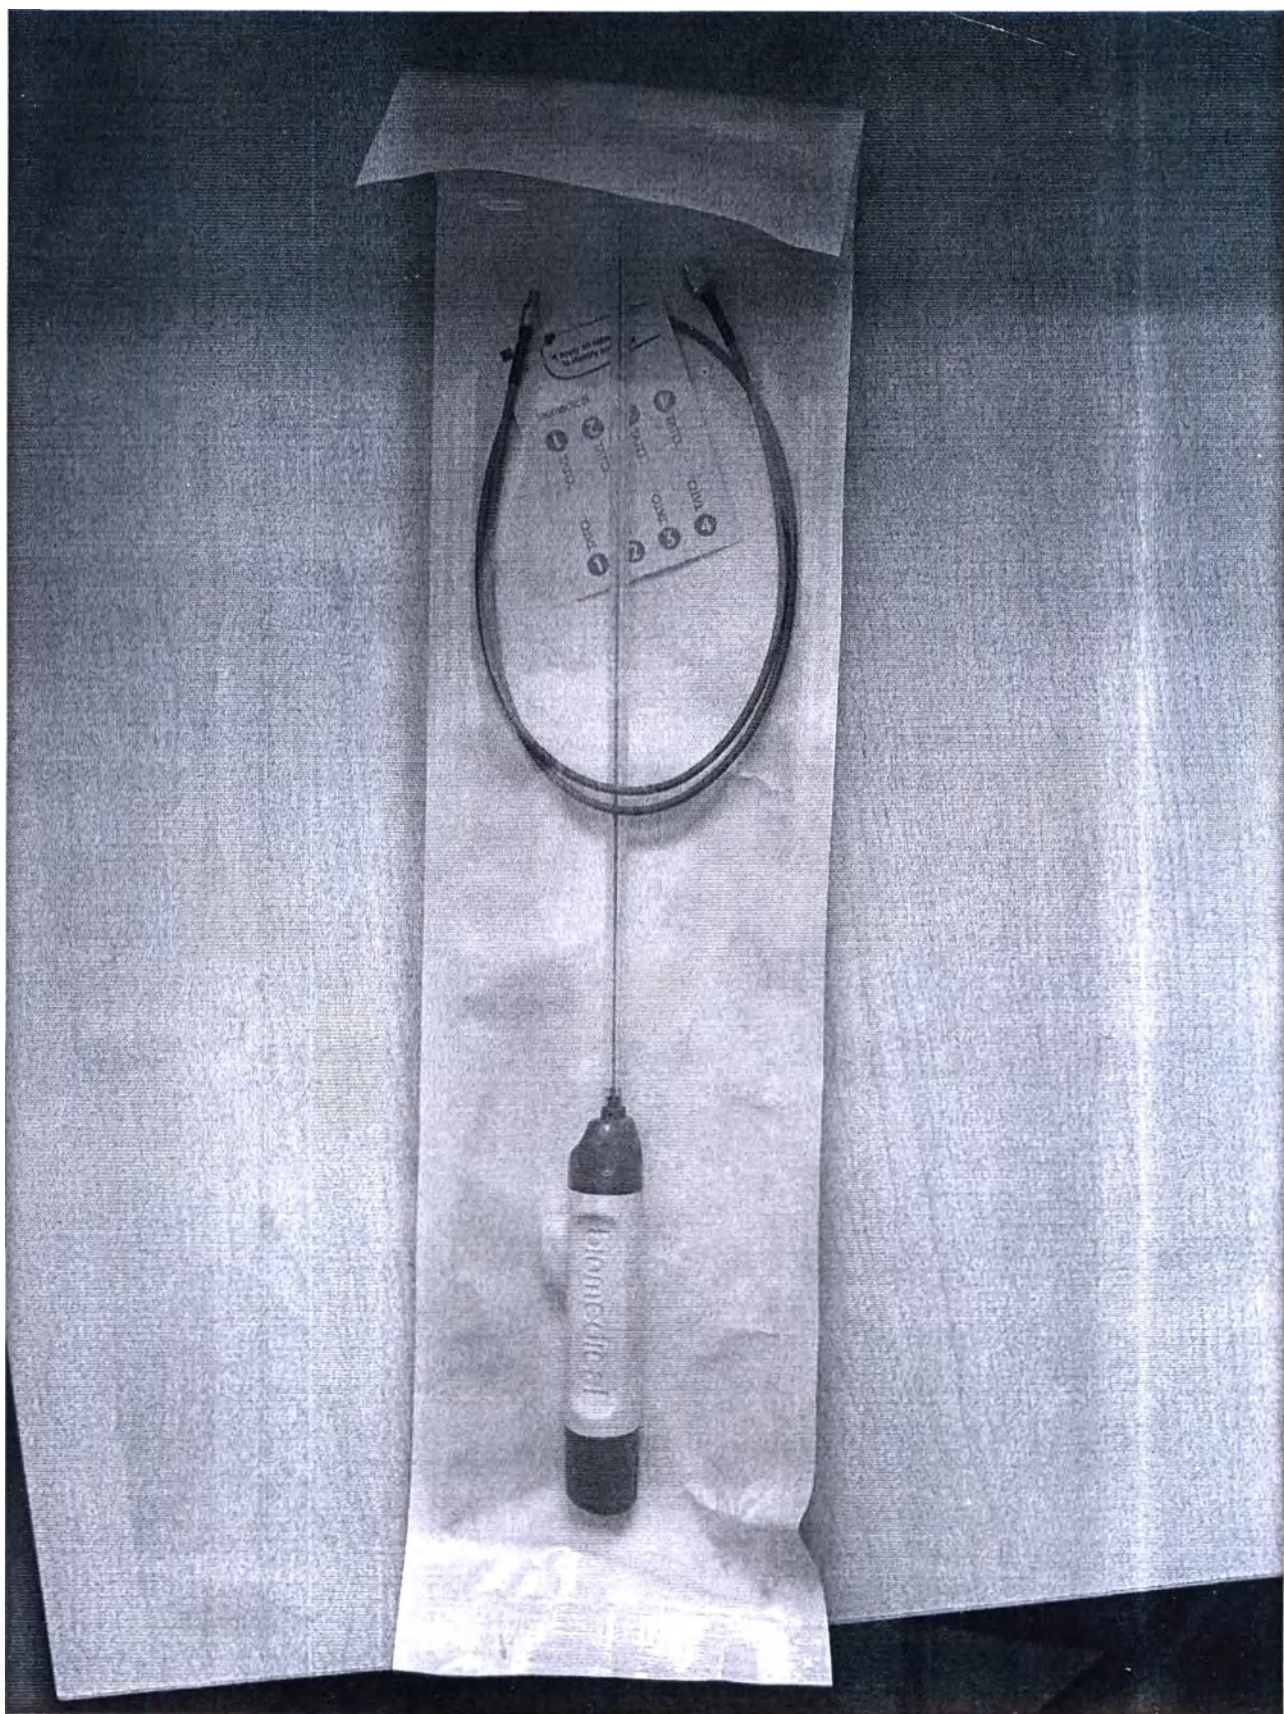


Рис.10. Аппликаторы TATOpro TTP1710CD-CM, TTP1715CD-CM, TTP1720CD-CM, TTP1725CD-CM размер 17G, длина 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке (На примере аппликатор TATOpro TTP1725CD-CM, размер 17G, длина 25 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке)

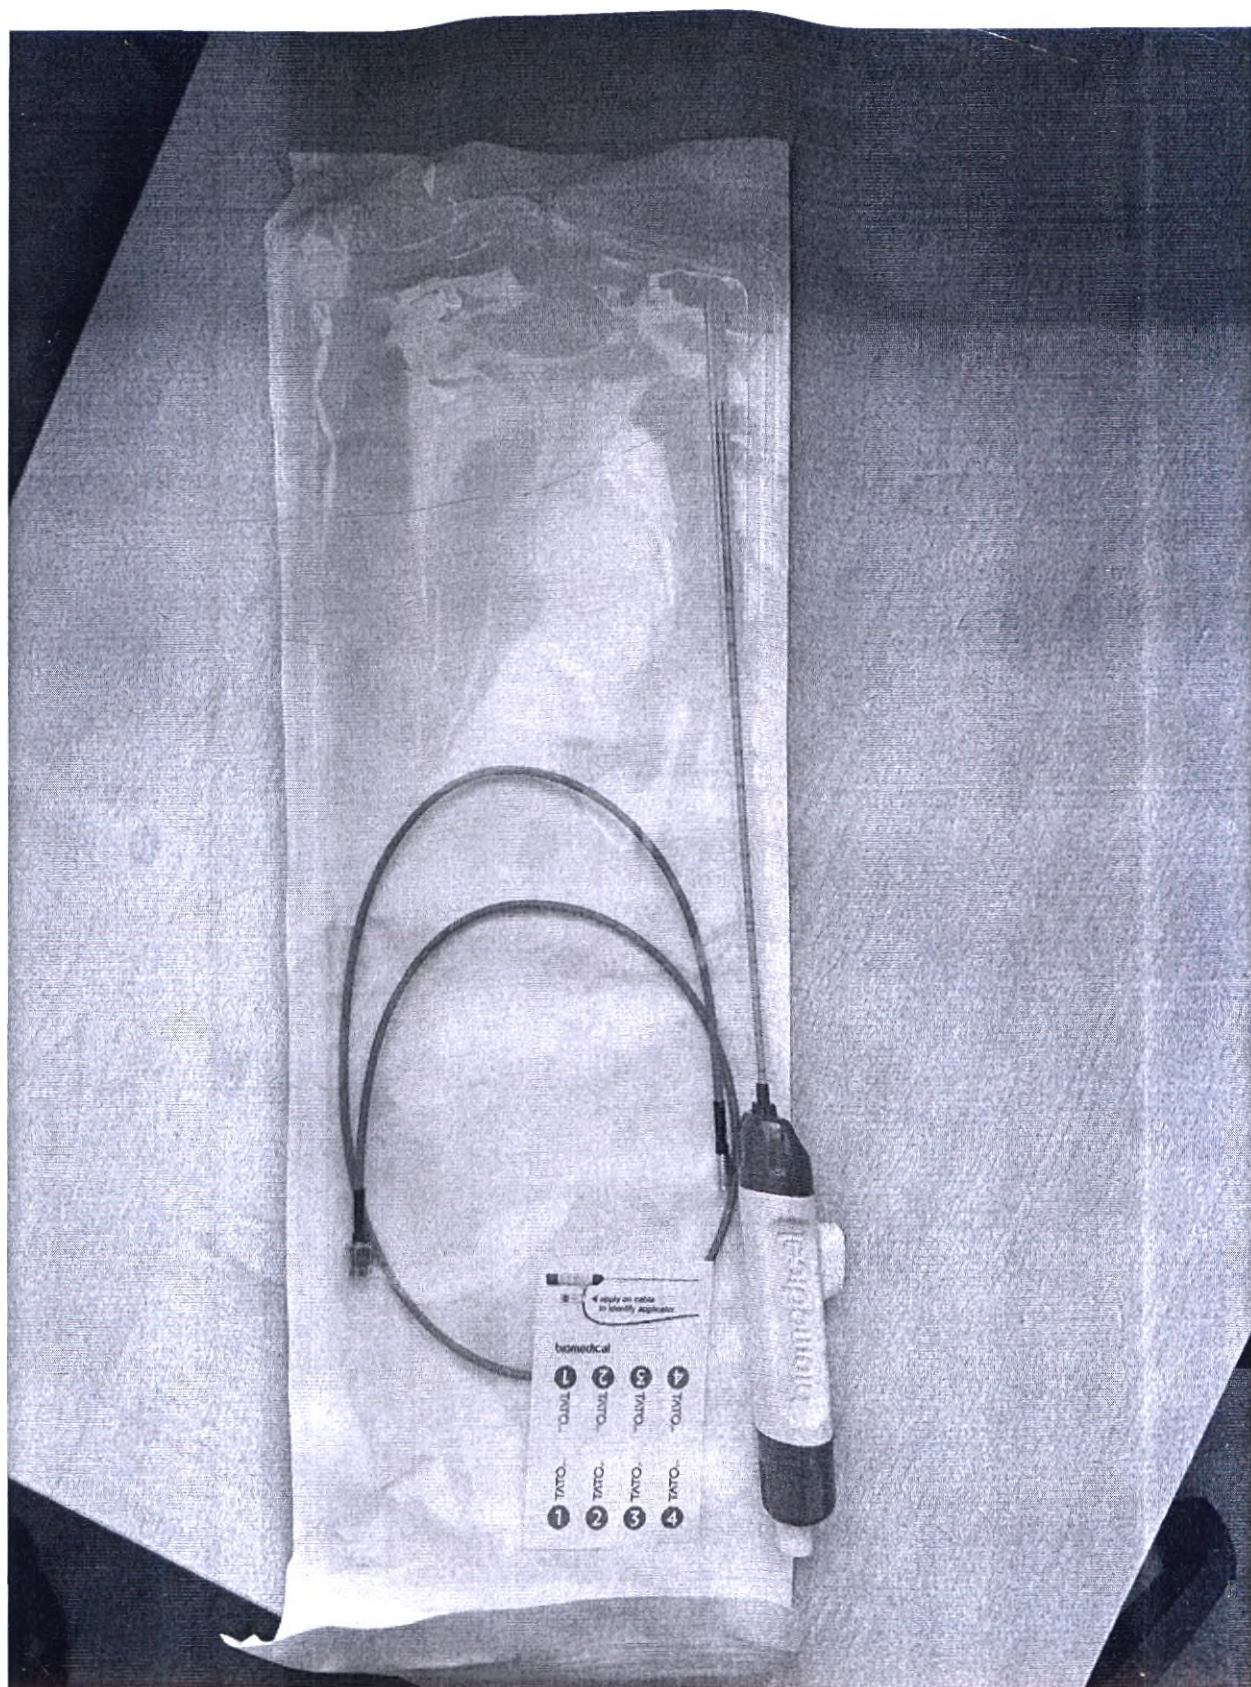


Рис.11. Аппликаторы TATOpro TTP1710CDL-CM, TTP1715CDL-CM, TTP1720CDL-CM, TTP1725CDL-CM размер 17G, длина 10 см, 15 см, 20, см, 25 см, с креплением типа Люэр-Лок для введения жидкостей, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке (На примере аппликатор TATOpro TTP1720CDL-CM, размер 17G, длина 20 см, с креплением типа Люэр-Лок для введения жидкостей в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке)



Рис.12. Аппликаторы TATOpro TTP1810CD-CM, TTP1815CD-CM, TTP1820CD-CM, TTP1825CD-CM размер 18G, длина 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке (На примере аппликатор TATOpro TTP1810CD-CM, размер 18G, длина 10 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем в первичной упаковке)

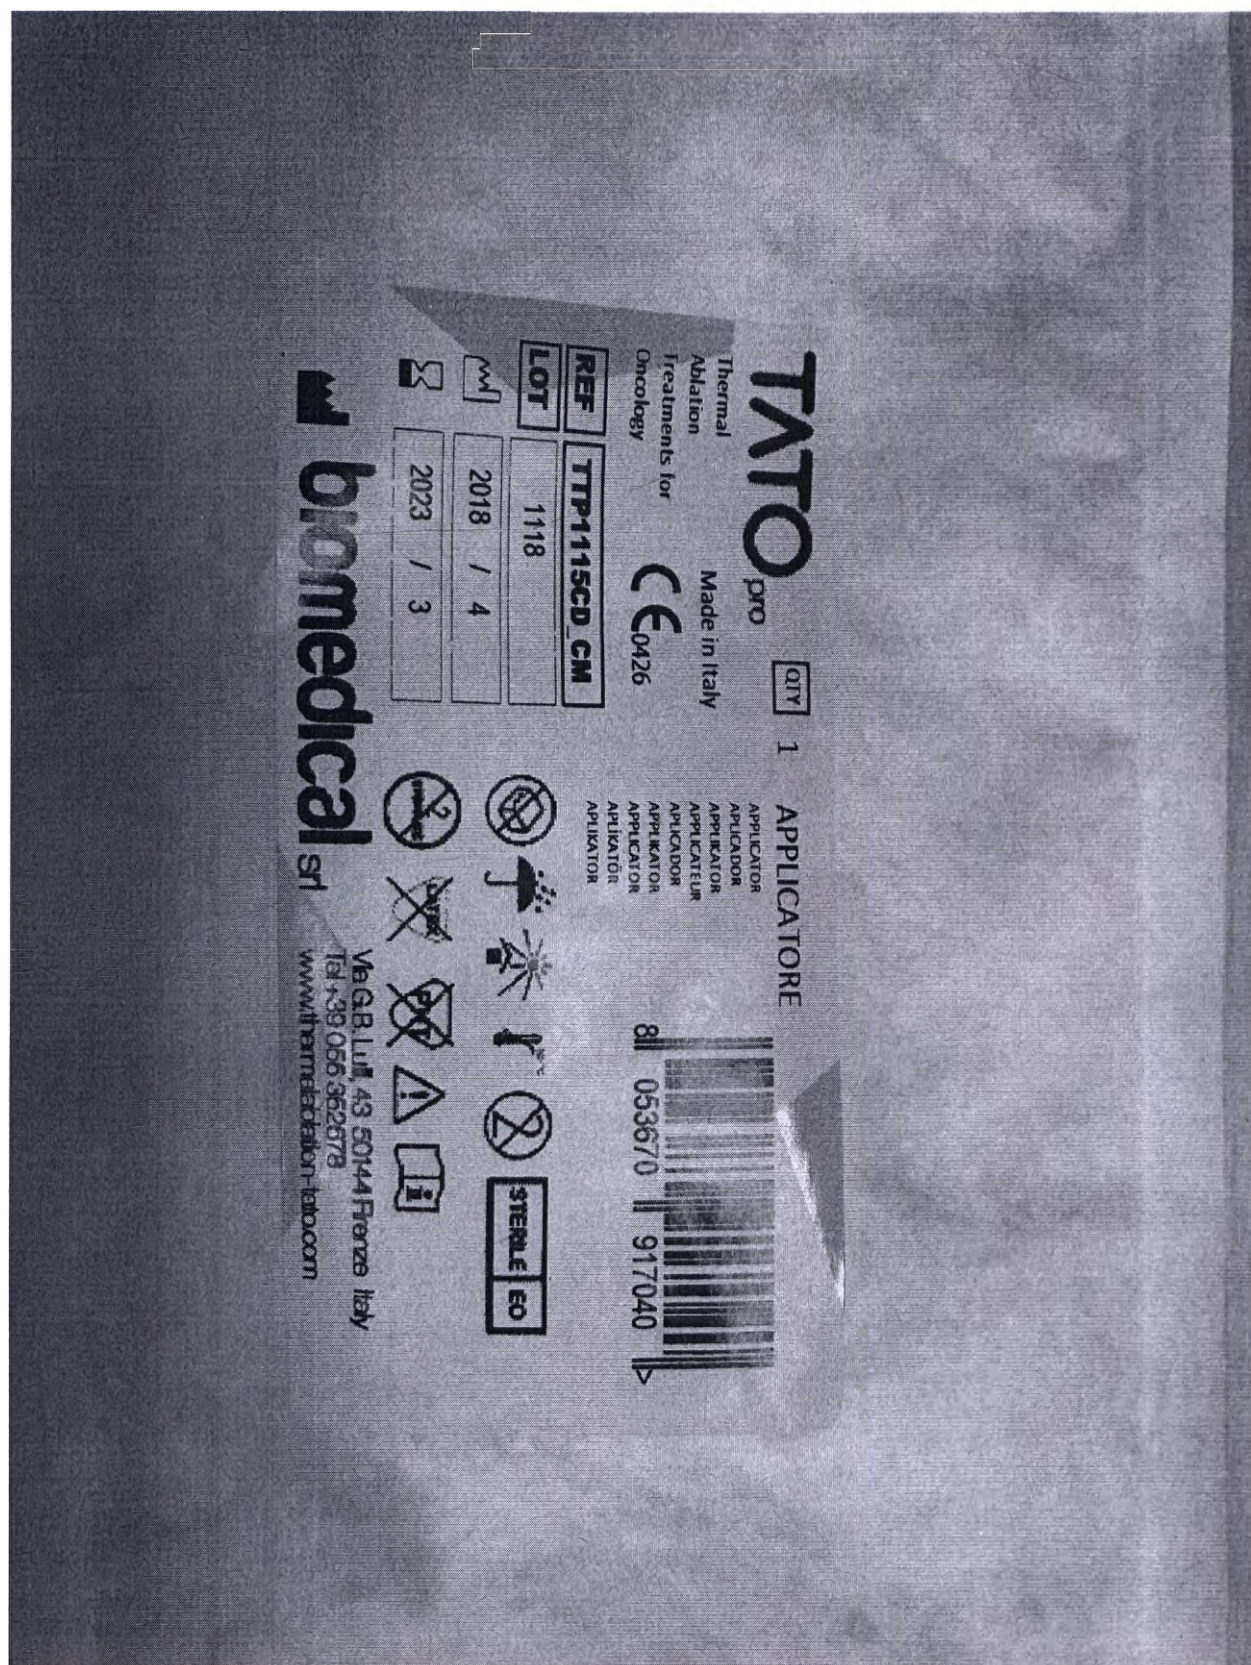


Рис.13. Маркировка первичной упаковки для всех вариантов исполнения аппликаторов
 (Маркировка представлена на примере аппликатора TATOpro TTP1115CD-CM, размер 11G, длина
 15 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем)

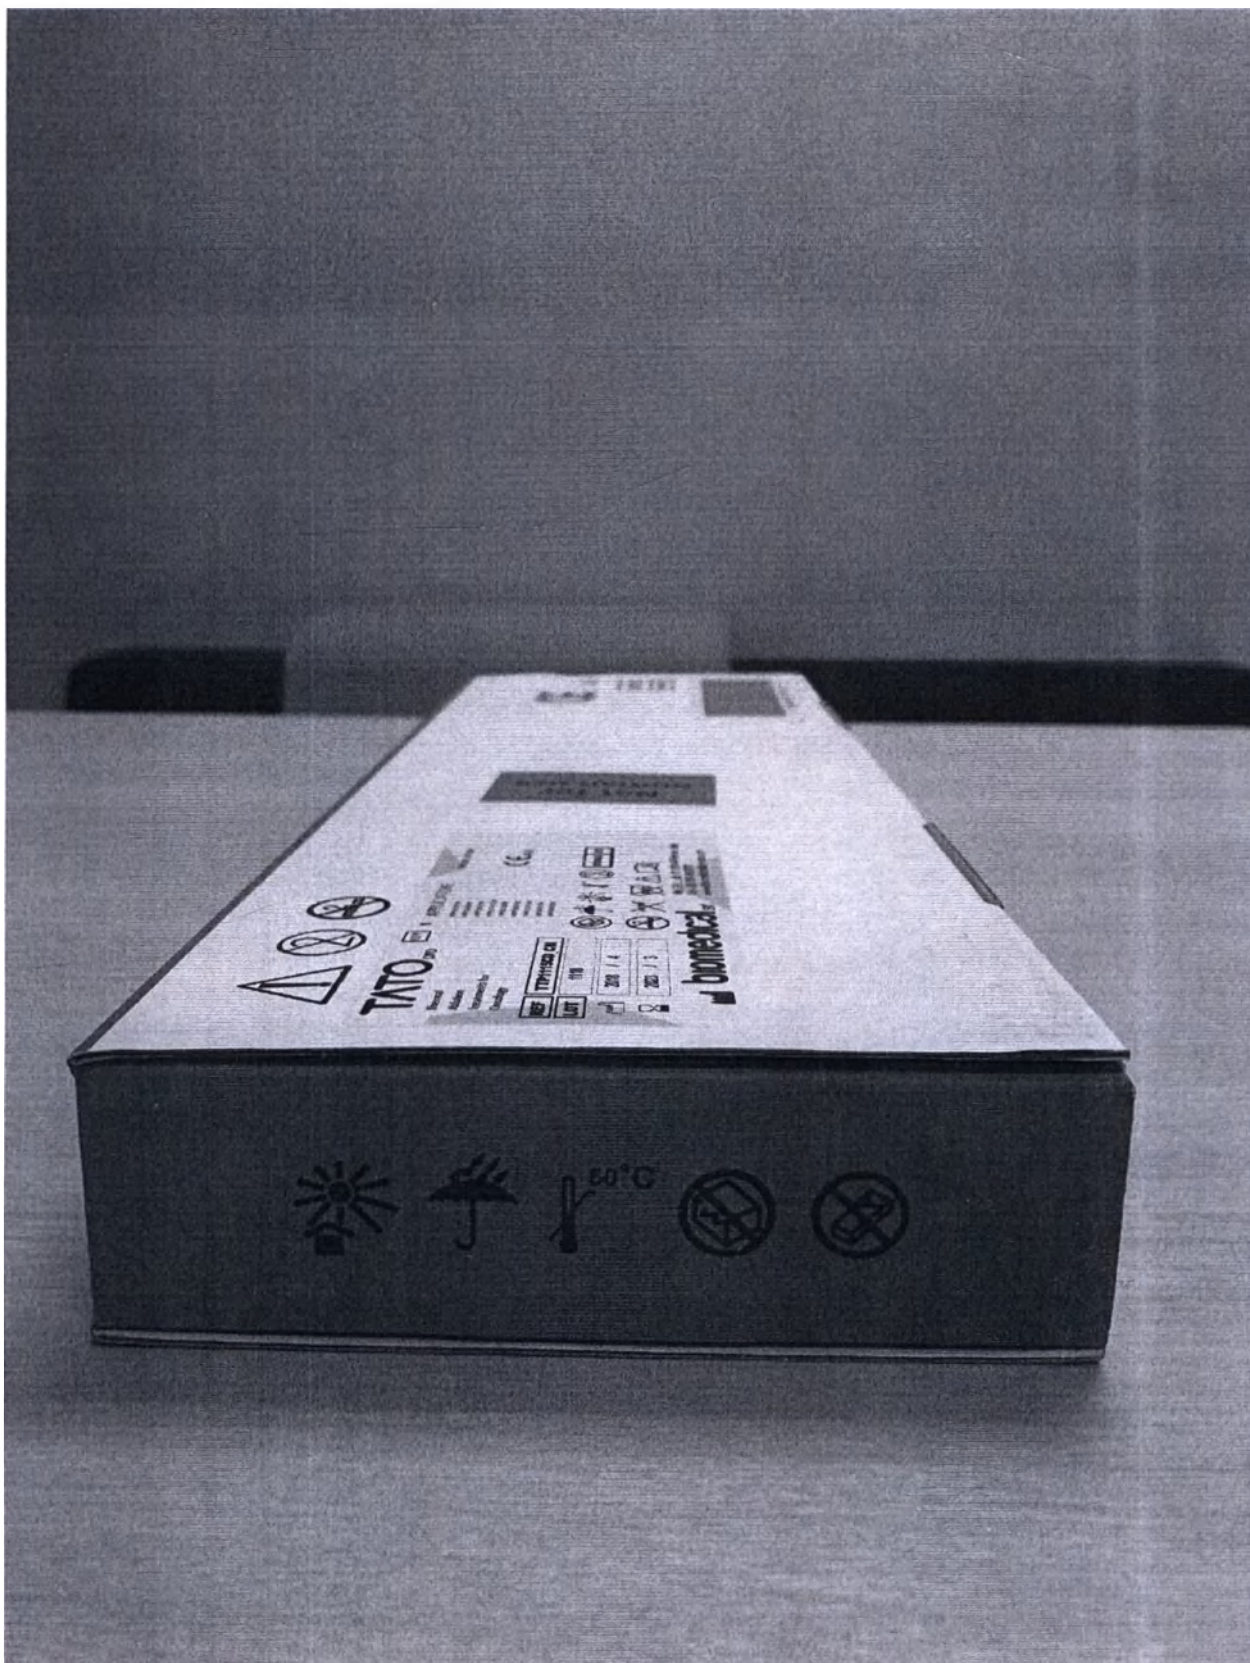


Рис.14. Вторичная упаковка для всех вариантов исполнения аппликаторов (На примере вторичная упаковка для аппликатора ТАТОрго ТТР1115СD-СМ, размер 11G, длина 15 см, в комплекте с отсоединяемым кабелем)



Рис.15. Транспортная упаковка для всех вариантов исполнения аппликаторов



Рис.16. Чемодан для транспортировки

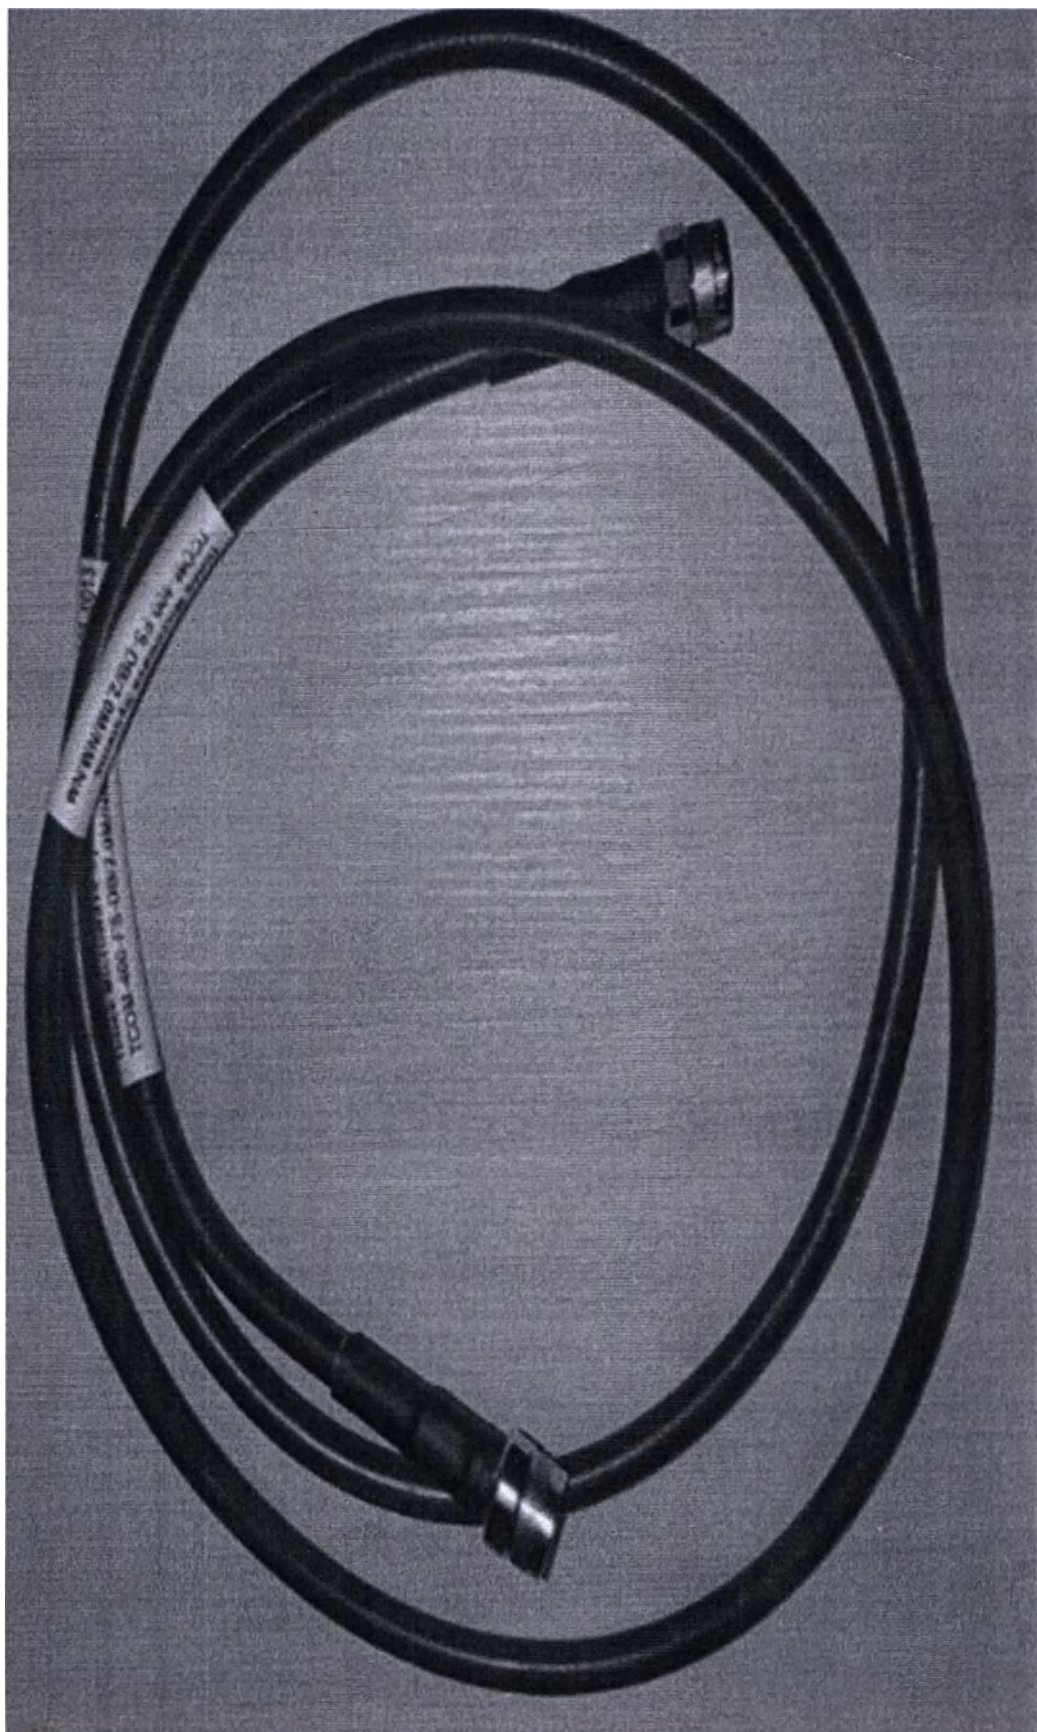


Рис.17. Коаксиальный кабель для передачи СВЧ-сигналов

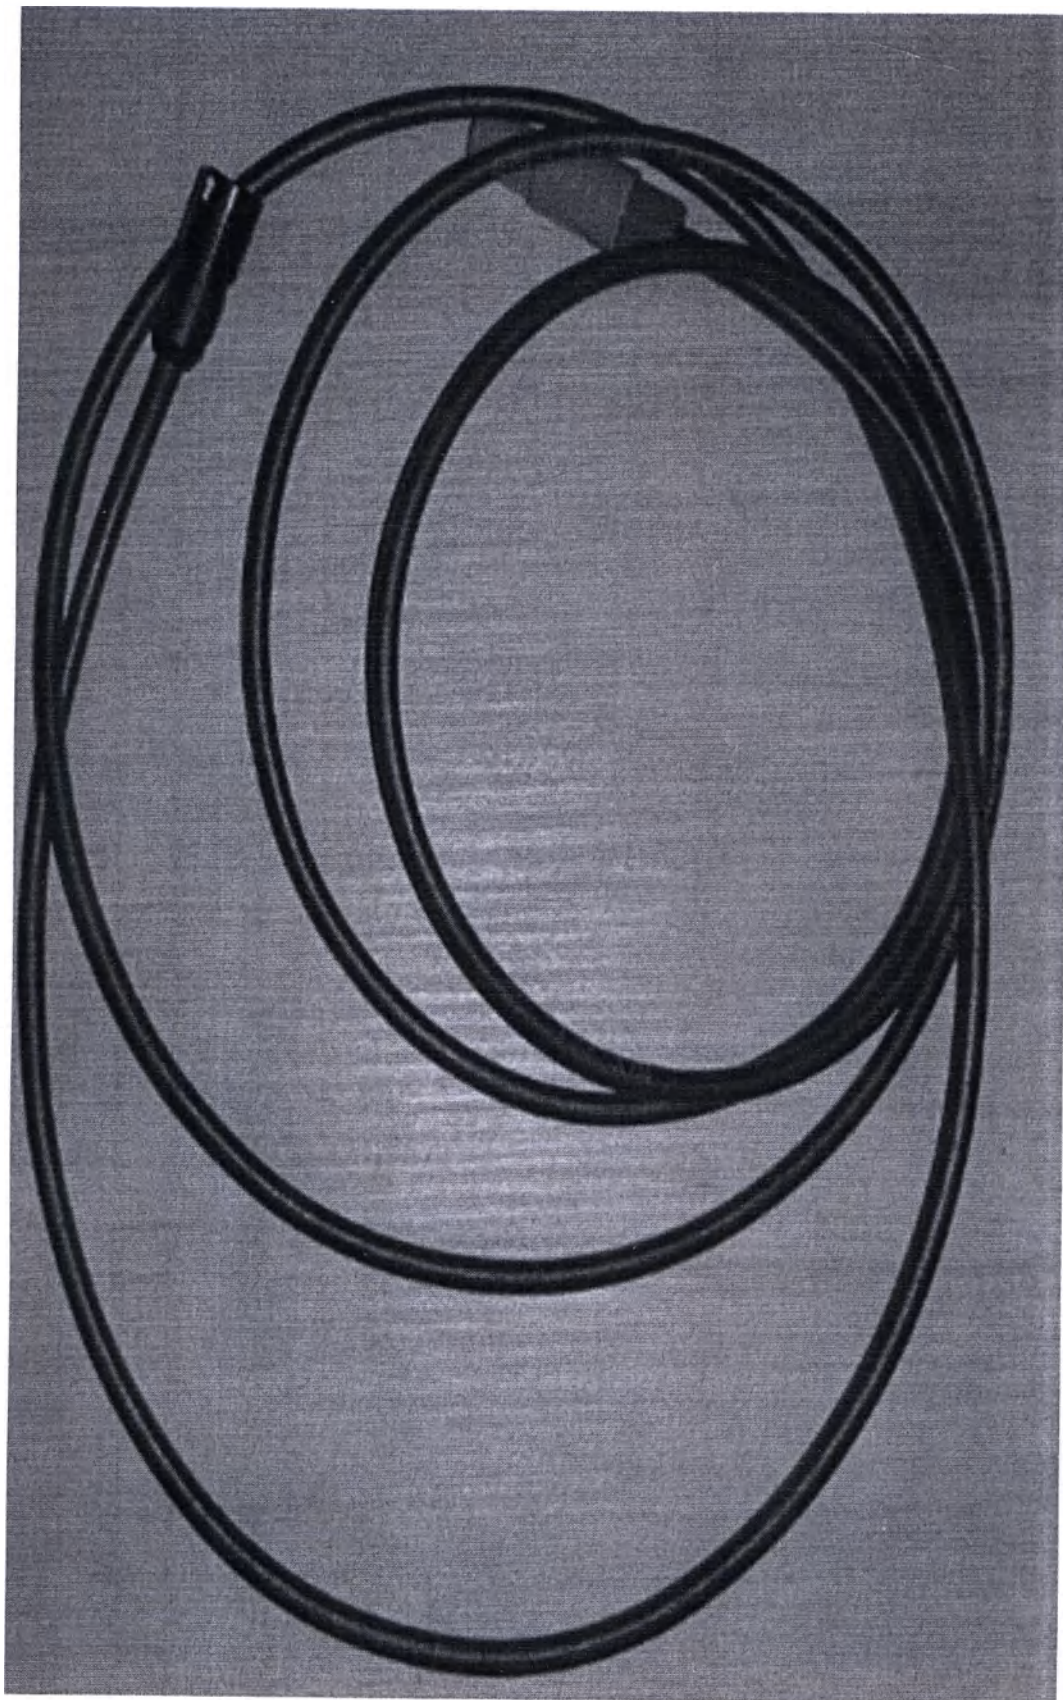


Рис.18. Кабель передачи данных

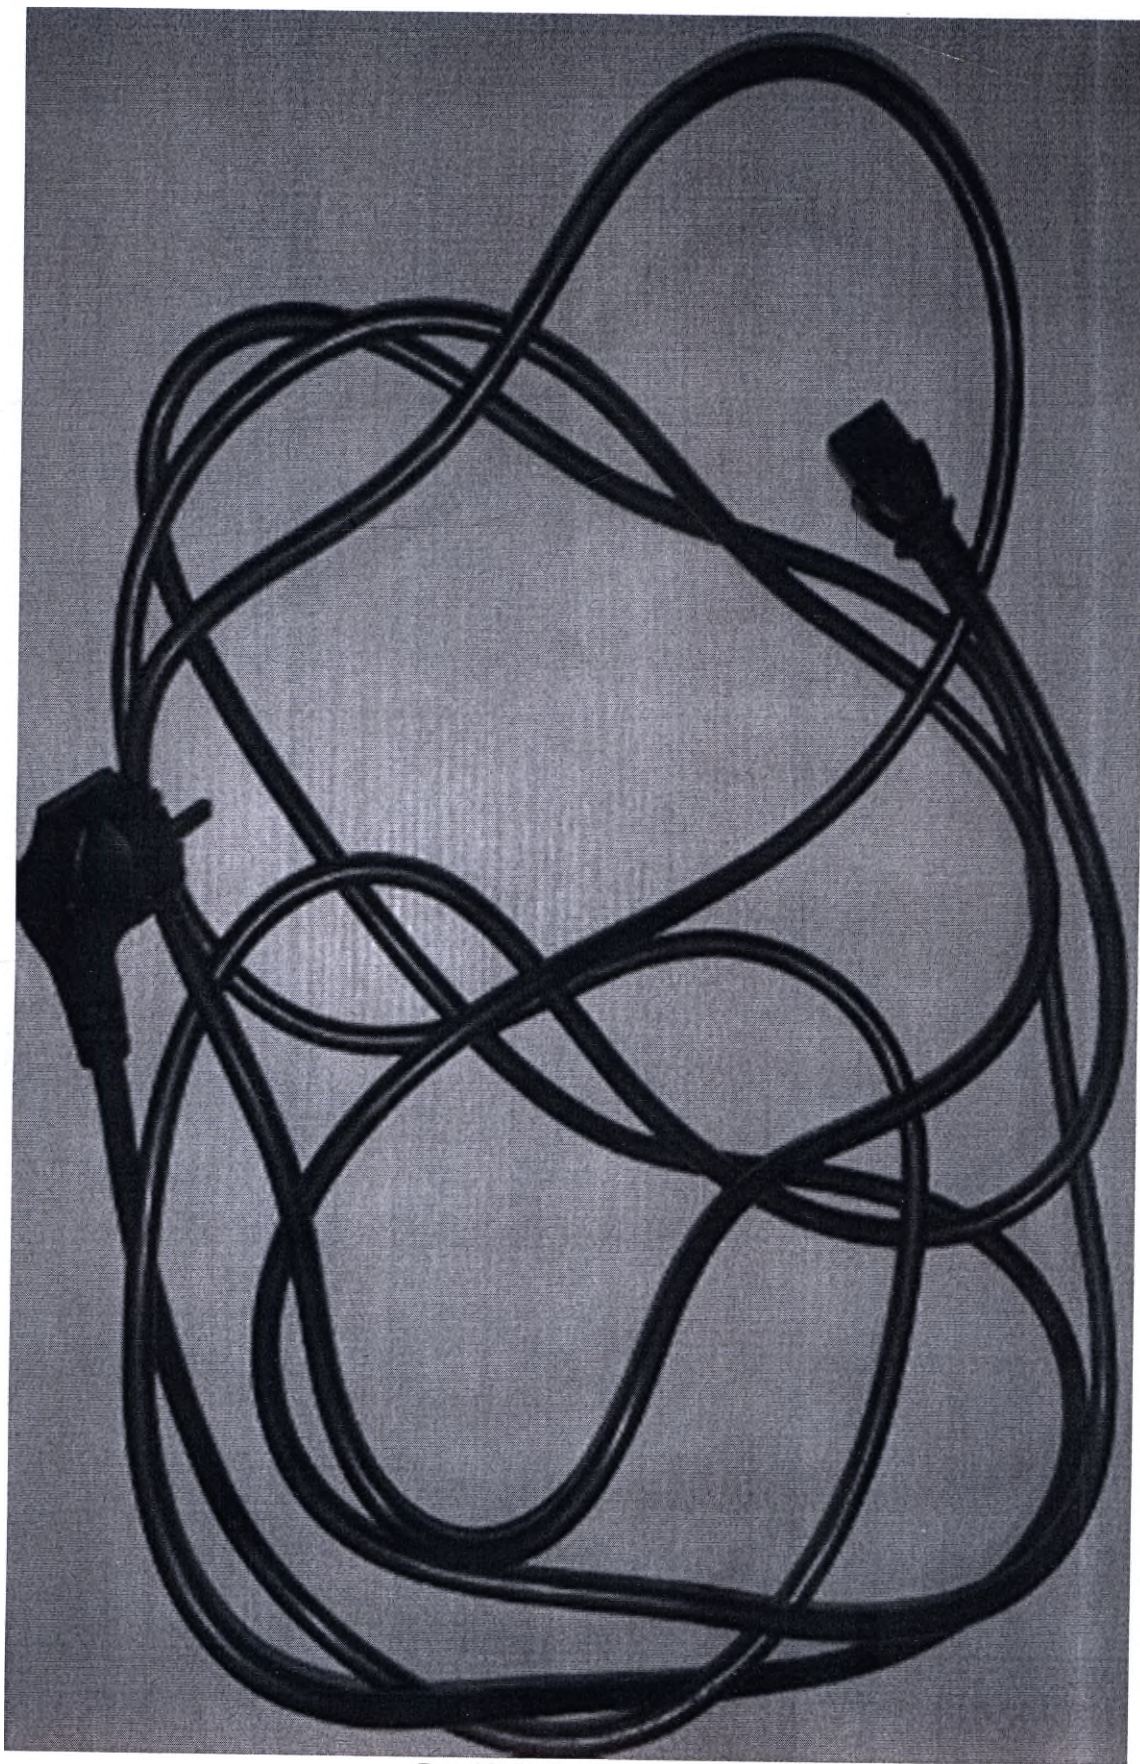


Рис.19. Кабель питания



Рис.20. Эксплуатационная документация на бумажных и электронных носителях

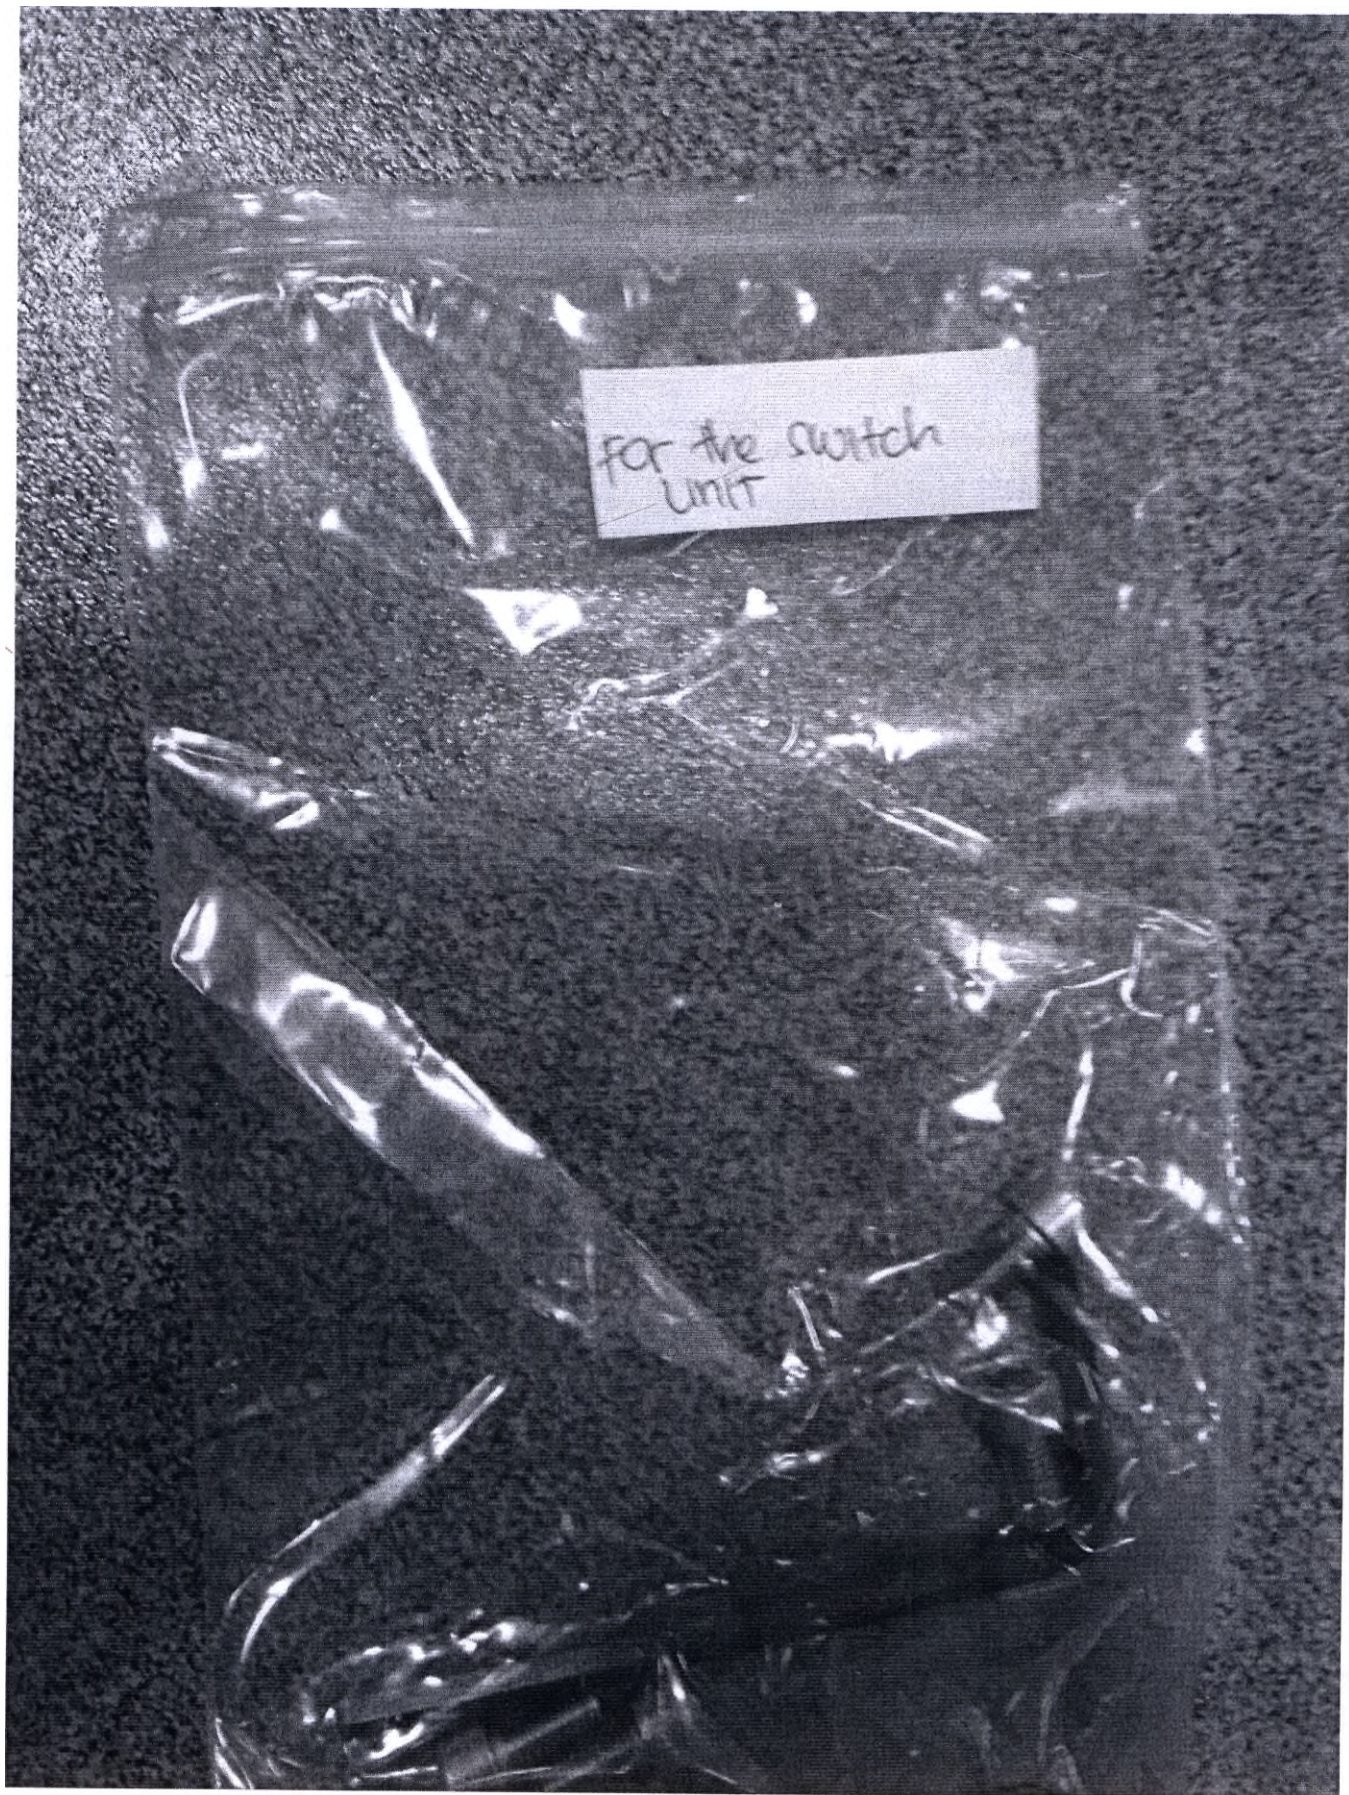


Рис.21.1. Крепежные инструменты в первичной упаковке



Рис.21.2. Крепежные инструменты в первичной упаковке

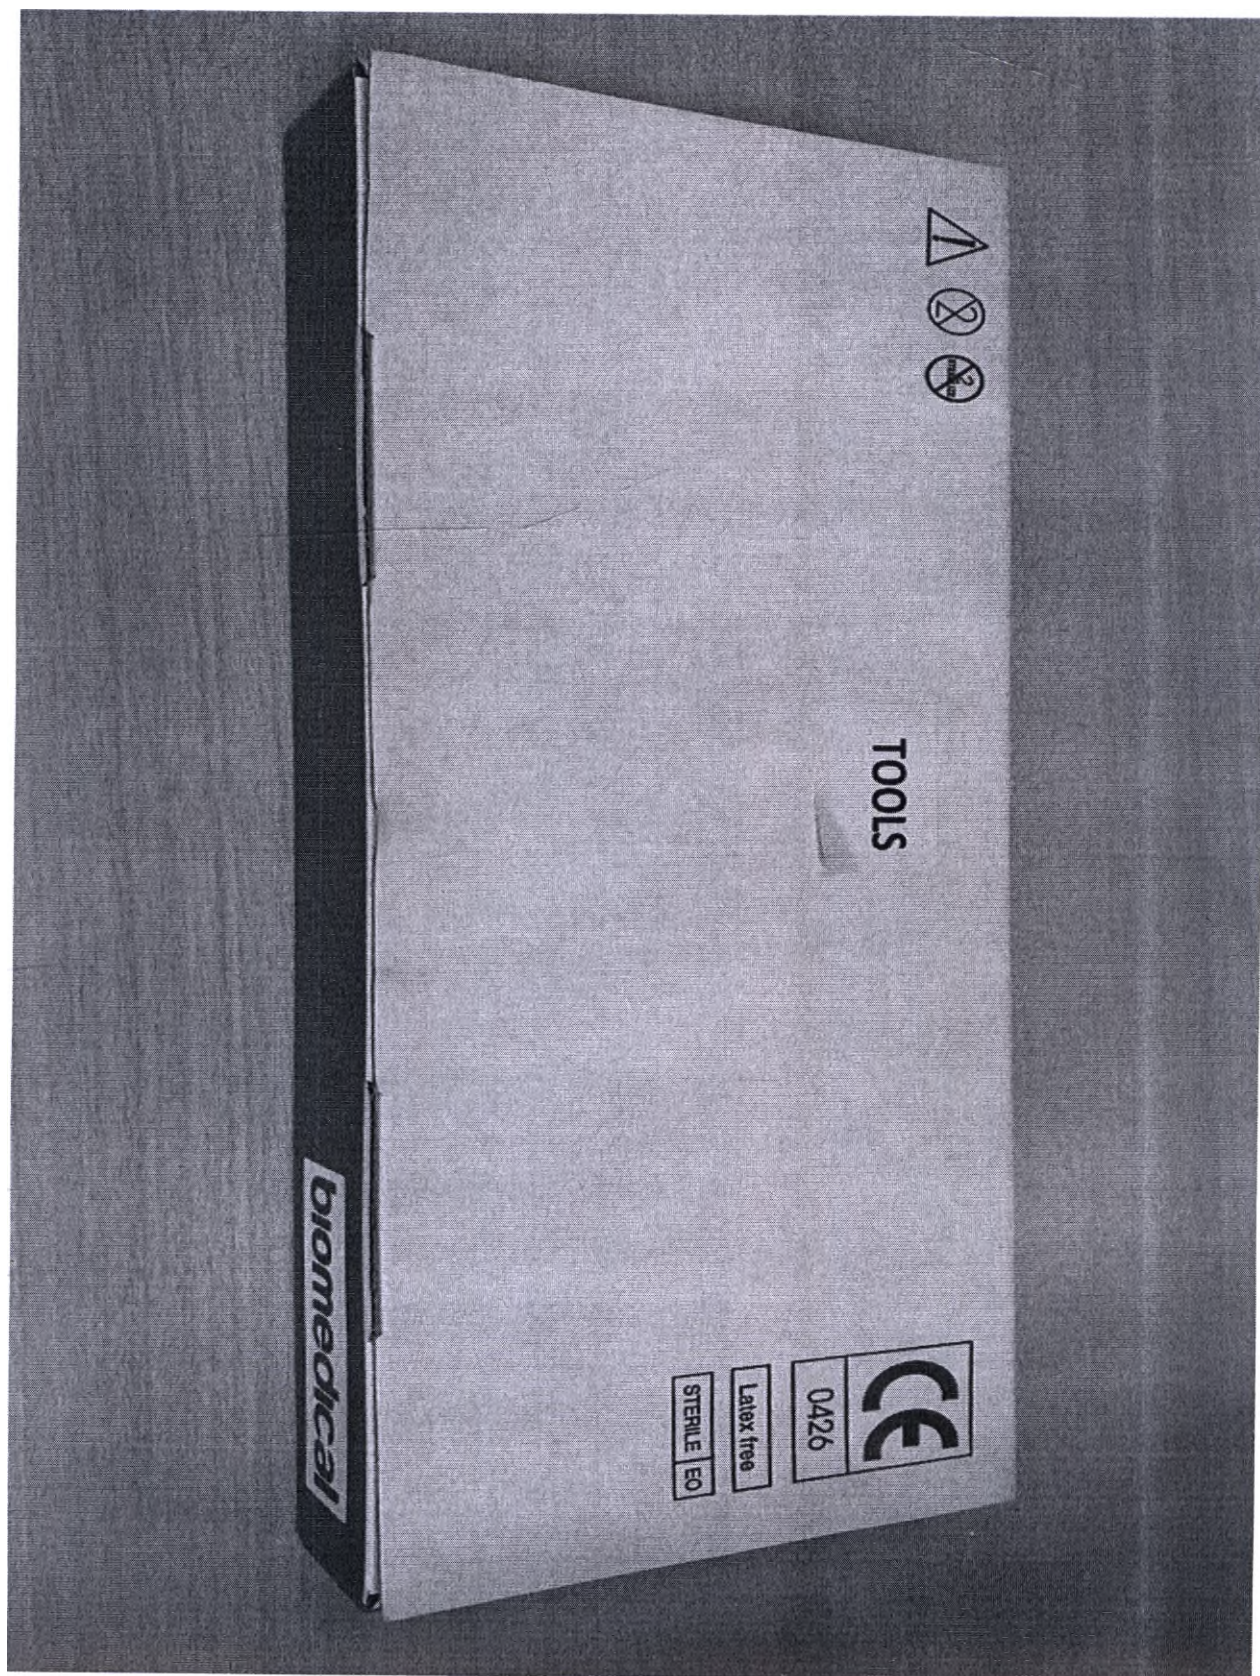


Рис.22. Вторичная упаковка крепежных инструментов

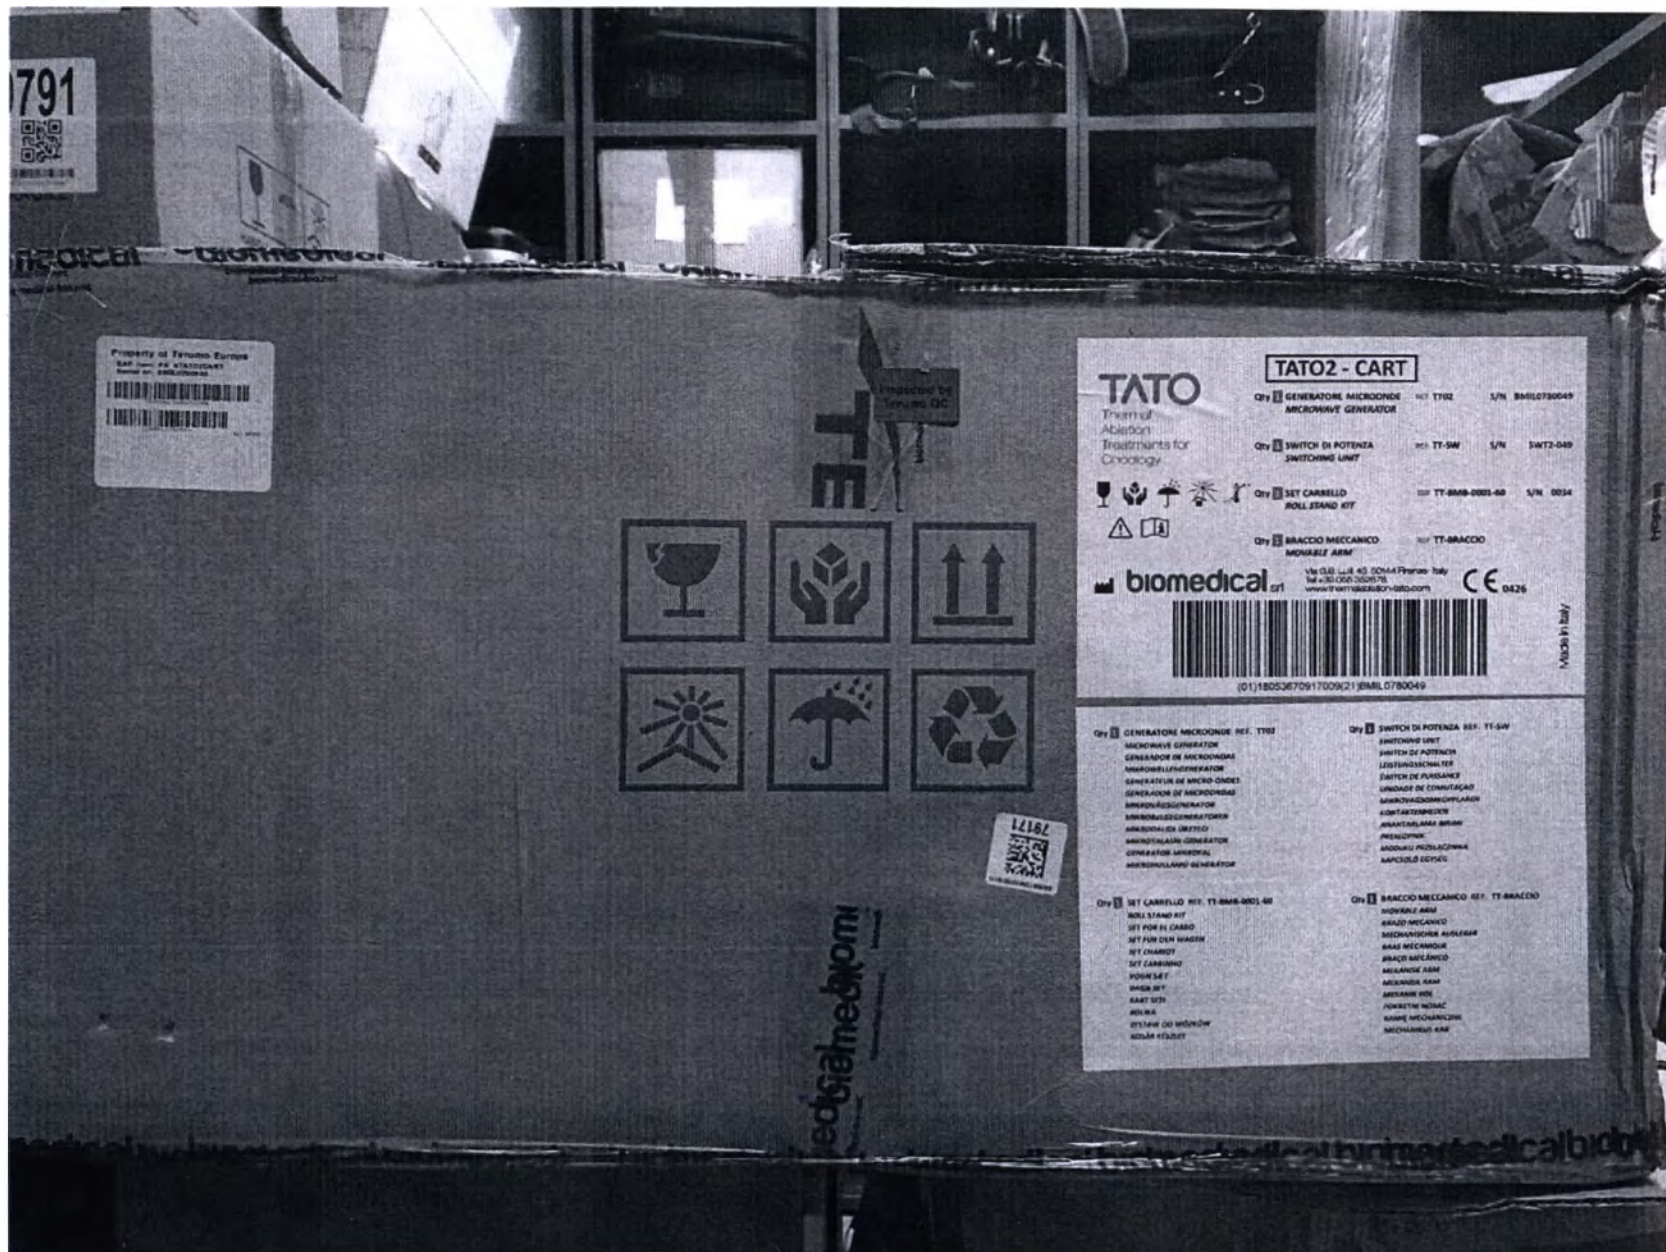


Рис.23. Транспортная упаковка системы TATO2

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 26 листов

М.П.

