


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»


О.В. Якубович

«19» 12 2018 г



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**«Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ-
«ПАЛЬМА®»**

**по
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018»**


2018

1. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 150 x 150 мм:



Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

2. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 350 x 350 мм:

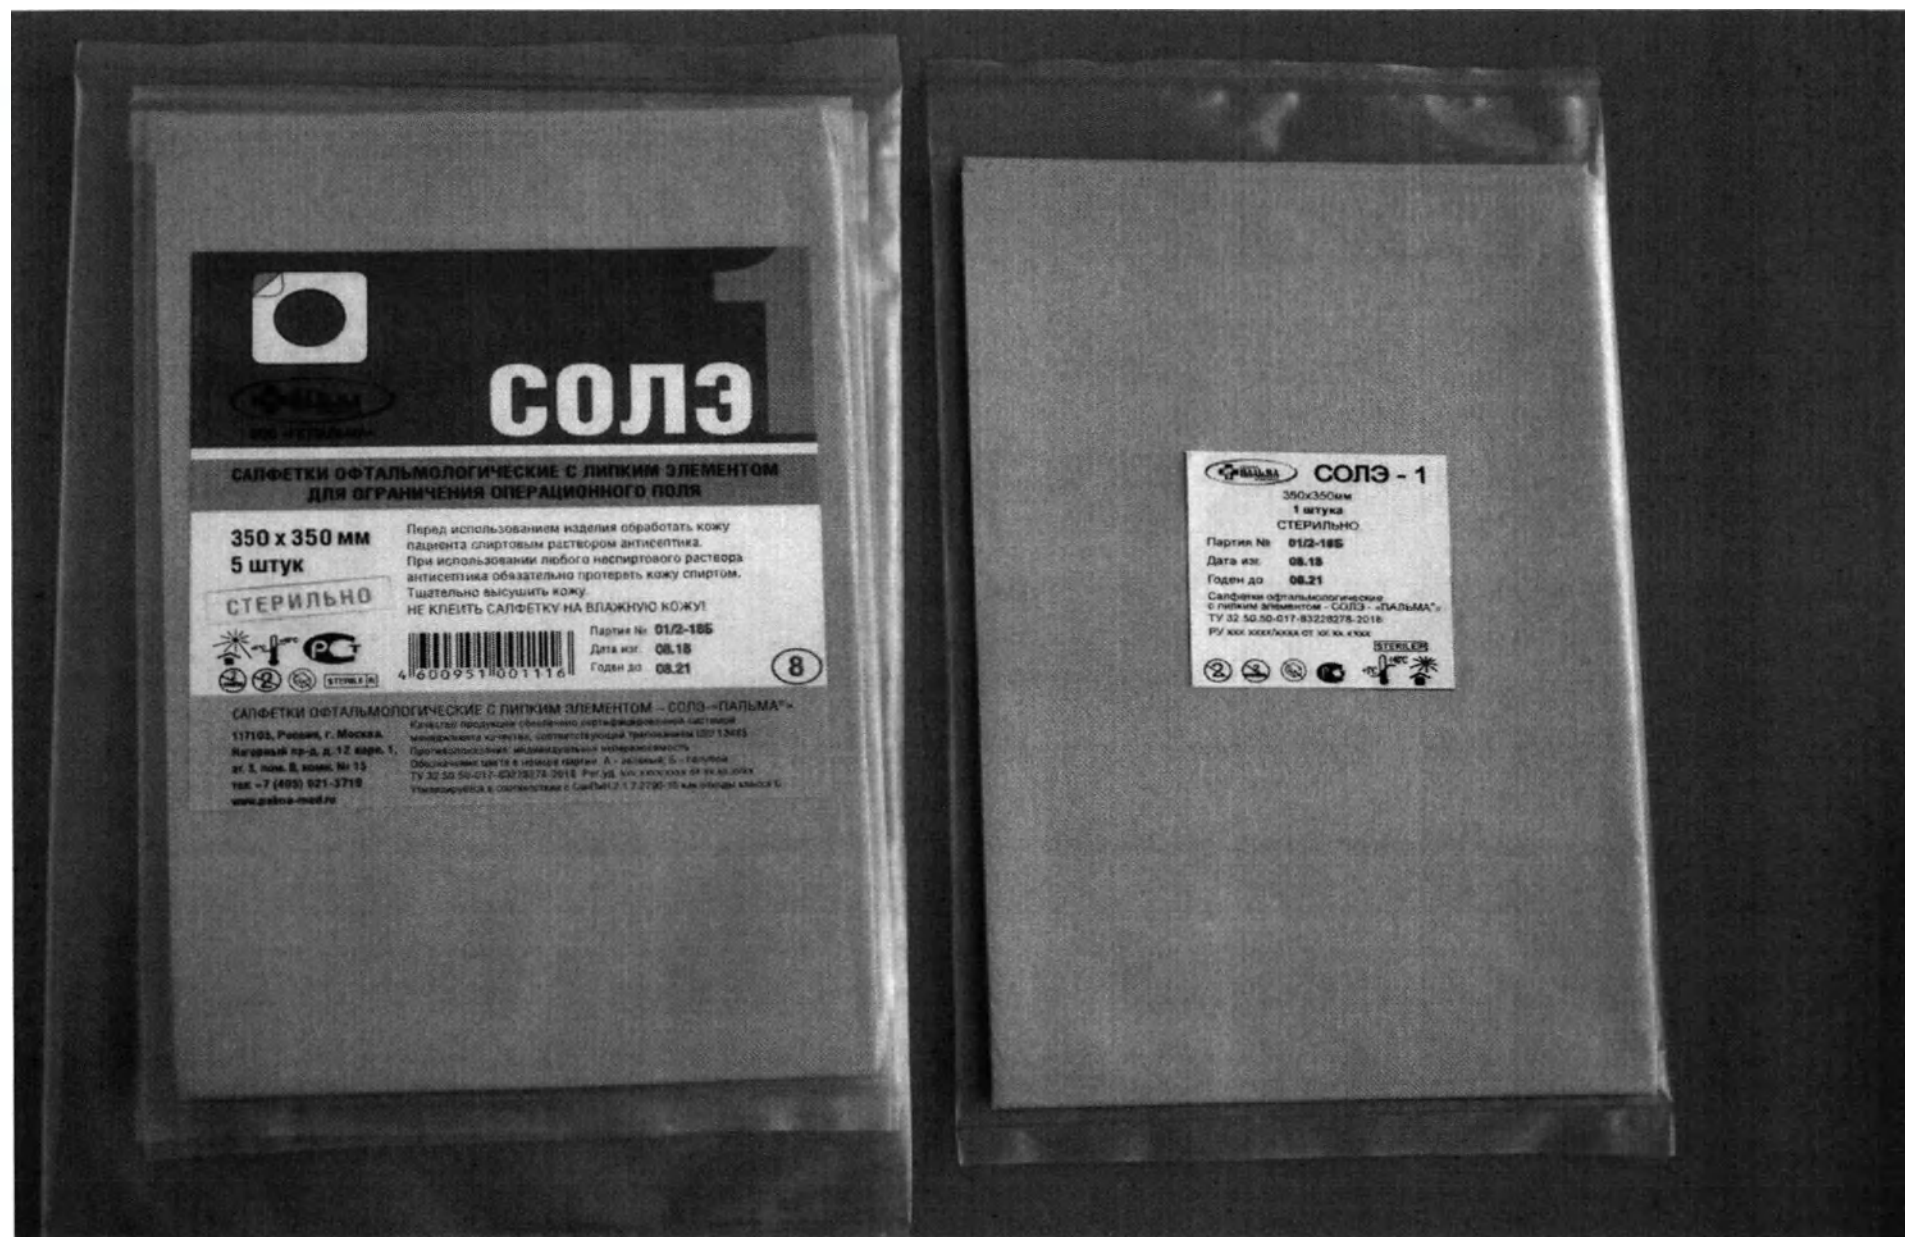

Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

3. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 650 x 650 мм:




Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

4. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 650 x 900 мм:



Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

5. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 650 x 1200 мм:

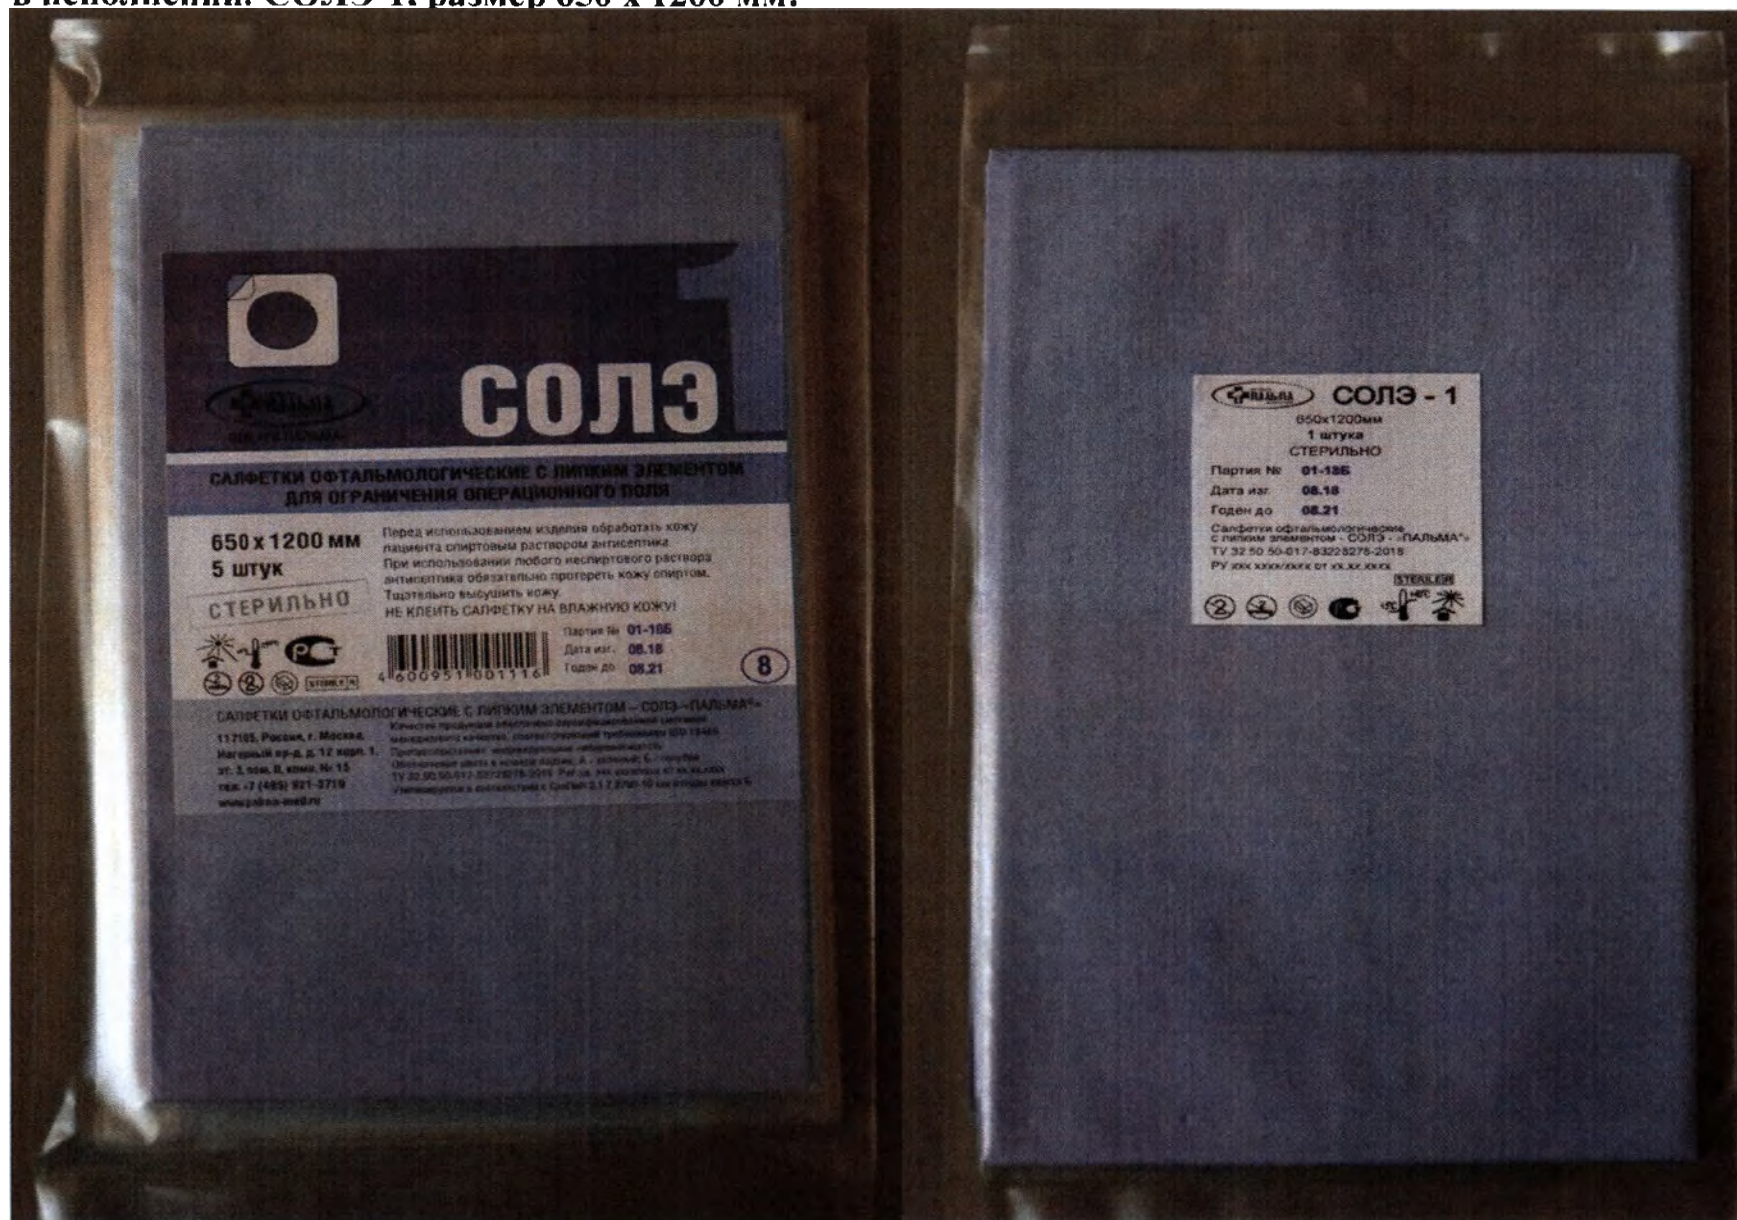


Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

6. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 150 x 150 мм:



Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

7. Салфетки офтальмологические с линким элементом- СО.Г)- «ПА.ПМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СО.Г)-1 с линкой операционной пленкой с разрезом, размер 350 x 350 мм:

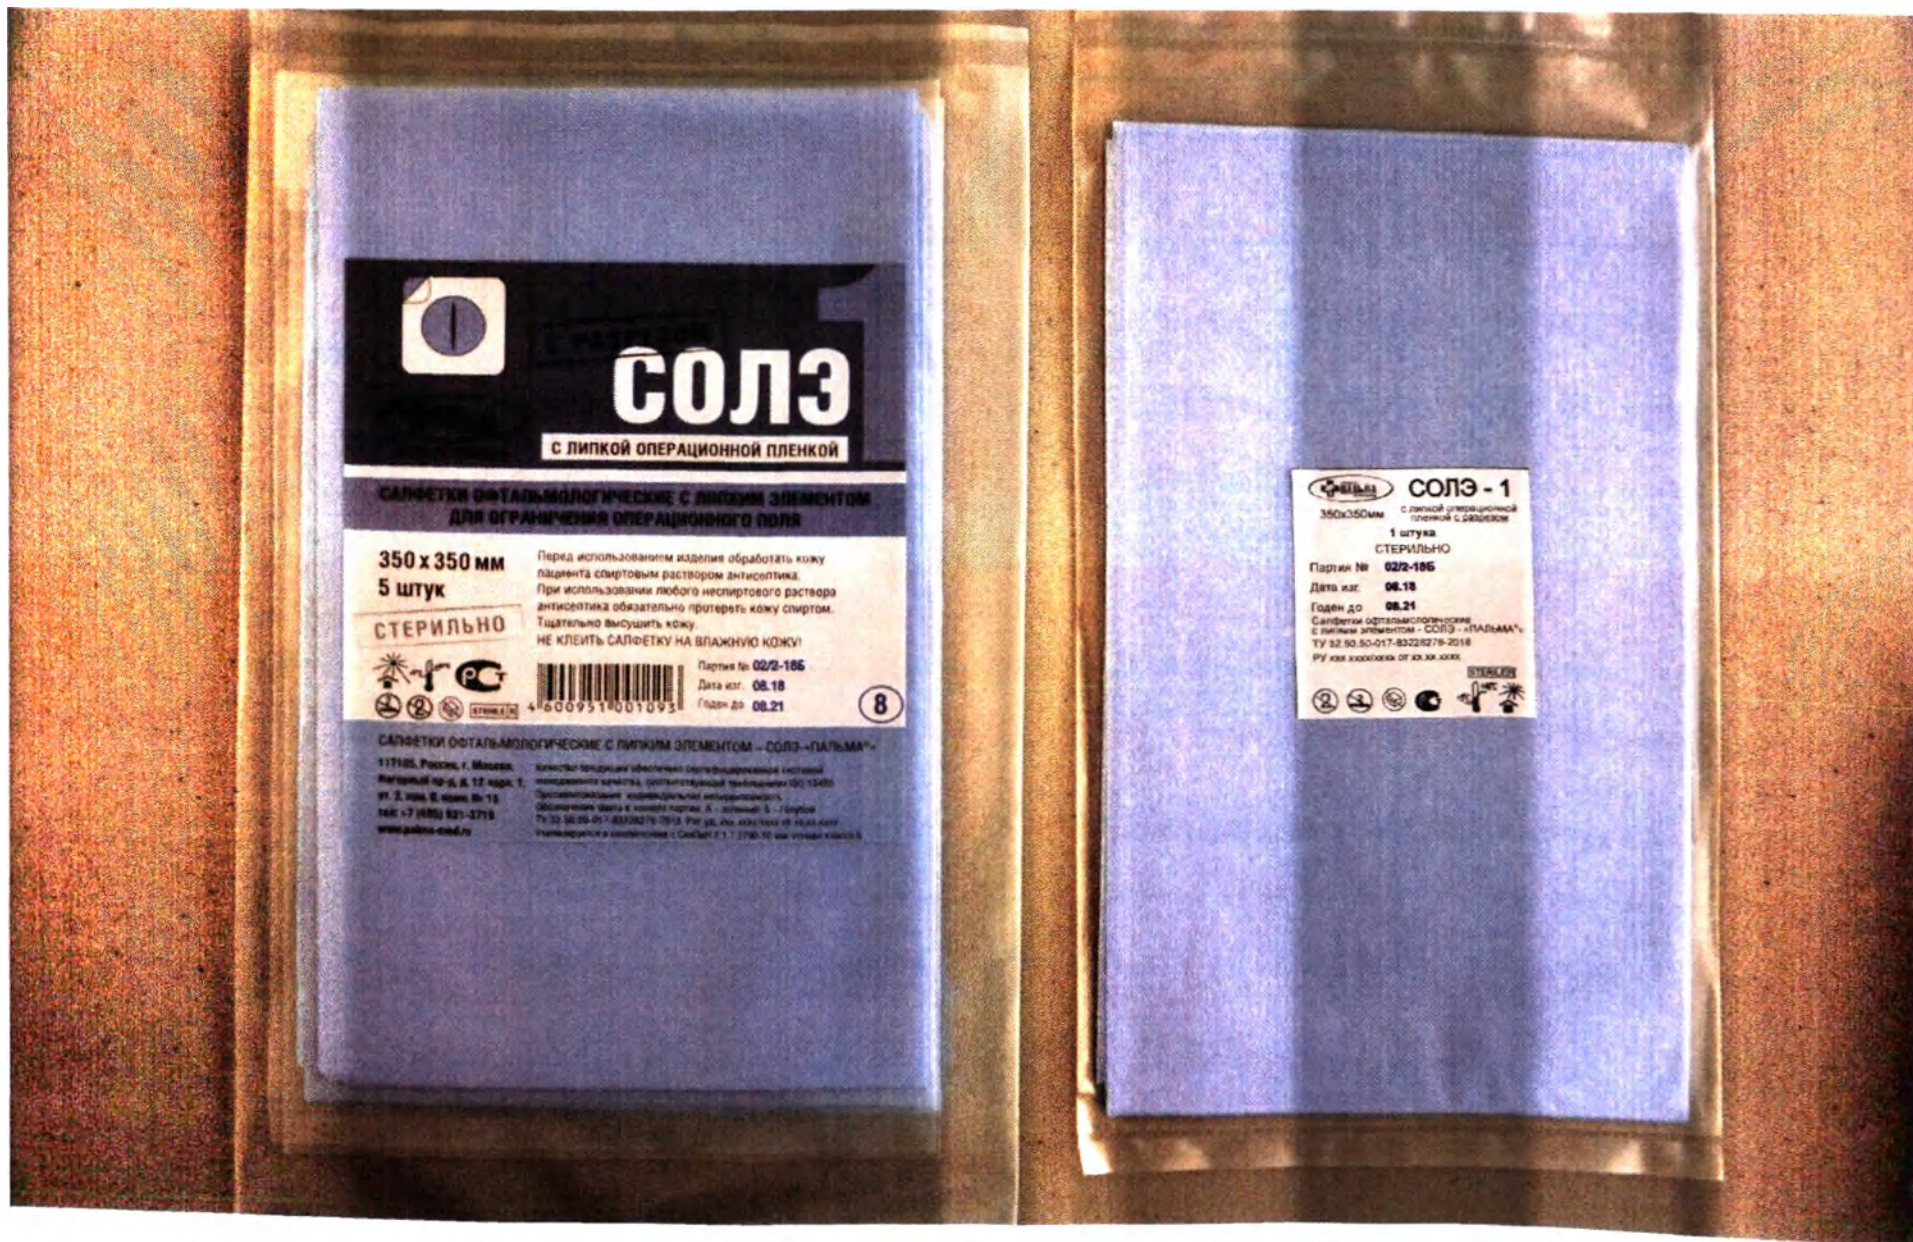

Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

8. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 650 x 650 мм:



Примечание: репер и штамп могут отсутствовать

9. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 650 x 900 мм:



Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

10. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 650 x 1200 мм:



Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

11. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА»® по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2, размер 650 х650 мм:




Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

12. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2, размер 650 x900 мм:




Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

13. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА»® по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2, размер 650 x1200 мм:

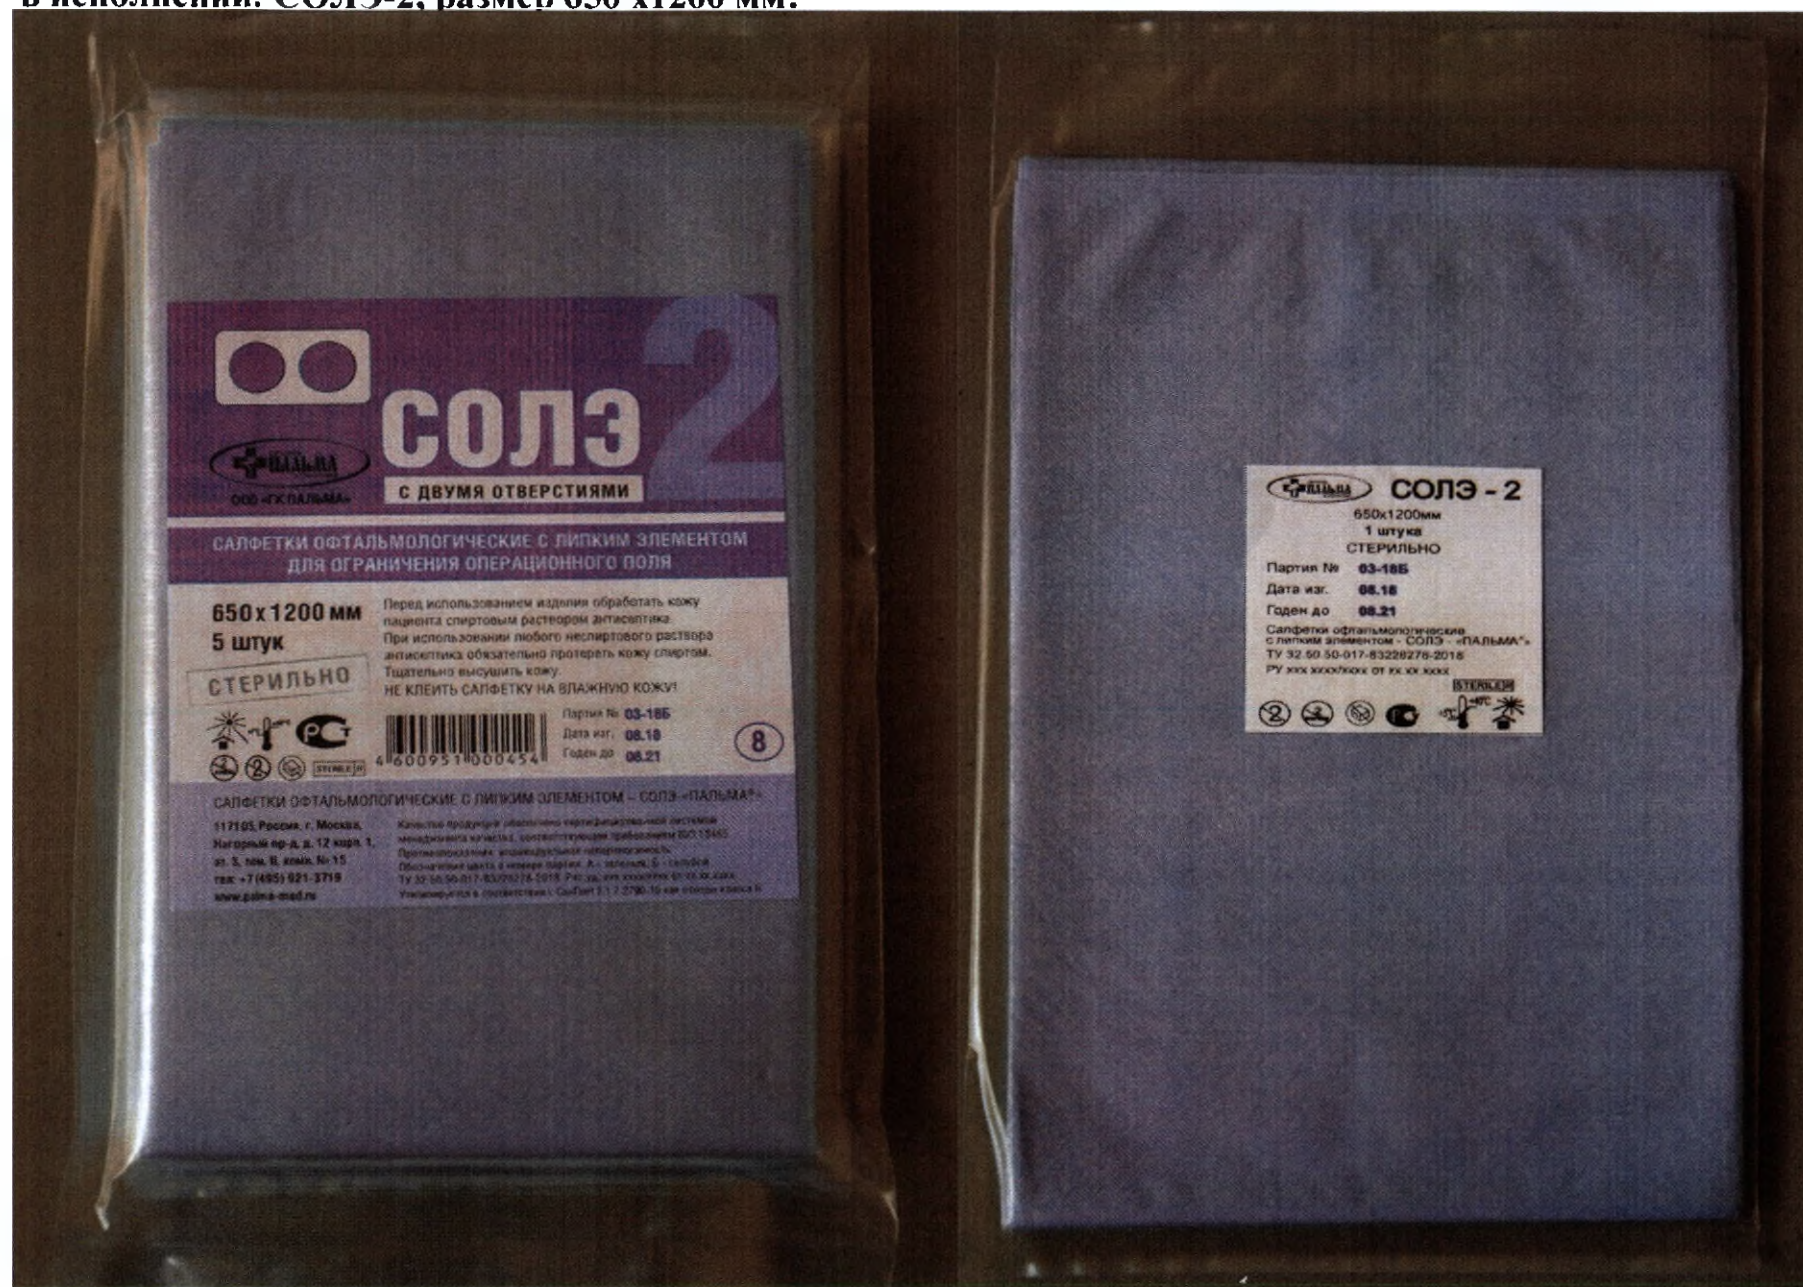

Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

14. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2 со «шторкой», размер 650 х650 мм:

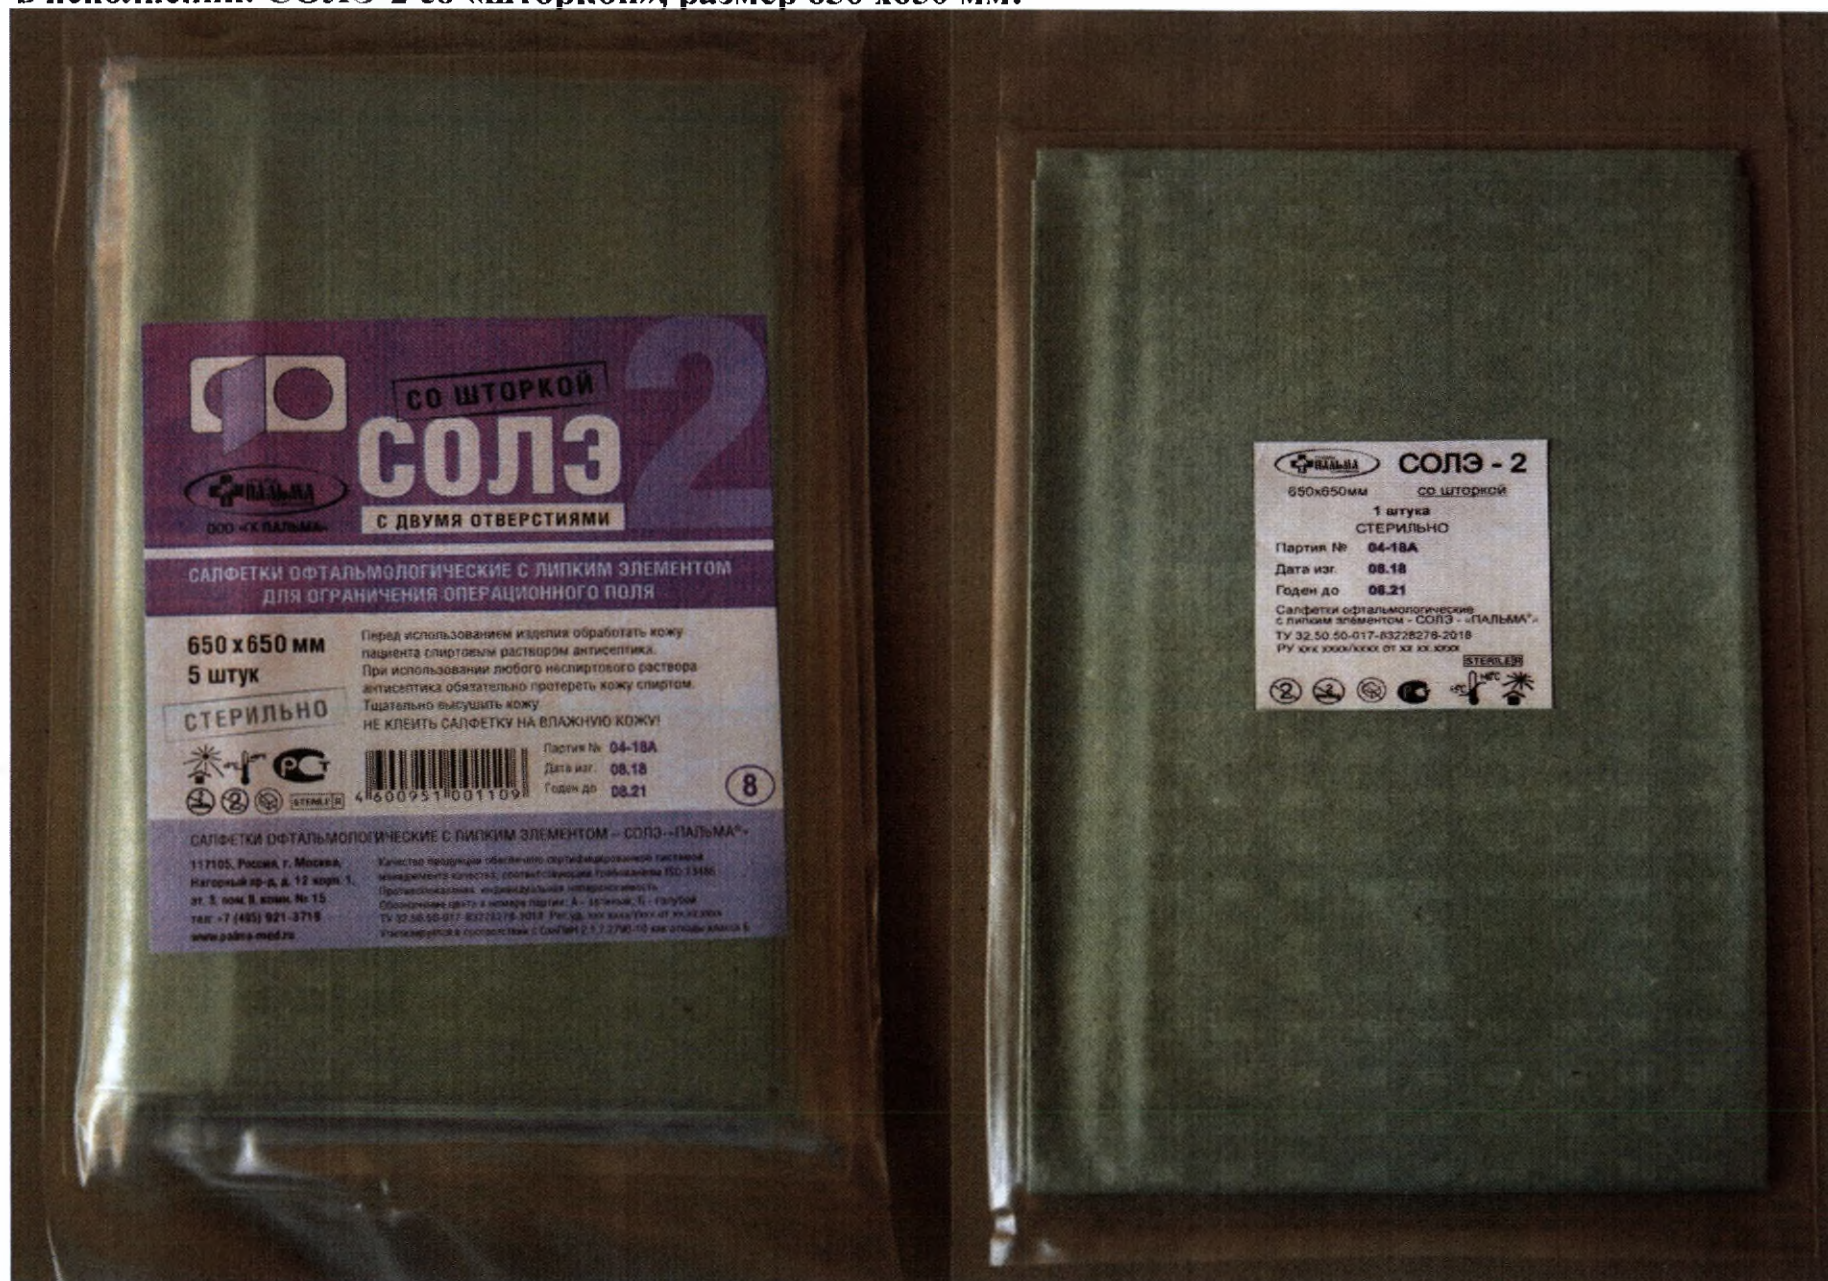

Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

15. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2 со «шторкой», размер 650 x900 мм:




16. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2 со «шторкой», размер 650 x1200 мм:



Примечание: раcцвет и цветопередача может отличаться от оригинала

17. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1, с карманом 200x250, размер 650 x650 мм:

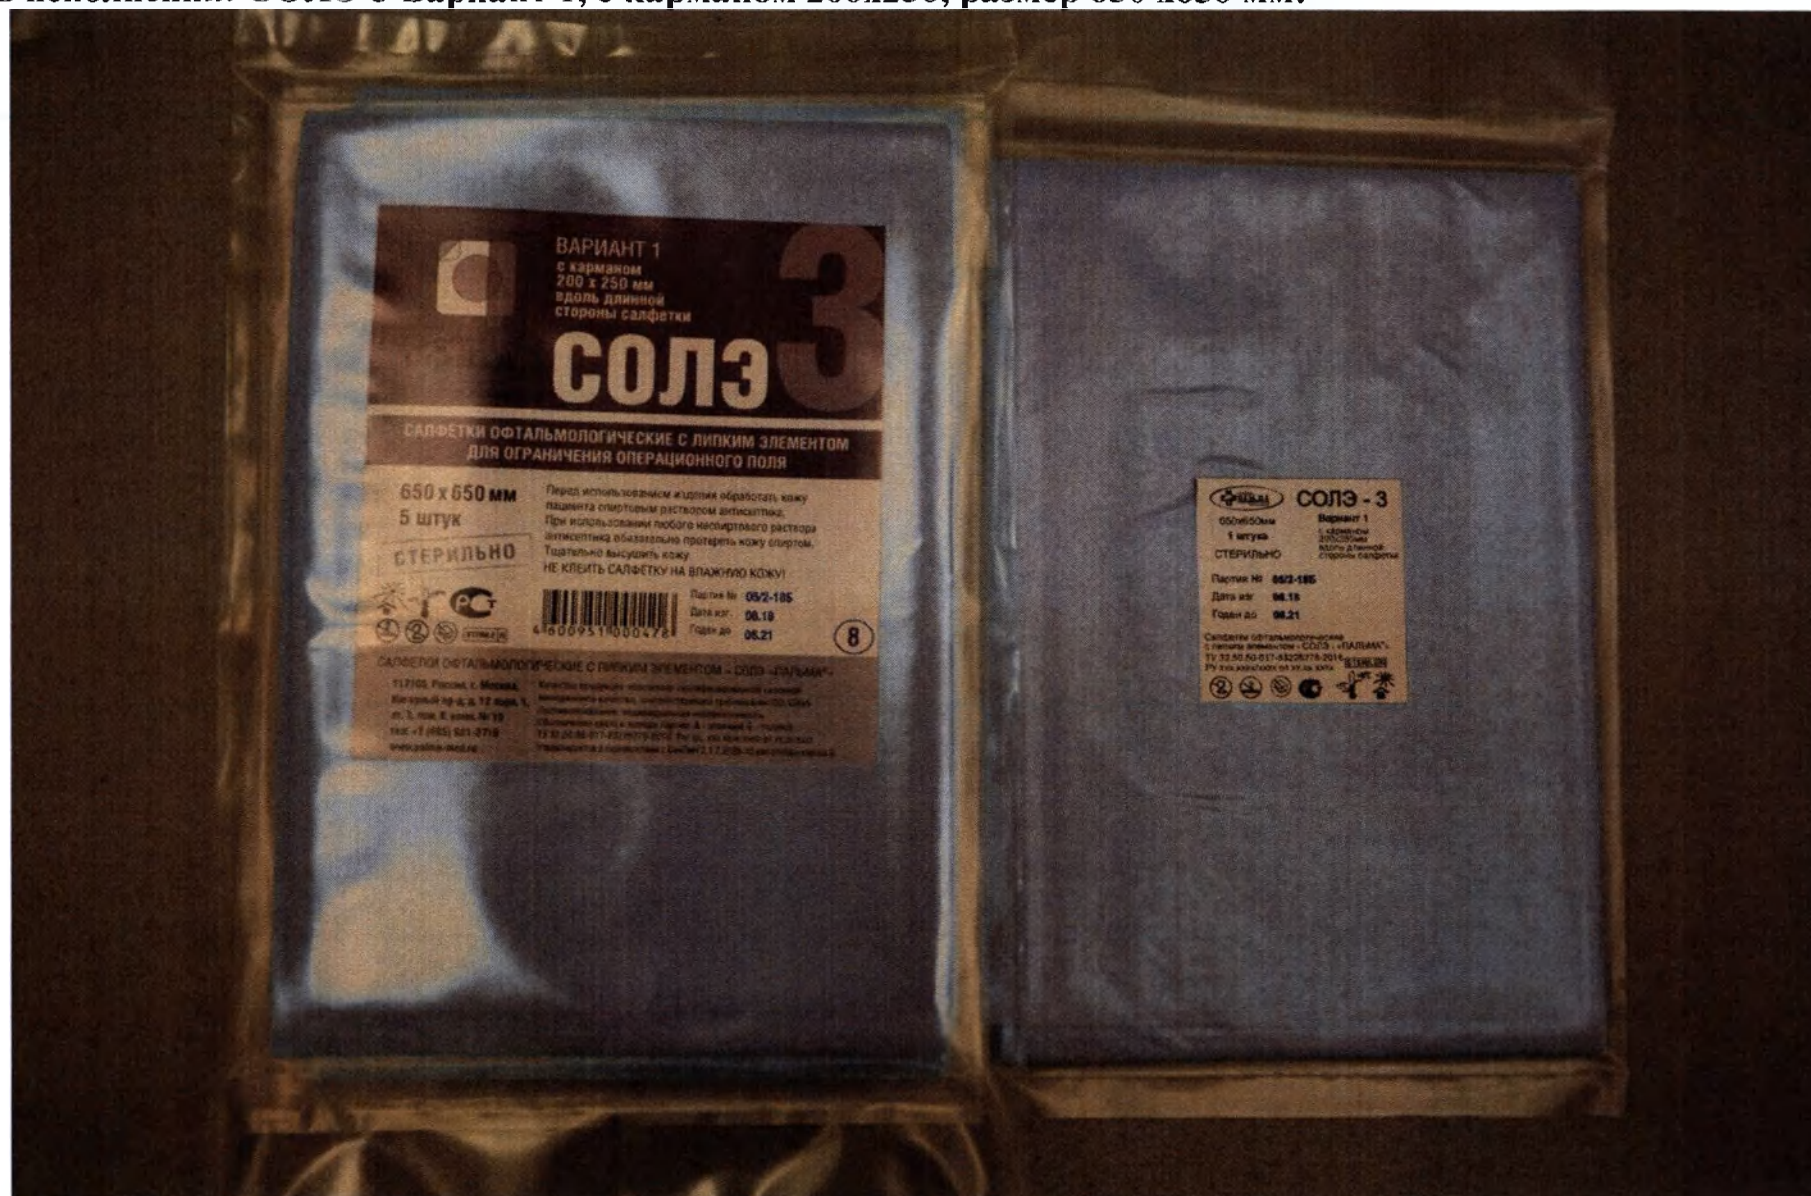


Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

18. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1, с карманом 200х250, размер 650 х900мм:




Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

19. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1, с карманом 200х250, размер 650 x1200 мм:

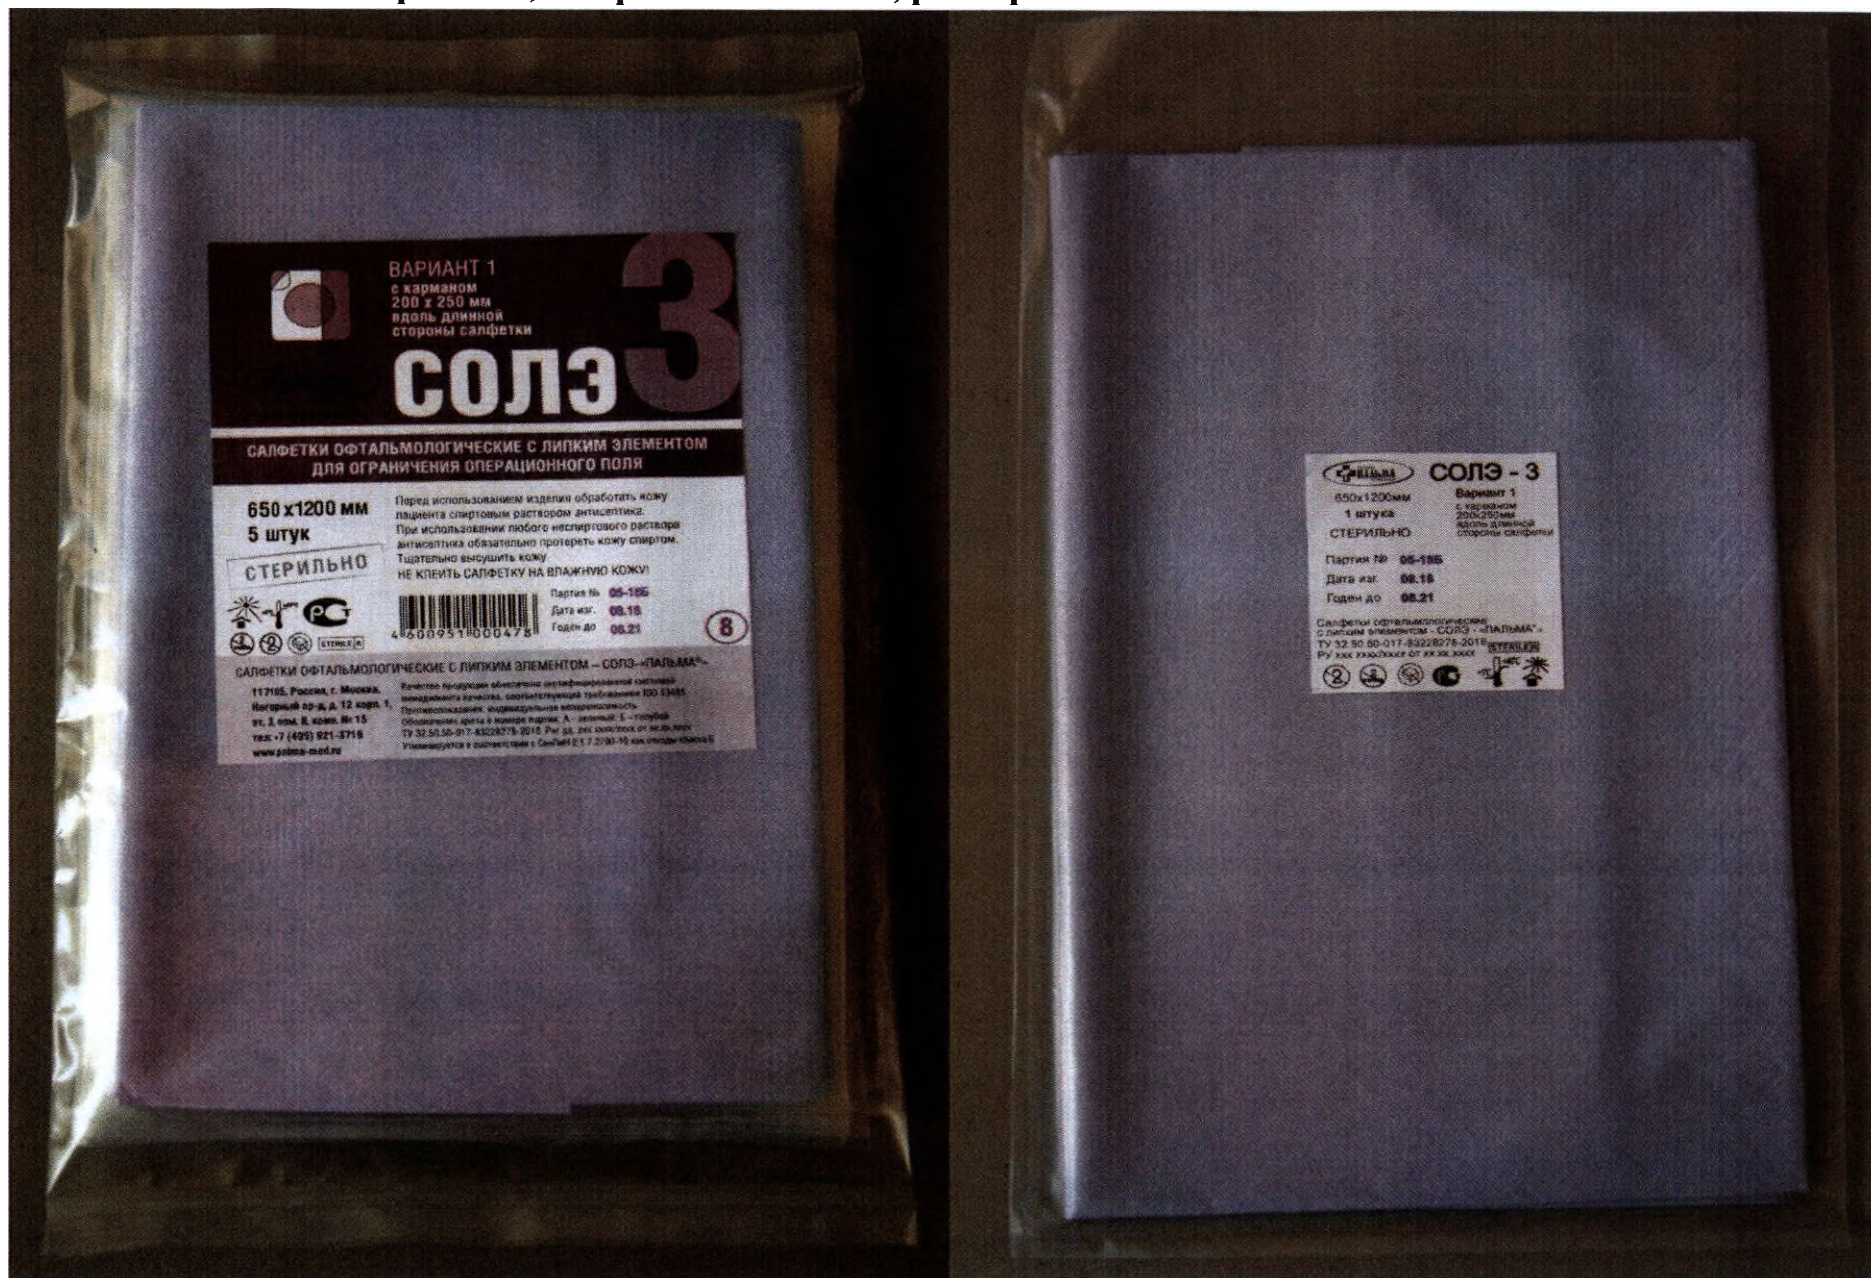

Примечание: ра и цветопередача может отличаться от оригинала

20. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1И, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

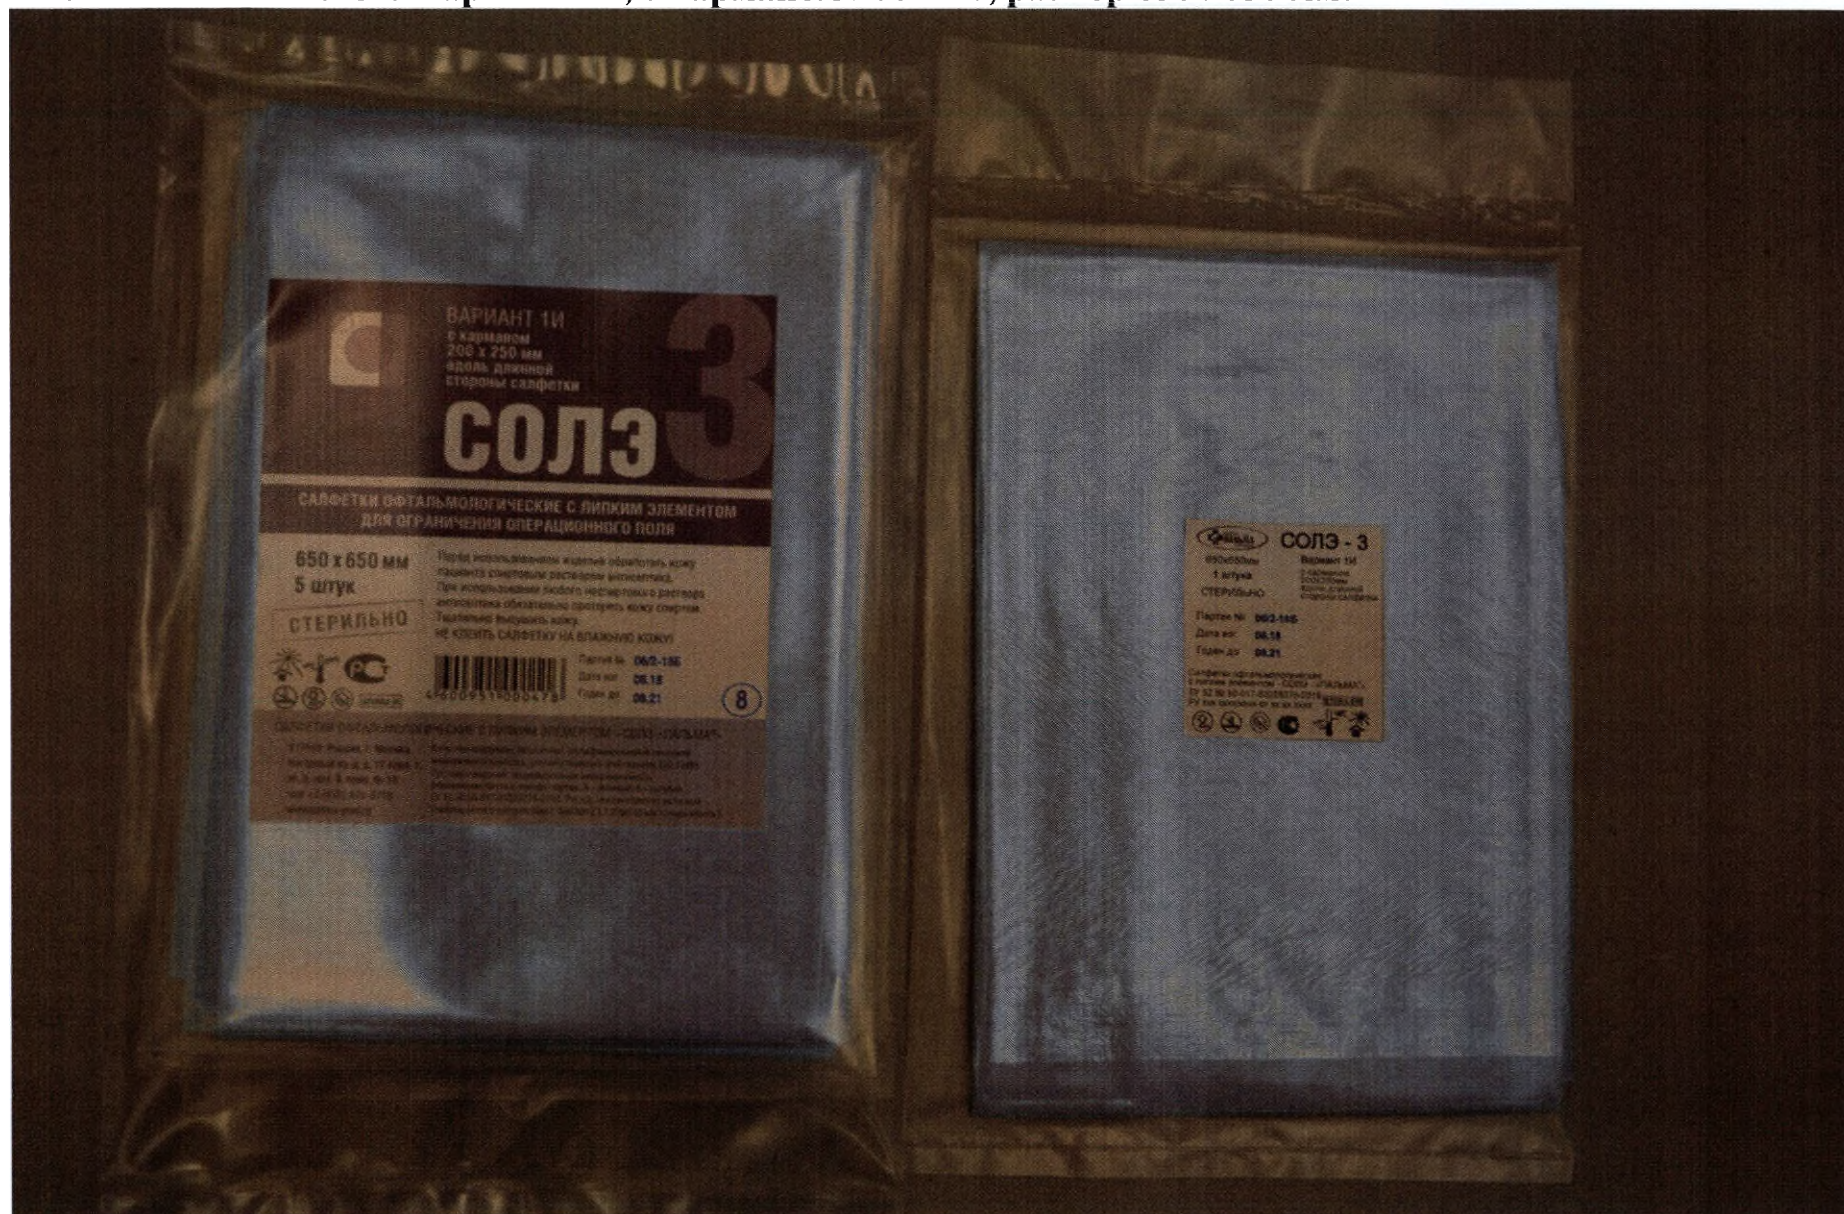


Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

21. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1И, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:



22. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА»® по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1И, с карманом 200x250 мм, размер 650 x1200 мм:

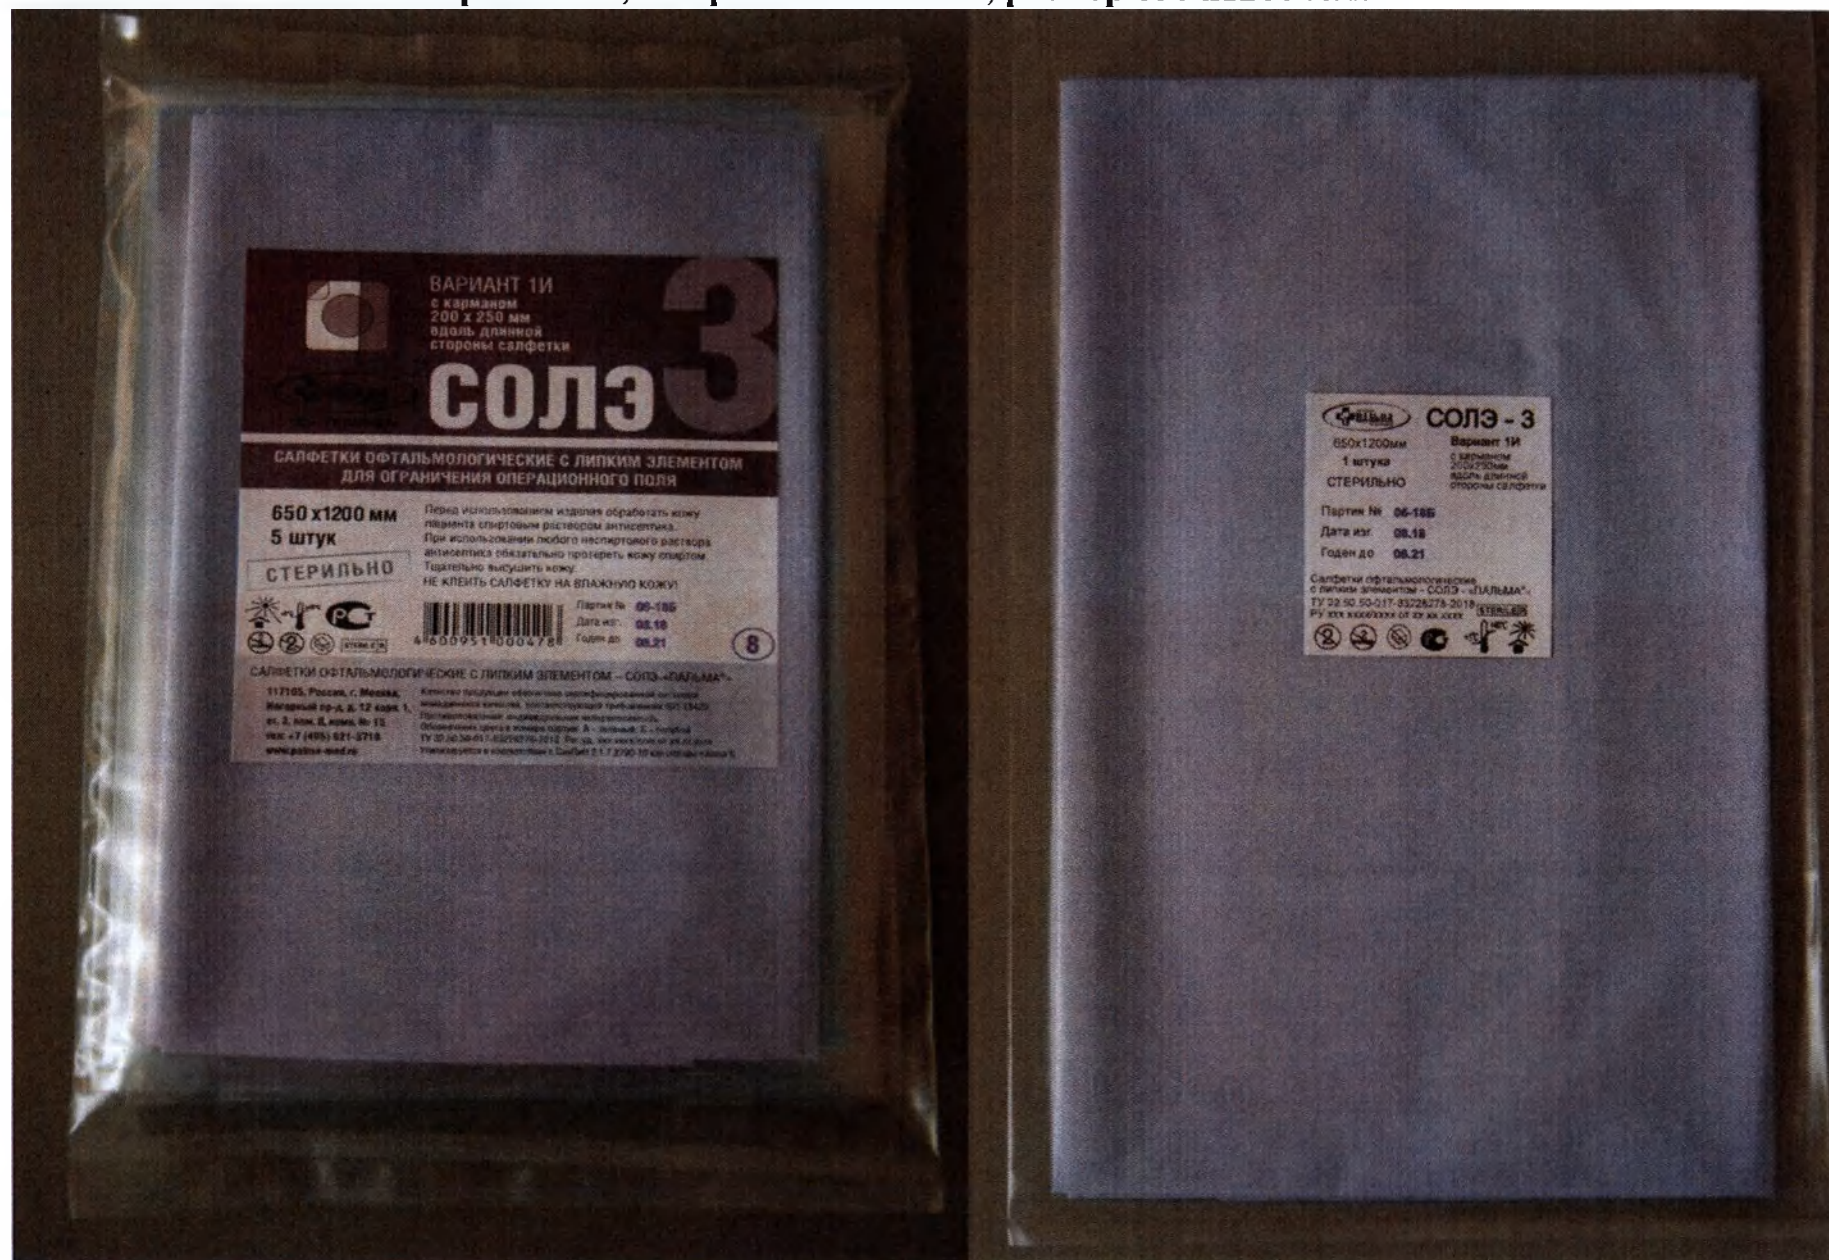

Примечание: рисунок и цветопередача может отличаться от оригинала

23. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

24. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

25. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:



Примечание: размер и цвет упаковки может отличаться от оригинала

26. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 300х350, размер 650 х650 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

27. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 300х350, размер 650 х900 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

28. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 300х350, размер 650 x1200 мм:



29. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

ВАРИАНТ 3И
с карманом
200 x 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 x 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделие обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого медицинского раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
Не класть салфетку на влажную кожу!

Партия №: 00/5-186
Дата из: 06.18
Годен до: 06.21

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-ИТАЛЬМА®
г.Тольятти, Россия, г. Москва
Иркутский пр. д. 12 этаж 5,
эт. 3, пом. 8, литер. №13
тел: +7 (495) 871-2718
www.dofin-med.ru

Упаковка-предостережение: использовать только для дезинфекции операционного поля, не использовать для дезинфекции кожи!
После использования упаковку необходимо утилизировать.
Информация о безопасности: не использовать для дезинфекции кожи!
После использования упаковку необходимо утилизировать.


СОЛЭ - 3
Вариант 3И
с карманом
200 x 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СТЕРИЛЬНО

Партия №: 00/5-186
Дата из: 06.18
Годен до: 06.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
с липким элементом – СОЛЭ-ИТАЛЬМА®
ТУ 32.50.50-017-8322678-2018
РУ ККА 00000000 00 КХ ХХ ХХ ХХ

31. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 200х250, размер 650 x1200 мм:

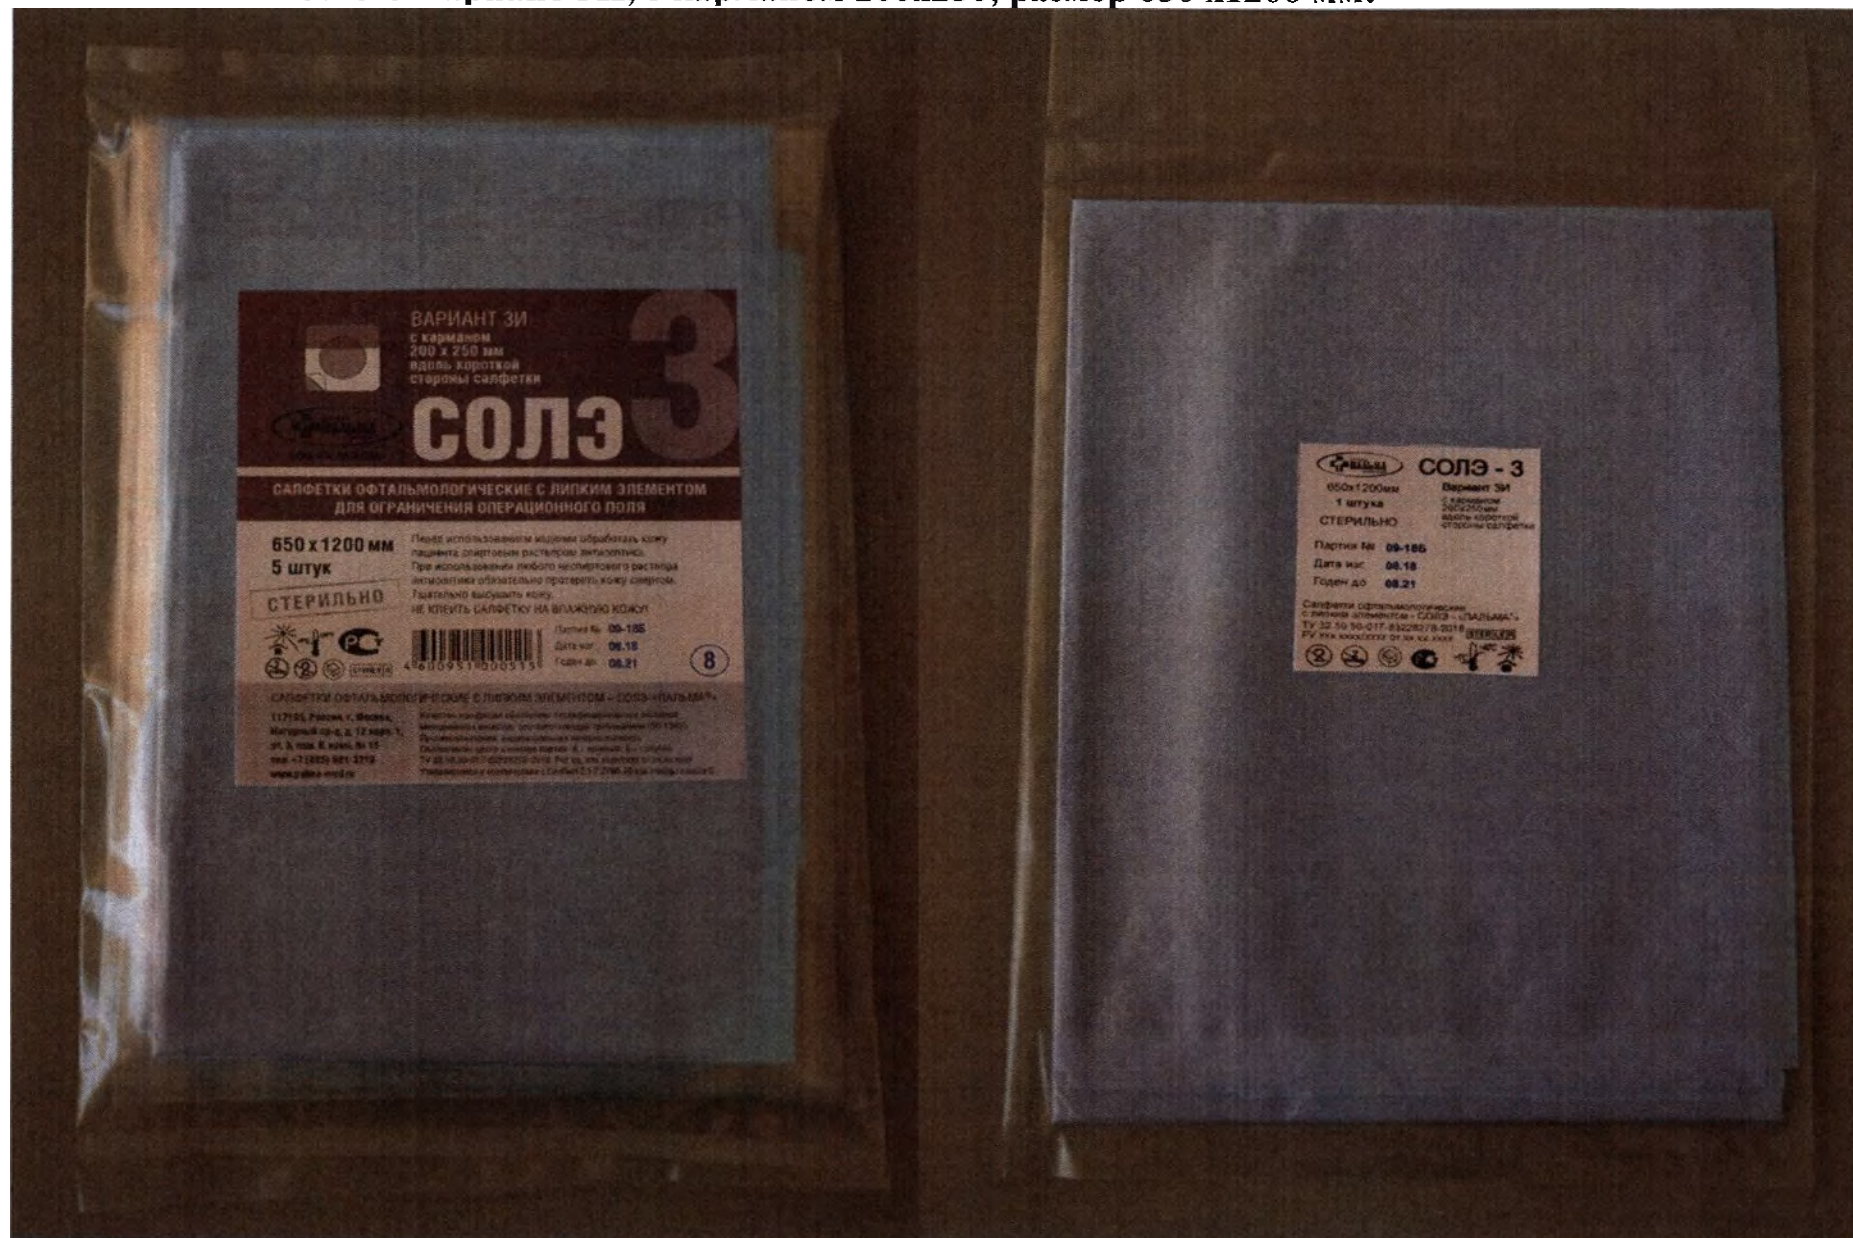

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

32. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 300х350, размер 650 х650 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

33. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 300х350, размер 650 х900 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

34. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 300х350, размер 650 х1200 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

35. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

10105
29.03.2019

36. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

10125
29.03.2019

37. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:



[illegible]

39. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5И, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

29.03.2019

40. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5И, с карманом 200х250, размер 650 x1200 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала


10125
29.03.2019

41. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-4, размер 650 х650 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

42. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА»® по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-4, размер 650 x900 мм:

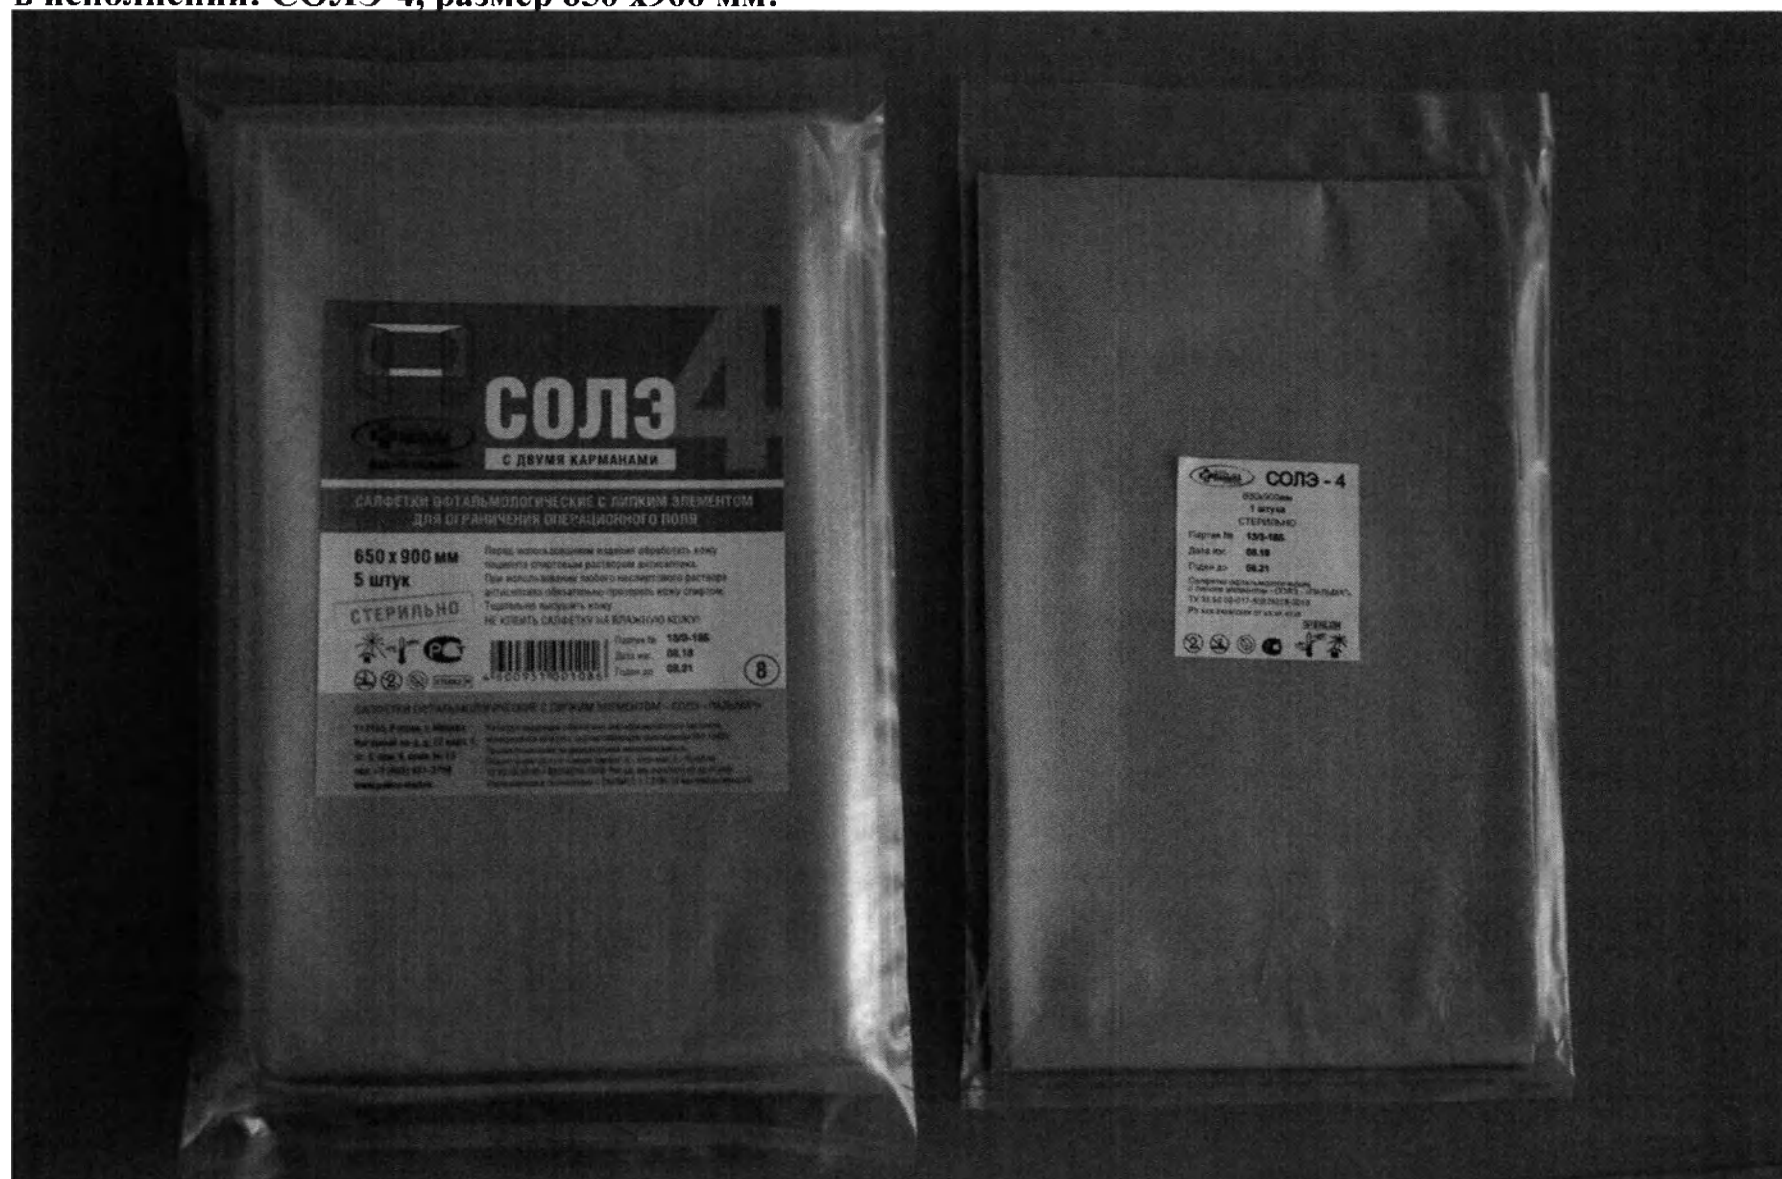

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

43. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-4, размер 650 x1200 мм:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

44. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-5, размер 45х90 мм:




Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 45

(срок пять) листов

Генеральный директор

ООО «ГК ПАЛЬМА»

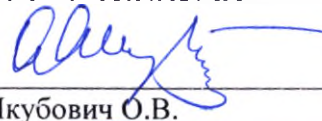

Якубович О.В.

«28» отв. 28 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»

 О.В. Якубович

«19» 12 2018 г



**Макет этикетки для групповой и индивидуальной упаковки
на медицинское изделие**

**«Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ-
«ПАЛЬМА®» по
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018»**

2018

**1. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018,
в исполнении: СОЛЭ-1, размер 150 х 150 мм:**


Макет этикетки групповой упаковки



**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

**150 х 150 мм
5 штук**

СТЕРИЛЬНО



Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!



Партия № **01/1-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**



САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел. +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. зох хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 1

150х150мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Партия № **01/1-18Б**

Дата изг. **08.18**

Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»

ТУ 32.50.50-017-83228278-2018

РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

STERILE



Примечание: размер макета может отличаться от оригинала

2. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 350 x 350 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



СОЛЭ 1

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

350 x 350 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО


Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 01/2-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел. +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой.
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. 2008.00000000 от 01.01.2008
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б.

Макет этикетки индивидуальной упаковки

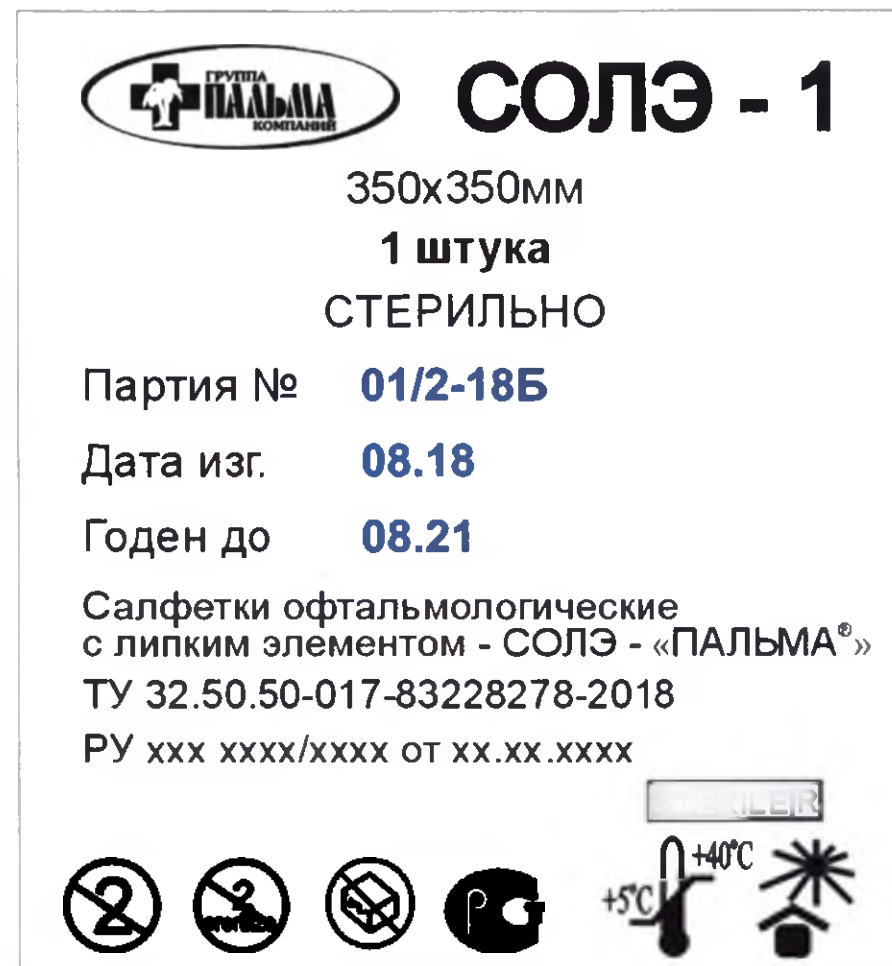

СОЛЭ - 1

350x350мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № 01/2-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

3. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 650 x 650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



СОЛЭ

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО


Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **01/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32 50 50-017-83228278-2018 Рег. уд. 000/0000 от 01.01.2018
Утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

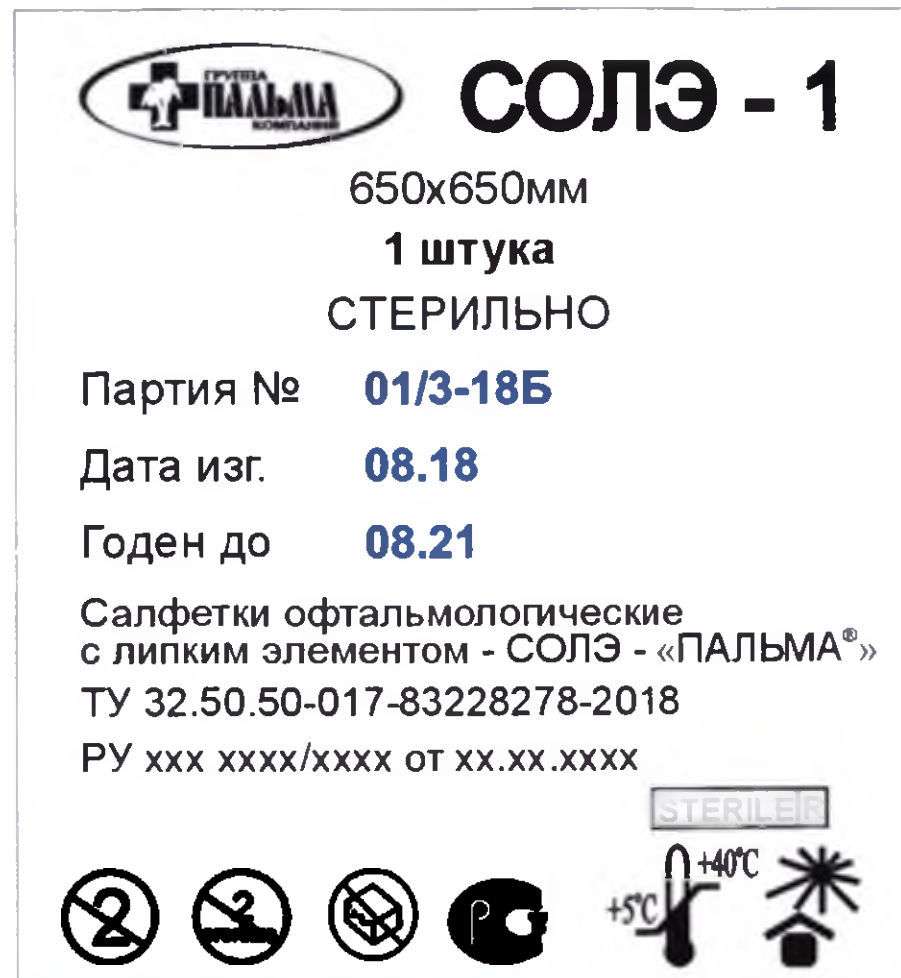

ПАЛЬМА

СОЛЭ - 1

650x650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **01/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

4. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 650 x 900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



СОЛЭ

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Партия № 01/4-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 1

650x900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № 01/4-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

СТЕРИЛЬНО

+5°C +40°C

Примечание: размер макета может отличаться от оригинала

5. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1, размер 650 x 1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО


Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **01-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

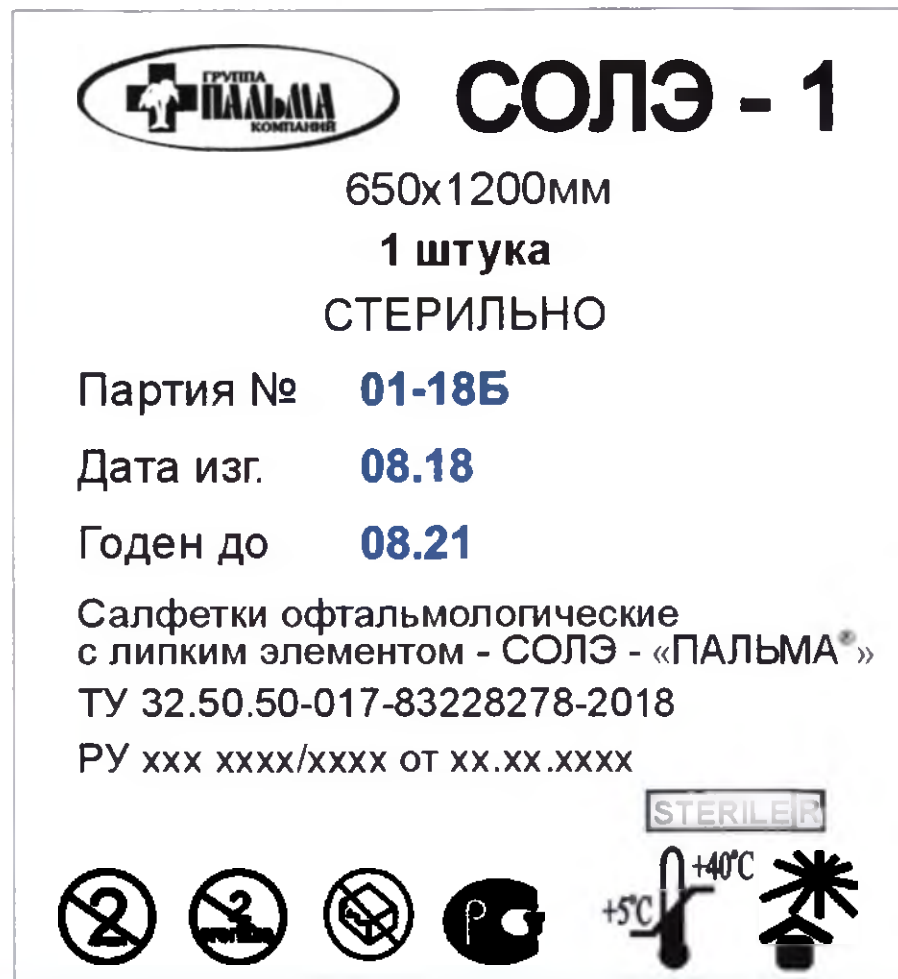

ПАЛЬМА КОМПАНИ **СОЛЭ - 1**

650x1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **01-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

6. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 150 x 150 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

СОЛЭ
С РАЗРЕЗОМ
С ЛИПКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ
ООО «ГК ПАЛЬМА»

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

150x150 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу. НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 02/1-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1, эт. 3 пом. II комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485. Противопоказаний индивидуальная непереносимость. Обозначение цвета в номере партии: А – зеленый, Б – голубой. ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx Унифицируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА
КОМПАНИ

СОЛЭ - 1
150x150мм с липкой операционной пленкой с разрезом
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № 02/1-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE
+5°C +40°C

7. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 350 x 350 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

350 x 350 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Негорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Партия № **02/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 001093

8

Макет этикетки индивидуальной упаковки

СОЛЭ - 1

350x350мм с липкой операционной пленкой с разрезом

1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **02/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

СТЕРИЛЬНО

8

8. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 650 x 650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ для ограничения операционного поля

650 x 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу. НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 02-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1, эт. 3, пом. II комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

СОЛЭ - 1
650x650мм с липкой операционной пленкой с разрезом


1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **02-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**


Салфетки офтальмологические с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

STORAGE: +5°C to +40°C

Макет этикетки групповой упаковки



СТЕРИЛЬНО



Партия № **02/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**



Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
 Противопоказания: индивидуальная непереносимость
 Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
 ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. дох. хххххххххх от дох. хх.хх.хх
 Утилизируется в соответствии с СанПиН 2 1 7 2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



с липкой операционной пленкой с разрезом

1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **02/3-18Б**

Дата изг. **08.18**

Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»

TY 32.50.50-017-83228278-2018

PY xxx xxxx/xxxx OT xx.xx.xxxx



10. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-1 с липкой операционной пленкой с разрезом, размер 650 x 1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО



Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!



Партия № 02/4-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21



САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва.
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел. +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 1

650x1200мм с липкой операционной пленкой с разрезом

1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № 02/4-18Б

Дата изг. 08.18

Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»

ТУ 32.50.50-017-83228278-2018

РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE




11. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



650 x 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО



Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!



Партия № 03/1-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21



САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 2

650x650мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Партия № 03/1-18Б

Дата изг. 08.18

Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx



12. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



650 x 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО



Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ



Партия № 03/2-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21



САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 2

650x900мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Партия № 03/2-18Б

Дата изг. 08.18

Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»

ТУ 32.50.50-017-83228278-2018

РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх



Макет этикетки групповой упаковки



СТЕРИЛЬНО



САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЗ-«ПАЛЬМА®»

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!



Партия № 03-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21



Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50-017-83.28278-2018 Рег.уд. 00х.х00х/00х.00х.х00х.х00х
Утверждается в соответствии с СанПиН 2.1.2.790-10 как объект класса Б



ГРУППА
ПАЛЬМА
КОМПАНИЙ

650x1200mm

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Партия № **03-18Б**

Дата изг. **08.18**

Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА»

TY 32.50.50-017-83228278-2018

PY xxx xxxx/xxxx OT xx.xx.xxxx

STERILE



14. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2 со «шторкой», размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



СО ШТОРКОЙ

СОЛЭ 2

С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ

ООО «ГК ПАЛЬМА»

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **04-18А**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 6009511001109

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



ПАЛЬМА (CORNEALAPR)

СОЛЭ - 2

650x650мм со шторкой

1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **04-18А**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

Макет этикетки групповой упаковки



Примечание: размер макета может отличаться от оригинала

16. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-2 со «шторкой», размер 650 x1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



СО ШТОРКОЙ

СОЛЭ 2

ГРУППА ПАЛЬМА КОМПАНИИ

ООО «ГК ПАЛЬМА»

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 04/2-18A
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизирована в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



ГРУППА ПАЛЬМА КОМПАНИИ

СОЛЭ - 2

650x1200мм СО ШТОРКОЙ

1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № 04/2-18A
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»

ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

STERILIZER

+5°C +40°C

17. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 1
с карманом
200 х 250 мм
вдоль длинной
стороны салфетки

СОЛЭ 3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу. НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **05/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный п-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег уд ююх юююх/юююх от хх.хх.юююх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

СОЛЭ - 3

Вариант 1
с карманом
200х250мм
вдоль длинной
стороны салфетки

650х650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **05/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от хх.хх.хххх

STERILE

+5°C +40°C

18. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1, с карманом 200х250, размер 650 х900мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 1
с карманом
200 х 250 мм
вдоль длинной
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ГРУППА **ПАЛЬМА**
КОМПАНИЙ
ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!


Партия № **05/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. 11, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

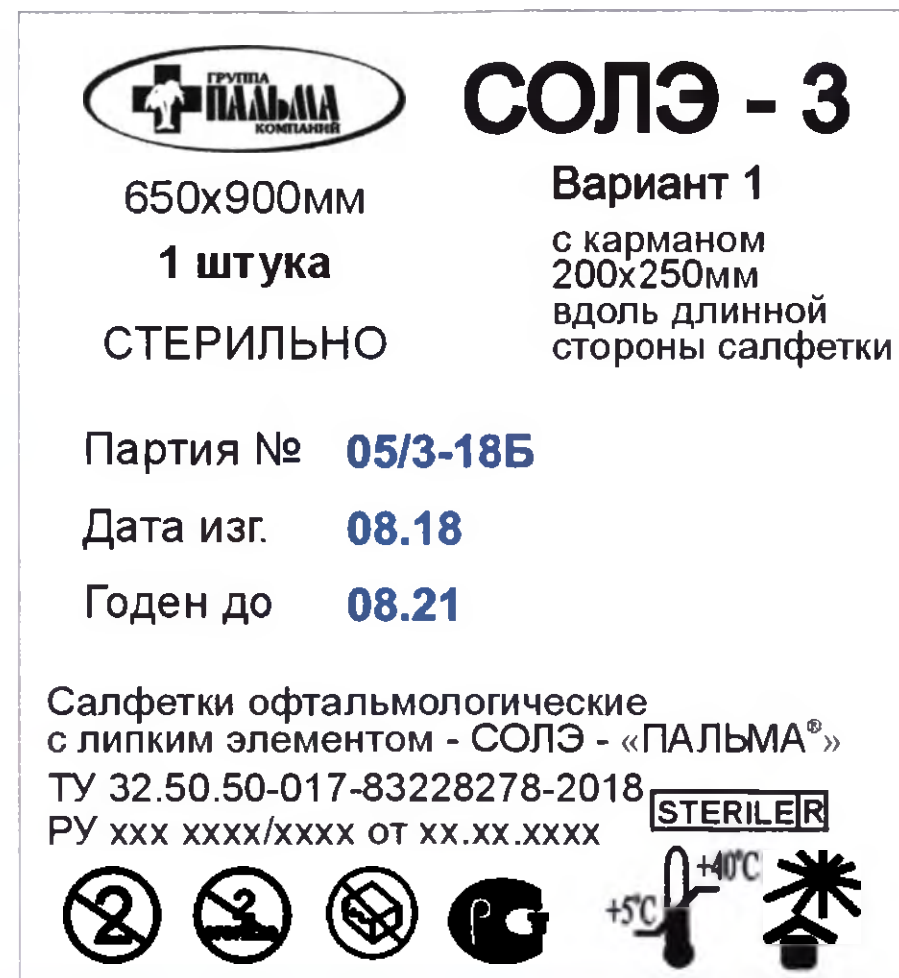

ГРУППА **ПАЛЬМА**
КОМПАНИЙ

СОЛЭ - 3

Вариант 1
с карманом
200х250мм
вдоль длинной
стороны салфетки

650х900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **05/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

19. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 1
с карманом
200 х 250 мм
вдоль длинной
стороны салфетки

СОЛЭ-3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Партия № 05-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Негорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначения цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рвг.уд. ххх хххх/хххх от хх хх хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА
КОМПАНЬИ

СОЛЭ - 3

650х1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Вариант 1
с карманом
200х250мм
вдоль длинной
стороны салфетки

Партия № 05-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

STERILE

+5°C +40°C

20. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1И, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 1И
с карманом
200 х 250 мм
вдоль длинной
стороны салфетки

СОЛЭ-3

ПАЛЬМА
КОМПАНИИ
ООО «ГК ПАЛЬМА»

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 06/2-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА
КОМПАНИИ

СОЛЭ - 3

650х650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Вариант 1И
с карманом
200х250мм
вдоль длинной
стороны салфетки

Партия № 06/2-185
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬНО

+5°C +40°C

21. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1И, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 1И
с карманом
200 х 250 мм
вдоль длинной
стороны салфетки

3

СОЛЭ

ООО «ГК ПАЛЬМА»

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 06/3-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3718
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018. Рег. уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

СОЛЭ - 3

650x900мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Вариант 1И
с карманом
200х250мм
вдоль длинной
стороны салфетки

Партия № 06/3-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

22. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 1И, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 1И
с карманом
200 х 250 мм
вдоль длинной
стороны салфетки

СОЛЭ 3

СЕРТИФИКАТ
ГРУППА
ПАЛЬМА
КОМПАНИИ
ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **08-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000478

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. В, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначения цвета в номере партии А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 1И
с карманом
200х250мм
вдоль длинной
стороны салфетки

650х1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **06-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬ

2 **2** **2** **PG** **+5°C** **+40°C**

23. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 3
с карманом
200 х 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 x 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **07/2-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.pelma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА КОМПАНИИ

СОЛЭ - 3

650x650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

с карманом
200х250мм
вдоль короткой
стороны салфетки

Партия № **07/2-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬ

+5°C +40°C

24. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3
с карманом
200 х 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
для ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **07/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (405) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. 100х 100х/100х от 11.01.2018
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3
с карманом
200х250мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **07/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
ПУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛИЗ

+40°C

+5°C

25. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 200x250, размер 650 x1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3
с карманом
200 x 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
для ограничения операционного поля**

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **07-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000515

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. юж.хорош.01.хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3
с карманом
200x250мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650x1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **07-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C **+40°C**

26. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 300х350, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3
с карманом
300 х 350 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № 08/2-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3
с карманом
300х350мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **08/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

5°C +40°C

27. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 300х350, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3
с карманом
300 х 350 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ-3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
для ограничения операционного поля**

650 х 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **08/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000515

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания, индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. 00х 000х/000х от 0х 0х 000х
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3
с карманом
300х350мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **08/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬНО

+5°C +40°C

28. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3, с карманом 300x350, размер 650 x1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3
с карманом
300 x 350 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **08-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. П, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания, индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А – зеленый; Б – голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3
с карманом
300x350мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650x1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **08-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
ПУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

2 **2** **2** **PG** **+5°C** **+40°C**

29. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3И
с карманом
200 х 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **09/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва.
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

650х650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Вариант 3И
с карманом
200х250мм
вдоль короткой
стороны салфетки

Партия № **09/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

СТЕРИЛЬН

+5°C +40°C

30. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3И
с карманом
200 х 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ГРУППА **ПАЛЬМА**
КОМПЛАЙН
ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **09/3-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000515

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50 50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7 2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



ГРУППА **ПАЛЬМА
КОМПЛАЙН**

СОЛЭ - 3

Вариант 3И
с карманом
200х250мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **09/3-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

**Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»**
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
ПУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬН

2 **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

31. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3И
с карманом
200 х 250 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **09-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000515

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А – зеленый; Б – голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. зссх юсх/юсхх от юх.юх.юсхх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



ПАЛЬМА
КОНТАКТ

СОЛЭ - 3

650x1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Вариант 3И
с карманом
200х250мм
вдоль короткой
стороны салфетки

Партия № **09-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

32. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 300х350, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3И
с карманом
300 х 350 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ГРУППА **ПАЛЬМА**
КОМПАНИИ
ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **10/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000515

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3710
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



ГРУППА **ПАЛЬМА**
КОМПАНИИ

СОЛЭ - 3

Вариант 3И
с карманом
300х350мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **10/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

33. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 300х350, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3И
с карманом
300 х 350 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
для ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **10/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 000515

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А – зеленый; Б – голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7 2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3И
с карманом
300х350мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **10/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

СТЕРИЛЬ

+5°C +40°C

34. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 3И, с карманом 300х350, размер 650 х1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 3И
с карманом
300 х 350 мм
вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ-3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **10-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

6009511000515

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xxxx.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 3И
с карманом
300х350мм
вдоль короткой
стороны салфетки

650х1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **10-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬ

2 **3** **4** **PG** **+5°C** **+40°C**

35. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 5
с карманом 200 х 250 мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

3

СОЛЭ

ООО «П.А.Л.Ь.М.А.»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия №: **11/2-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 001338

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА
КОМПАНЬИ

СОЛЭ - 3

Вариант 5

650х650мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

с карманом 200х250мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

Партия № **11/2-185**

Дата изг. **08.18**

Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

36. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 5
с карманом 200 х 250 мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

ПАЛЬМА
КОМПАНИ
ООО «ГК ПАЛЬМА»

СОЛЭ 3

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 x 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **11/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый, Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. зох зохх/зохх от зх,зх зххх
Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА
КОМПАНИ

СОЛЭ - 3
Вариант 5

650x900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

с карманом 200х250мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

Партия № **11/3-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE R

+5°C +40°C

37. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 5
с карманом 200 х 250 мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **11-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»-
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. 000 хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

СОЛЭ - 3
Вариант 5
650х1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО
с карманом 200х250мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

Партия № **11-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
ПУ xxx хххх/хххх от хх.хх.хххх

STERILE

+5°C +40°C

38. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5И, с карманом 200х250, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 5И
с карманом 200 х 250 мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 х 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО


Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **12/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические с липким элементом – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»
117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 821-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

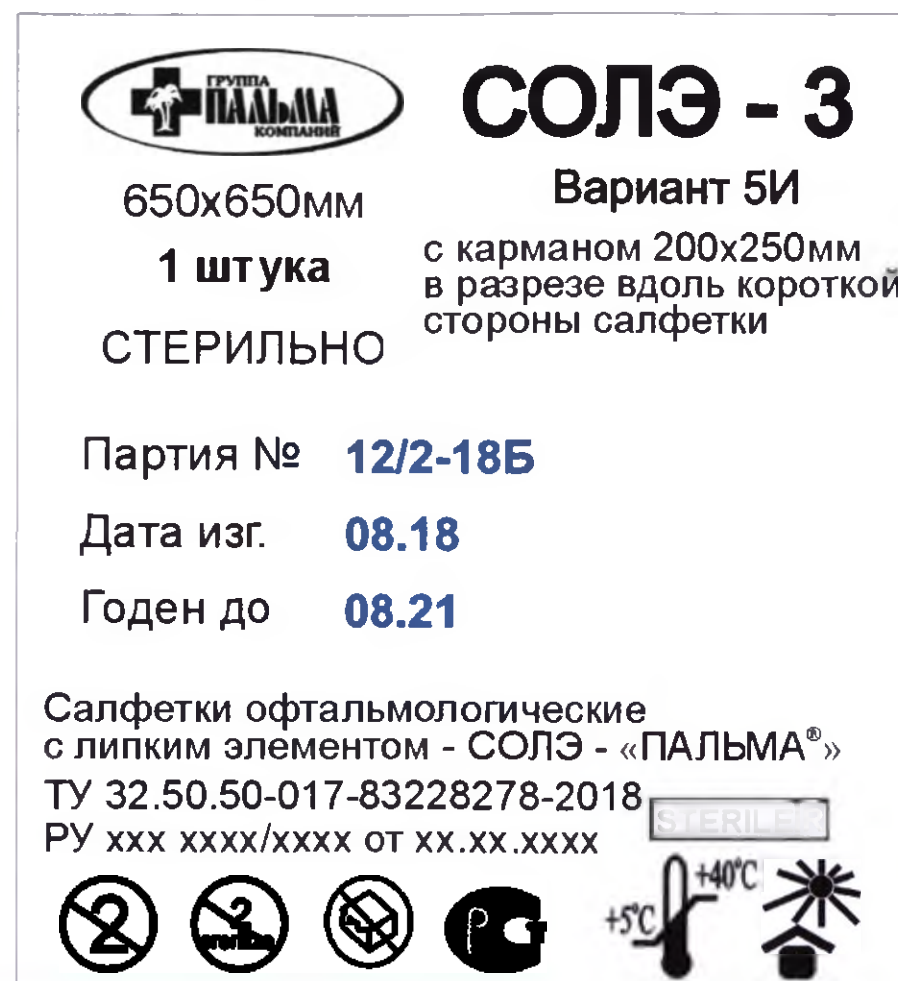

СОЛЭ - 3
Вариант 5И
с карманом 200х250мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

650х650мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **12/2-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

СТЕРИЛЬНО

+5°C +40°C

39. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5И, с карманом 200х250, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



ВАРИАНТ 5И
с карманом 200 х 250 мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

СОЛЭ 3

ООО «ГК ПАЛЬМА»

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
для ограничения операционного поля**

650 х 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!




Партия № **12/3-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®».

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 821-3718
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии. А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх
Утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 3

Вариант 5И
с карманом 200х250мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

650х900мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Партия № **12/3-185**

Дата изг. **08.18**

Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх



+5°C

+40°C



40. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-3 Вариант 5И, с карманом 200х250, размер 650 х1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

ВАРИАНТ 5И
с карманом 200 х 250 мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

ПАЛЬМА
КОМПАНИ

ООО «ГК ПАЛЬМА»

СОЛЭ 3

**САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу
пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора
антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!

Партия № **12-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. III, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palme-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. 000 0000000 от 00.00.0000
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

ПАЛЬМА
КОМПАНИ

СОЛЭ - 3
Вариант 5И
с карманом 200х250мм
в разрезе вдоль короткой
стороны салфетки

650x1200мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **12-185**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
ПУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

STERILE

+5°C +40°C

41. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-4, размер 650 х650 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



650 x 650 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО



Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу. НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!



Партия № 13/2-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр.-д. д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. В, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А – зеленый; Б – голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. 00х 000х/000х от 0х 0х/00хх
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



42. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-4, размер 650 х900 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



СОЛЭ 4
С ДВУМЯ КАРМАНАМИ

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

650 x 900 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО

Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика. При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом. Тщательно высушить кожу. НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!


Партия № 13/3-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®»

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 3, пом. II, комн. № 15
тел: +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. ххх хххххххх от хх хххххх
Упаковывается в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки

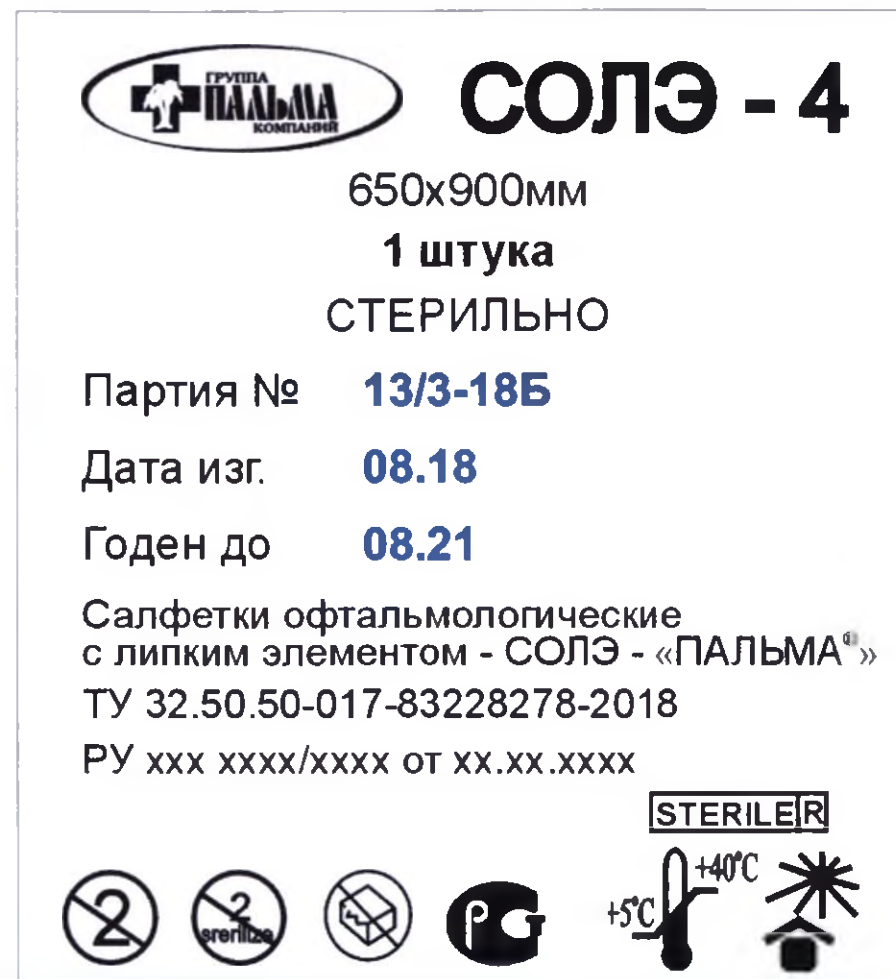

СОЛЭ - 4
650x900мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № 13/3-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ ххх хххх/хххх от хх.хх.хххх

STERILE

43. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-4, размер 650 x1200 мм:

Макет этикетки групповой упаковки



650 x 1200 мм
5 штук

СТЕРИЛЬНО



Перед использованием изделия обработать кожу пациента спиртовым раствором антисептика.
При использовании любого неспиртового раствора антисептика обязательно протереть кожу спиртом.
Тщательно высушить кожу.
НЕ КЛЕИТЬ САЛФЕТКУ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!



Партия № 13-18Б
Дата изг. 08.18
Годен до 08.21

8

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ-«ПАЛЬМА®».

117105, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д, д. 12 корп. 1,
эт. 2, пом. II, комн. № 15
телс +7 (495) 921-3719
www.palma-med.ru

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег.уд. 000.000.0000 от 01.01.2018
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Макет этикетки индивидуальной упаковки



СОЛЭ - 4

650x1200мм

1 штука

СТЕРИЛЬНО

Партия № 13-18Б

Дата изг. 08.18

Годен до 08.21

Салфетки офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018

РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx



44. Салфетки офтальмологические с липким элементом- СОЛЭ- «ПАЛЬМА®» по ТУ 32.50.50-017-83228278-2018, в исполнении: СОЛЭ-5, размер 45х90 мм:

Макет этикетки групповой упаковки

СОЛЭ 5

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВЕК И РЕСНИЦ

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

ООО «ГК ПАЛЬМА»

45 x 90 мм
20 штук (5 упаковок)

СТЕРИЛЬНО

Партия № **14-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

4 600951 001086

САЛФЕТКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ С ЛИПКИМ ЭЛЕМЕНТОМ – СОЛЭ – «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018 Рег. уд. xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx
117106, Россия, г. Москва, Нагорный пр.-д, д. 12, корп. 1, эт. 3, пом. II, комн. № 15
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Обозначение цвета в номере партии: А - зеленый; Б - голубой
Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Качество продукции обеспечено
сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485

Макет этикетки индивидуальной упаковки

СОЛЭ - 5

45x90мм
1 штука
СТЕРИЛЬНО

Партия № **14-18Б**
Дата изг. **08.18**
Годен до **08.21**

САЛФЕТКИ офтальмологические
с липким элементом - СОЛЭ - «ПАЛЬМА®»
ТУ 32.50.50-017-83228278-2018
РУ xxx xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx


STERILE

+5°C +40°C

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 45

(срок 1276) листов

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»

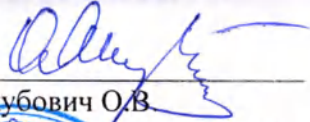
Якубович О.В.

2019 г.

