

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-
WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro.
Лот № 006, лот № 009.**

NEW IFU REVISION

ENZY-WELL

SARS-CoV-2 IgG

MT PLATE	1 x 96
CONJ	1 x 16 mL
CONTROL -	1 x 0.8 mL
CONTROL CUT-OFF	1 x 0.8 mL
CONTROL +	1 x 0.8 mL
SAMP DEL 2	1 x 100 mL
WASH BUF 10x	1 x 100 mL
H ₂ SO ₄ 0.3M	1 x 16 mL
SUBS TMB	1 x 12 mL

REF 91400

IVD

96

A4150



2°C 8°C



DIESSE



DIESSE Diagnostica Senese SpA
Via delle Rasse, 10 - 53035 Monteriggioni (SI) - ITALY
Tel. + 39 0577 319600/61 - Fax +39 0577 318763

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro.

ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG

IVD



8 033891 324155



(10)006(17)210430

BIESSE

Monteriggioni - Italy

REF 91400

LOT 006

H4150

2020-04

2021-04

2°C - 8°C

CE


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Маркировка набора. Лот 006.



Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-Cov-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 006.




Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.

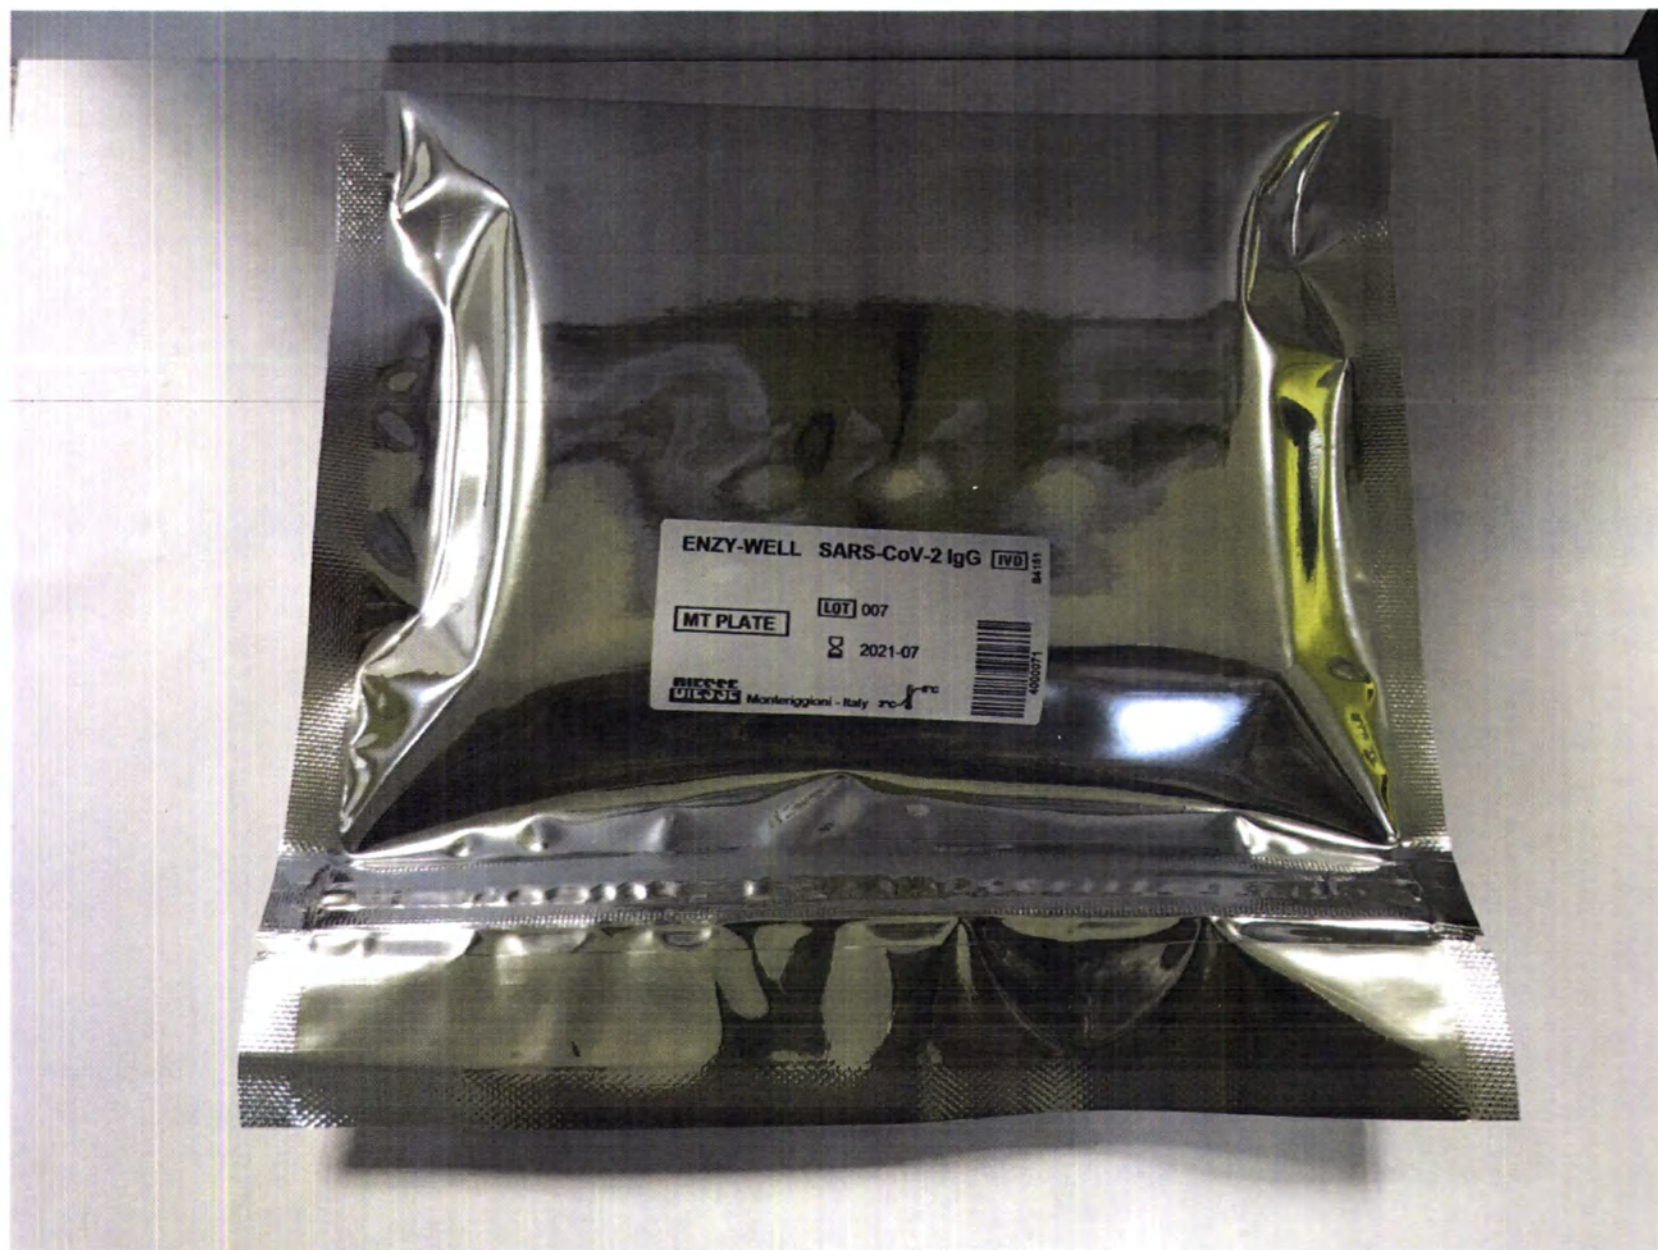


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Микропланшет. Лот 006.



Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.
Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.

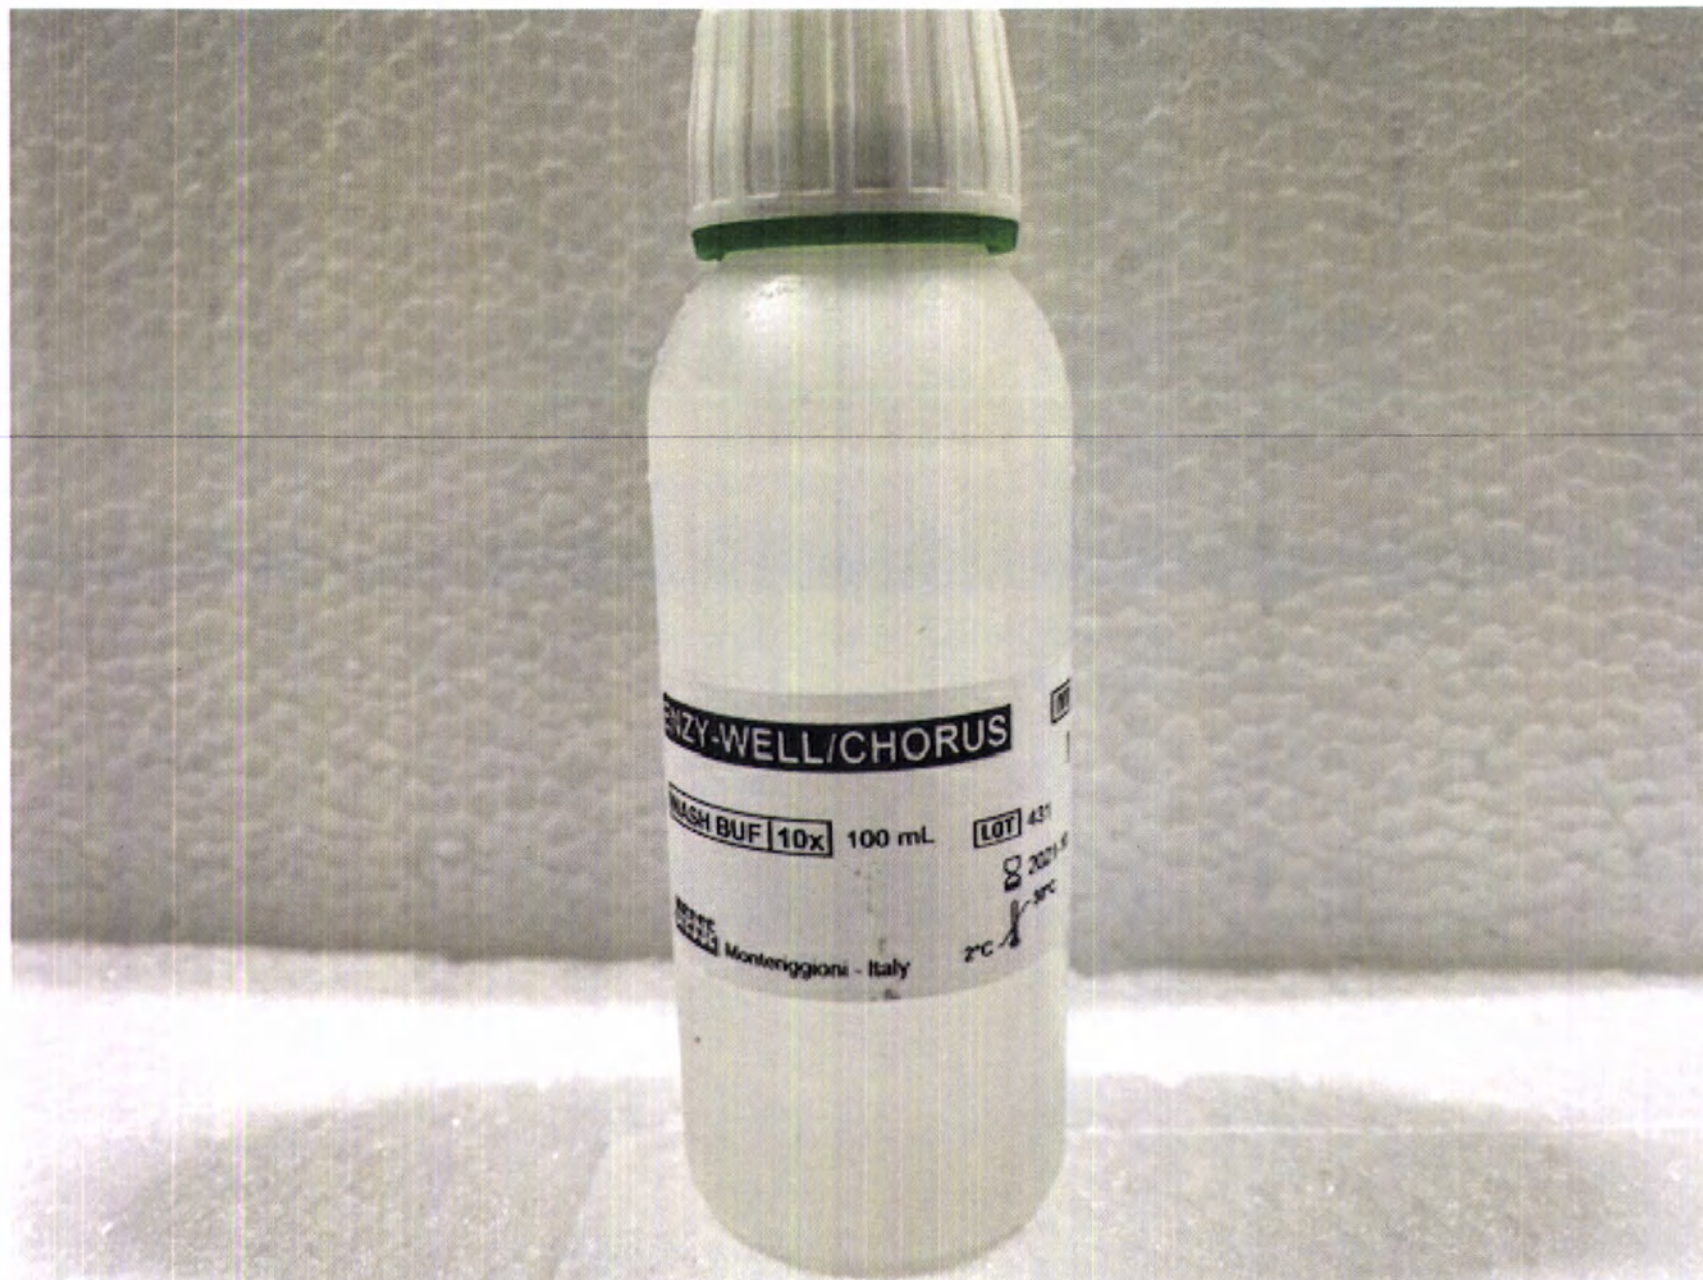

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.
Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.

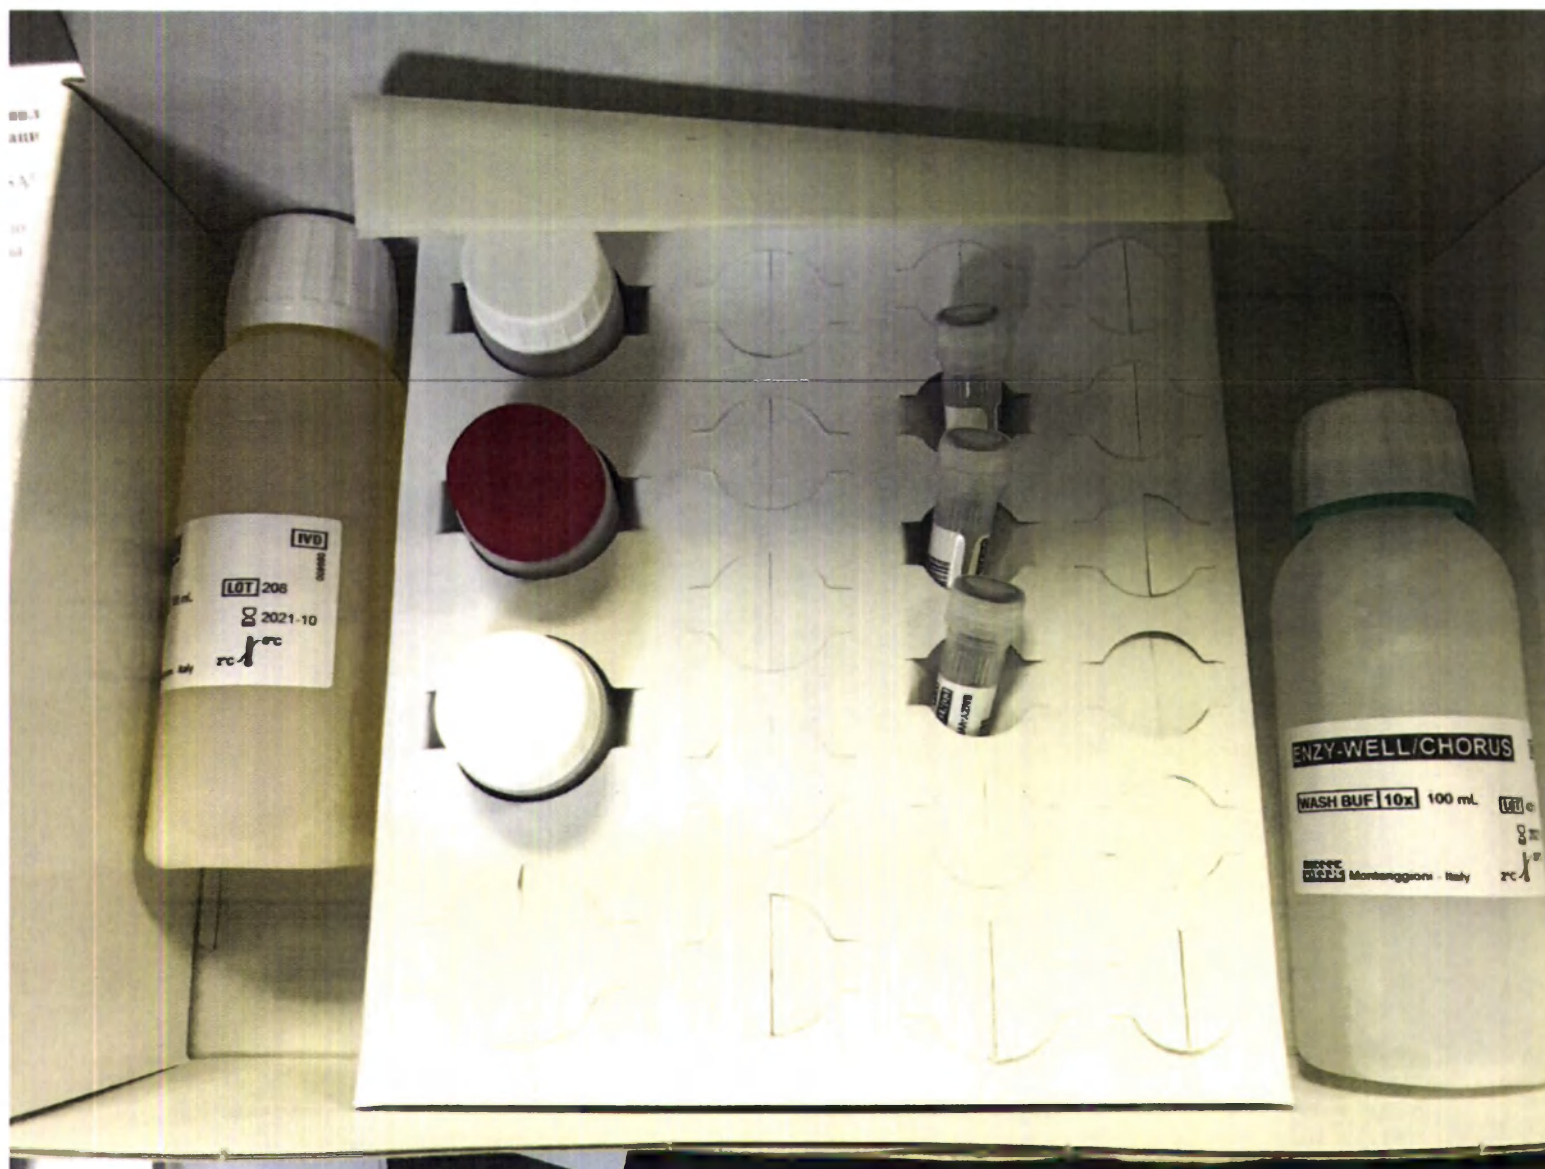

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 006.




Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.

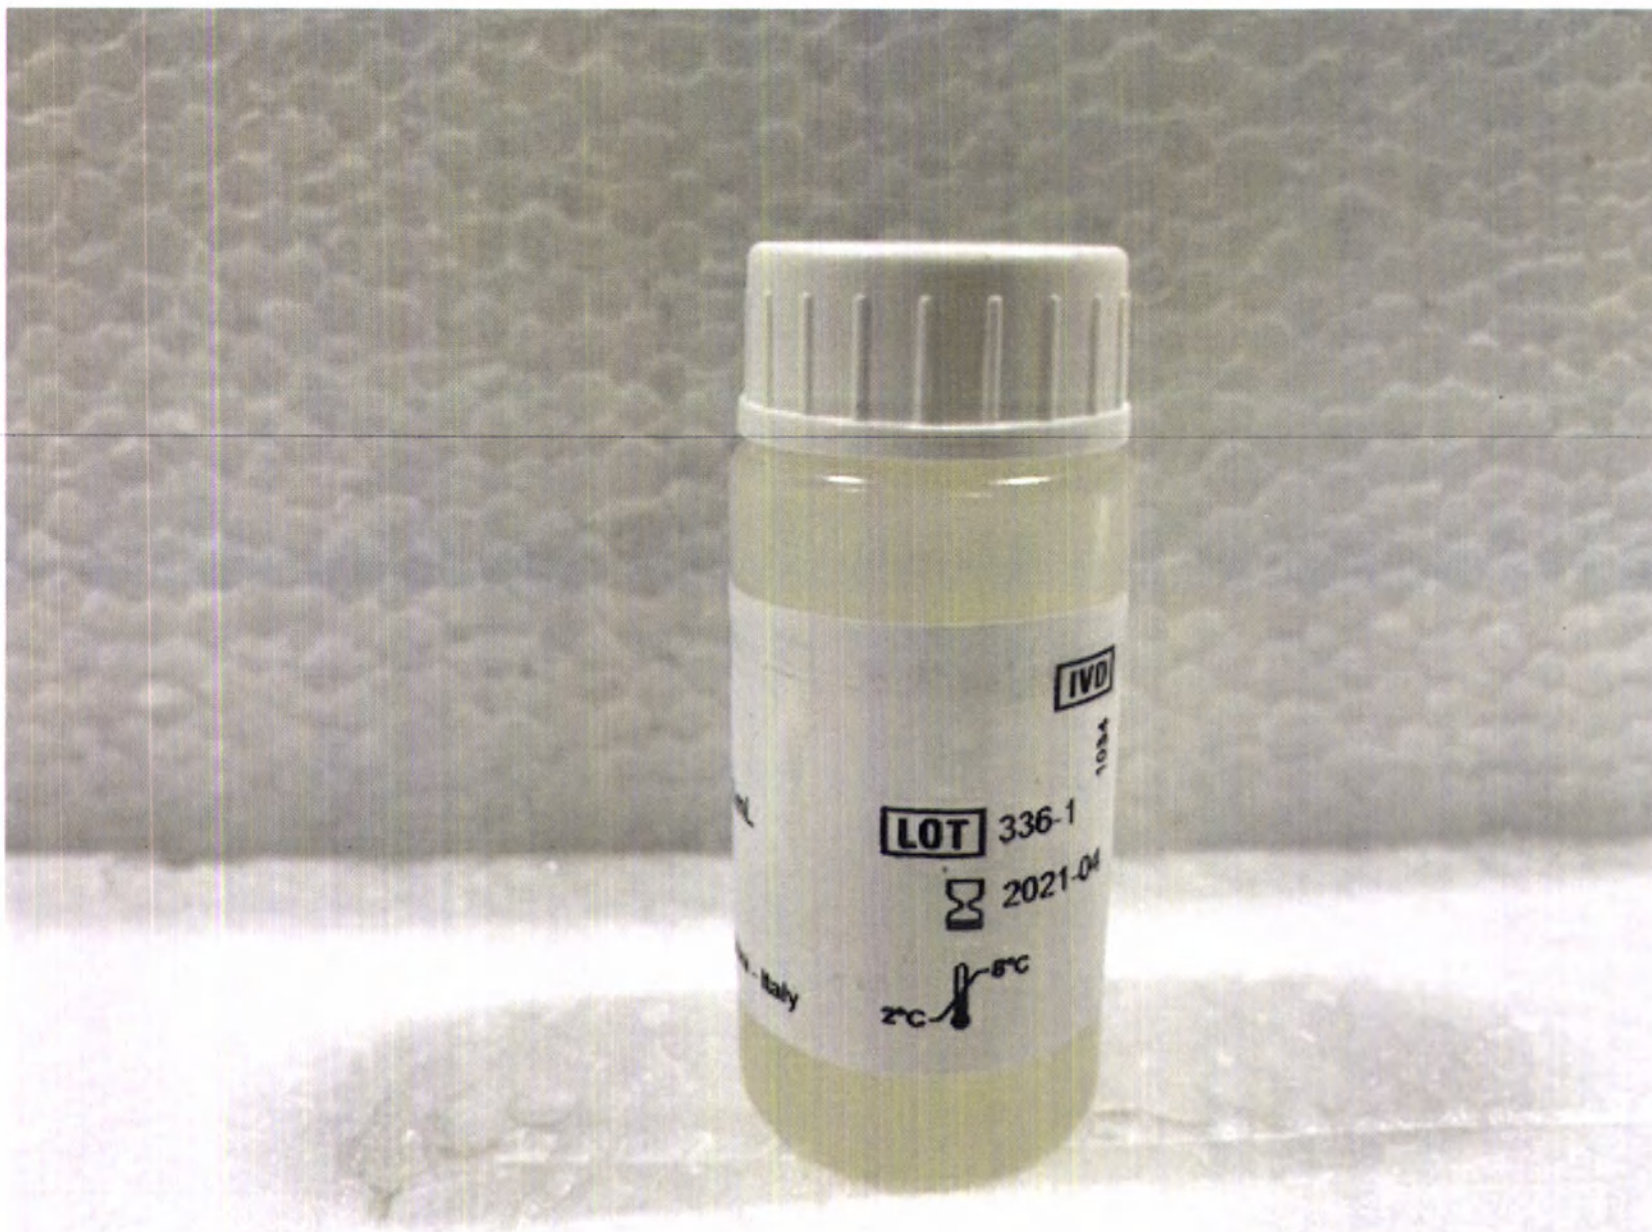

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 006. Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.

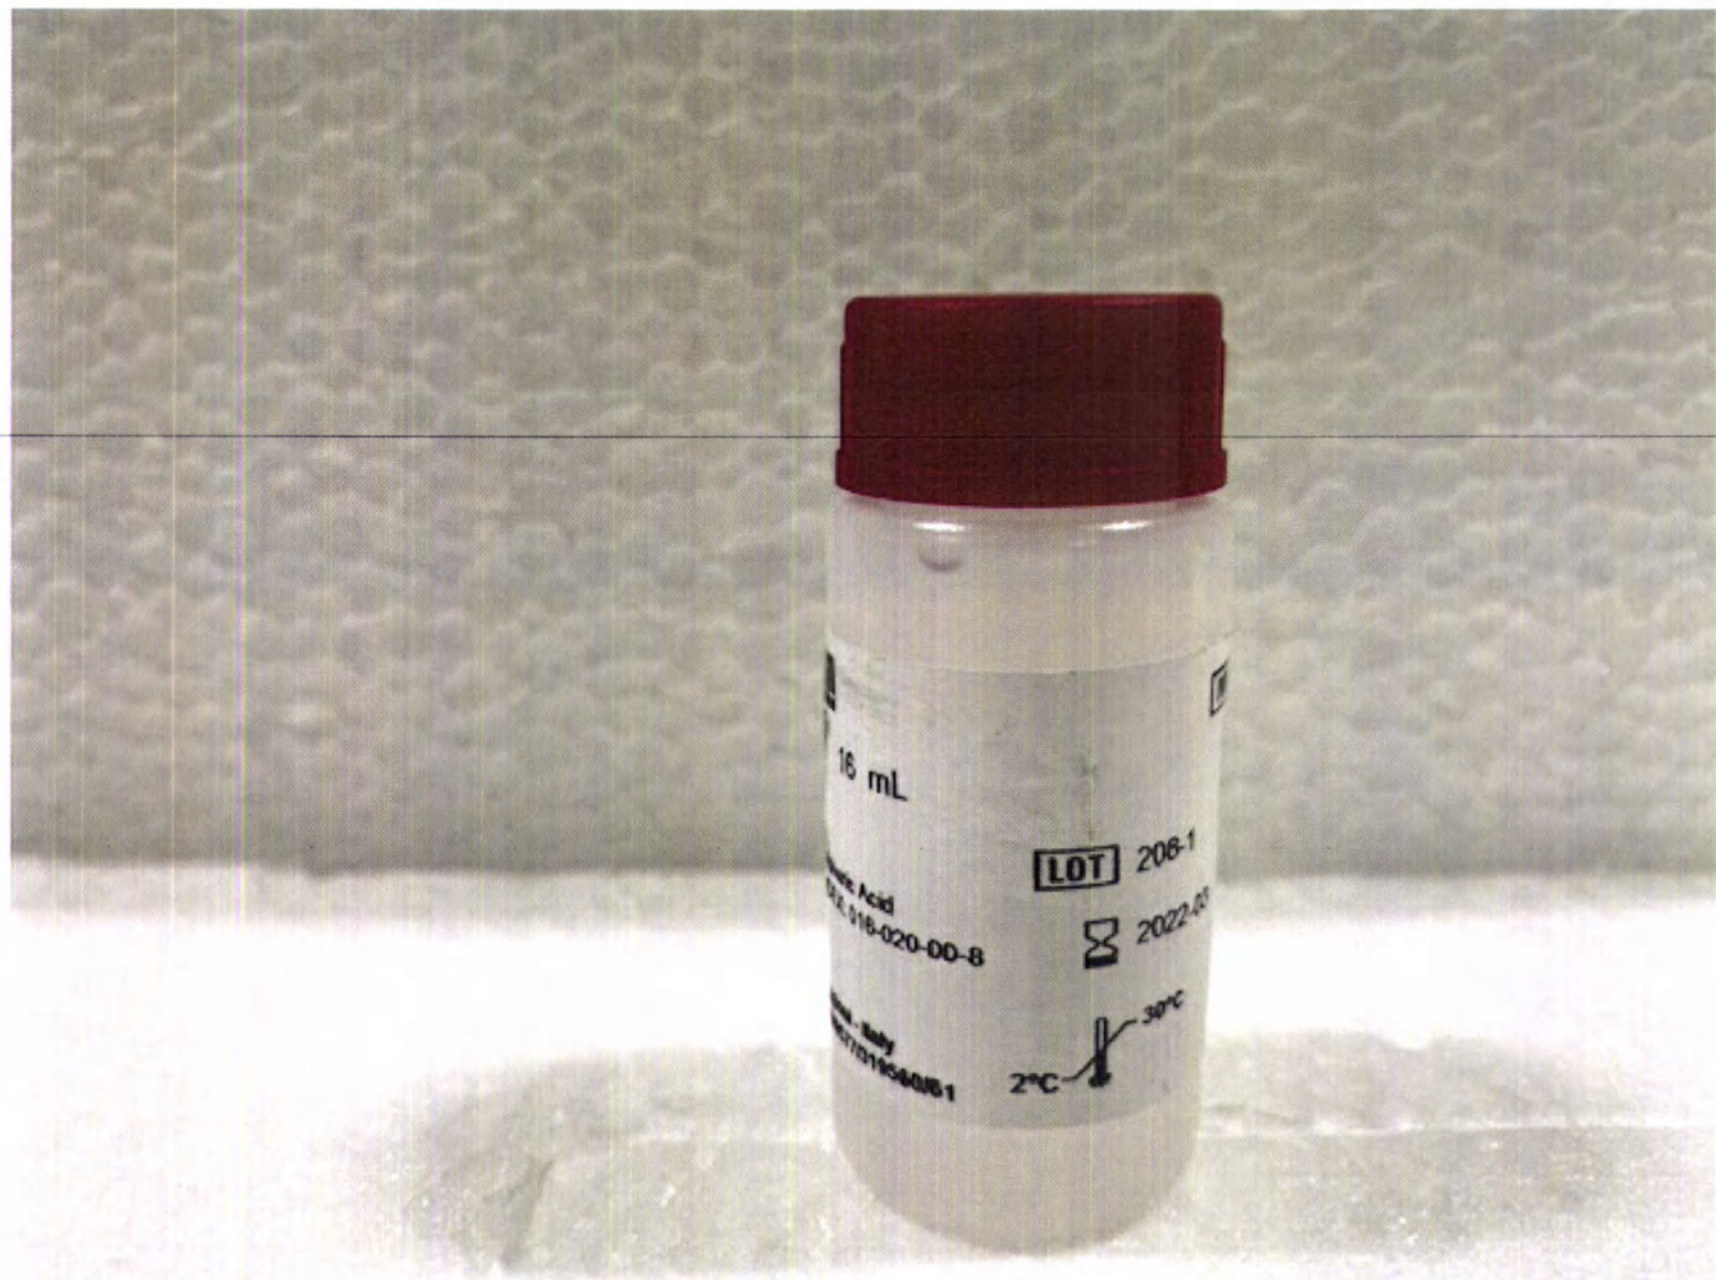

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006. Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.

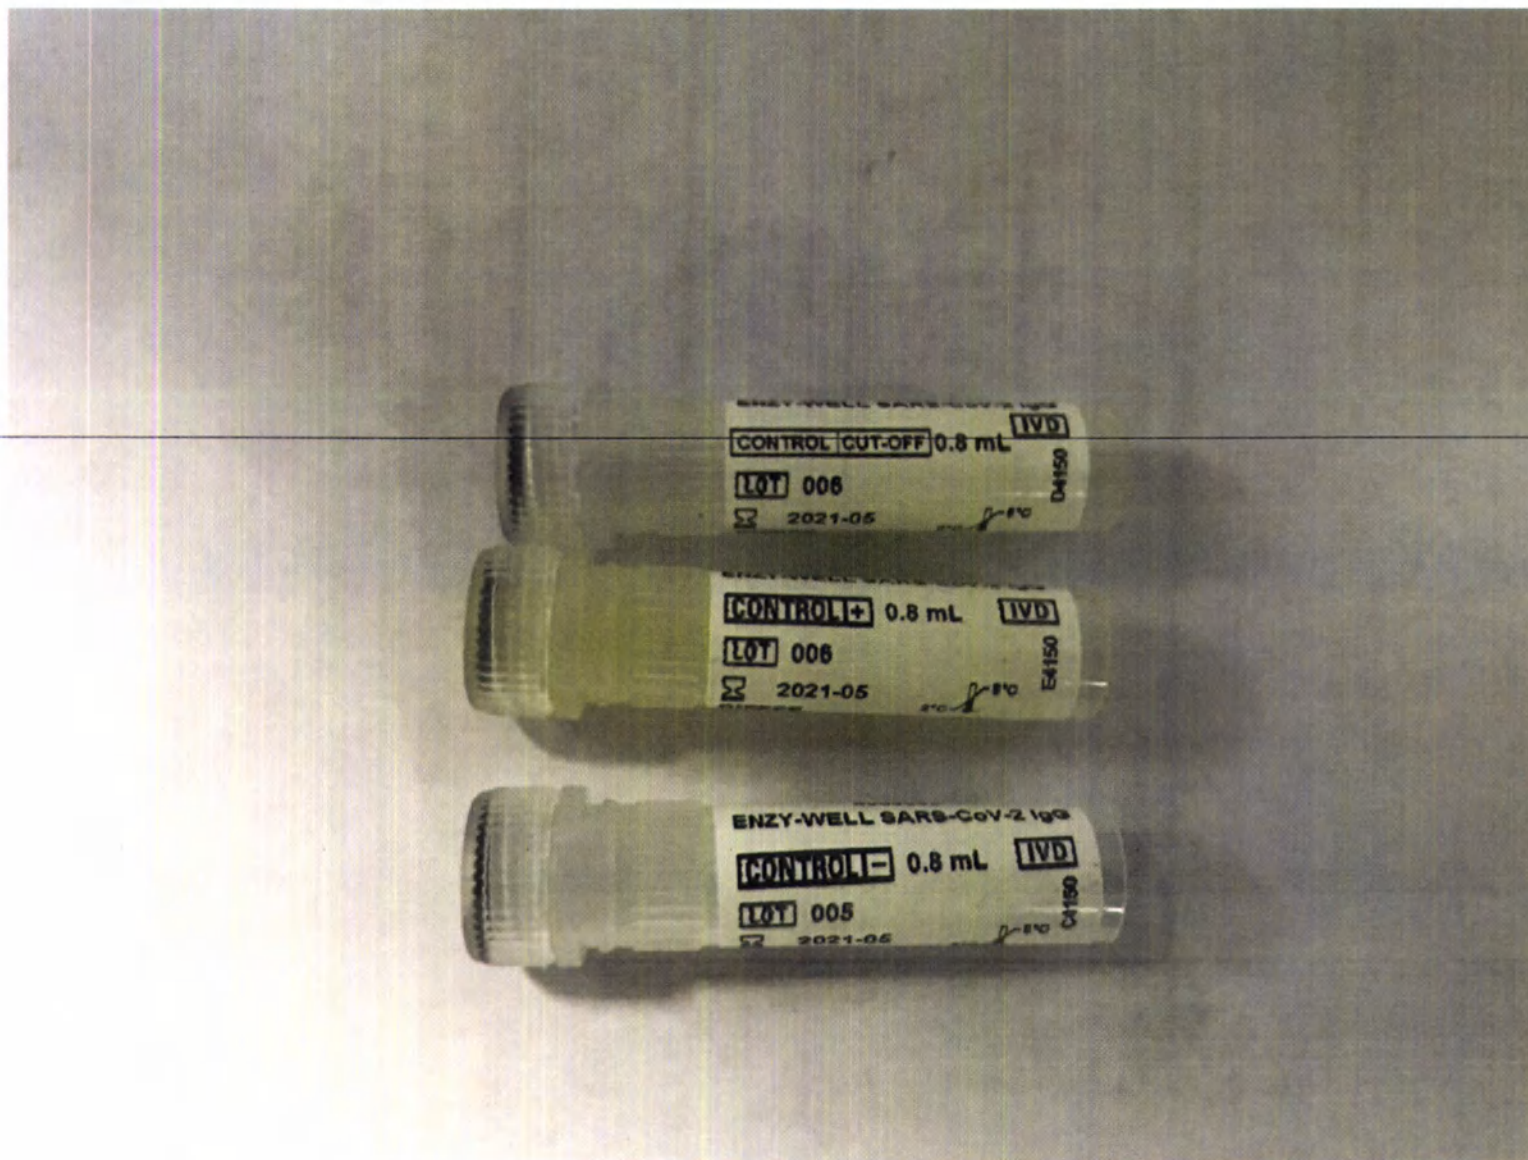


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 006.


Образец контрольный, отрицательный, 1 флакон – 0,8 мл.; Образец контрольный, положительный, 1 флакон – 0,8 мл.; Контроль Cut-off, 1 флакон – 0,8 мл.

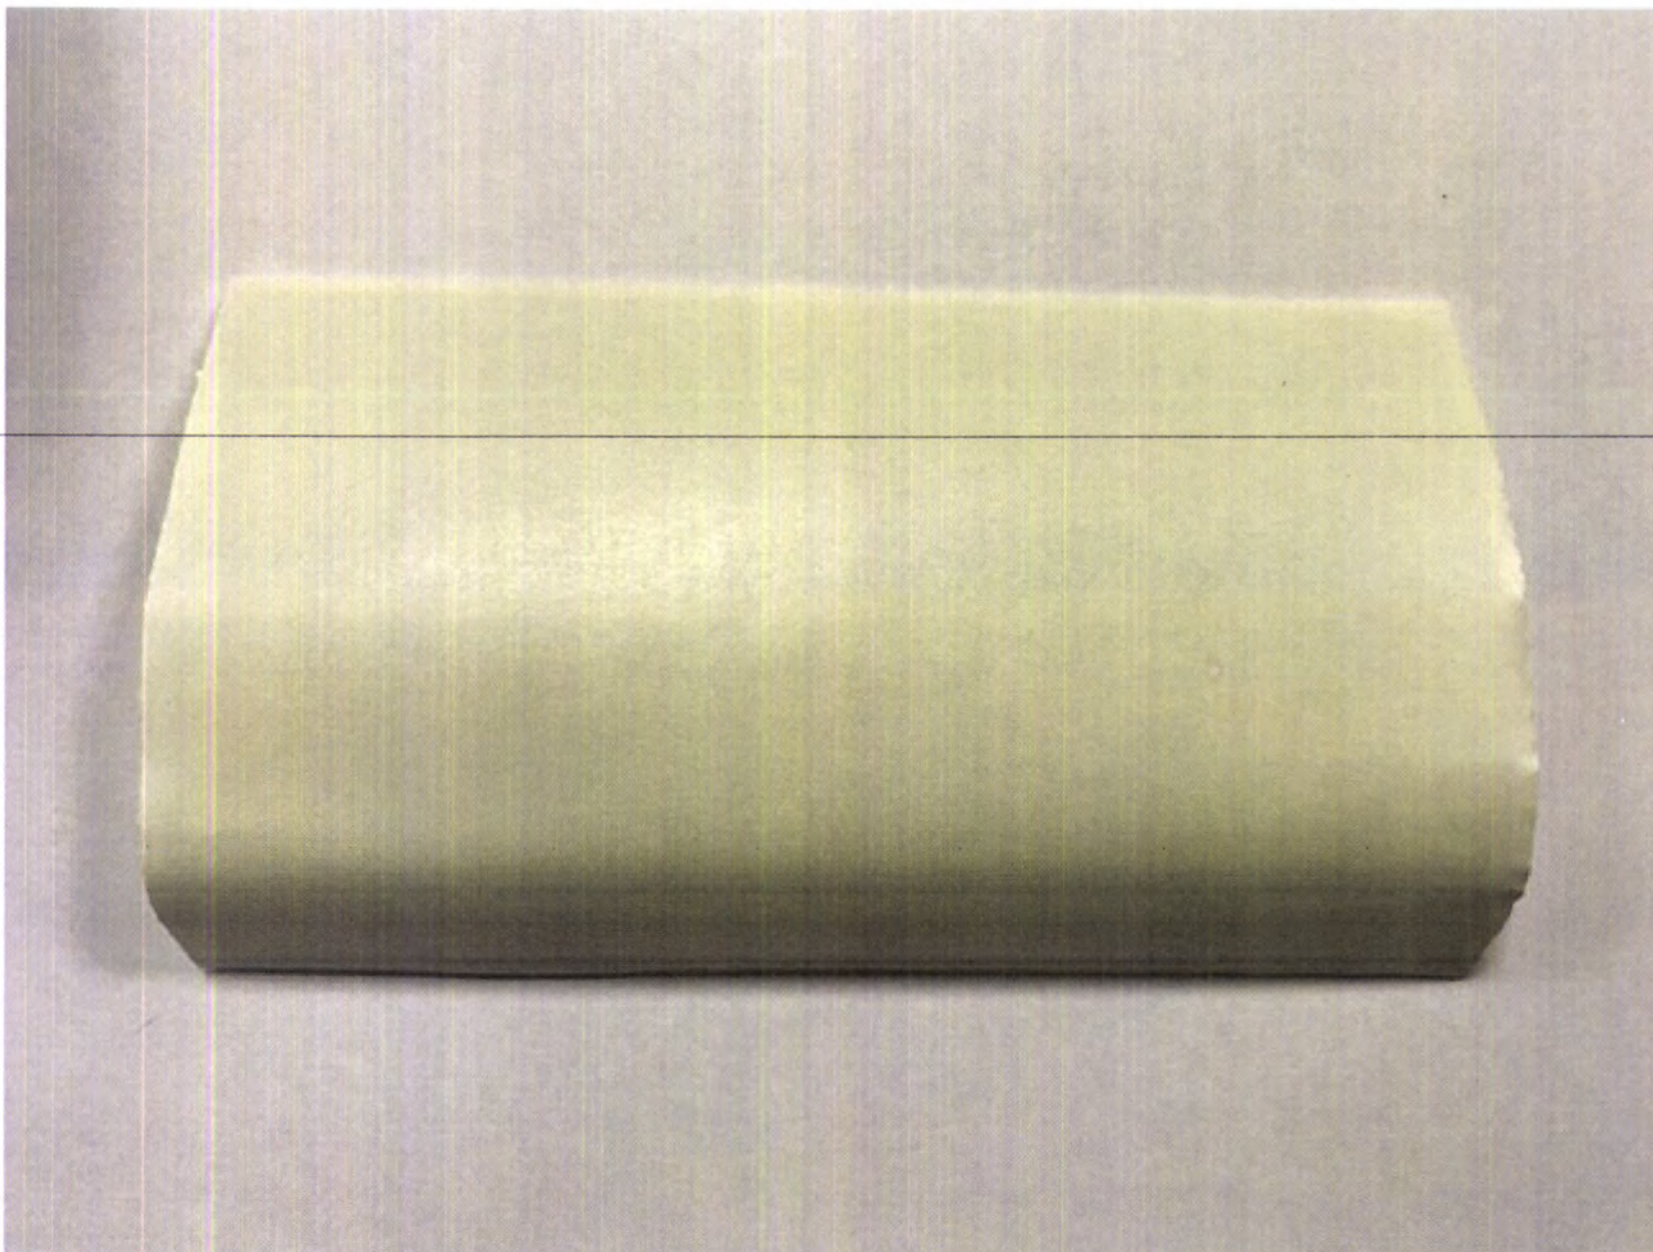

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.
Защитная пленка

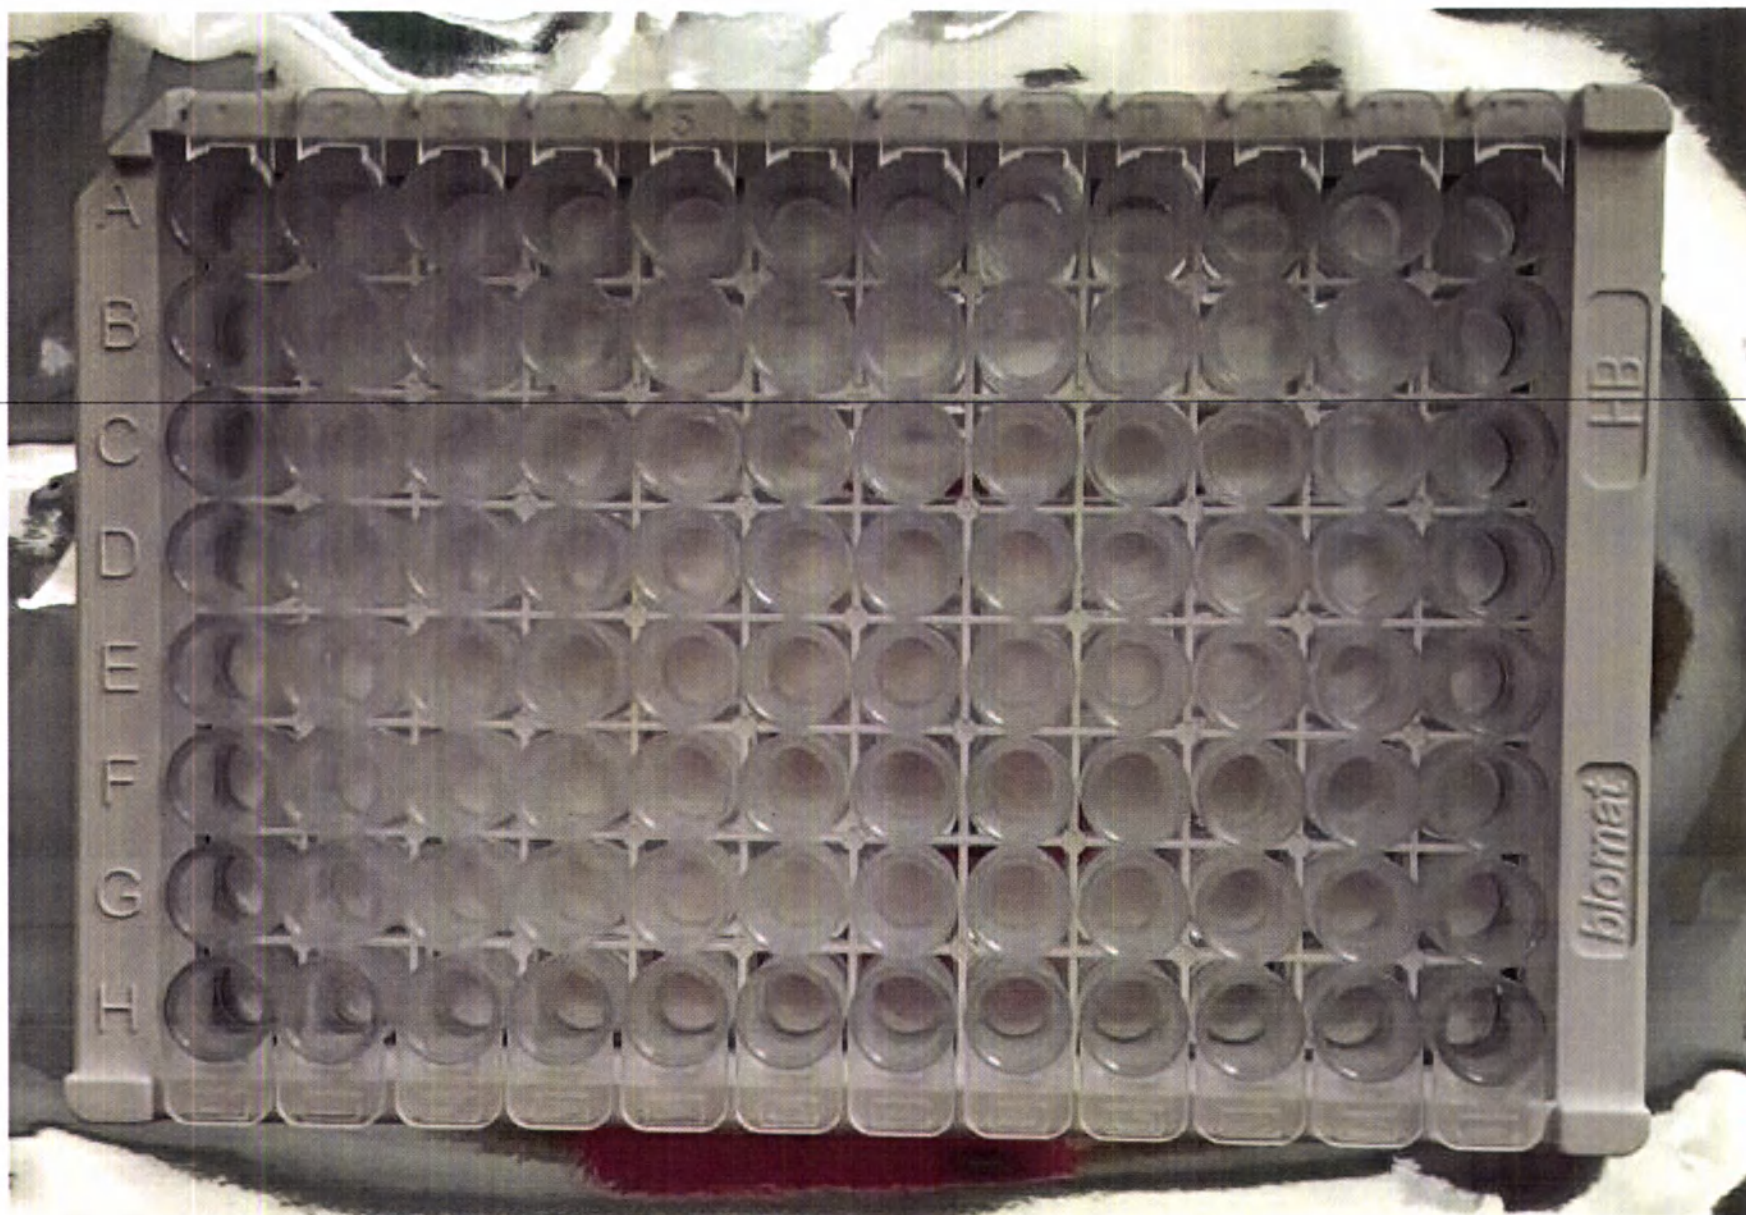

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 006.
Микропланшет

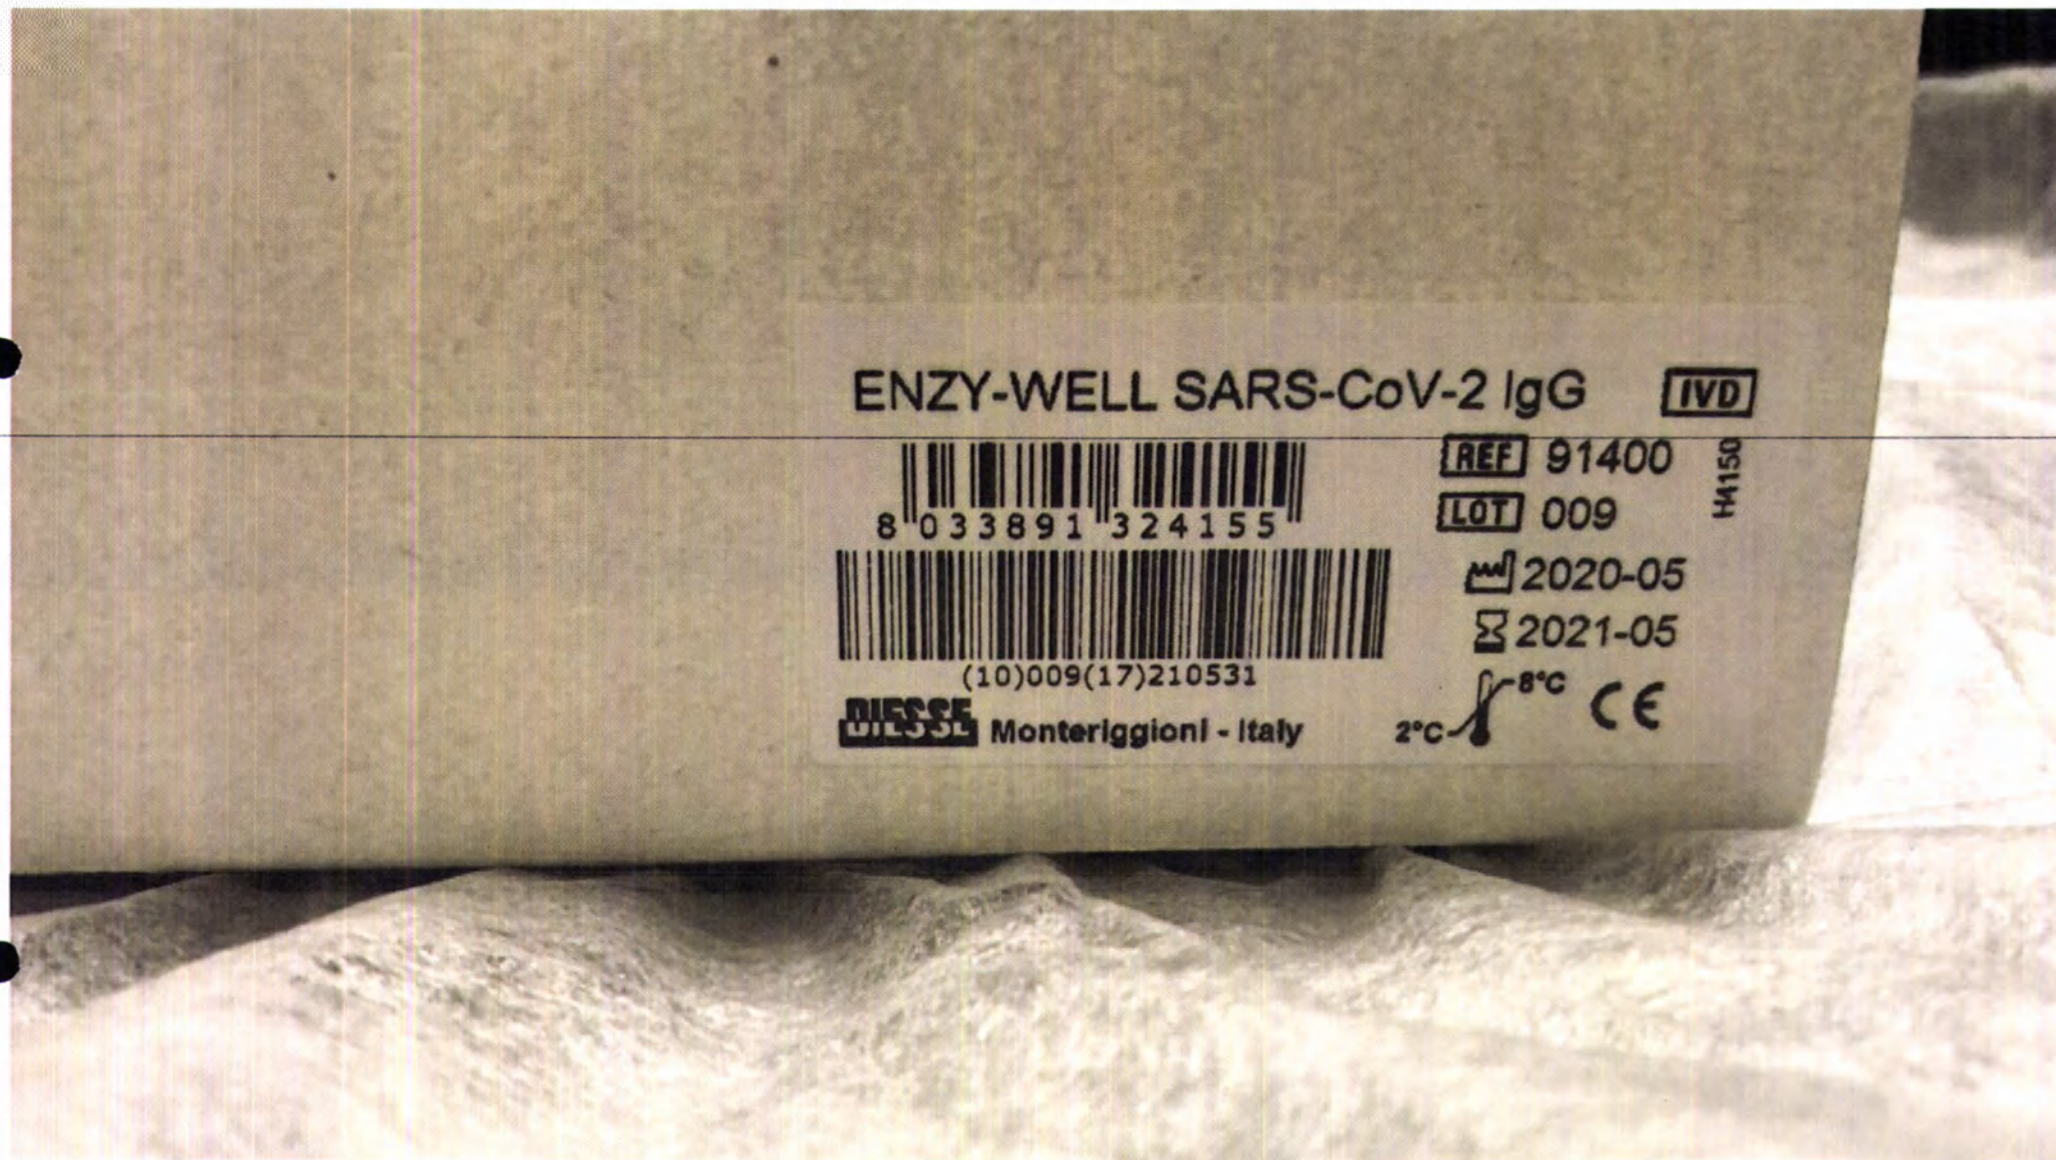

ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG **IVD**

8 033891 324155

REF 91400

LOT 009

H4150

(10)009(17)210531


2020-05

2021-05


BIESSE Monteriggioni - Italy

2°C 8°C **CE**


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-Cov-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Маркировка набора. Лот 009.

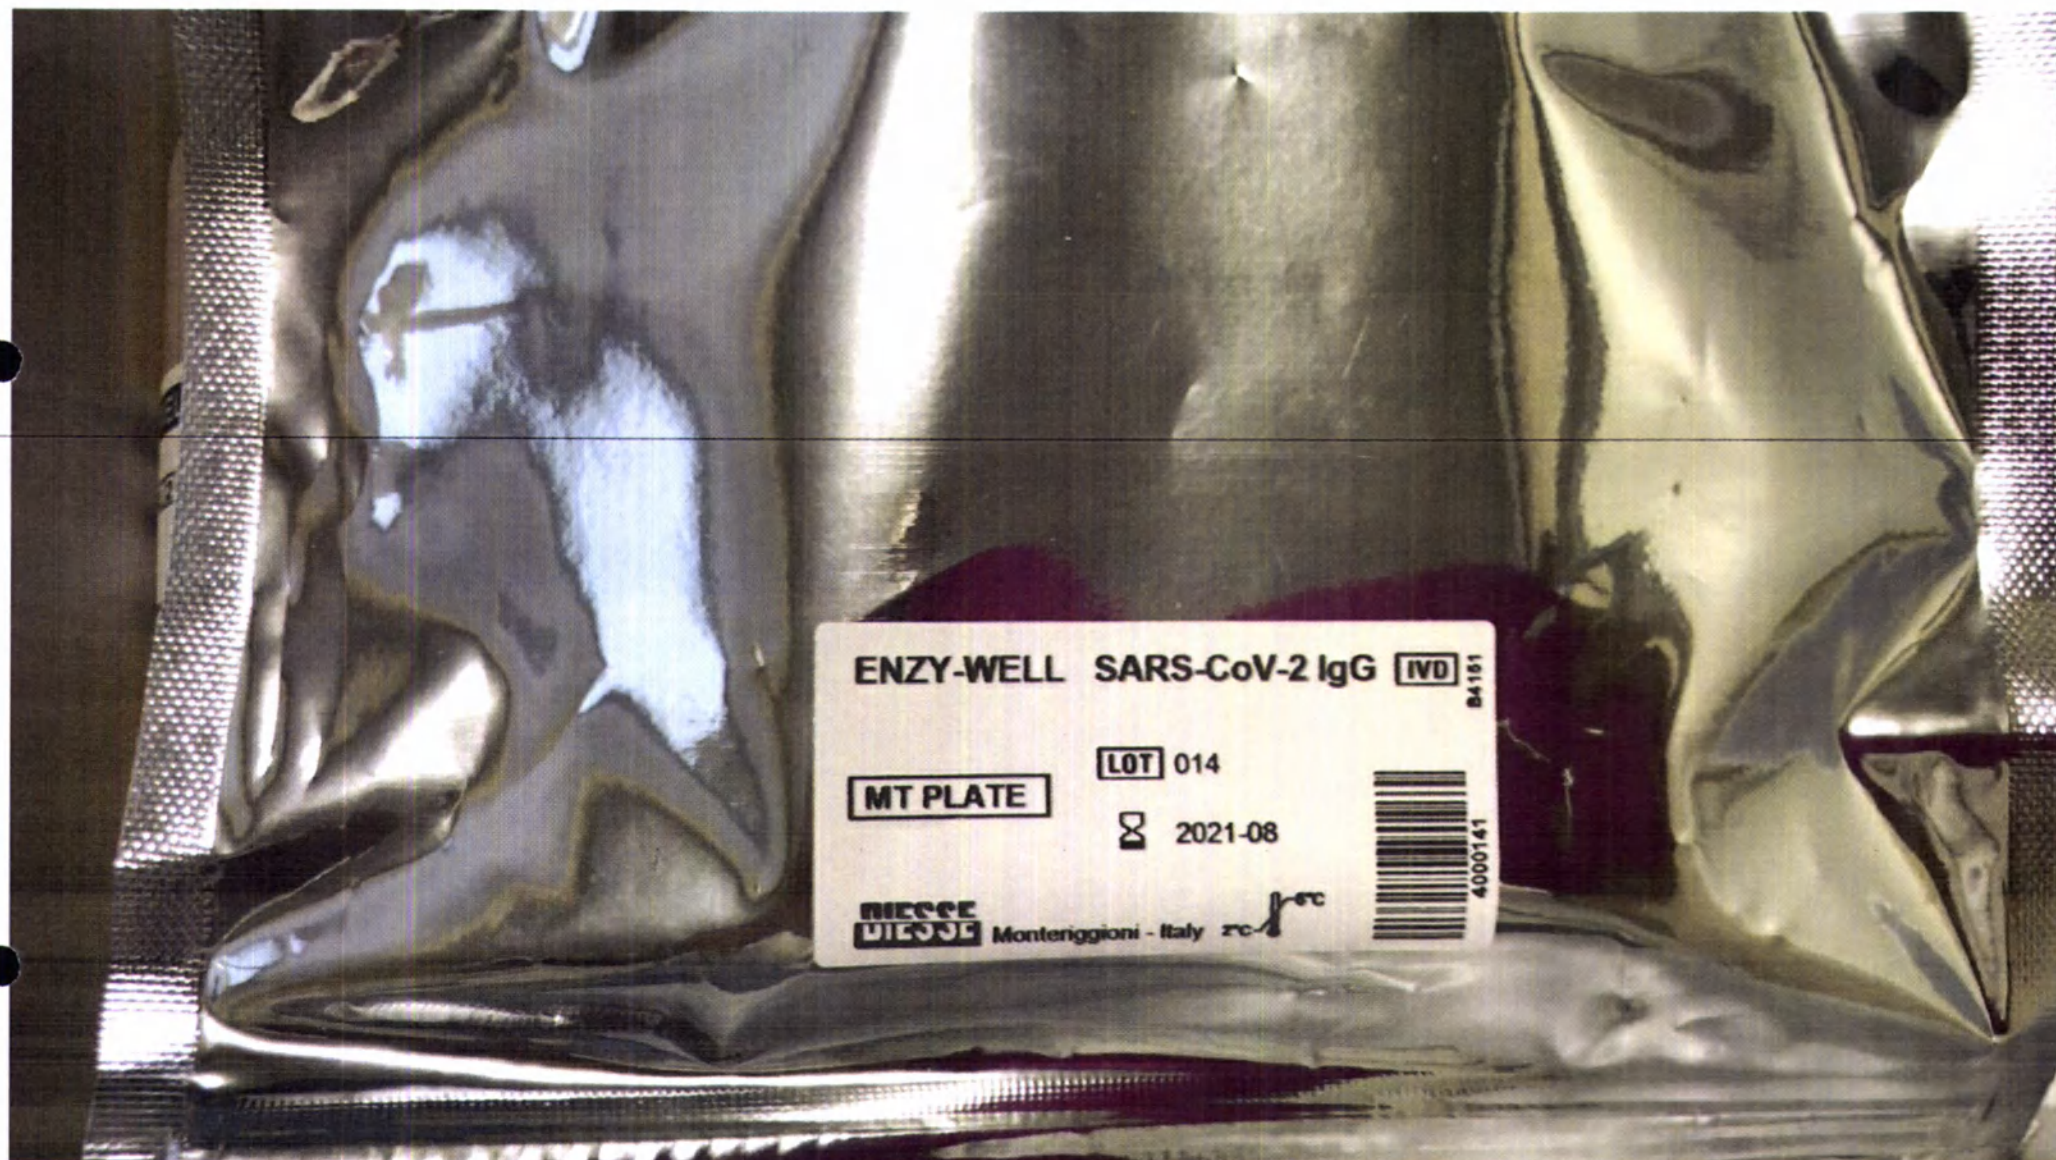


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Микропланшет. Лот 009.

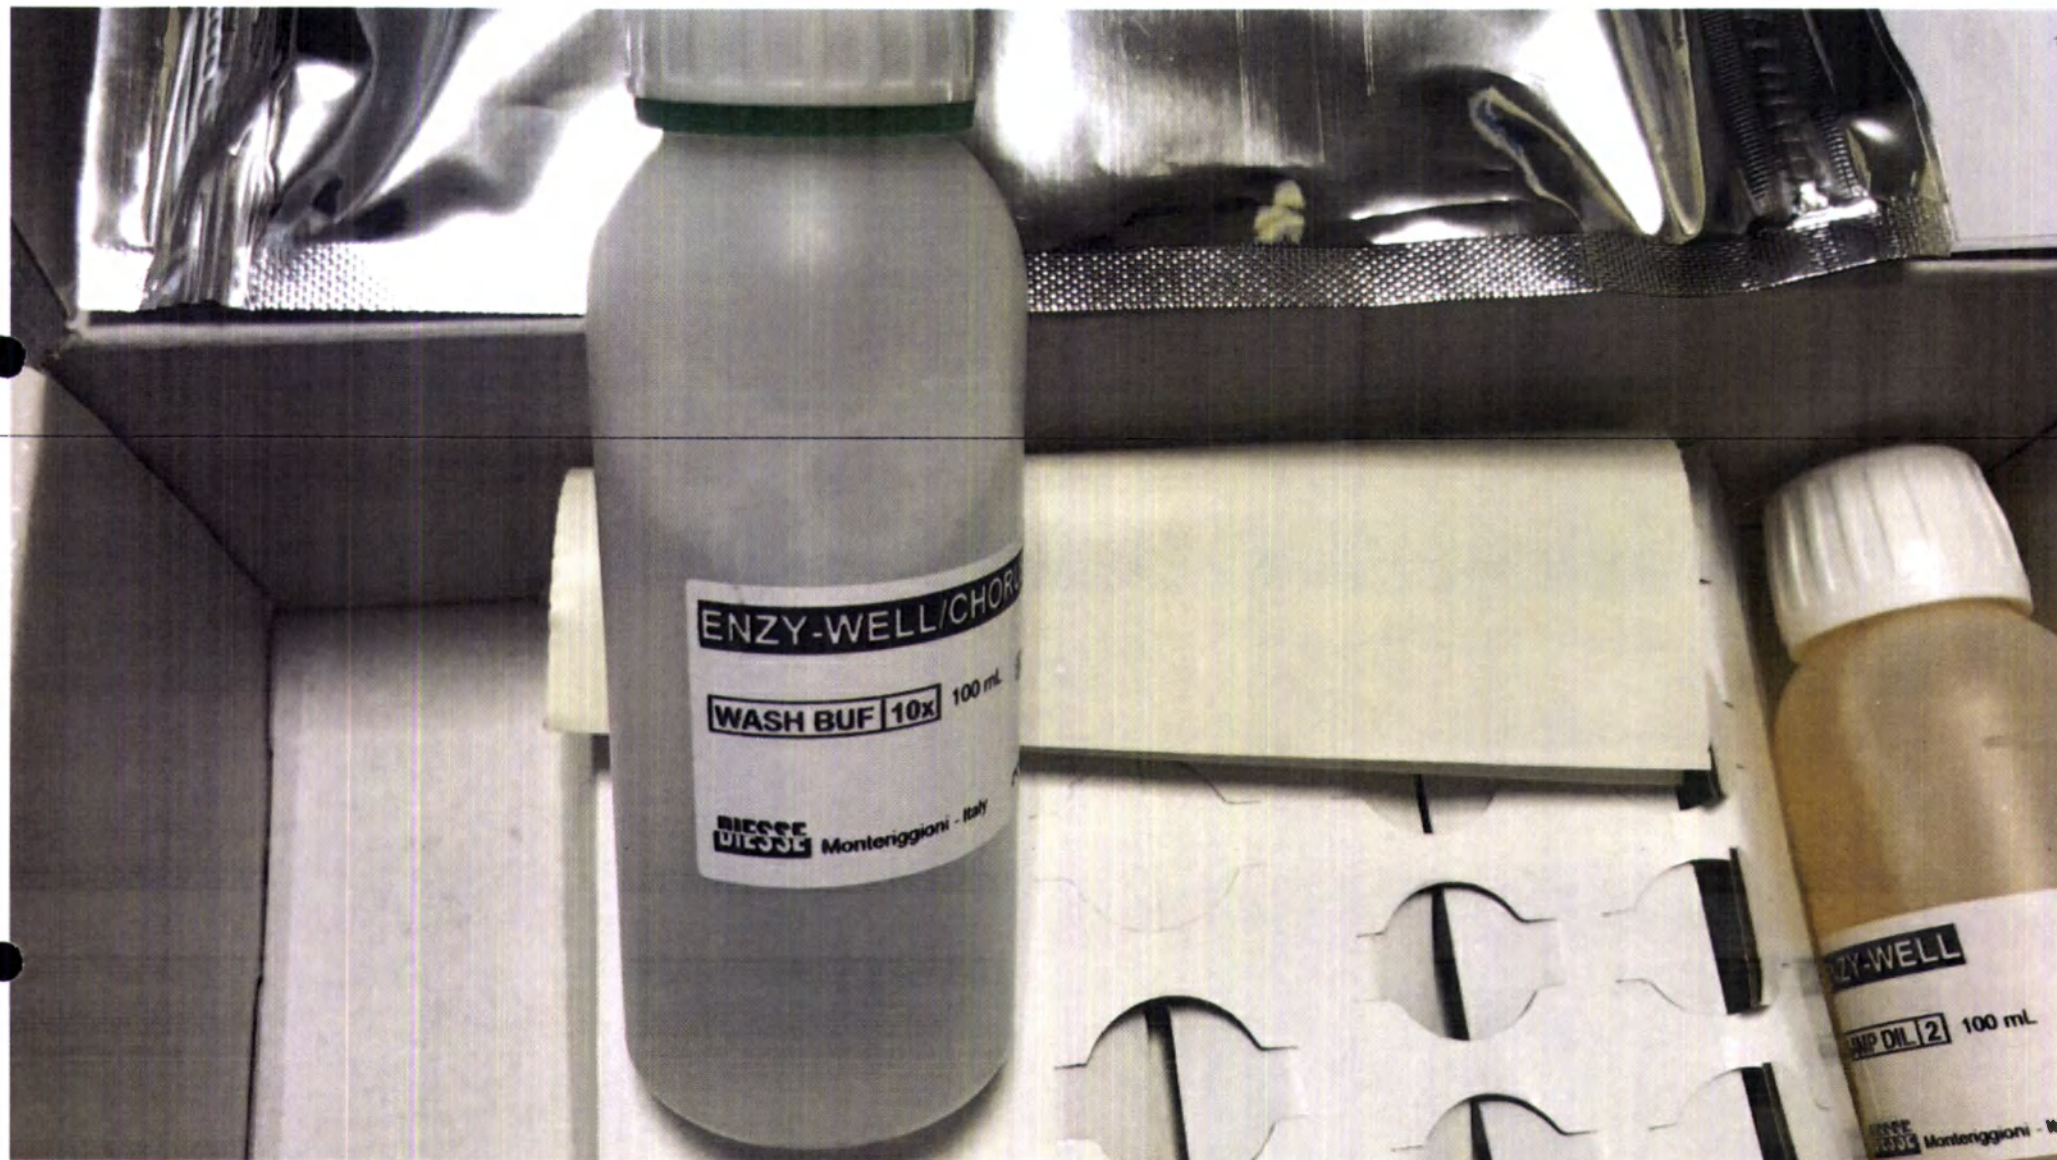


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009.
Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.

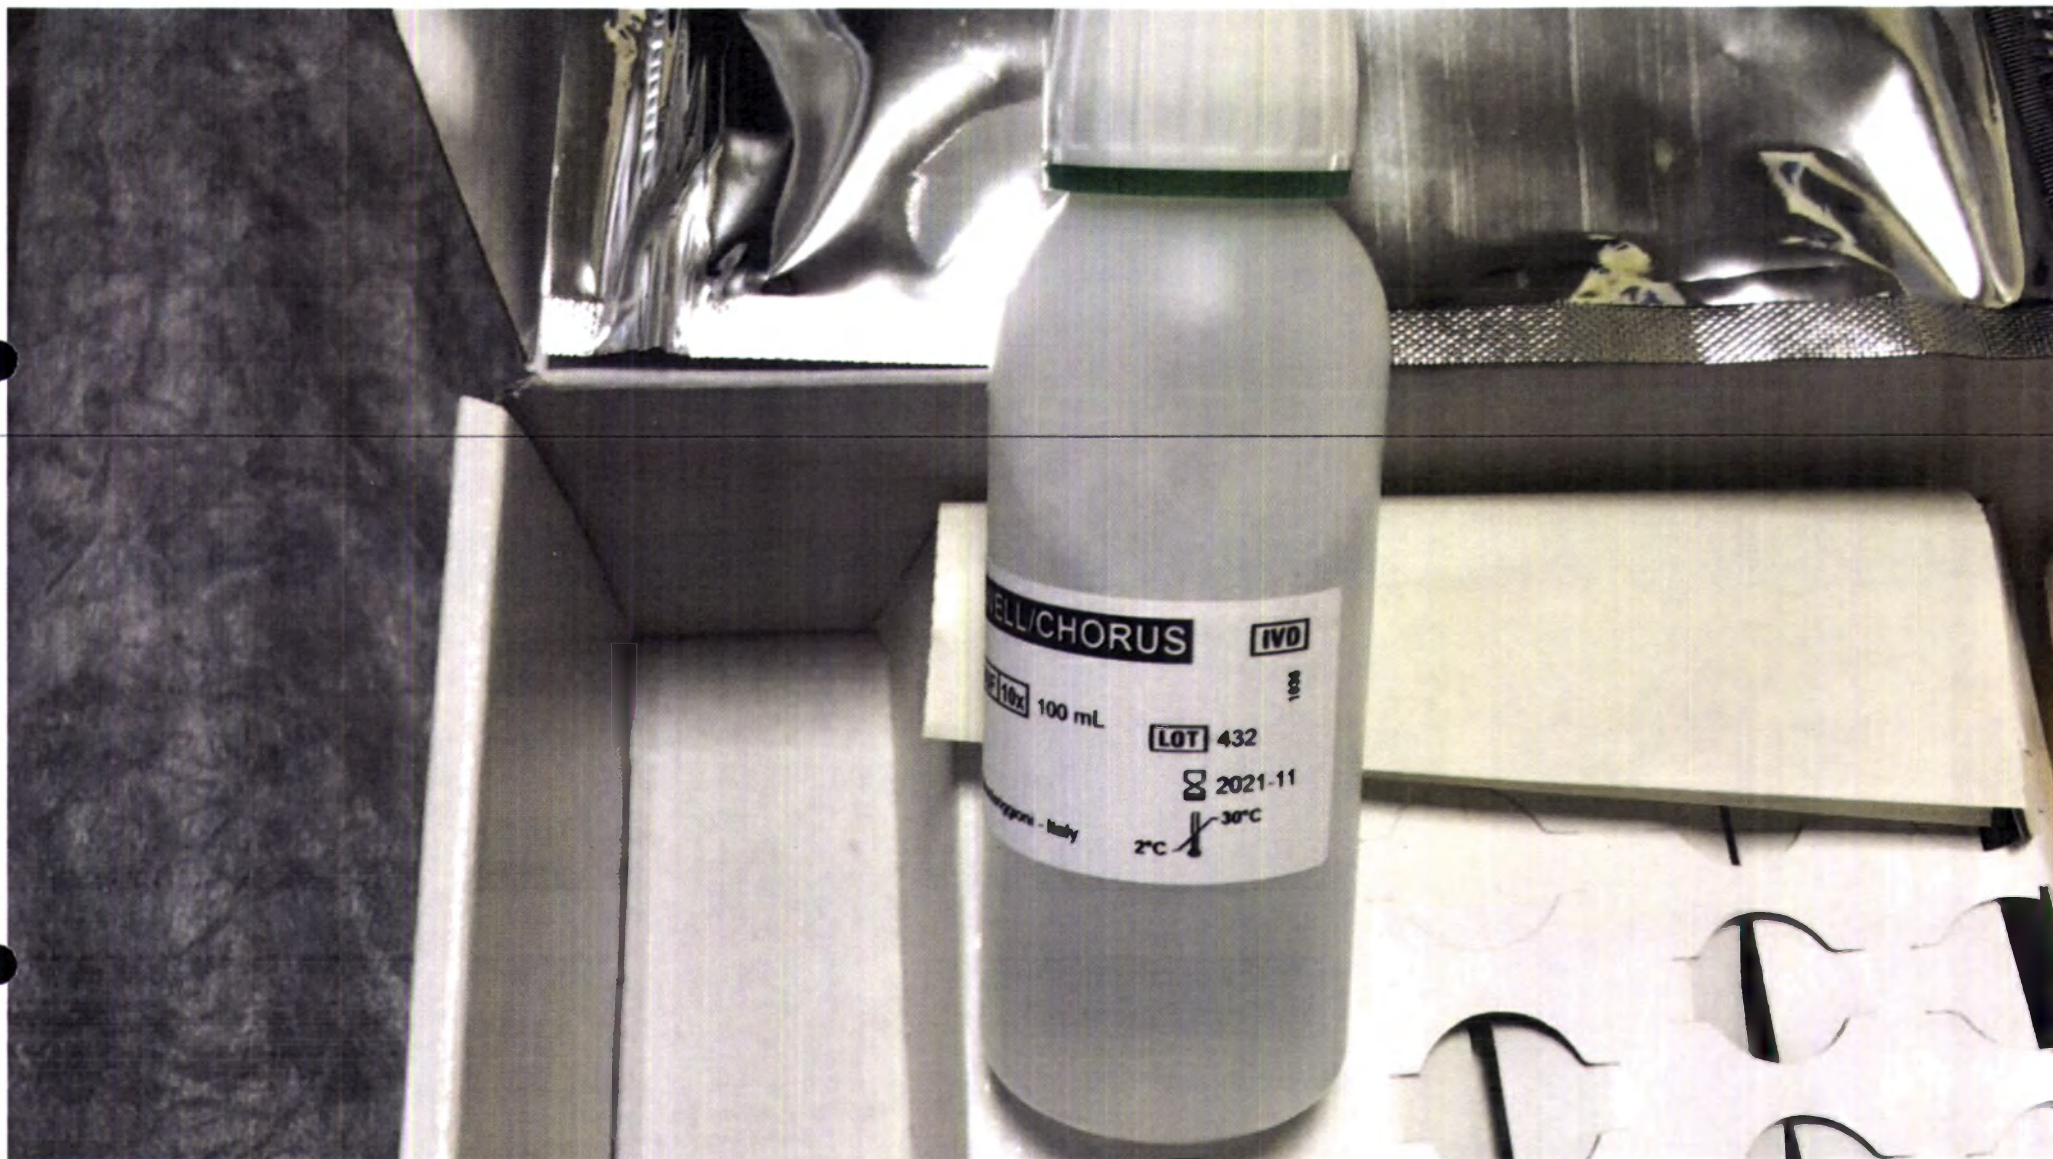


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 009.
Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.

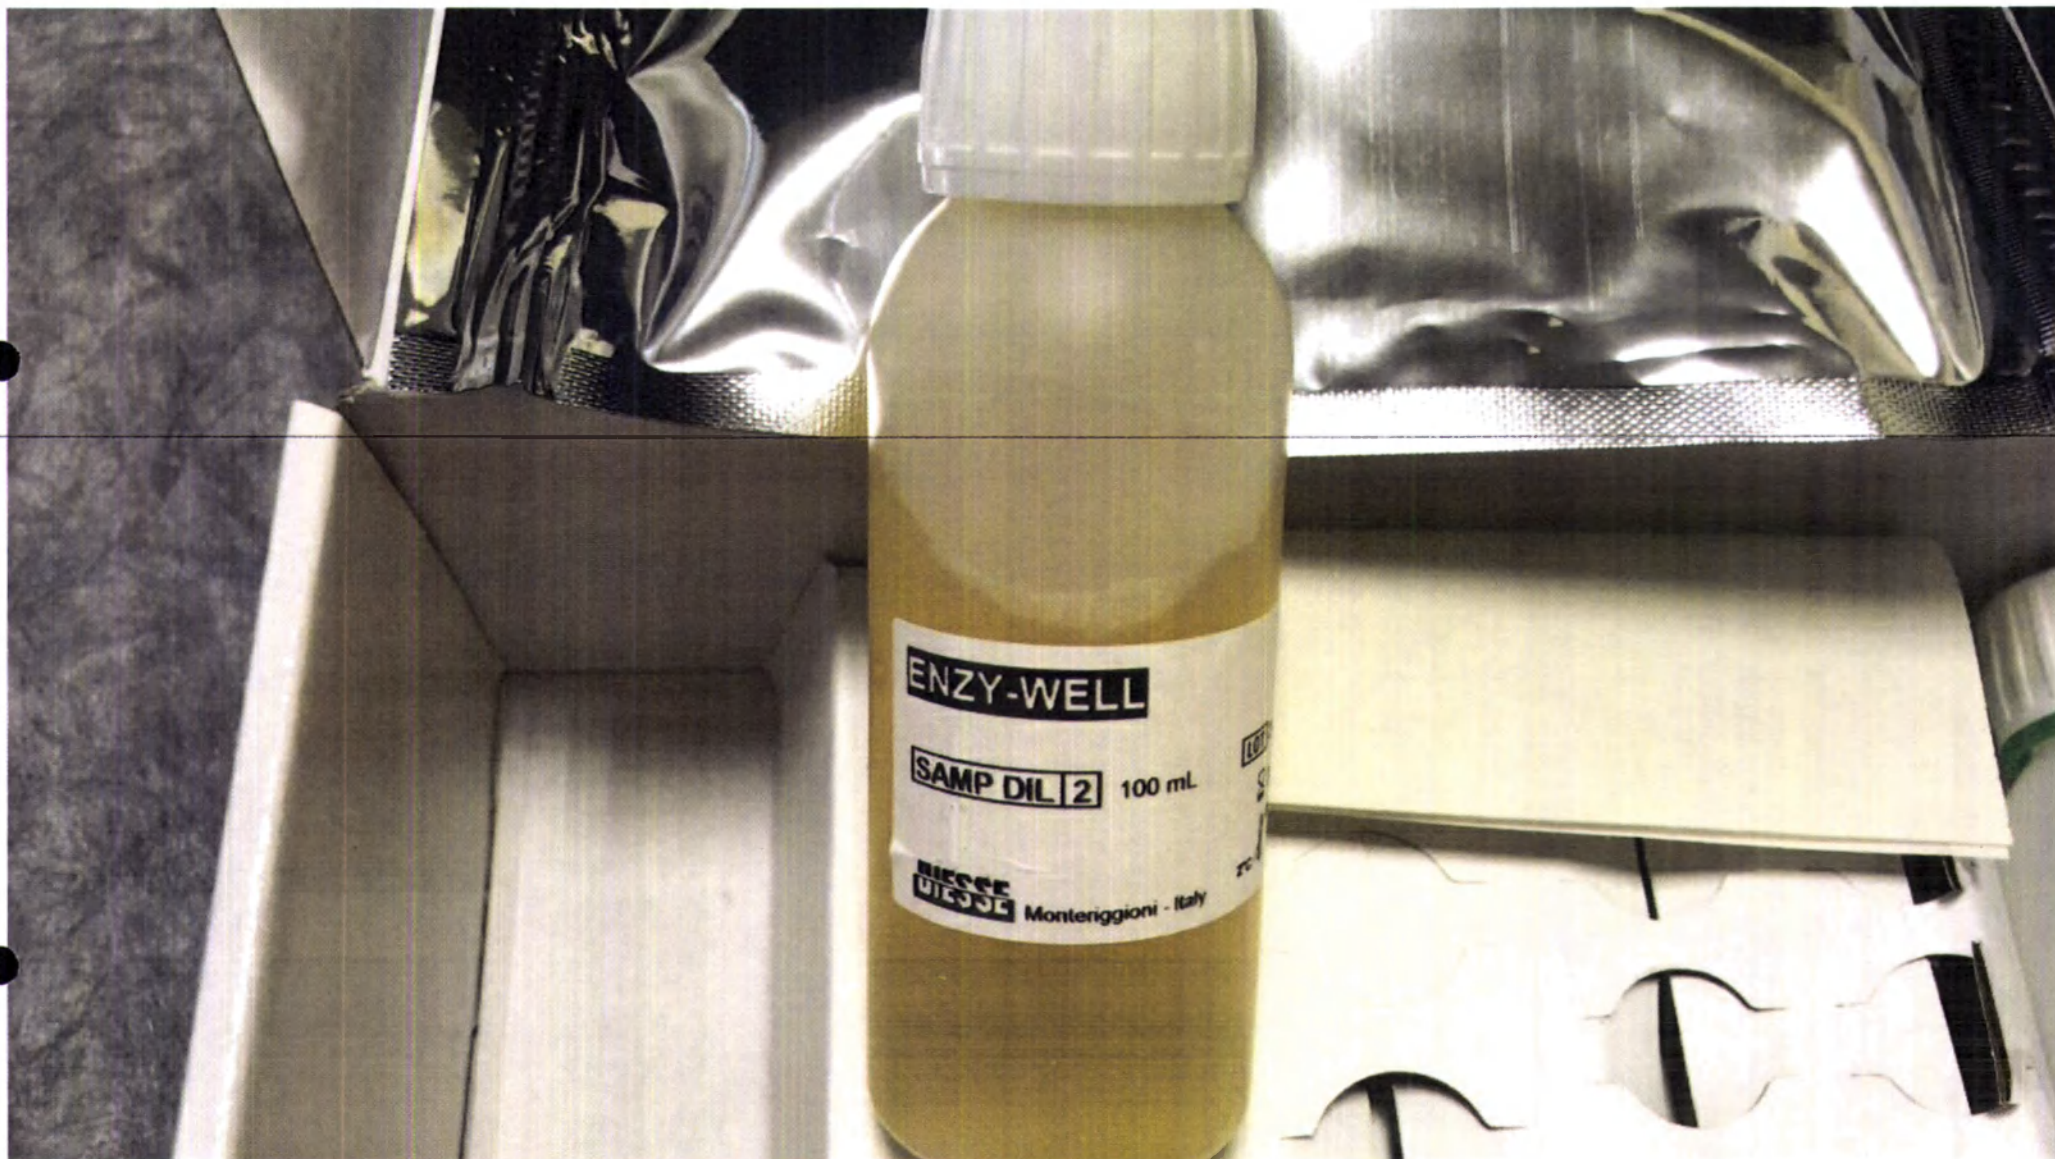


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.

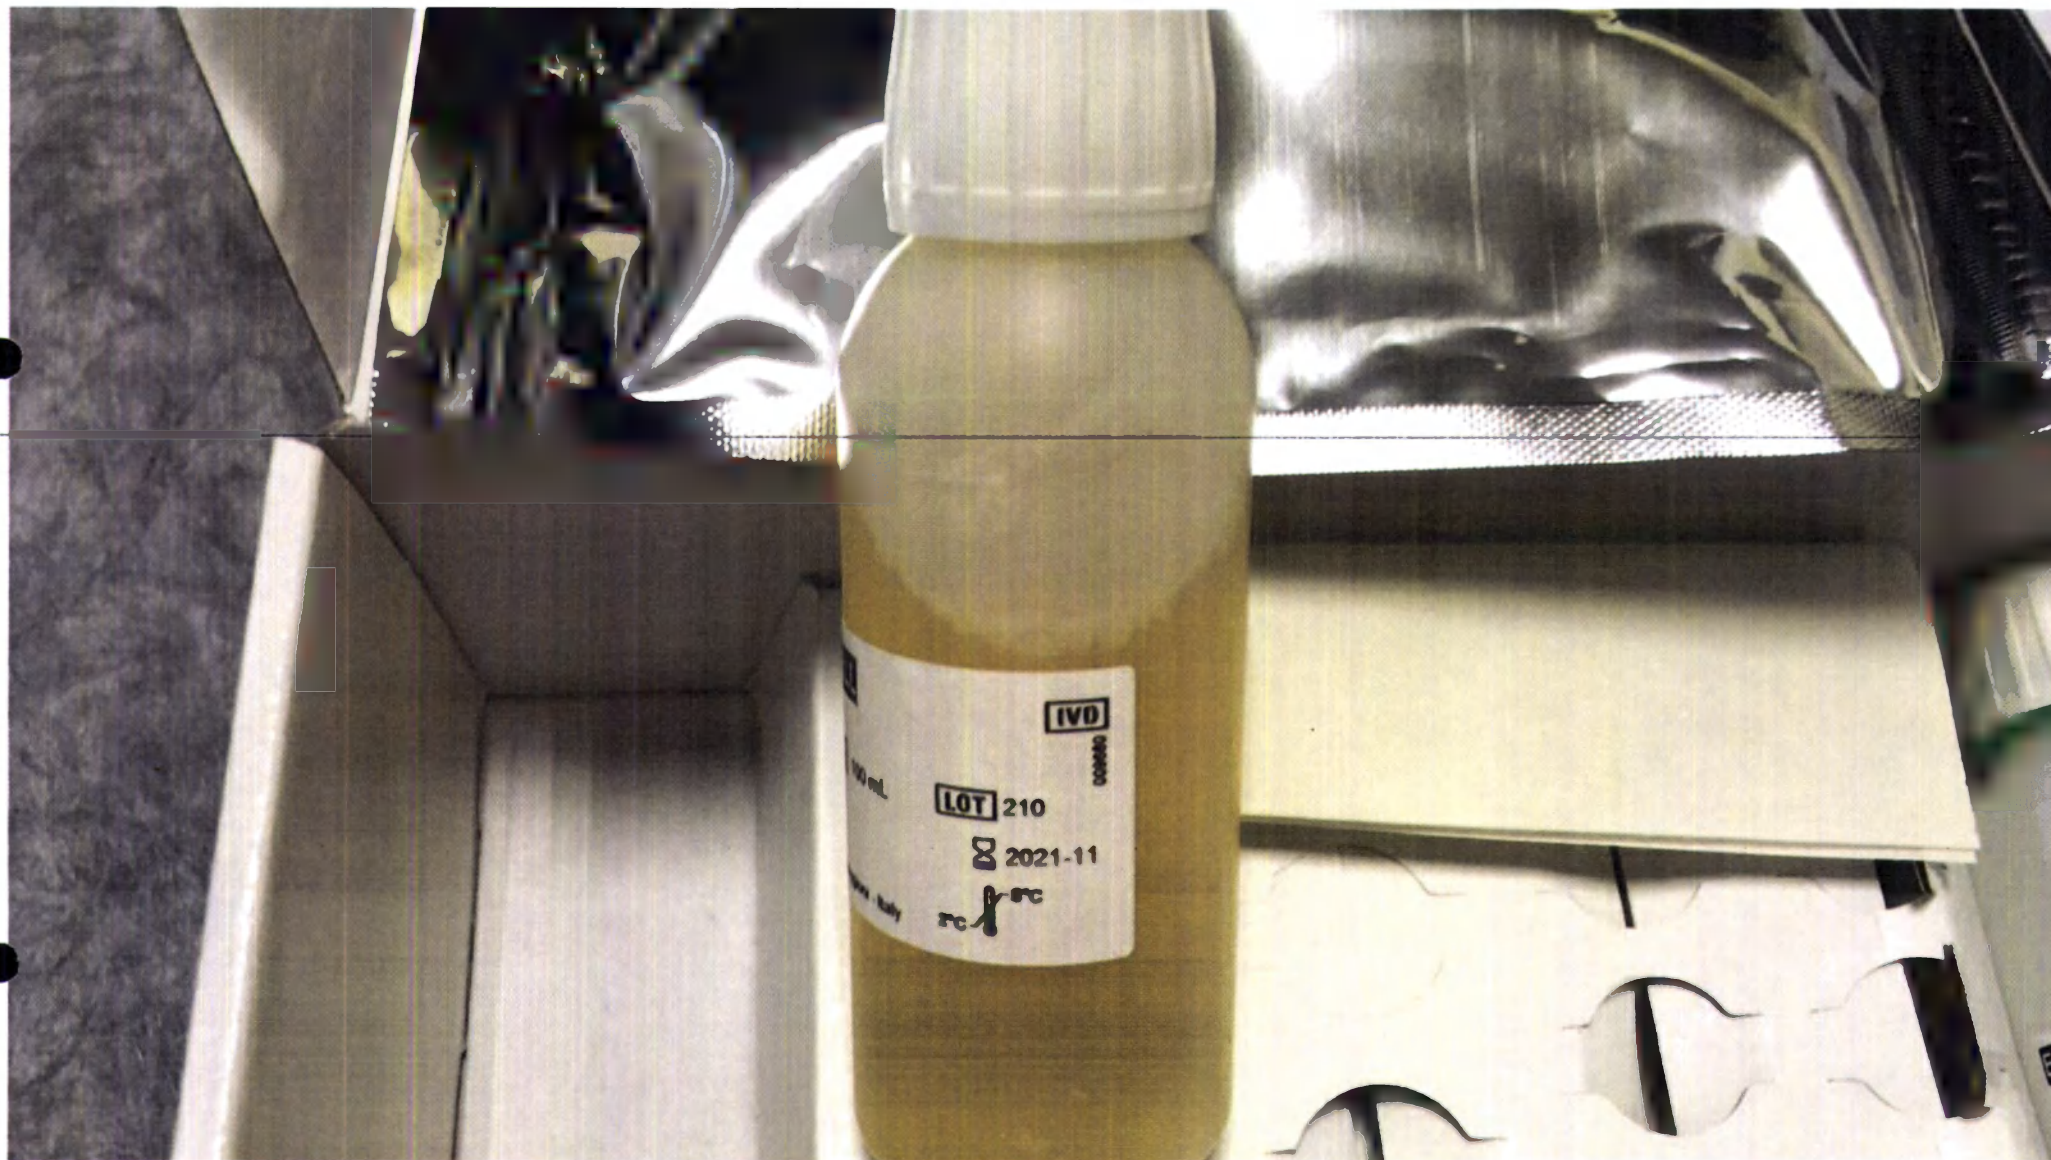


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 009. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.

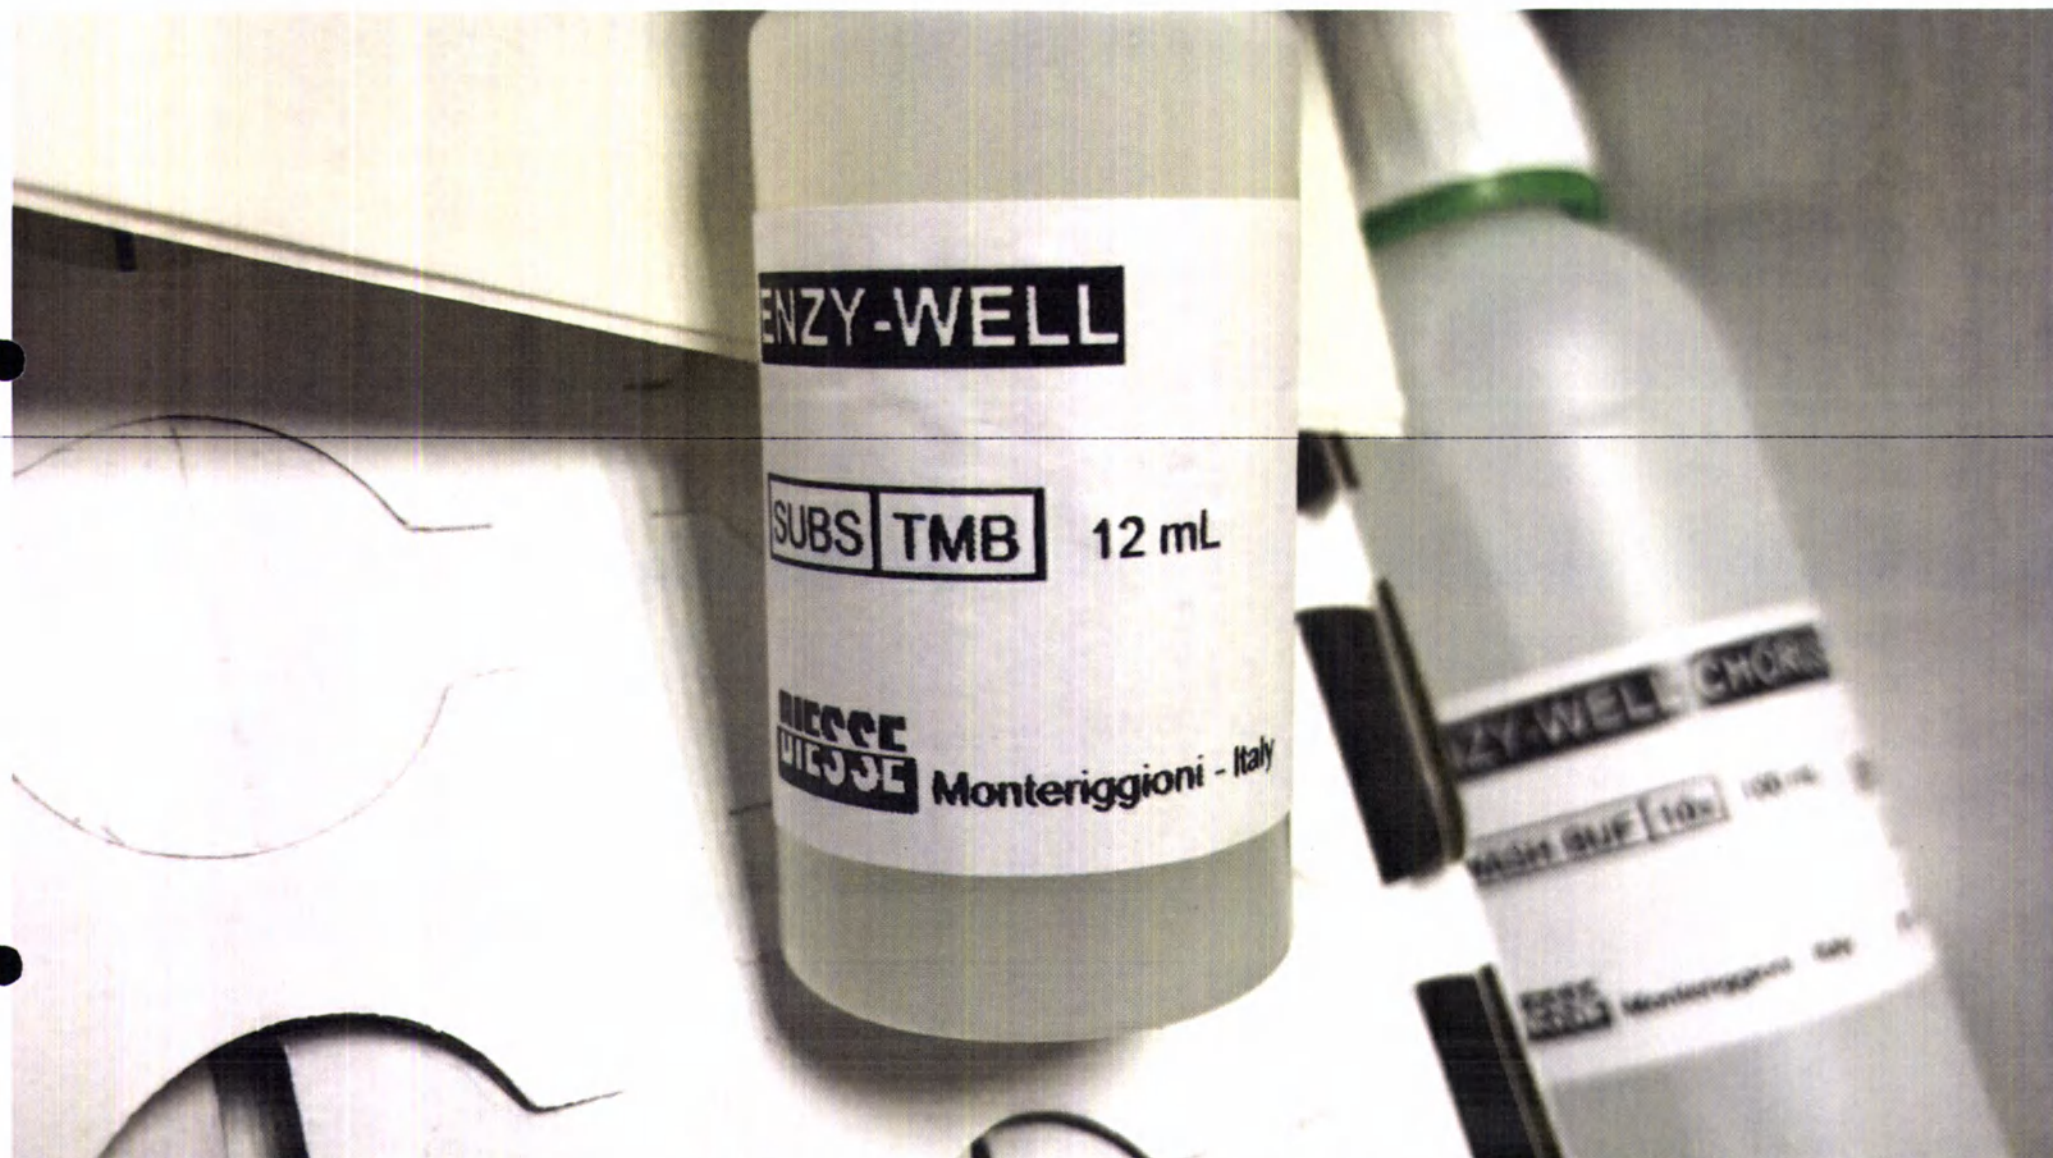


Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.

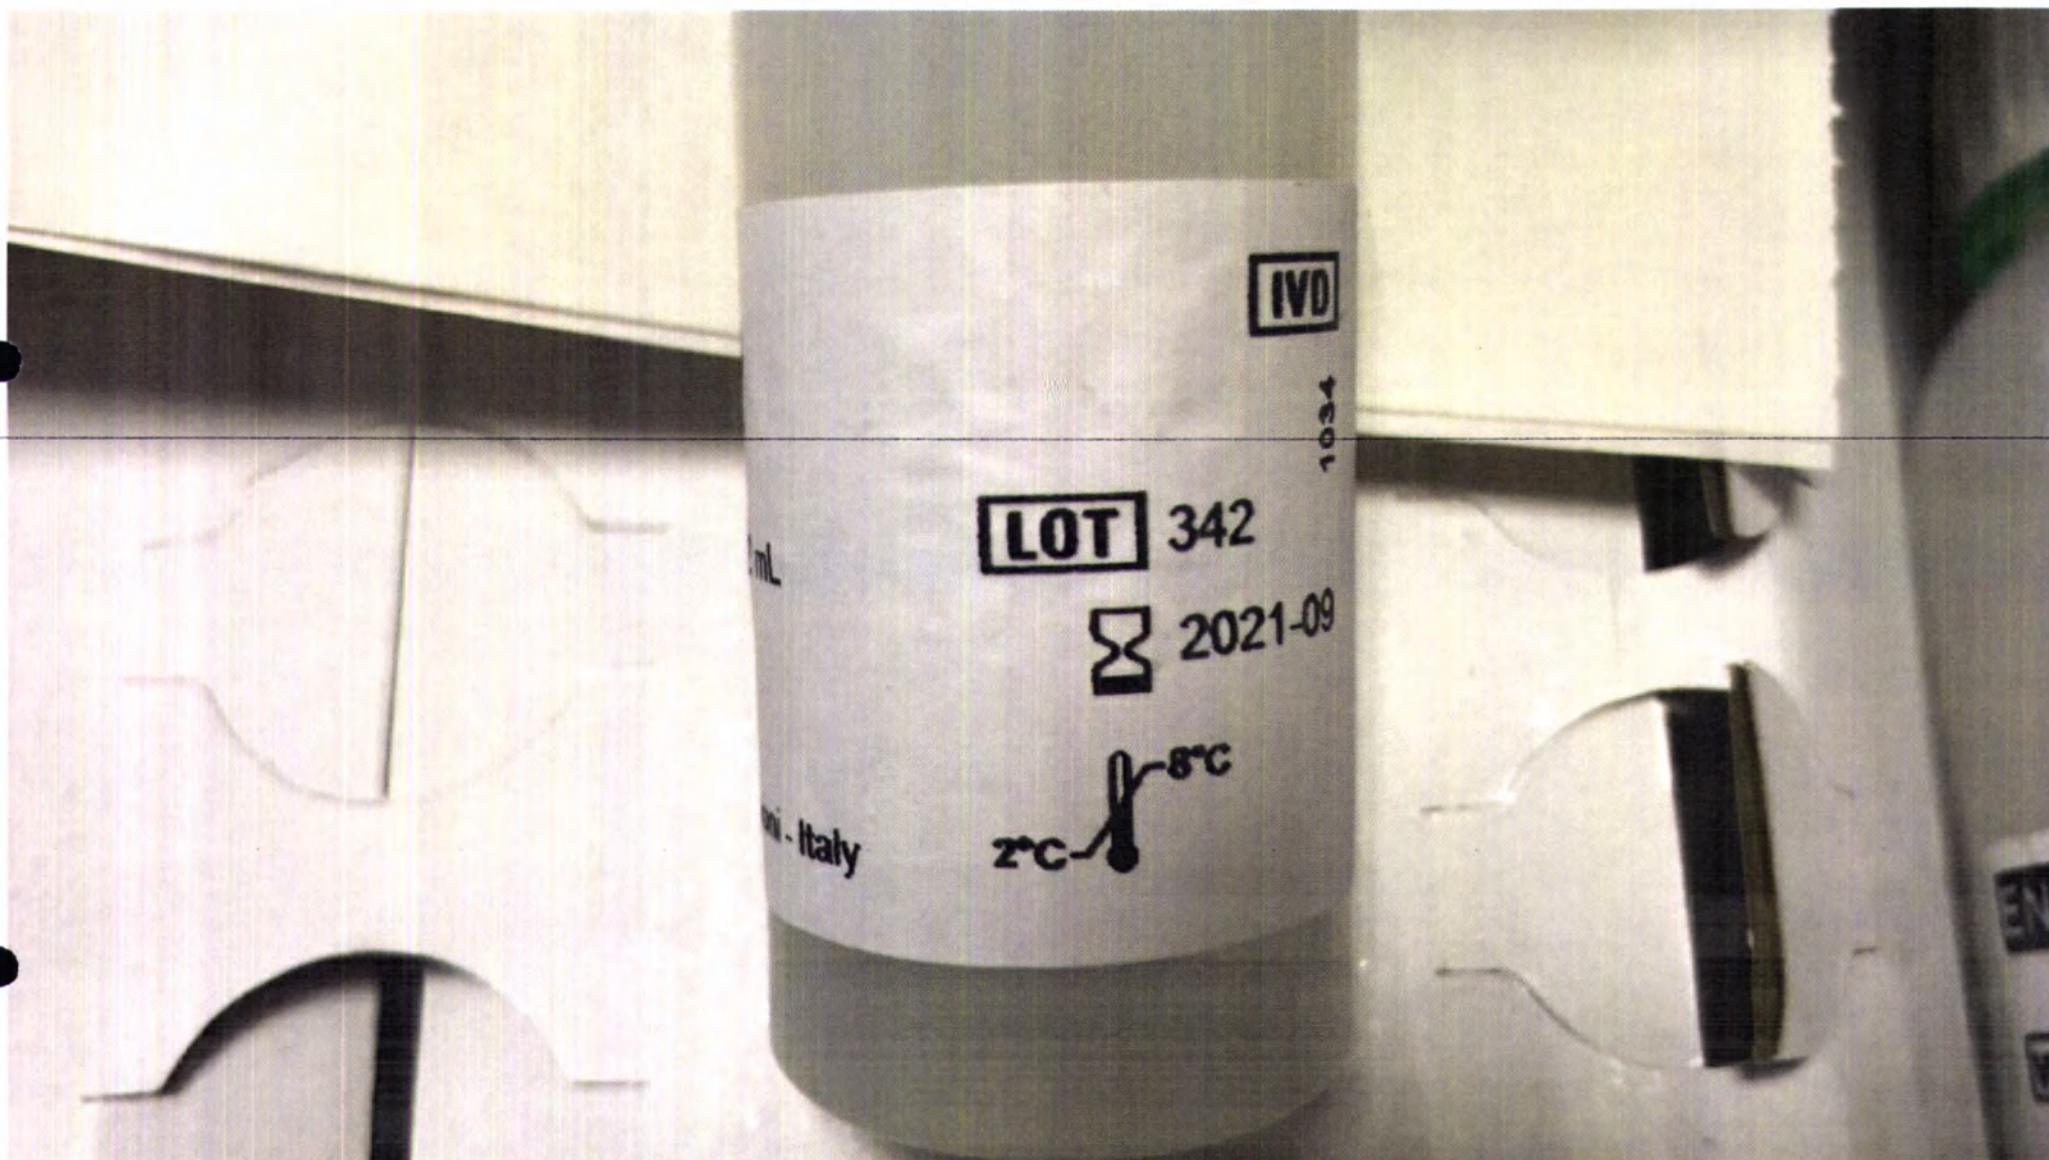

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.

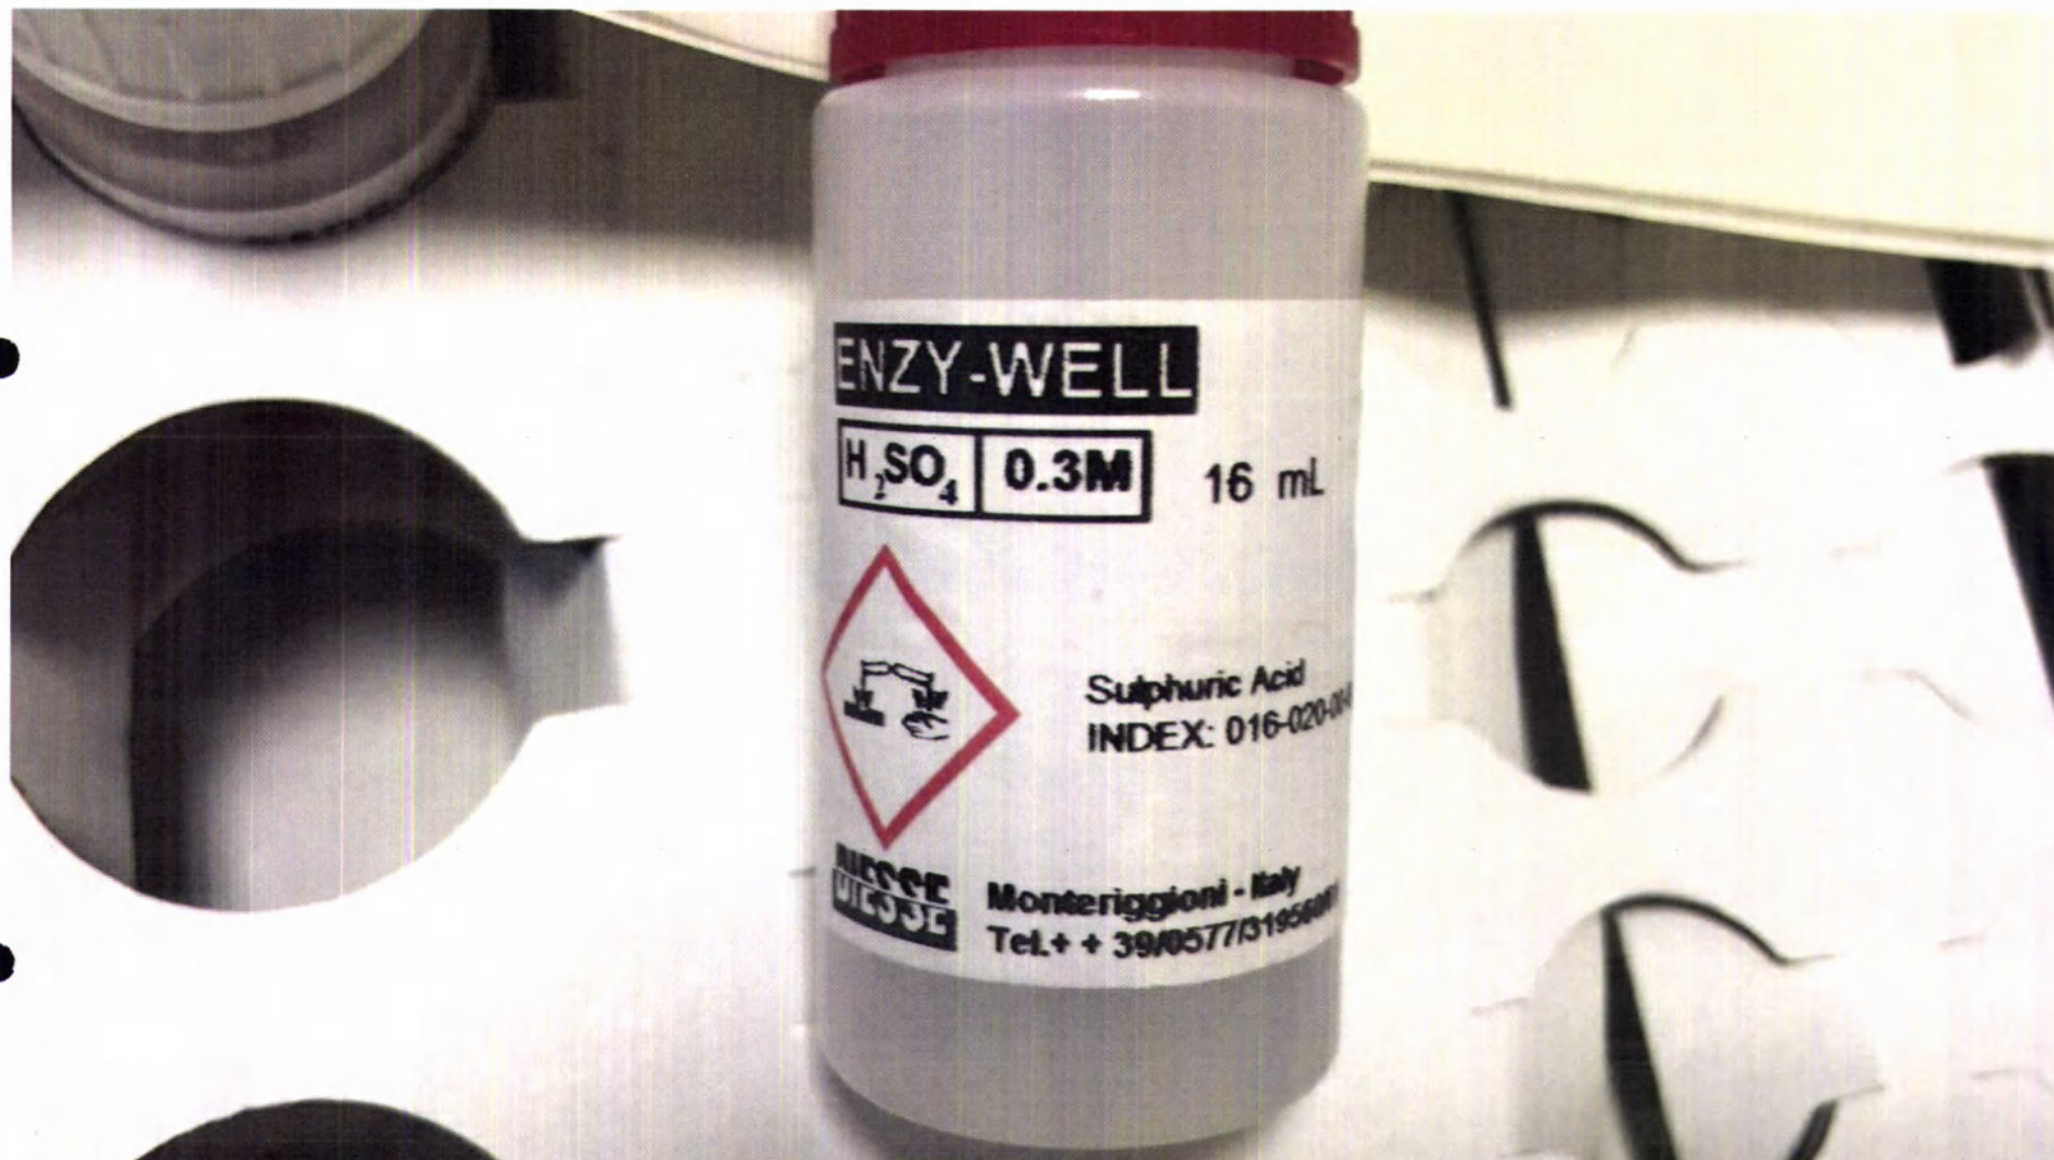

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 009. Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.

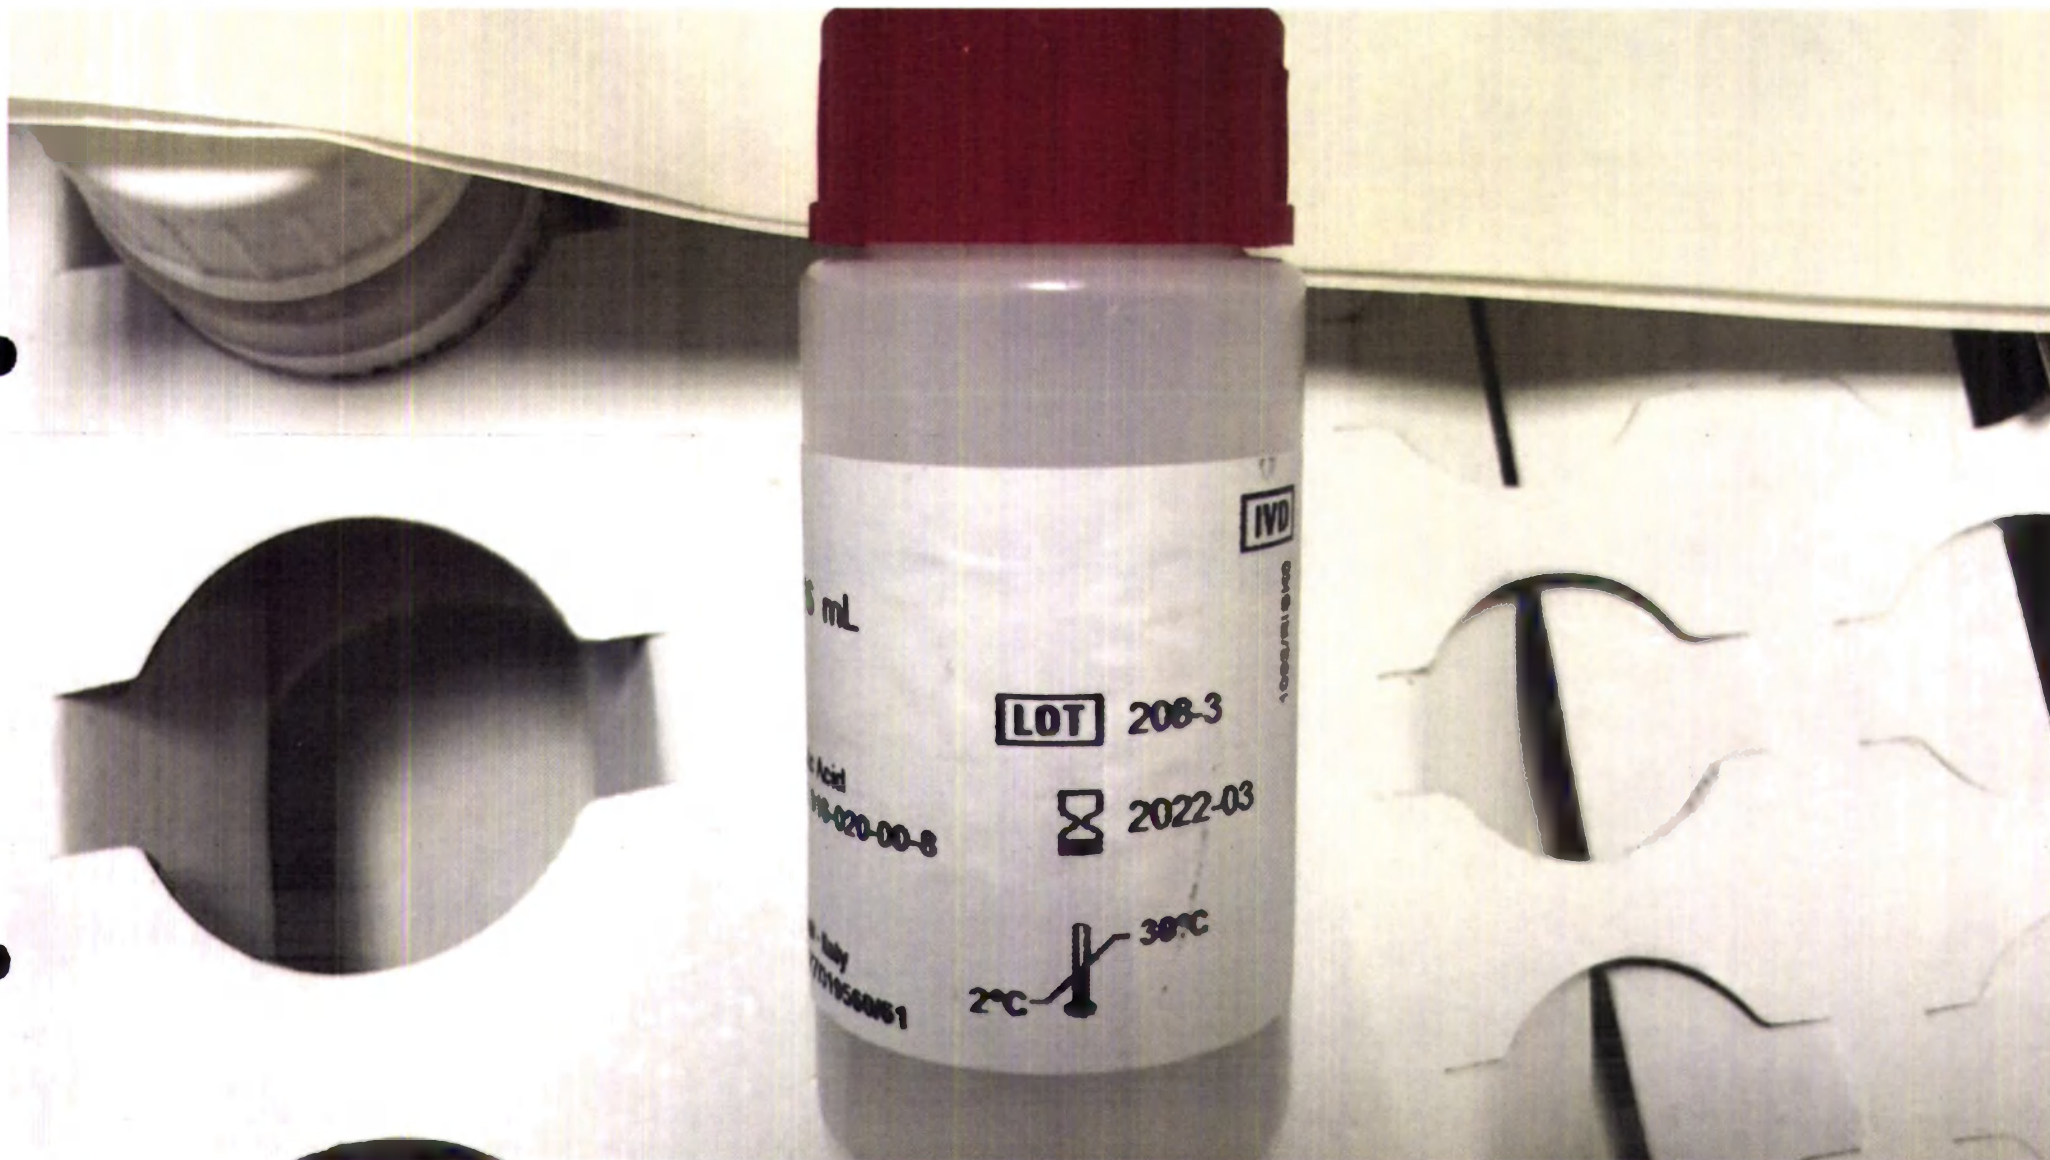

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009. Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.

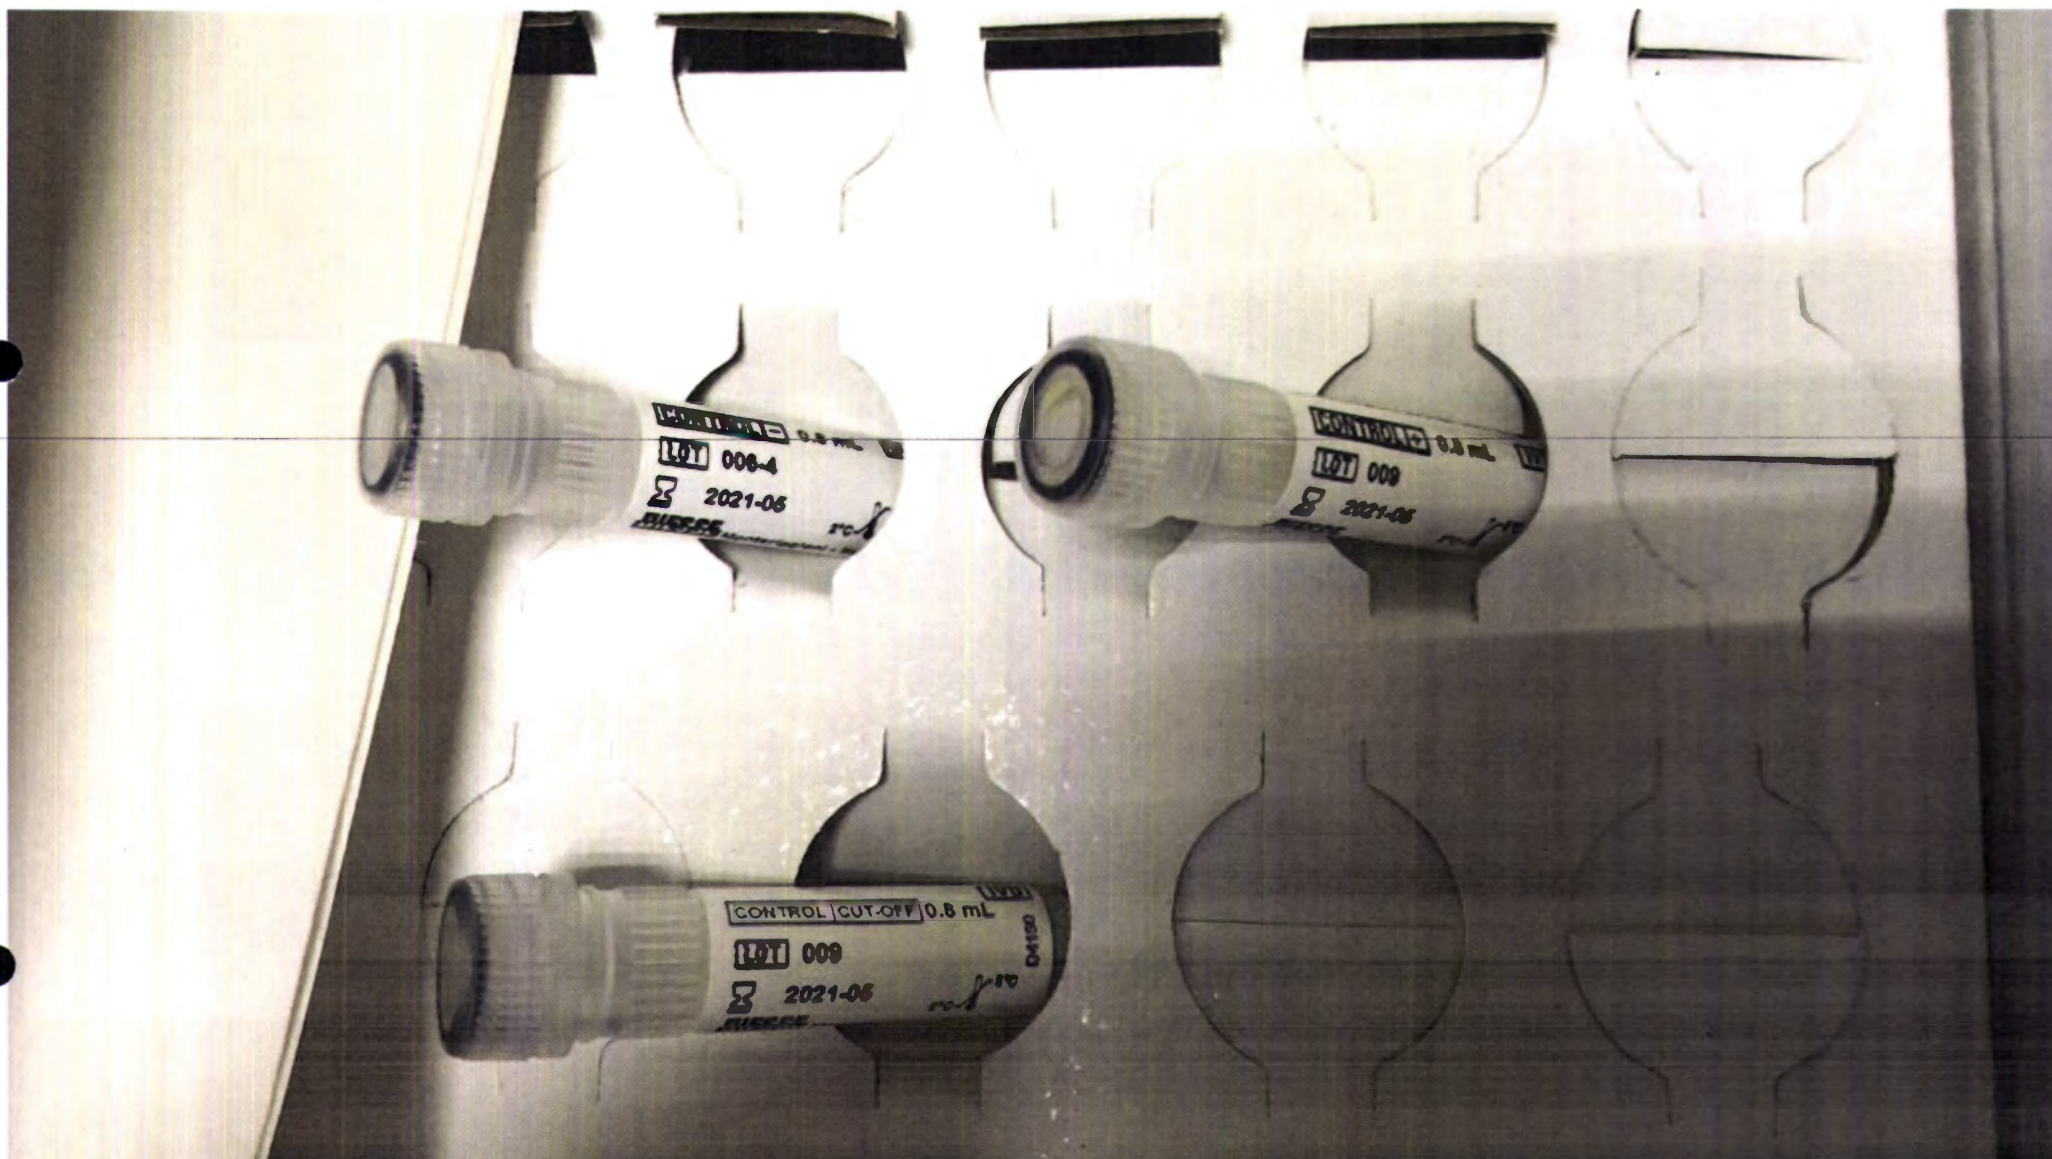

Набор реагентов для качественного определения антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgG) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 009.

Образец контрольный, отрицательный, 1 флакон – 0,8 мл.; Образец контрольный, положительный, 1 флакон – 0,8 мл.; Контроль Cut-off, 1 флакон – 0,8 мл.

Всего прошито и скреплено печатью
33 листов.

Генеральный директор ООО «КОРМЕЙ
РУСЛАНД»

Звонов А.В.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the General Director mentioned in the text.