




и принадлежности, необходимые для применения медицинского изделия по назначению

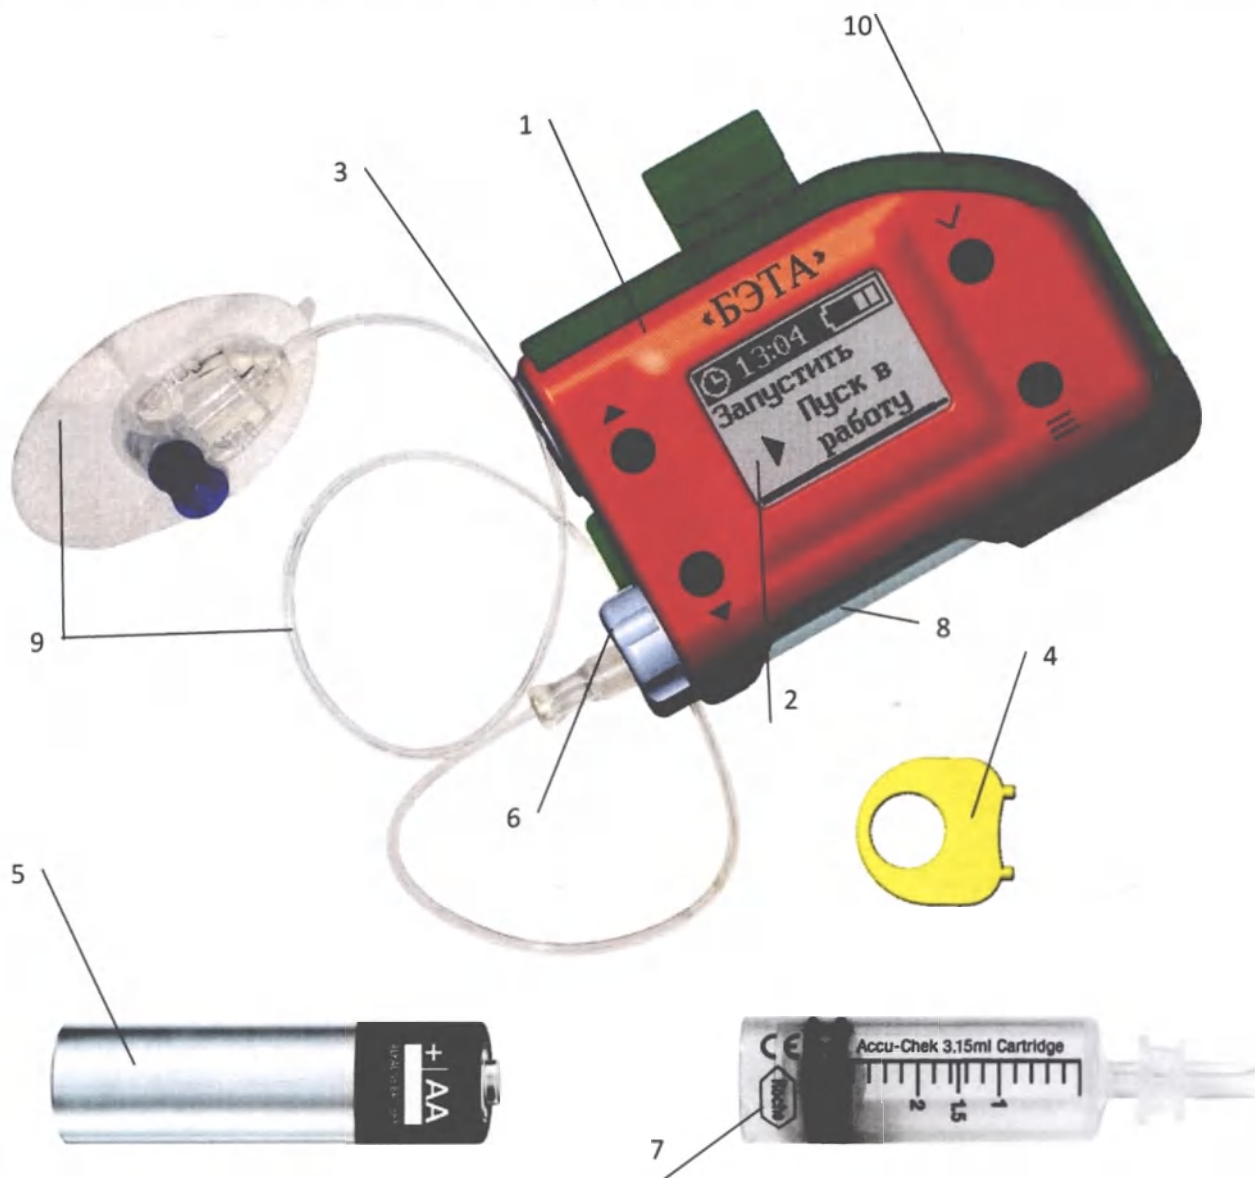

- ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

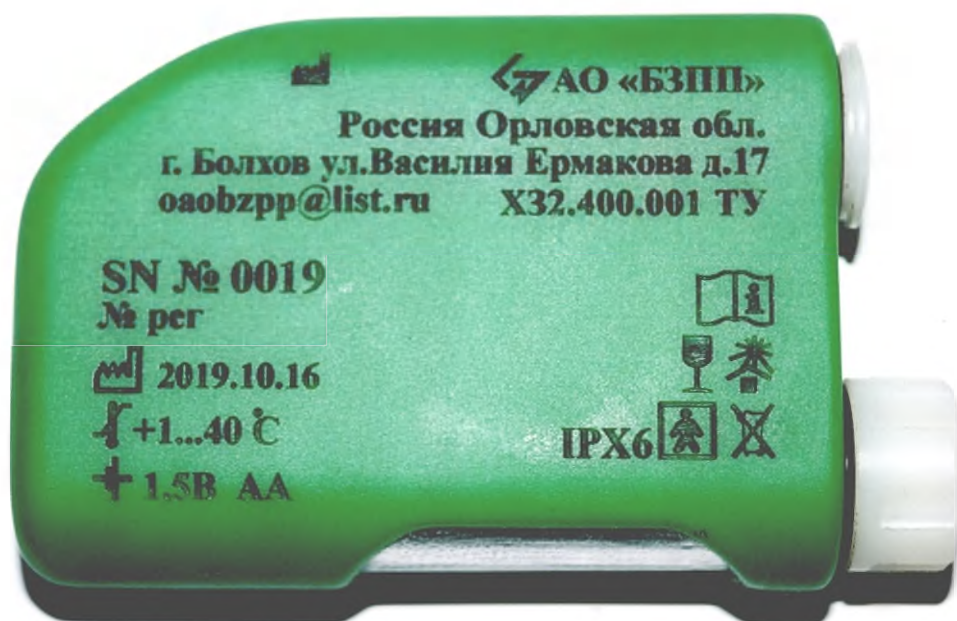

Общий вид Помпы инсулиновой "БЭТА"

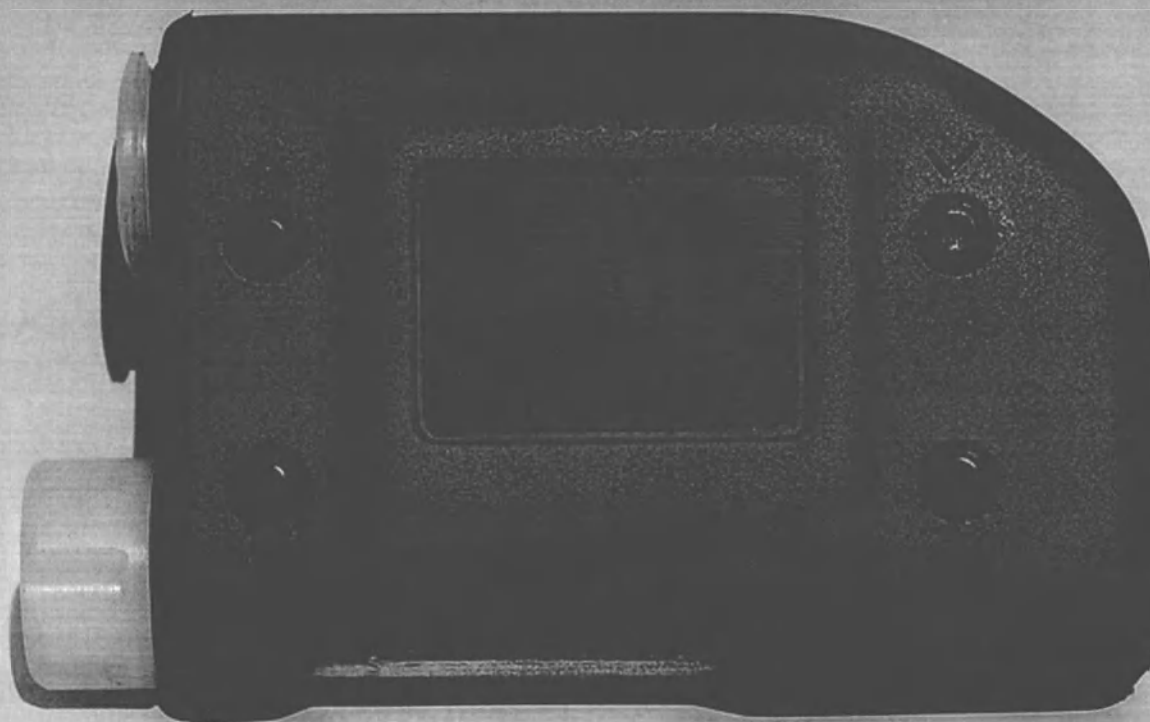

Помпа инсулиновая "БЭТА" по Х32.400.001 ТУ с принадлежностями

Крышка отсека элемента питания

Дисплей

Чехол для помпы с фиксатором




Картридж-система АККУ-ЧЕК Спирит для инсулина, 3,15 мл

Крышка для картридж системы

Окно резервуара



Ключ для крышки отсека элемента питания

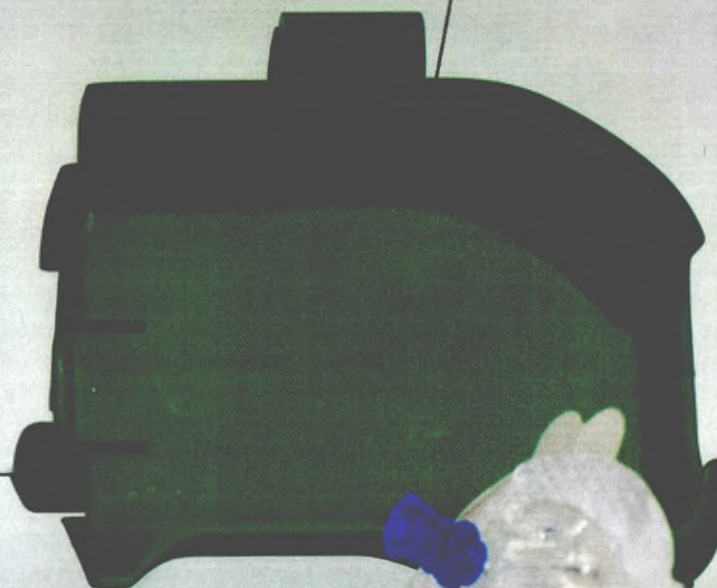


Элемент питания 1,5 В или 1,2 В (формфактор АА с емкостью не менее 2500мА/ч)




Набор инфузионный АККУ-ЧЕК Флекс.Линк I

Помпа инсулиновая "БЭТА" по Х32.400.001 ТУ в сборе

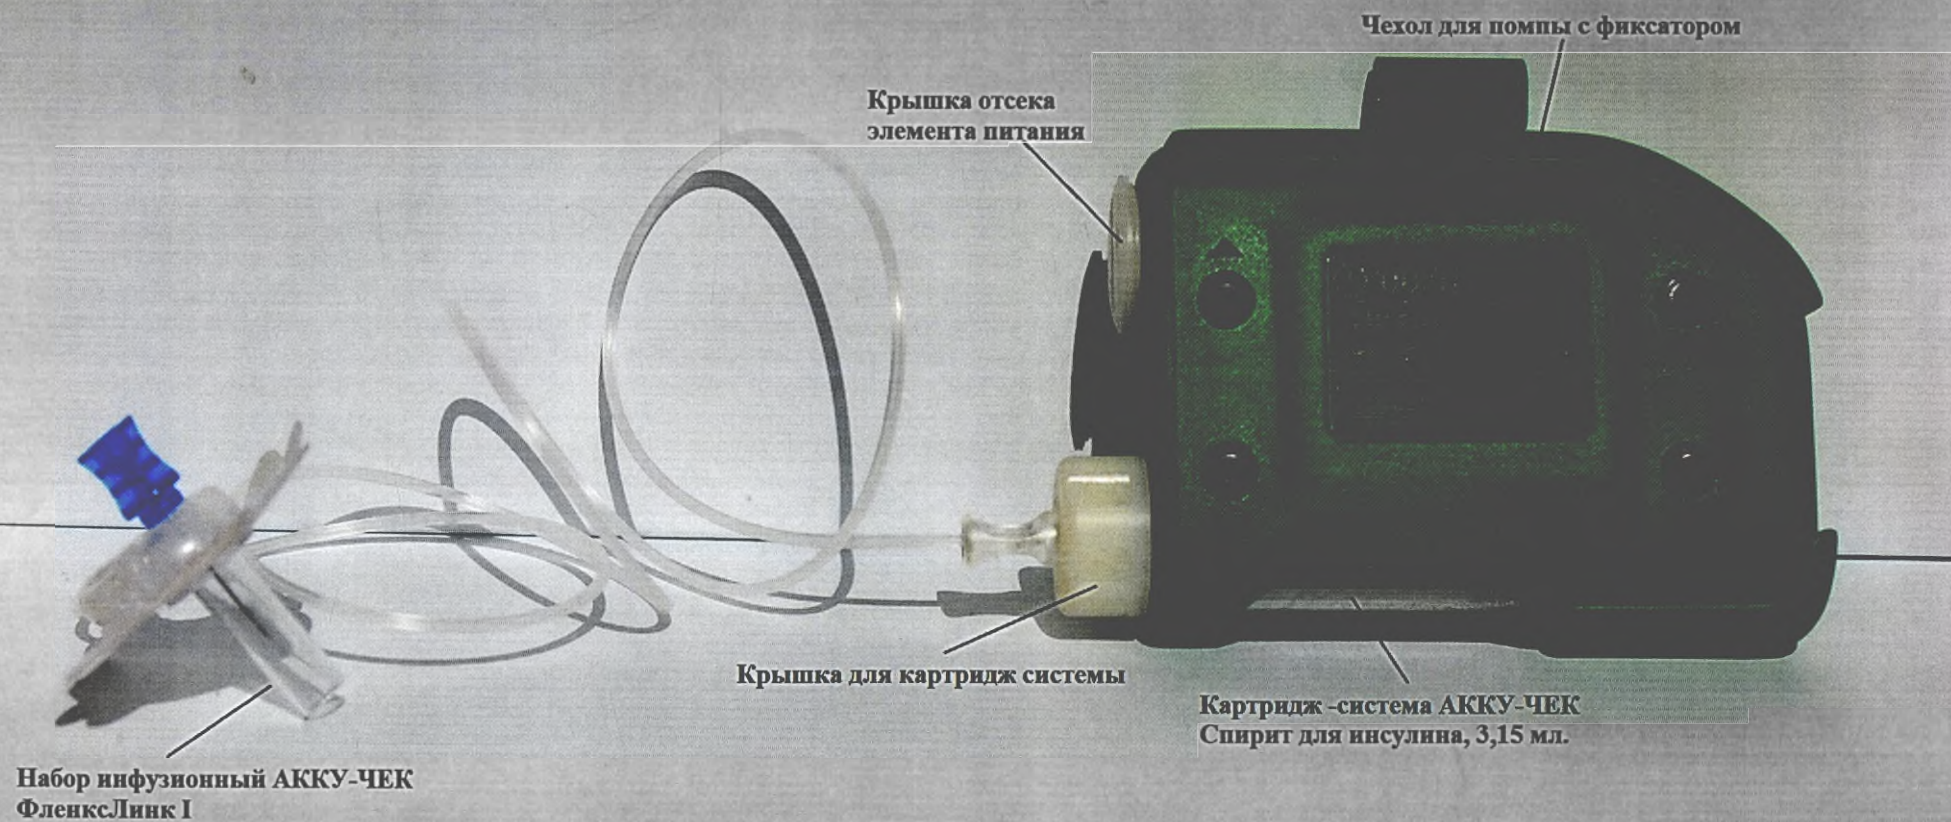

Маркировка Помпы инсулиновой "БЭТА" по Х32.400.001 ТУ

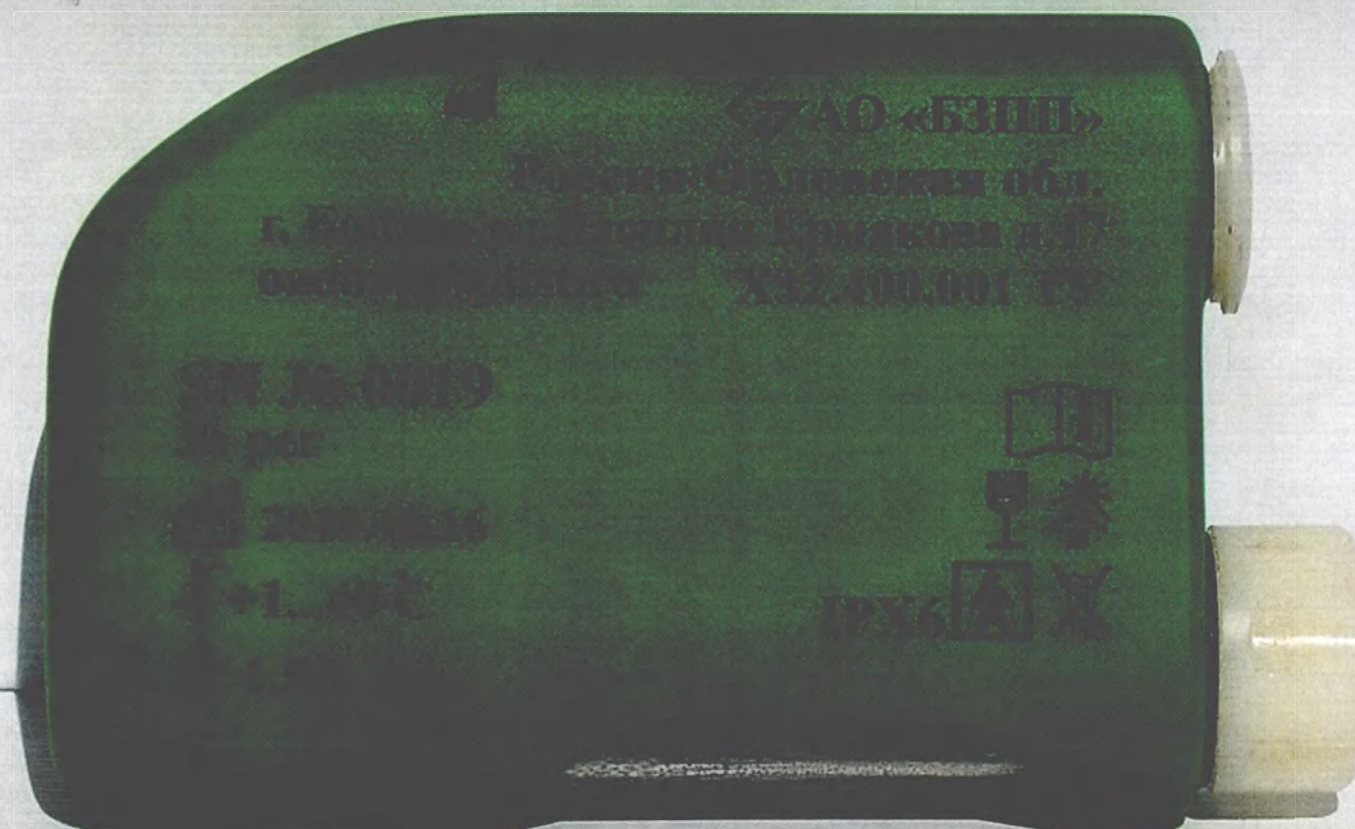

Упаковка потребительская (общий вид)



Упаковка потребительская (вид сзади)



Упаковка потребительская (верх)

БЭТА

insulin pump


помпа инсулиновая



Упаковка потребительская (вид спереди)

insulin pump

ПОМПА ИНСУЛИНОВАЯ

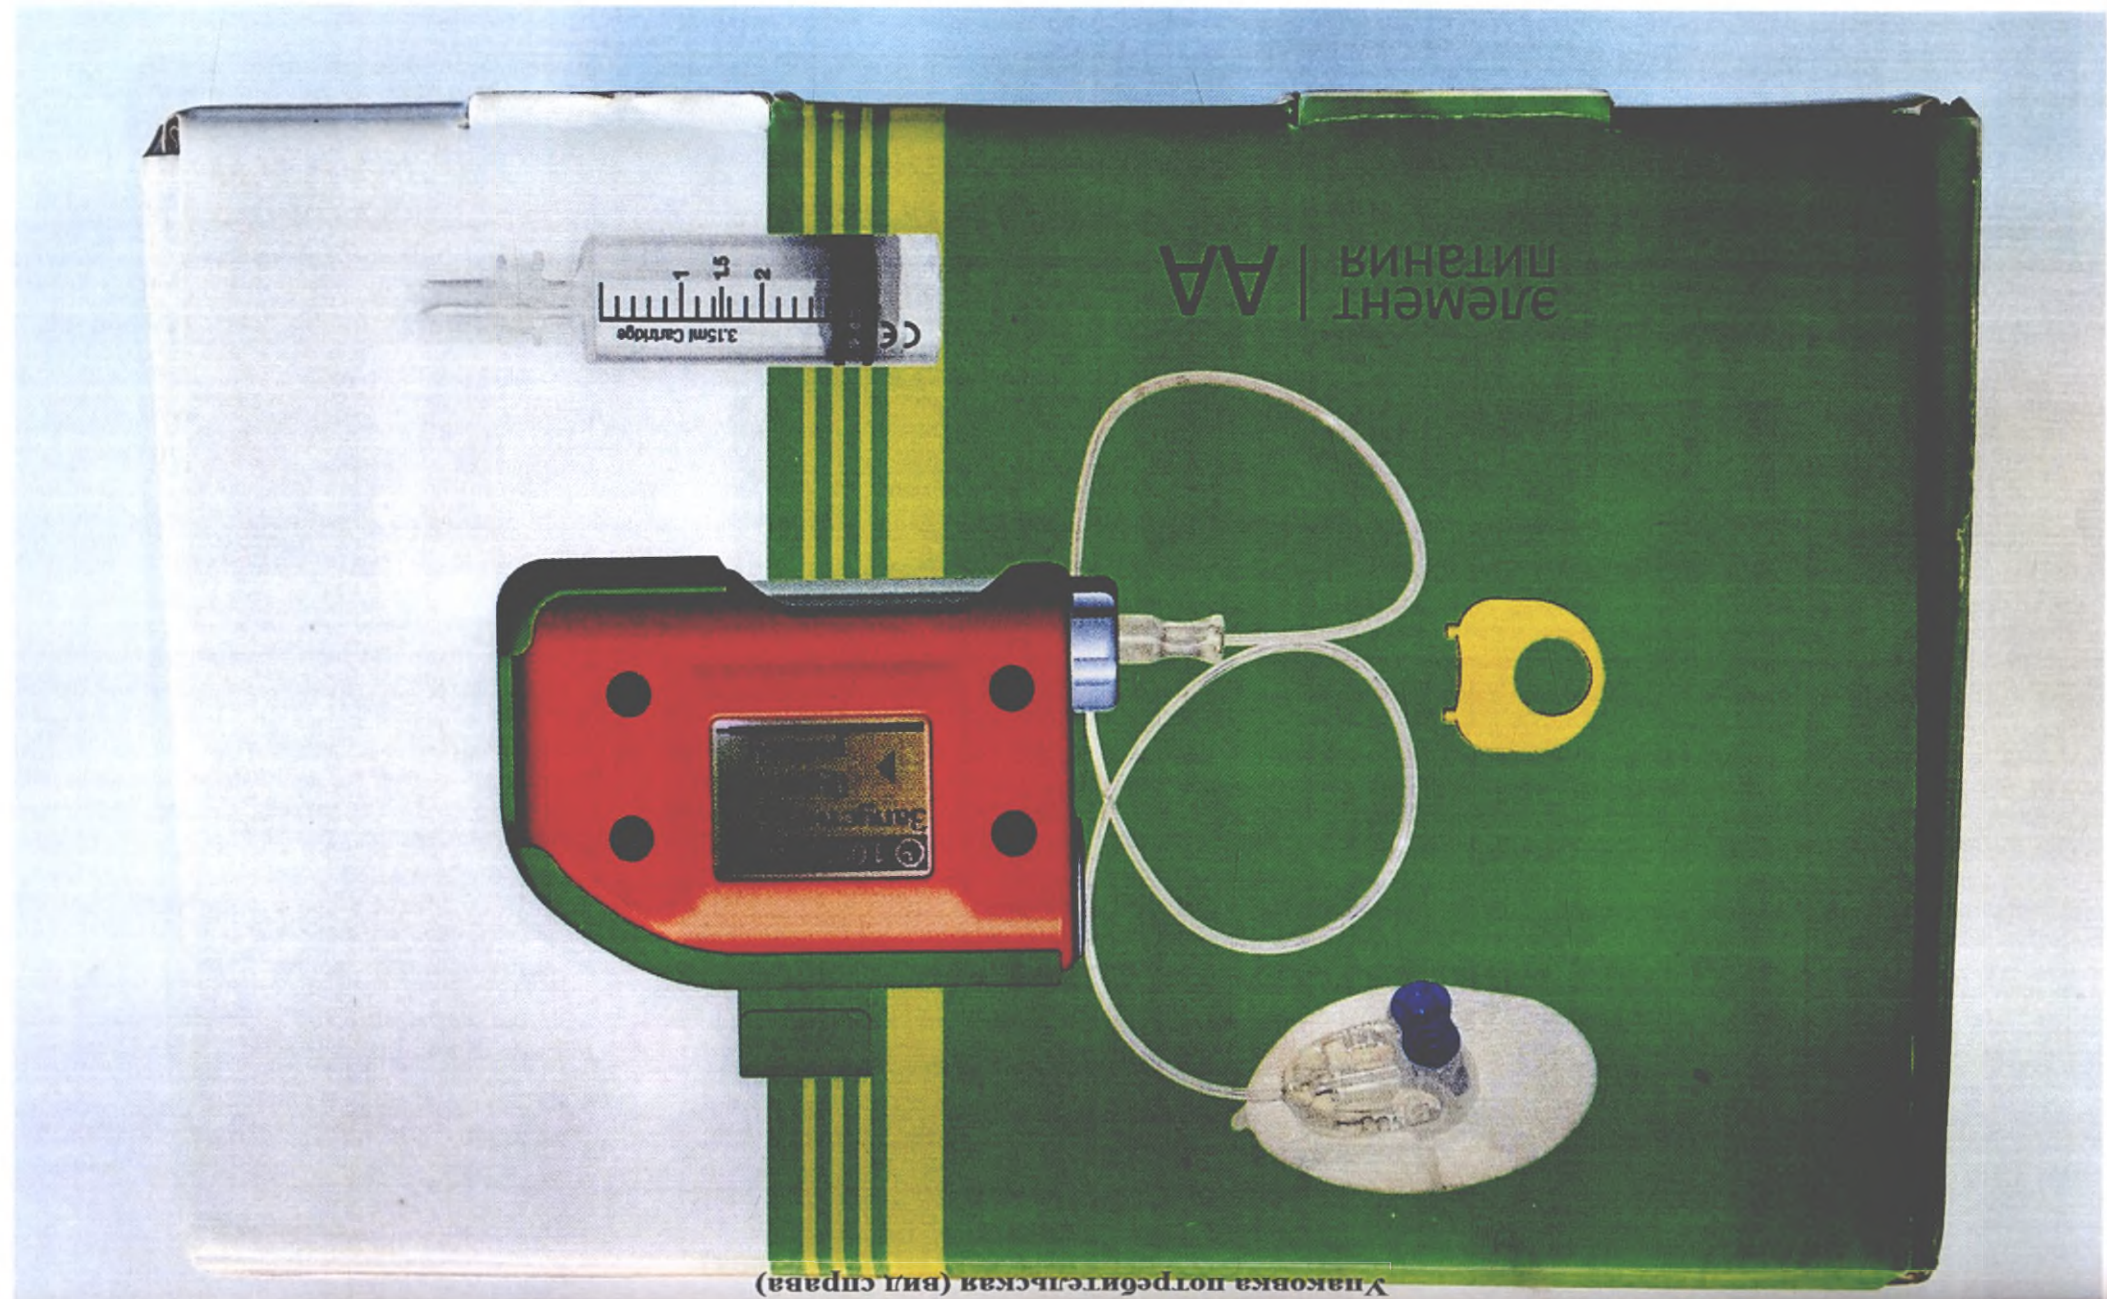

Упаковка потребительская (вкл. трубка)


Упаковка потребительская (вид слева)

SN 0019

2019-10-16

2022-04

№ пер




Красный

Желтый

Зеленый

Цвет изделия:

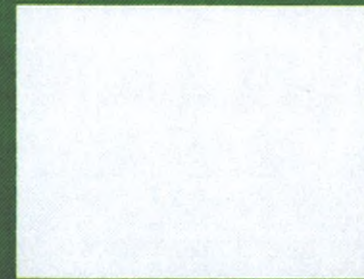

X32.400.001 TV

Тара транспортная (вид 1)



Тара транспортная (вид 2)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 12 (двенадцати) листах

Генеральный директор АО «БЗПП»

В.Н. Поярков

