


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:


"Дилуэнт образца для исследования с использованием реагентов, подтверждающих наличие HBsAg качественный II на иммунохимических анализаторах Alinity i "HBsAg качественный II Подтверждающий дилуэнт" (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографические изображения "Дилуэнт образца для исследования с использованием реагентов, подтверждающих наличие HBsAg качественный II, иммунохимических анализаторах Alinity i "HBsAg качественный II Подтверждающий дилуэнт" (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent)"

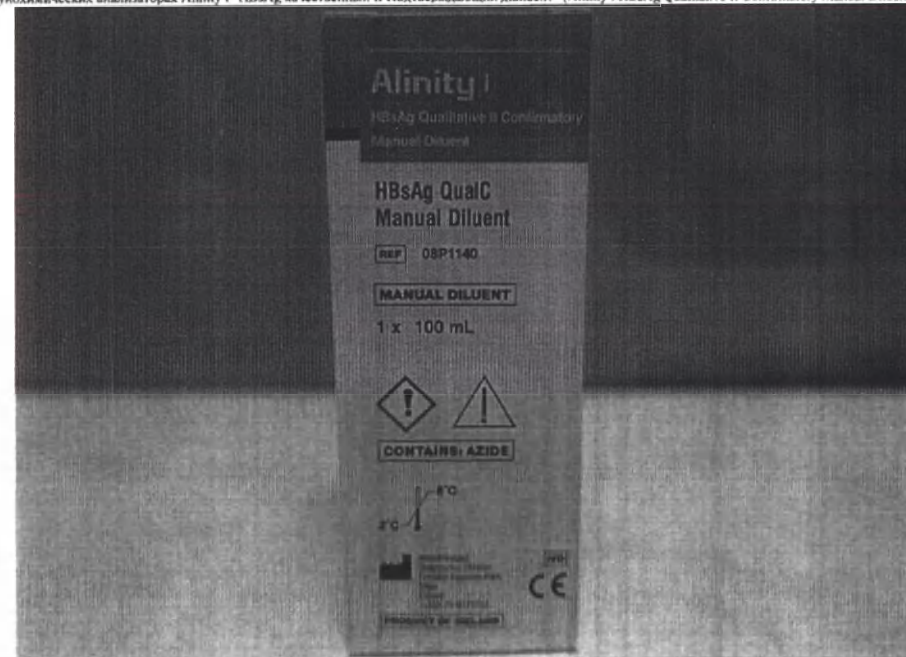

Фоторафинесне изображение "Диспергент образца для исследования с использованием рентгенов, подтверждающих наличие HBsAg качественной II (Alinity i HBsAg качественный II Подтверждающий диспергент" (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent) - научномедицинских лабораториях Alinity i "HBsAg качественный II Подтверждающий диспергент" (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent)

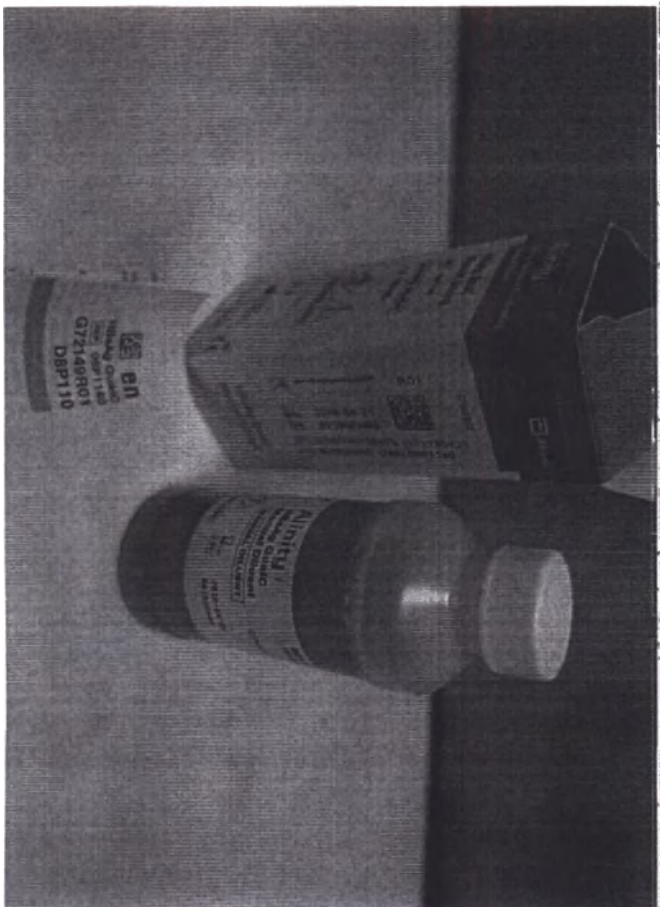

Фоторафинесне изображение "Диспергент образца для исследования с использованием рентгенов, подтверждающих наличие HBsAg качественной II (Alinity i HBsAg Qualitative II Подтверждающий диспергент" (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent) - научномедицинских лабораториях Alinity i "HBsAg качественный II Подтверждающий диспергент" (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent)

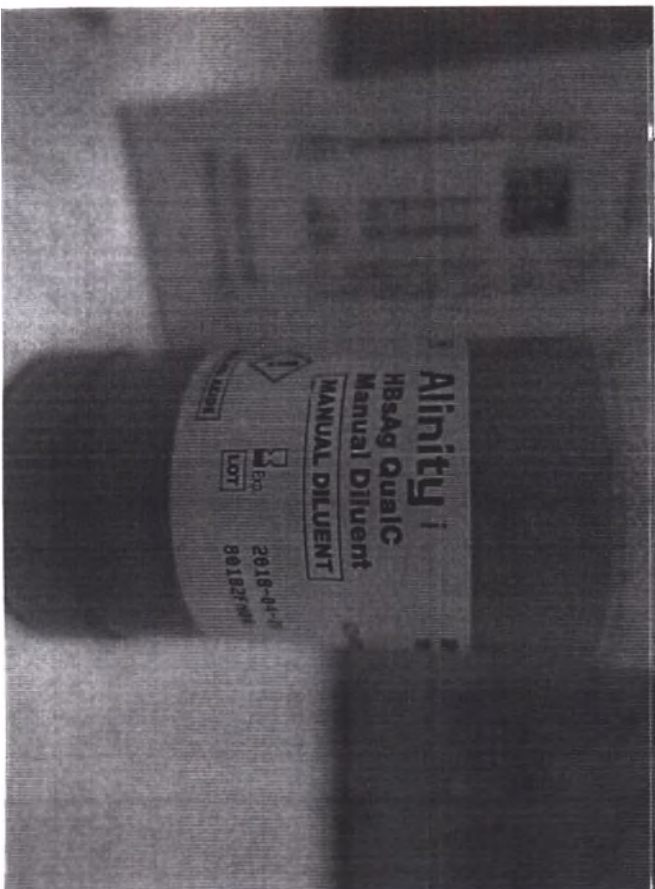

Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на _____
" 10.05.2020 " _____ лис

Макет маркировки на медицинское изделие

**Дилуэнт для ручного разведения образцов при исследовании наличия поверхностного
антигена вируса гепатита В с использованием набора HBsAg качественный II
Подтверждающие Реагенты на иммунохимических анализаторах Alinity i "HBsAg
качественный II Подтверждающий Дилуэнт (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory
Manual Diluent)"**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации:

		08P11-40		
---	---	----------	---	---



Дилуэнт для ручного разведения образцов при исследовании наличия поверхностного антигена вируса гепатита В с использованием набора HBsAg качественный II Подтверждающие Реагенты на иммунохимических анализаторах Alinity i "HBsAg качественный II Подтверждающий Дилуэнт (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent)"

Состав:

- Дилуэнт (Manual Diluent) – 1 x 100 мл,
Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostic Division, Finisklin Business Park Sligo, Ireland (Ирландия)
 РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкцию по применению на русском языке:
www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.
 Расшифровку графических символов см. в инструкции.
 Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.
 Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
 Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия

08P11-TF-40_Eng_POTe.indd 1 File: 08P11-TF-40_Eng_POTe.indd Template: Alinity_i_A_Manual Diluent.indd Size: 80 mm x 108 mm Drawing: AK4582 Refer to the drawing for stamp fields and material Text, Symbols: Black; Branding: PMS 376 c, Text reversed Warning Symbol: Border: Pantone 185 c / Inside border Symbol: Black Refer to site specific documents	Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent 	
	HBsAg QualC Manual Diluent  08P1140 MANUAL DILUENT 1 x 100 mL   CONTAINS: AZIDE   Abbott Ireland Diagnostics Division Finisklin Business Park Sligo Ireland +353-71-9171712 PRODUCT OF IRELAND	G70443R02     HBsAg QualC Manual Diluent



IVD

Alinity i
HBsAg QualC
Manual Diluent
MANUAL DILUENT

08P11P
100 mL


G70450R01



ABBOTT



CONTAINS: AZIDE



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
3 (три) _____ листах

