


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ДИАКОН»
И.Е. Карпова
2019г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Анализатор автоматический биохимический iMagic-S7 с принадлежностями»

Анализатор автоматический биохимический iMagic-S7 с принадлежностями

I. Анализатор автоматический биохимический iMagic-S7, в составе:

1. Анализатор автоматический биохимический (Automatic Chemistry Analyzer) – 1 шт.
2. Установочный диск с ПО (Installation disk) – 1 шт.
3. Сетевой кабель (Power cable) – 1 шт.
4. Провод заземления (Earthing wire) – 1 шт.
5. RS 232 последовательный серийный кабель (USB serial line) – 1 шт.
6. Сканер штрих-кодов (Barcode reader) – 1 шт. – при необходимости
7. Флакон для реагента (Reagent bottle) – 50 шт.
8. Крышка для флакона реагента (Reagent bottle cap) – 50 шт.
9. Белые винтовые крышки Ф10 (White Ф10 cap screw) – 4 шт.
10. Чашечка для образца (Sample cup) – 100 шт.
11. Дополнительные блоки для образцов (Additional blocks) – 20 шт. – при необходимости
12. Трубка для слива отходов (Waste Water pipe) – 1 шт. – при необходимости
13. Трубка (Pipeline) – 6 шт.
14. Емкость для деионизированной воды (Deion Bucket) – 1 шт. – при необходимости
15. Емкость для сливной жидкости (Waste Bucket) – 1 шт. – при необходимости
16. Компоненты крышки емкости детергента (Detergent bottle cap components) – 2 шт. – при необходимости
17. Датчик уровня деионизированной воды (Deion water level sensor) – 1 шт. – при необходимости
18. Датчик уровня сливной жидкости (Waste water level sensor) – 1 шт. – при необходимости
19. Внутренняя трубка для перистальтического насоса (Peristaltic pump inlet pipe) – 2 шт. – при необходимости
20. Лампа (Lamp) – 1 шт. – при необходимости
21. Очищающий раствор (Cleanser for chemistry analyzer) – 1 шт. – при необходимости
22. Руководство по эксплуатации (Operation manual) – 1 шт.
23. Краткая инструкция по работе (Quick Operation card) – 1 шт.


II. Принадлежности к анализатору автоматическому биохимическому iMagic-S7:

1. Предохранитель (Fuse (F5AL, 250V)) – 2 шт.
2. Крестовая отвертка (6*38) (Cross screwdriver (6*38)) – 1 шт.
3. Фильтр (Filter) – 2 шт.
4. Иглы для очистки пробоотборника (Acupuncture needles) – 1 шт.
5. Приспособление для удаления пузырьков (Bubble exhaust tool) – 1 шт.
6. Кювета (Cuvette) – 96 шт.


1. Анализатор автоматический биохимический (Automatic Chemistry Analyzer)




1. Анализатор автоматический биохимический (Automatic Chemistry Analyzer)

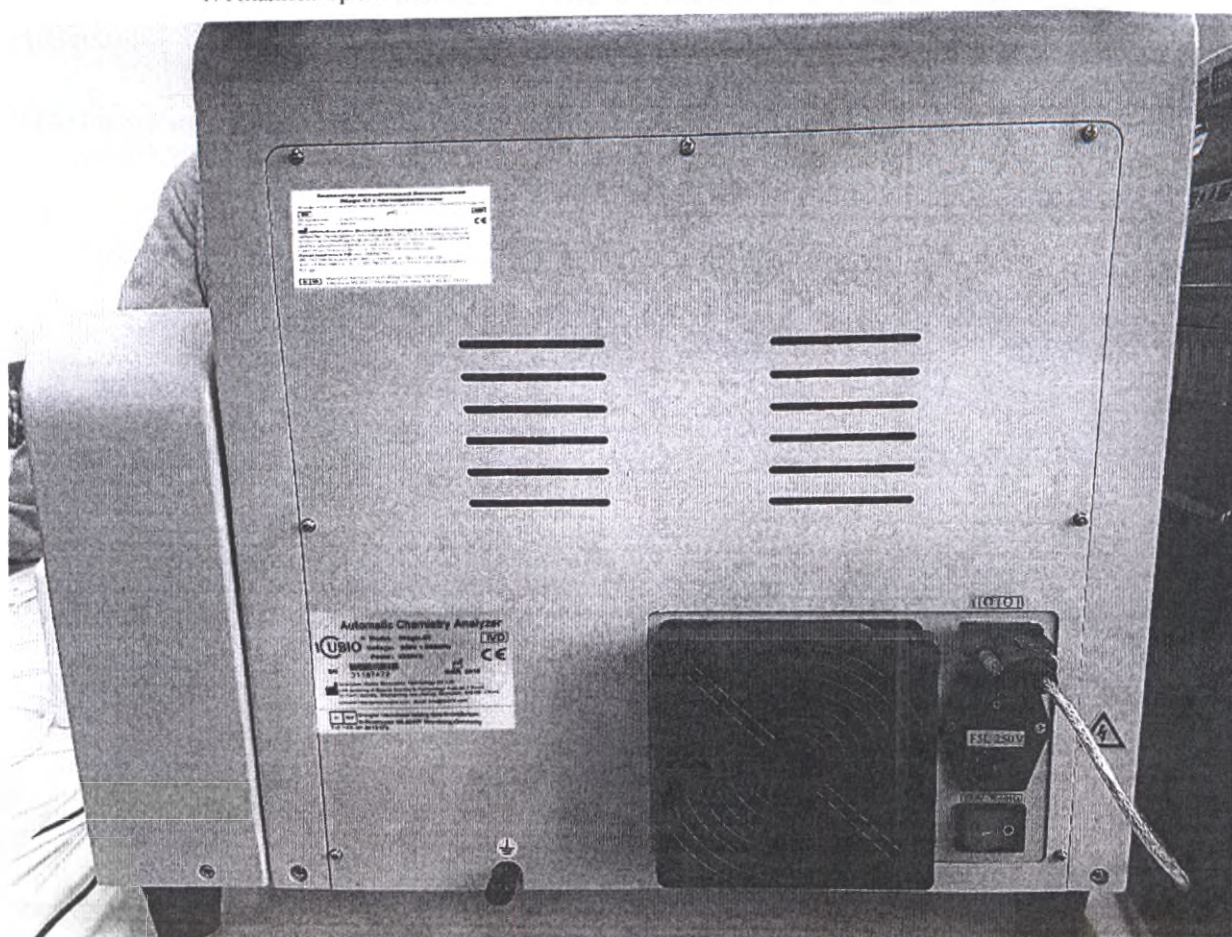

2. Установочный диск с ПО (Installation disk)

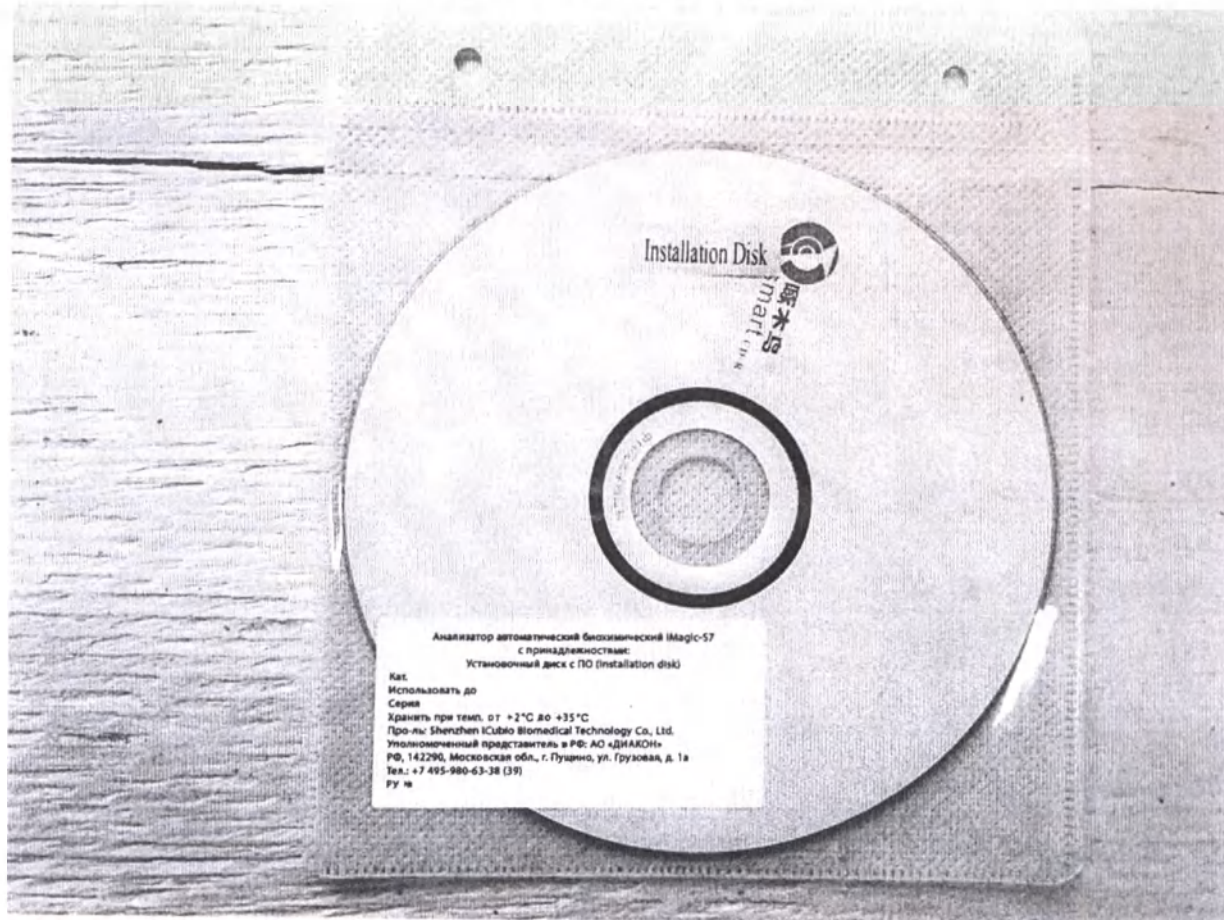

3. Сетевой кабель (Power cable)

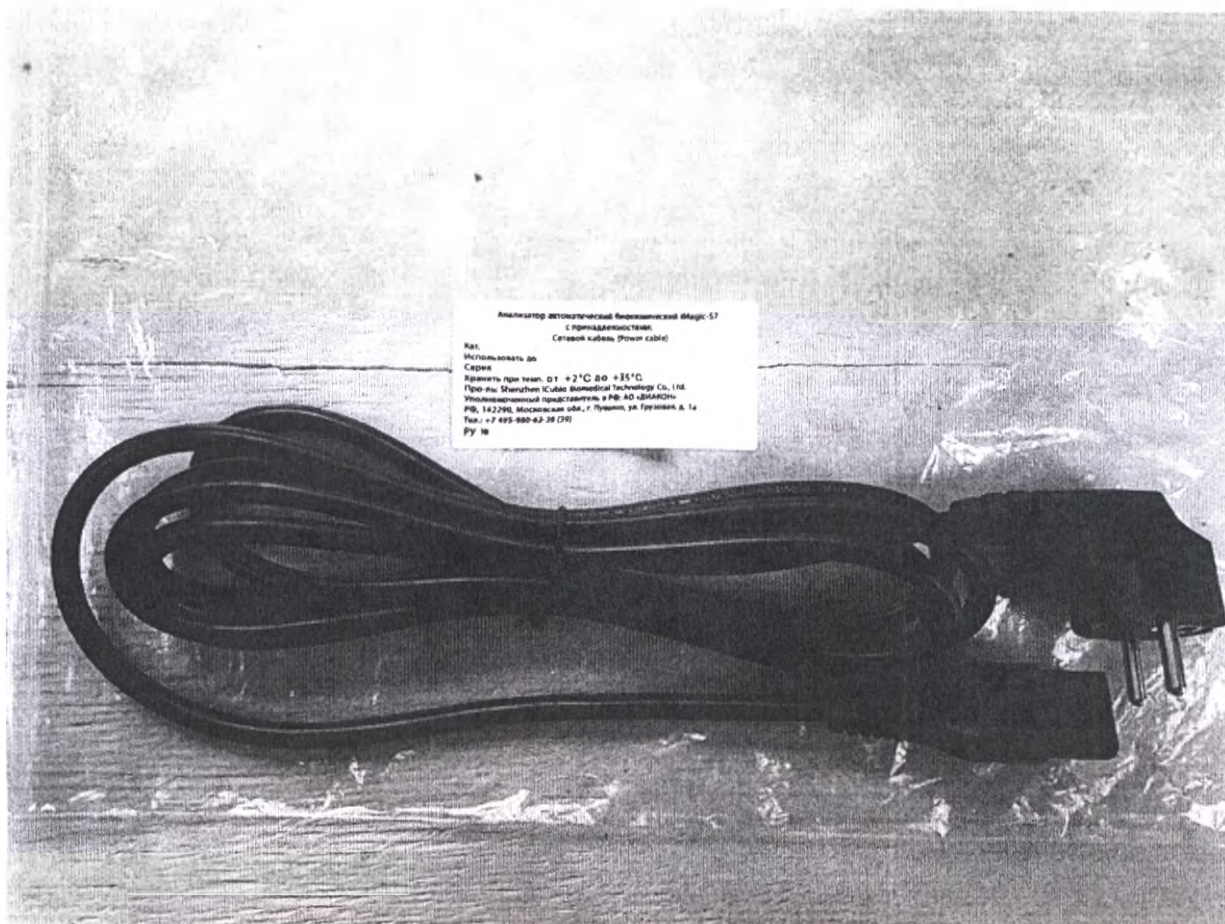


4. Провод заземления (Earthing wire)




Анализатор автоматический биомедицинский Magic-57
с принадлежностями
Провод заземления (Earthing wire)
Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Про-м. Shoniken Cyber Biomedical Technology Co., Ltd.
Уполномоченный представитель в РФ АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495 980 63 38 (30)
RU 18

5. RS 232 последовательный серийный кабель (USB serial line)

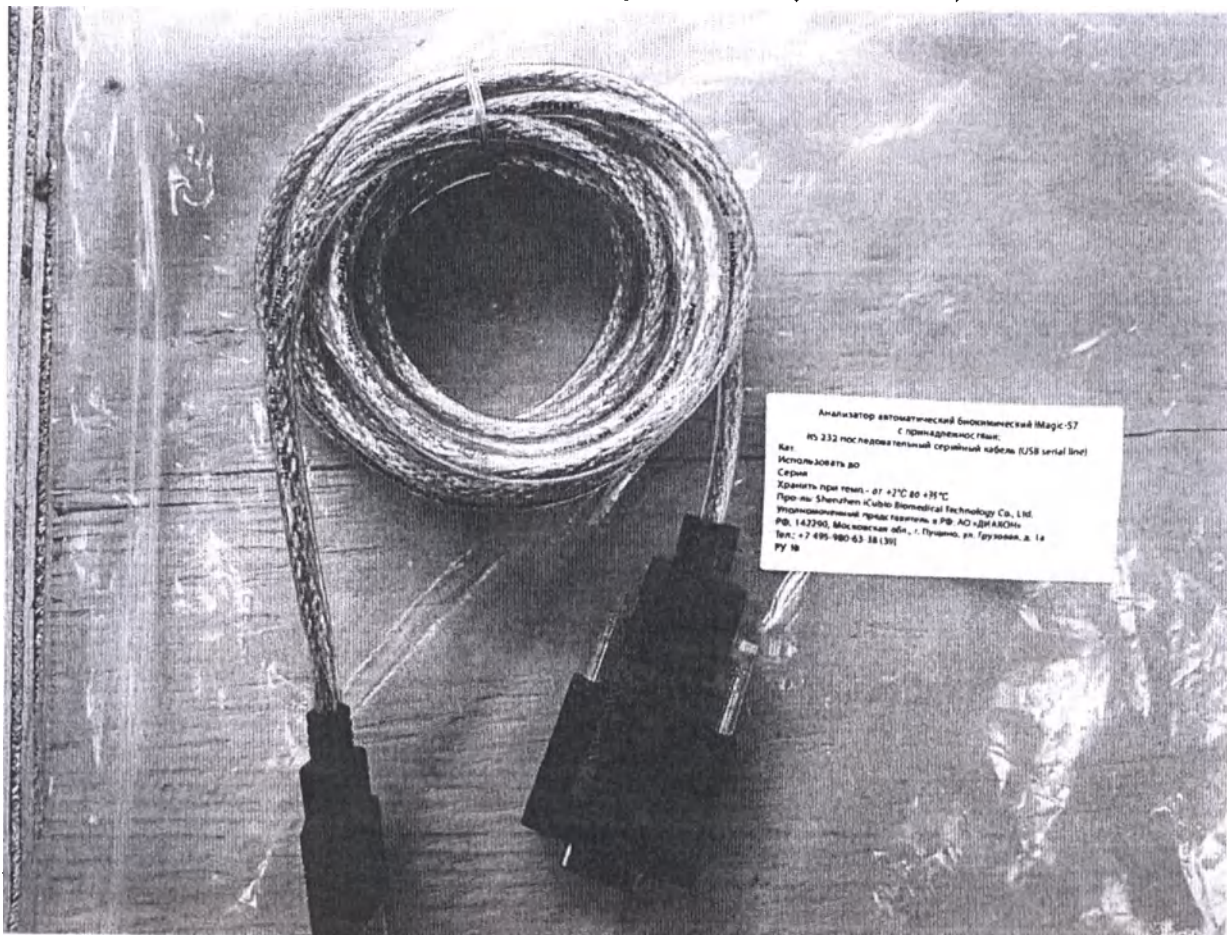


Анализатор автоматический биомедицинский Magic-57
с принадлежностями
RS 232 последовательный серийный кабель (USB serial line)
Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Про-м. Shoniken Cyber Biomedical Technology Co., Ltd.
Уполномоченный представитель в РФ АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495 980 63 38 (30)
RU 18


6. Сканер штрих-кодов (Barcode reader)

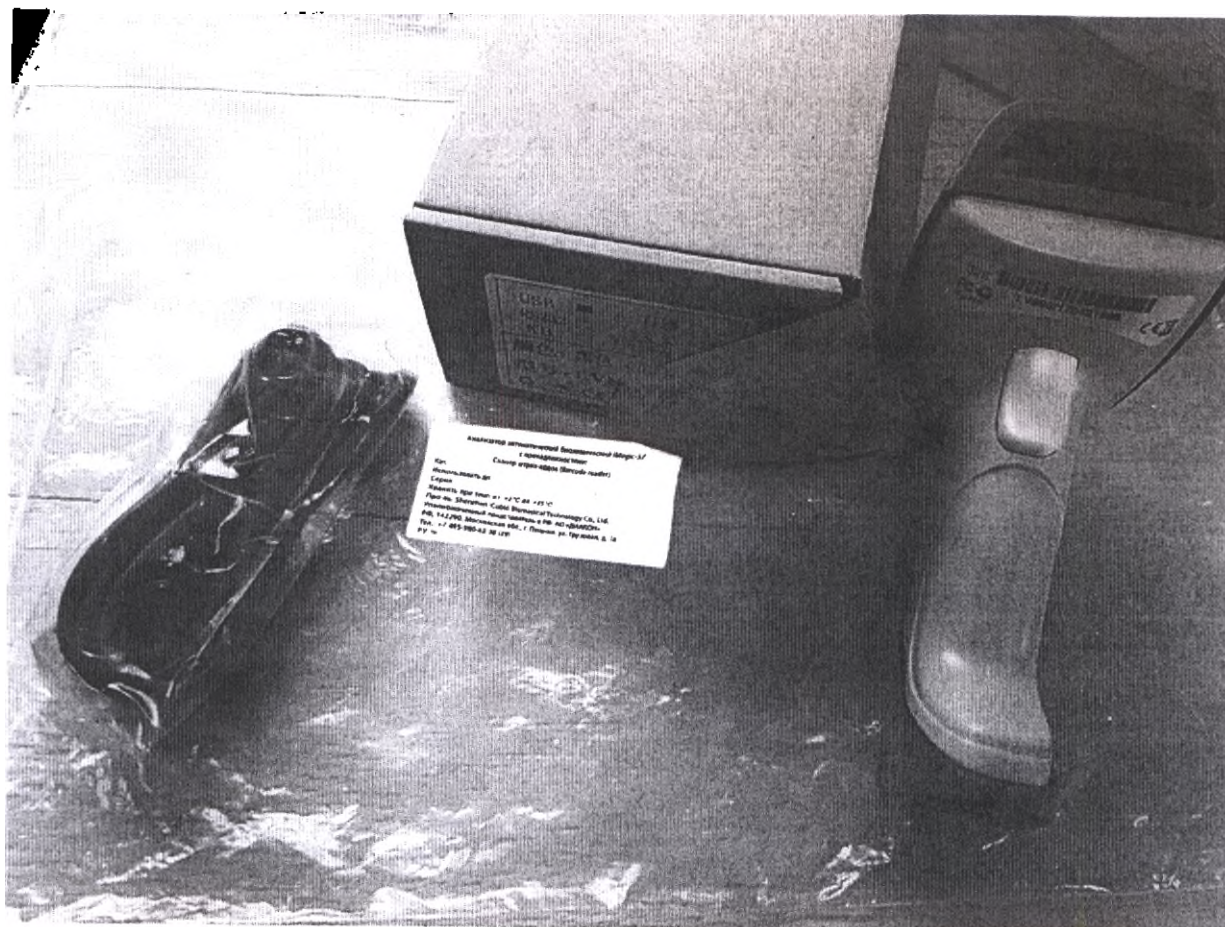


7. Флакон для реагента (Reagent bottle)

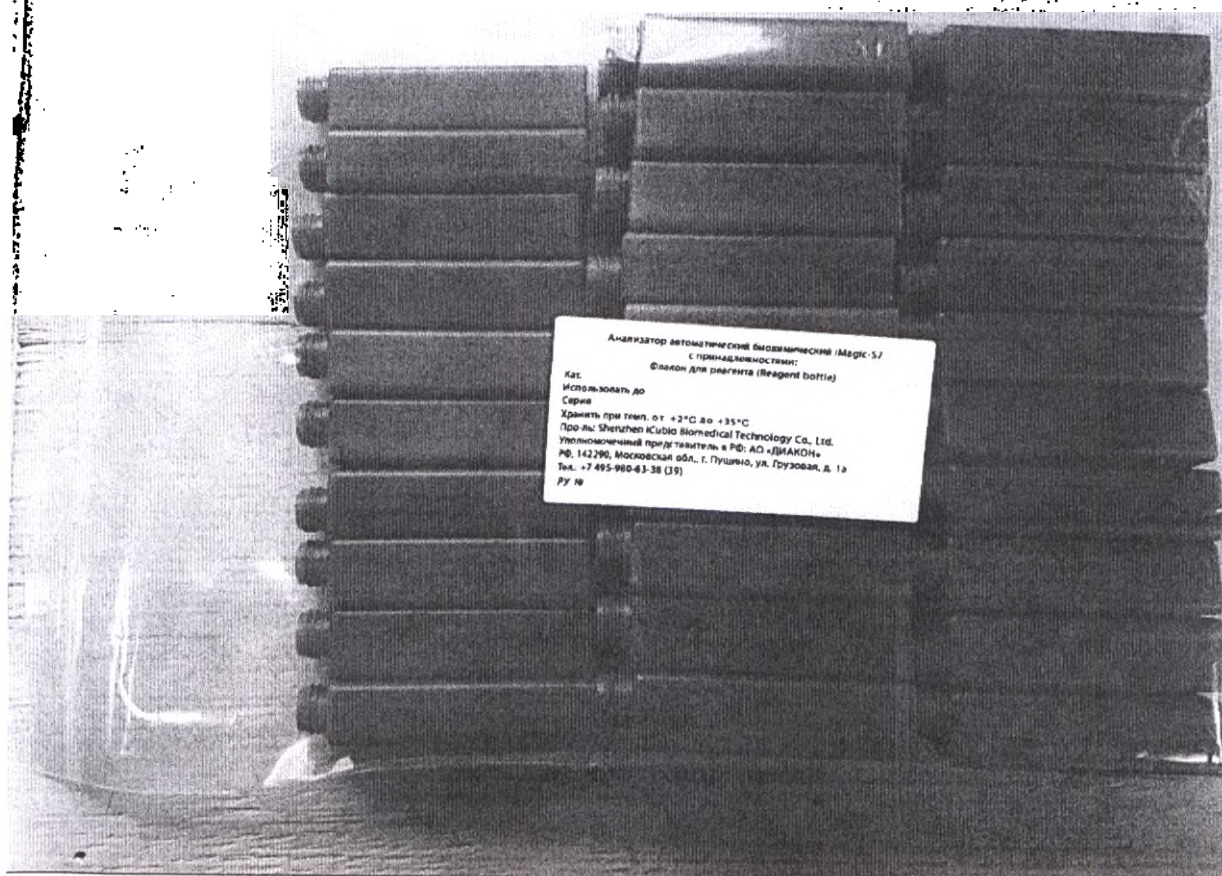

8. Крышка для флакона реагента (Reagent bottle cap)

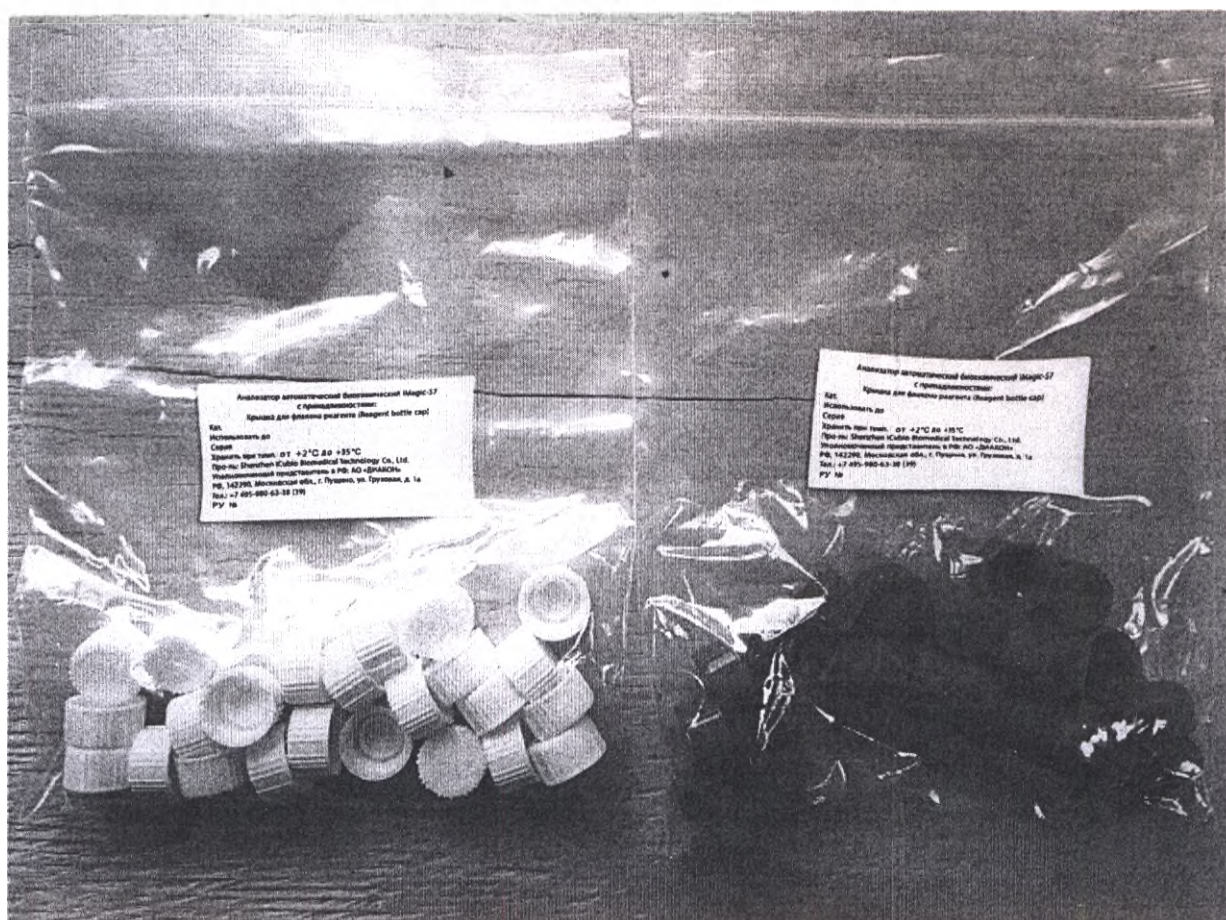


9. Белые винтовые крышки Ф10 (White Ф10 cap screw)

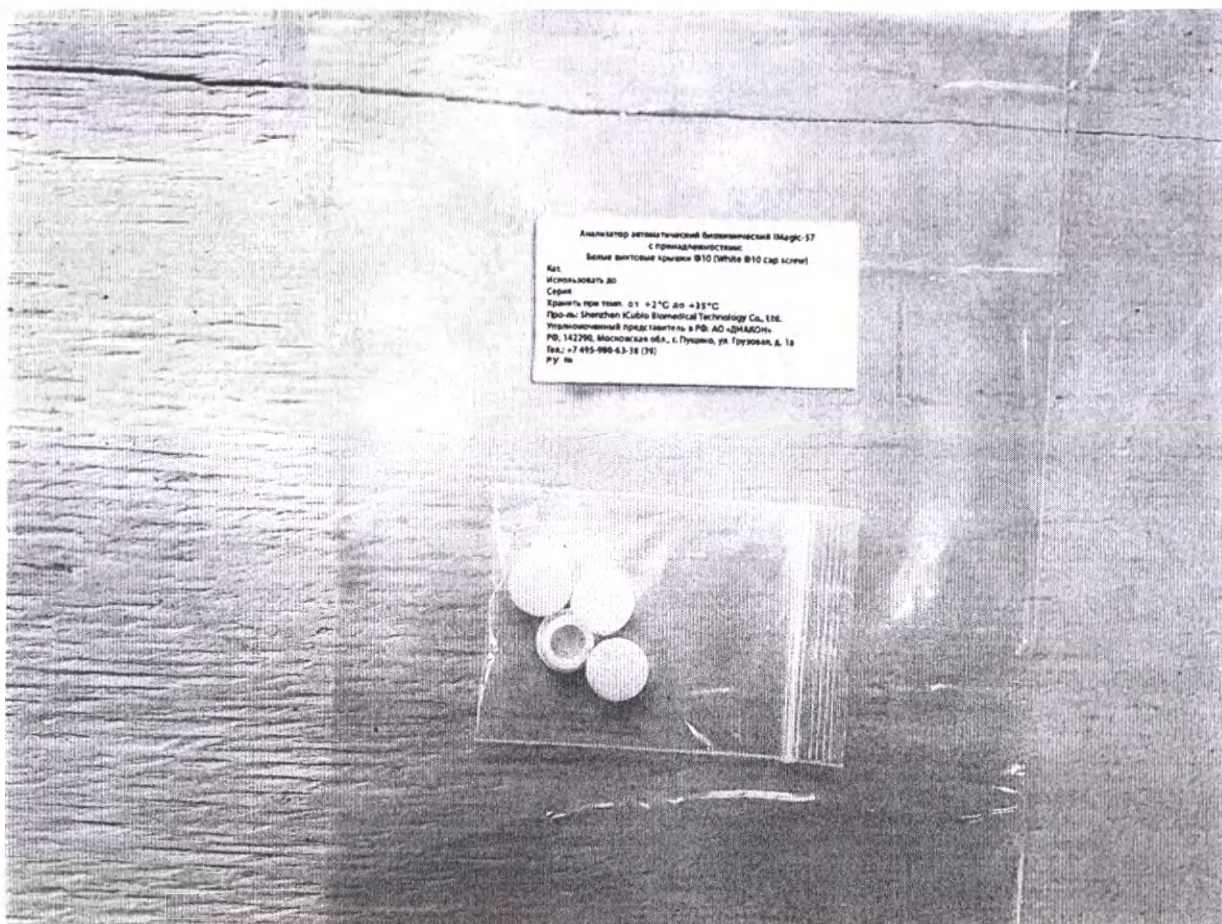


10. Чашечка для образца (Sample cup)




11. Дополнительные блоки для образцов (Additional blocks)

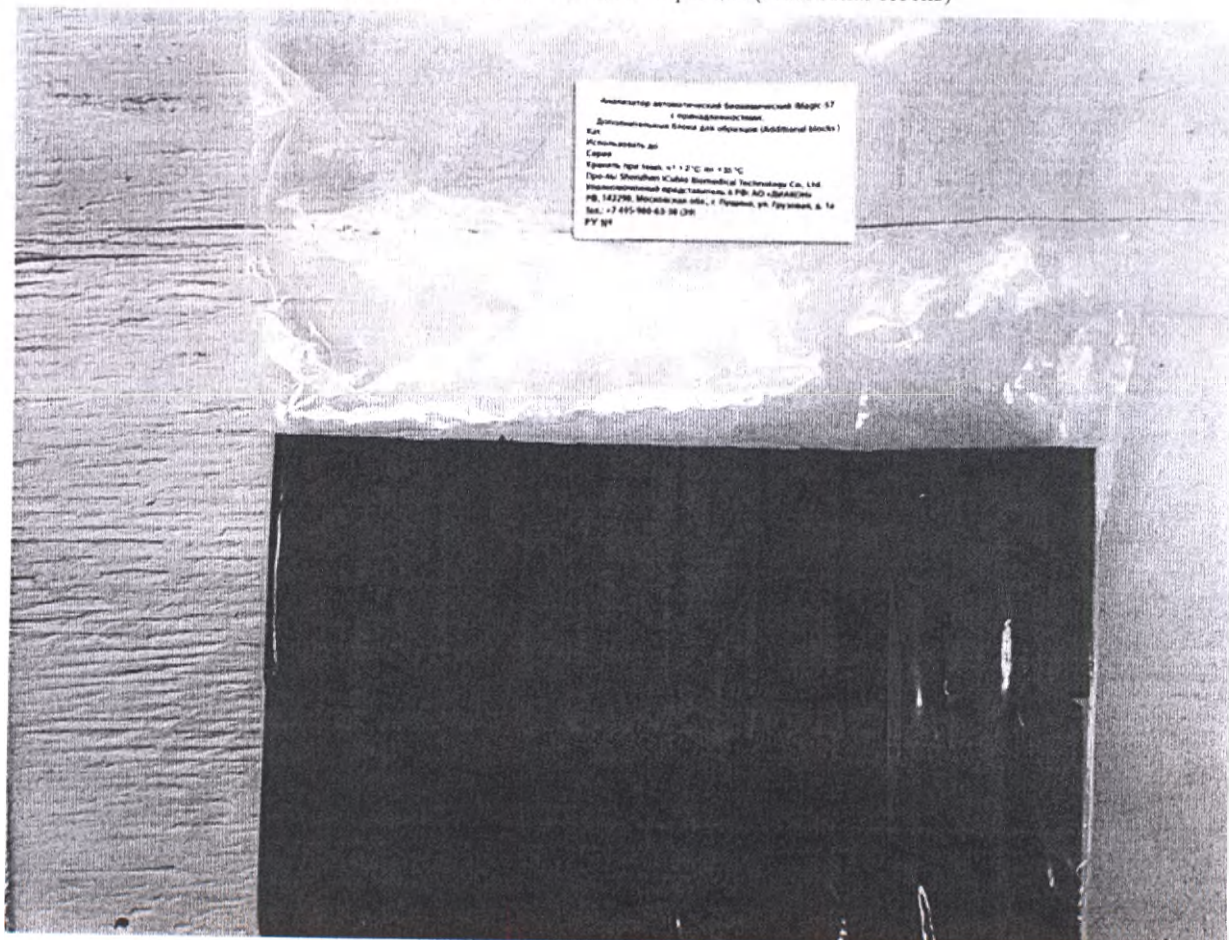


12. Трубка для слива отходов (Waste Water pipe)

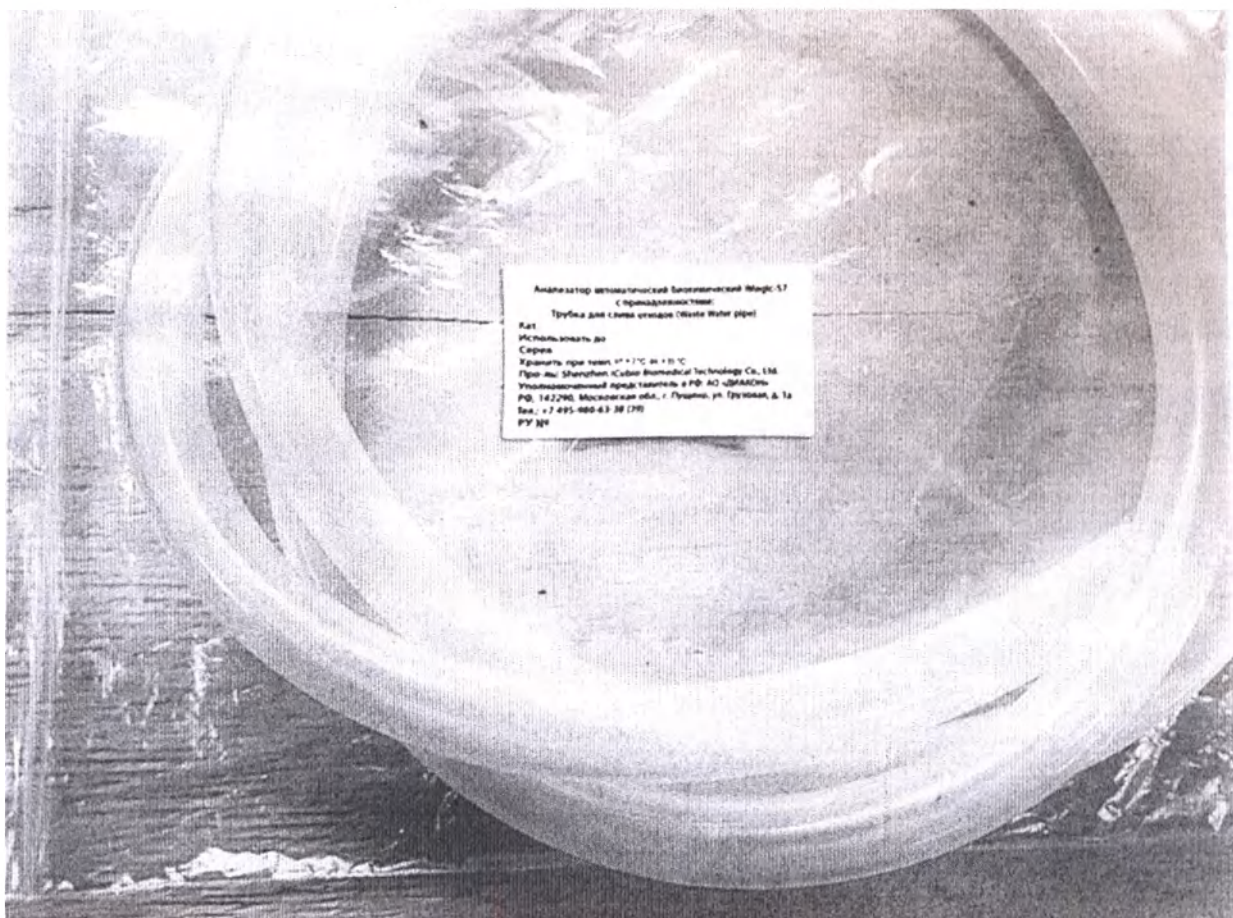


13. Трубка (Pipeline)

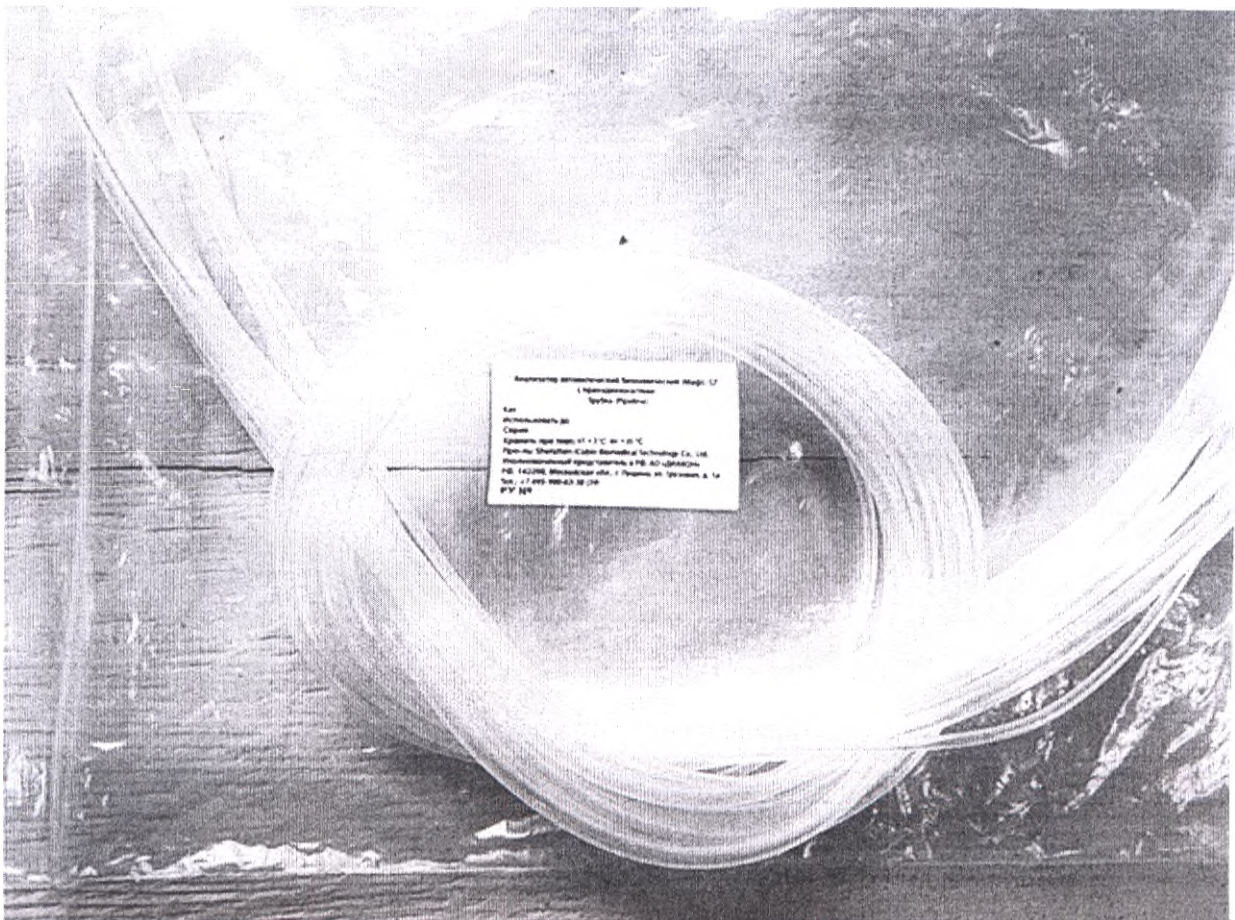


14. Емкость для деионизированной воды (Deion Bucket)

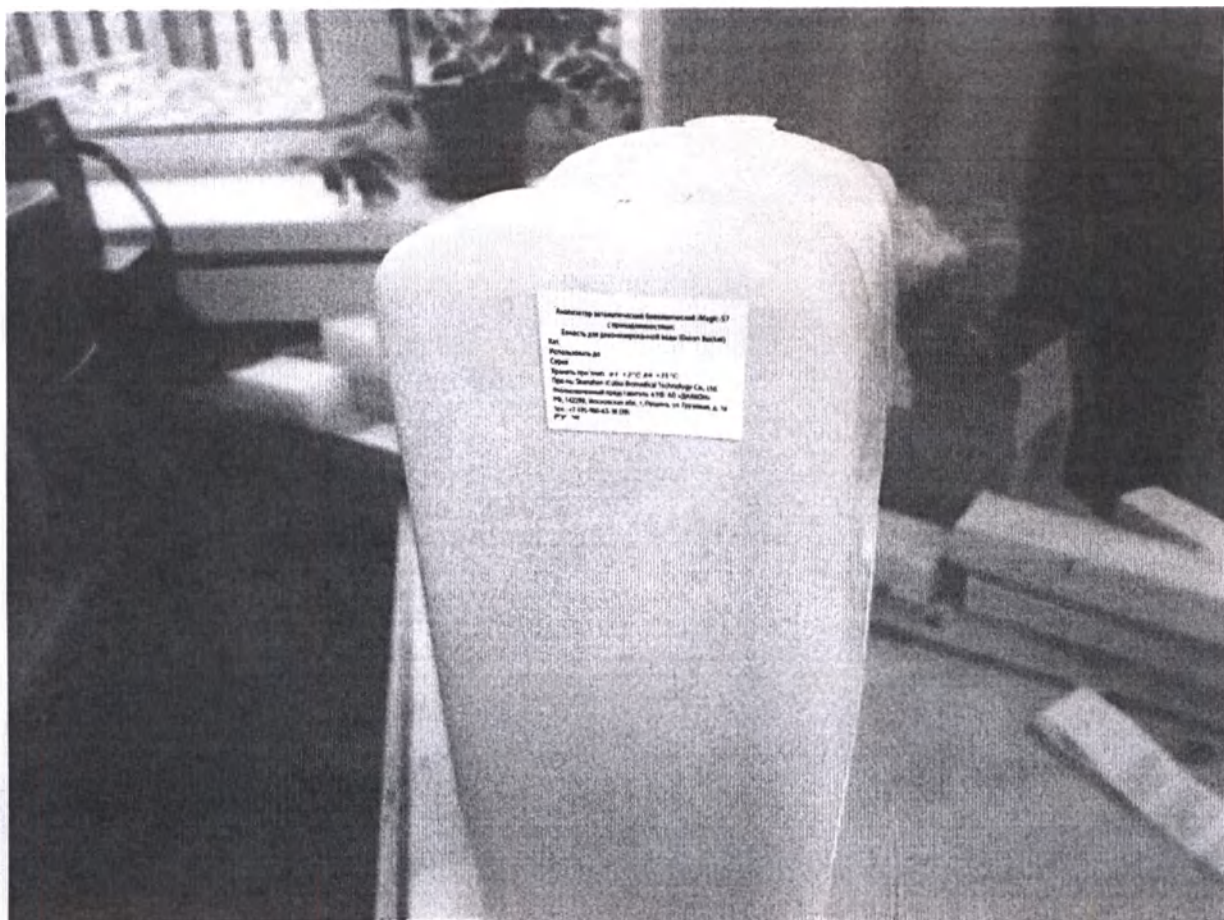


15. Емкость для сливной жидкости (Waste Bucket)

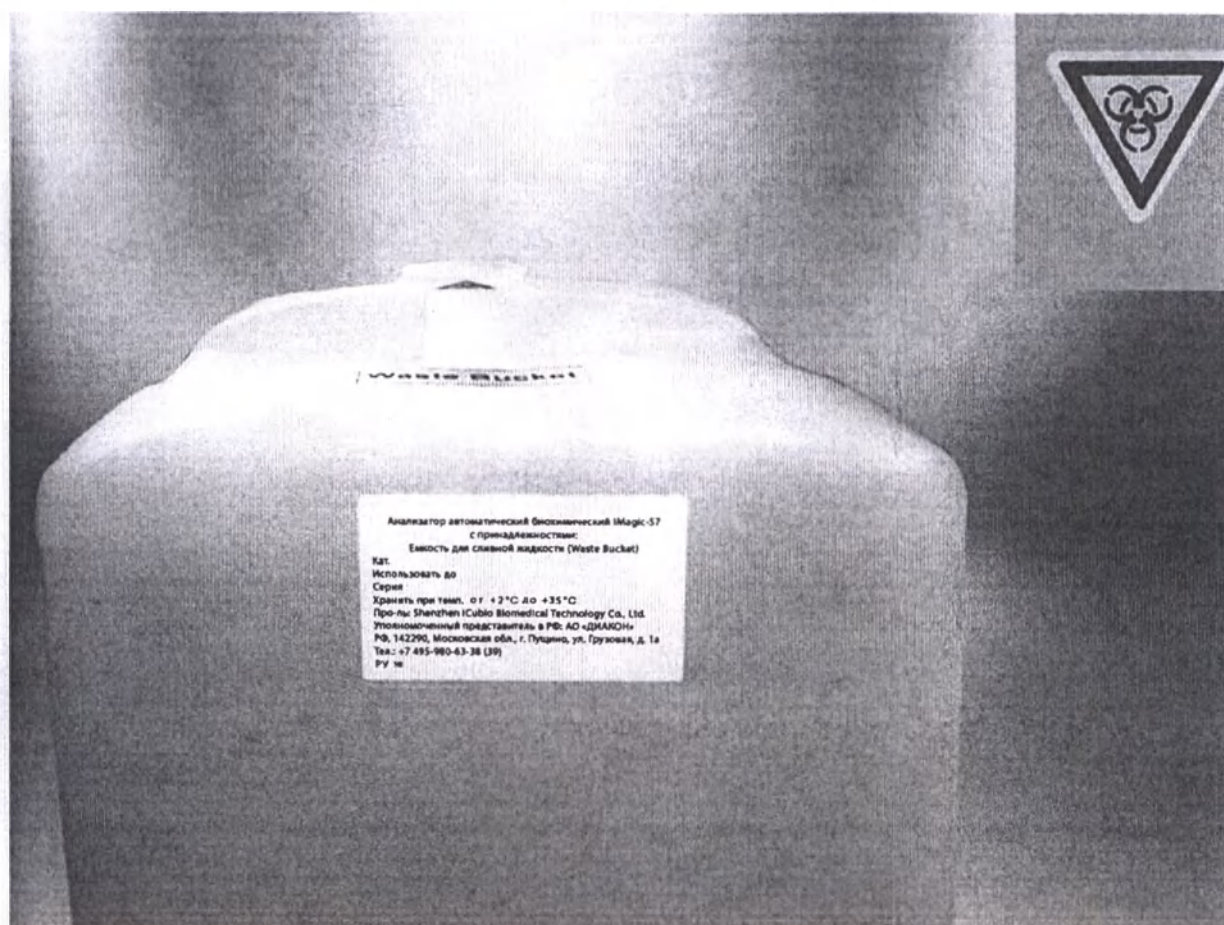


16. Компоненты крышки емкости deterгента (Detergent bottle cap components)

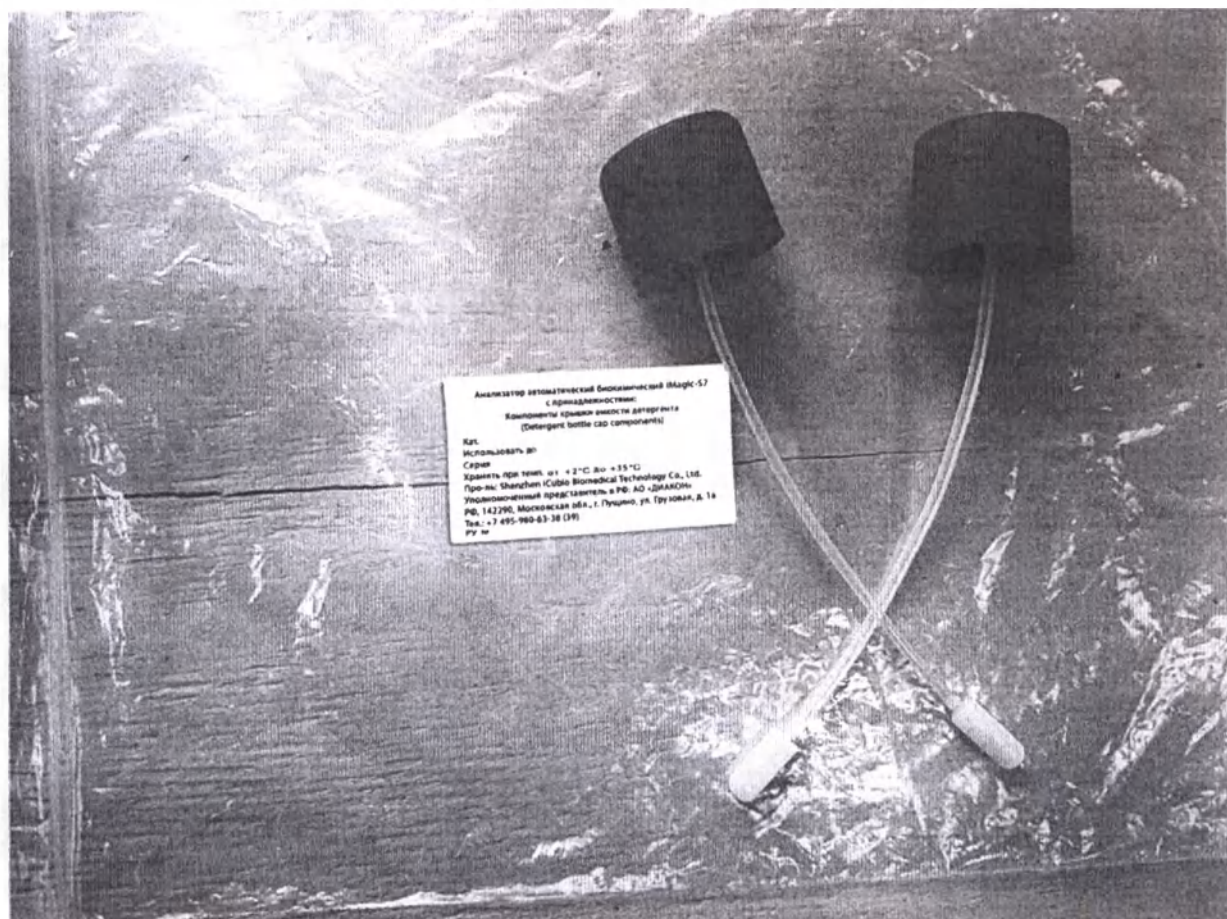

17. Датчик уровня деионизированной воды (Deion water level sensor)

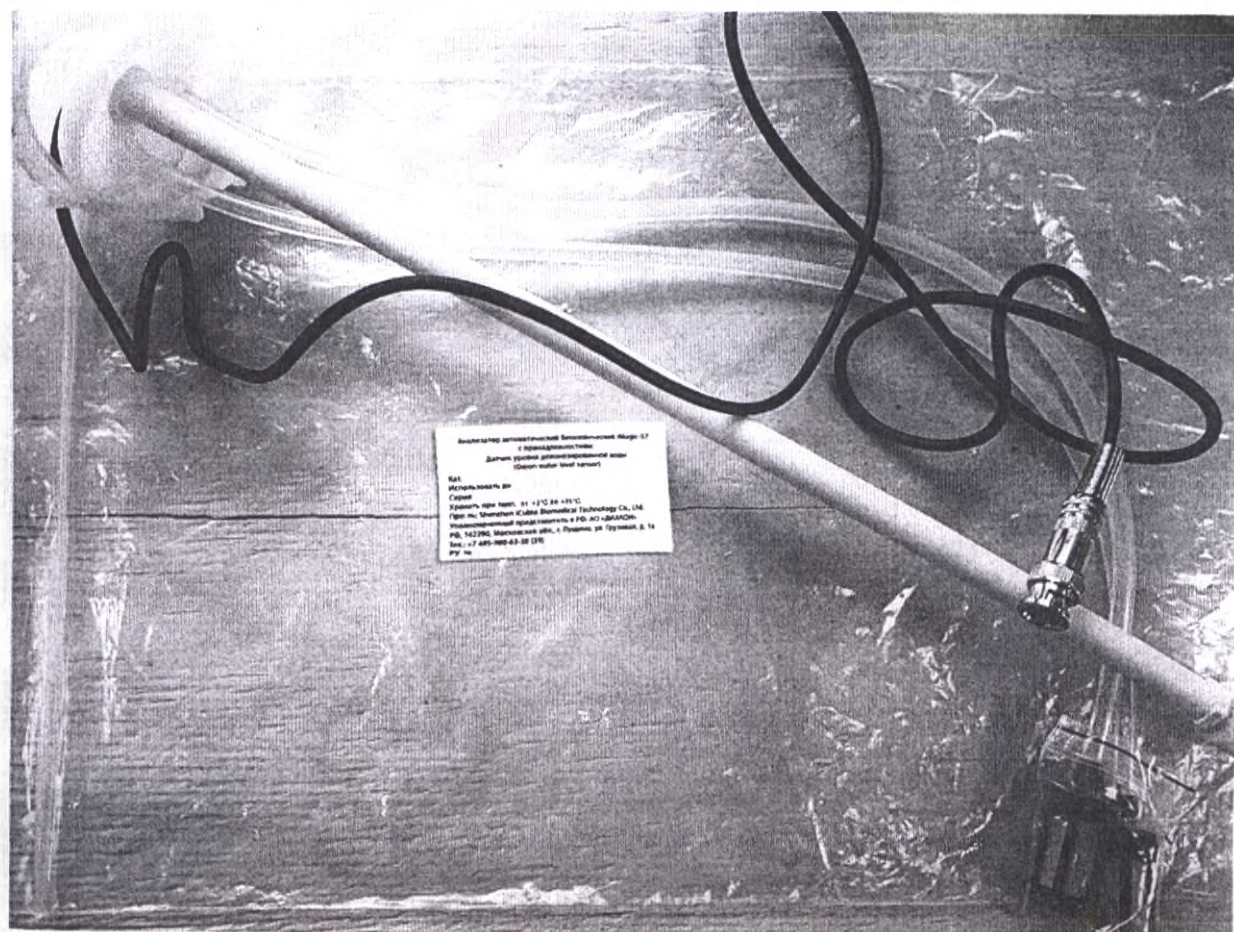


18. Датчик уровня сливной жидкости (Waste water level sensor)

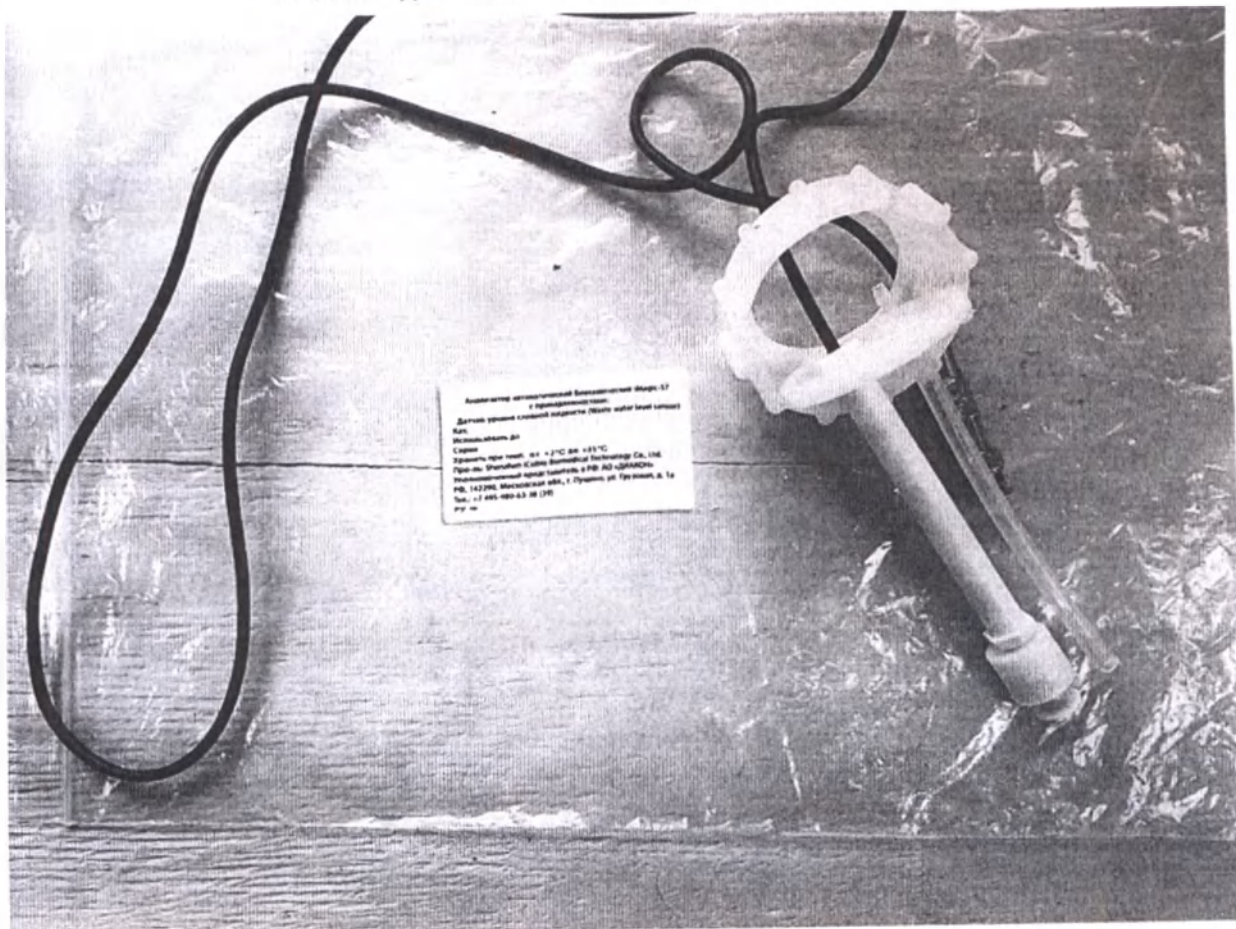


19. Внутренняя трубка для перистальтического насоса (Peristaltic pump inlet pipe)



20. Лампа (Lamp)

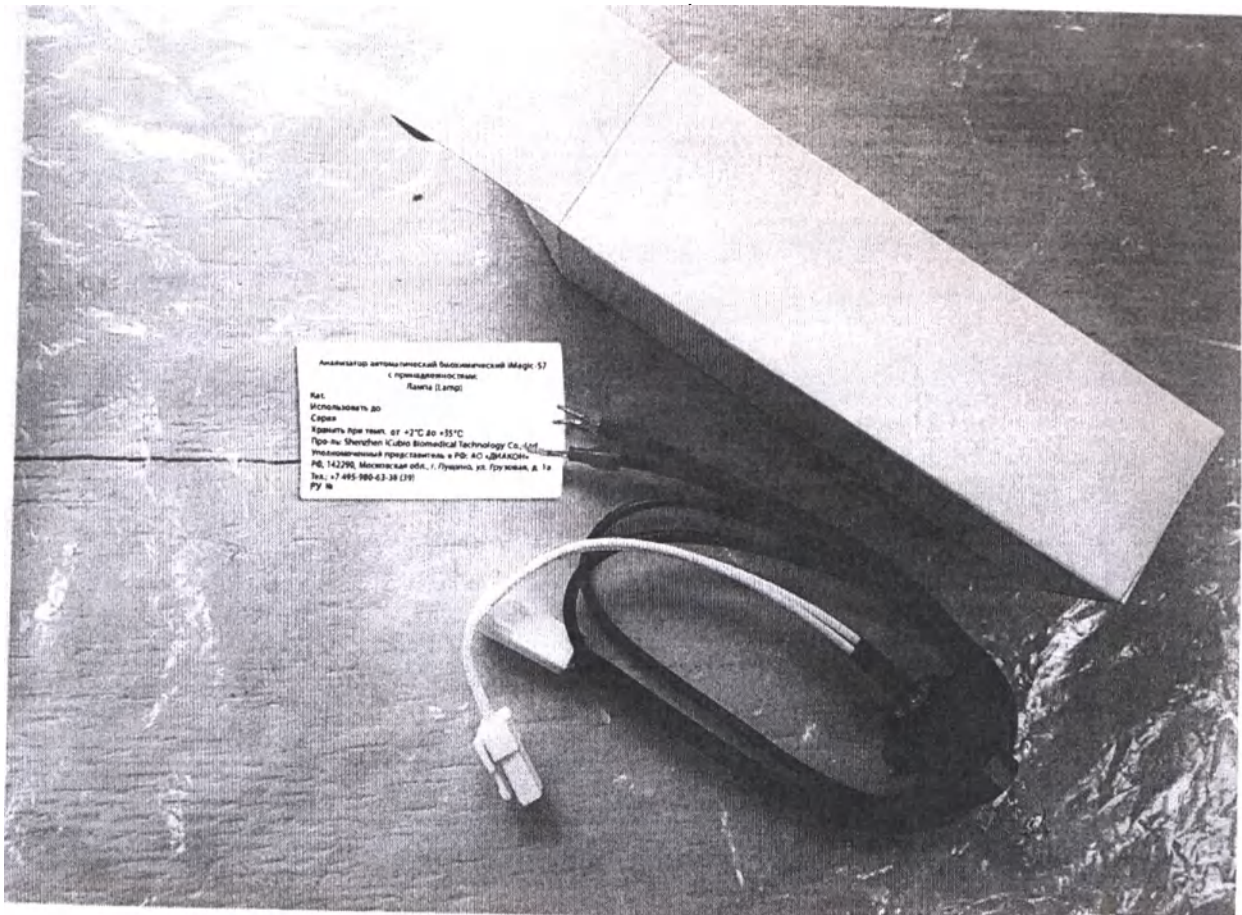

21. Очищающий раствор (Cleanser for chemistry analyzer)

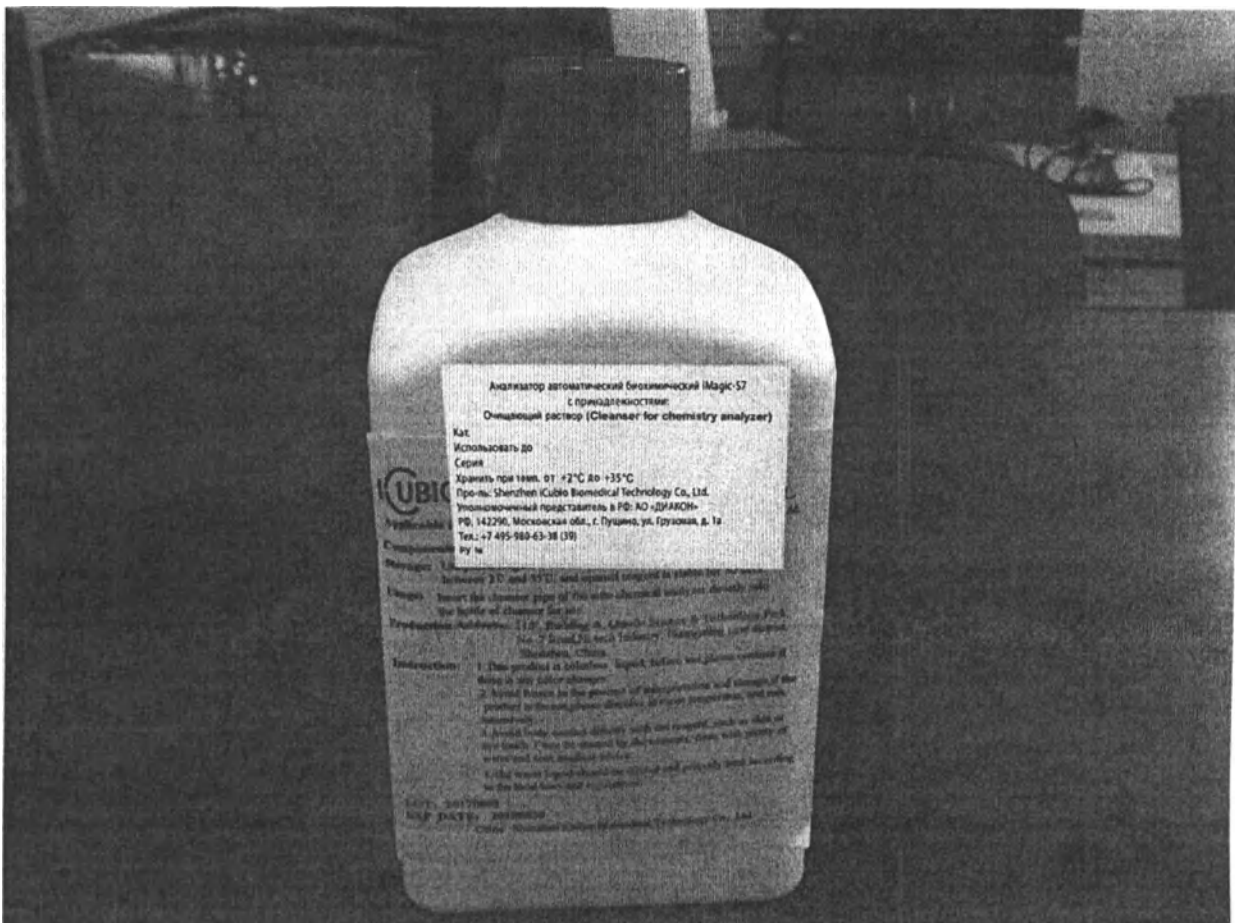


II. Принадлежности к анализатору автоматическому биохимическому iMagic-S7:

1. Предохранитель (Fuse (F5AL,250V)) – 2 шт.
2. Крестовая отвертка (6*38) (Cross screwdriver (6*38)) – 1 шт.
3. Фильтр (Filter) – 2 шт.
4. Иглы для очистки пробоотборника (Acupuncture needles) – 1 шт.
5. Приспособление для удаления пузырьков (Bubble exhaust tool) – 1 шт.
6. Кювета (Cuvette) – 96 шт.

II. Принадлежности к анализатору автоматическому биохимическому iMagic-S7:
1. Предохранитель (Fuse (F5AL,250V))

Анализатор автоматический биохимический iMagic-S7
с принадлежностями:
Предохранитель (Fuse (F5AL,250V))
Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. от +2°C до +35°C
Про-ль: Shenzhen iCubio Biomedical Technology Co., Ltd.
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38 (39)
ру №


2. Крестовая отвертка (6*38) (Cross screwdriver (6*38))

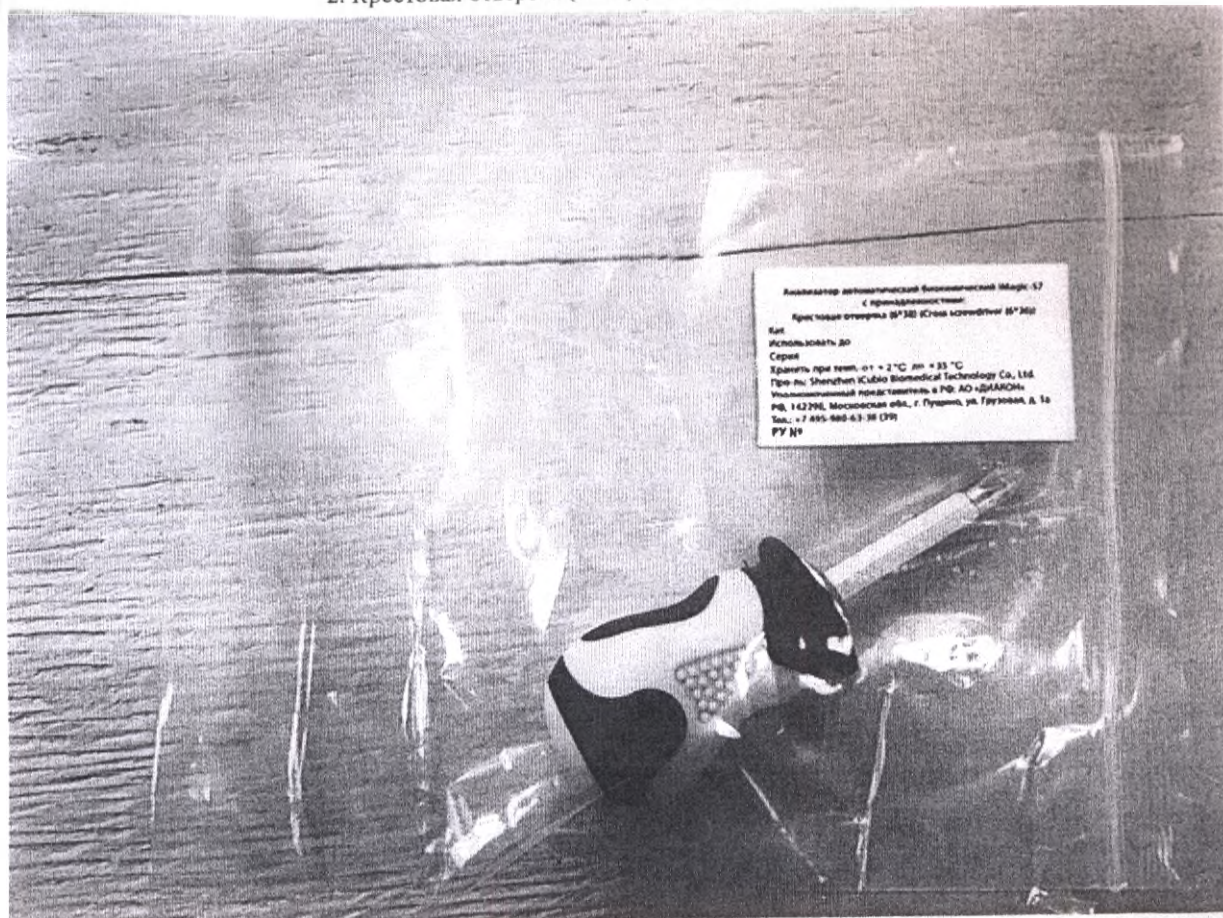


3. Фильтр (Filter)



4. Иглы для очистки пробоотборника (Acupuncture needles)

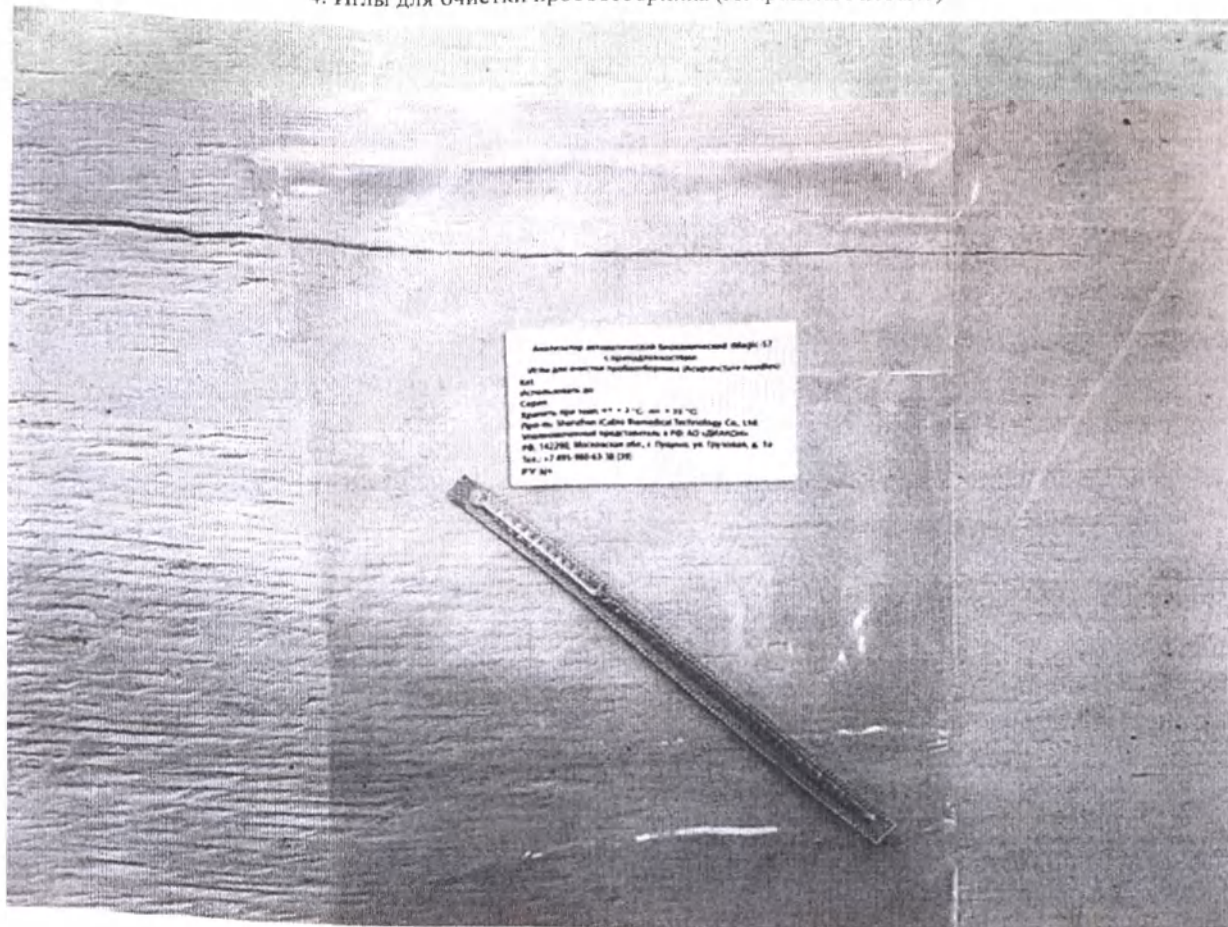

5. Приспособление для удаления пузырьков (Bubble exhaust tool)

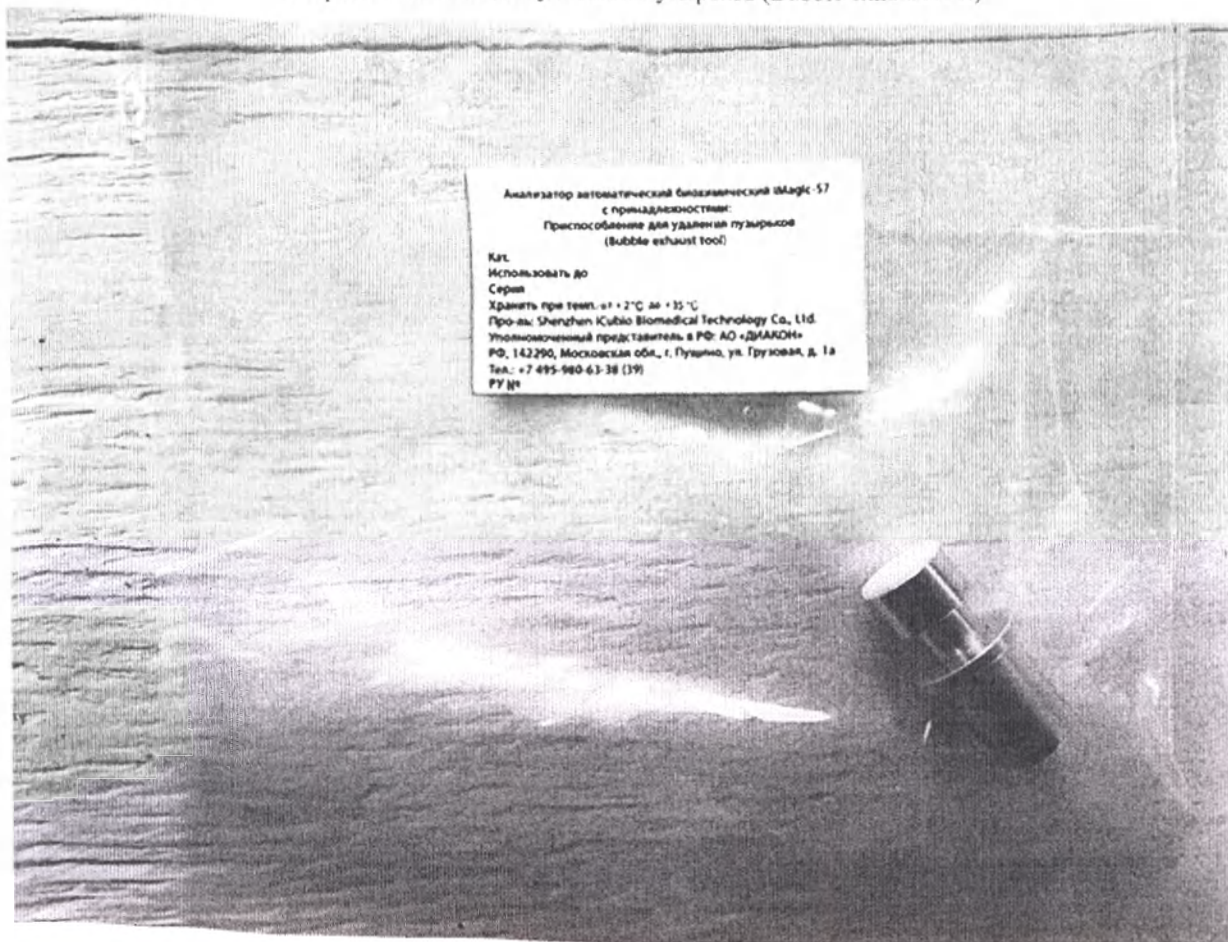

[illegible]