


К ПРОТОКОЛУ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 20.36.014 от 29 января 2014 г.

Озонатор терапевтический с регулируемым расходом озono-воздушной смеси и концентрации озона в ней, для лечения трофических язв конечностей и ожогов, портативный ОТ-15/155 «ОРИОН – СИ»:

- Процедураная камера «нога» с комплектом принадлежностей: штатный шланг длиной 800 мм. и диаметром 22мм
- Процедураная камера «рука» с комплектом принадлежностей: штатный шланг длиной 800 мм. и диаметром 22 мм
- Процедураная камера «стопа-кисть» с комплектом принадлежностей: штатный шланг длиной 800 мм. и диаметром 22 мм
- Процедураная камера «берет» штатный шланг длиной 800 мм. и диаметром 22 мм. штатный шланг длиной 400 мм., диаметром 22 мм
- Насадка к озонатору проктологическая
- Насадка к озонатору урологическая
- Насадка к озонатору гинекологическая
- Насадка к озонатору «ректальная инсуффляция»
- Насадка колокол

Фото образцов:

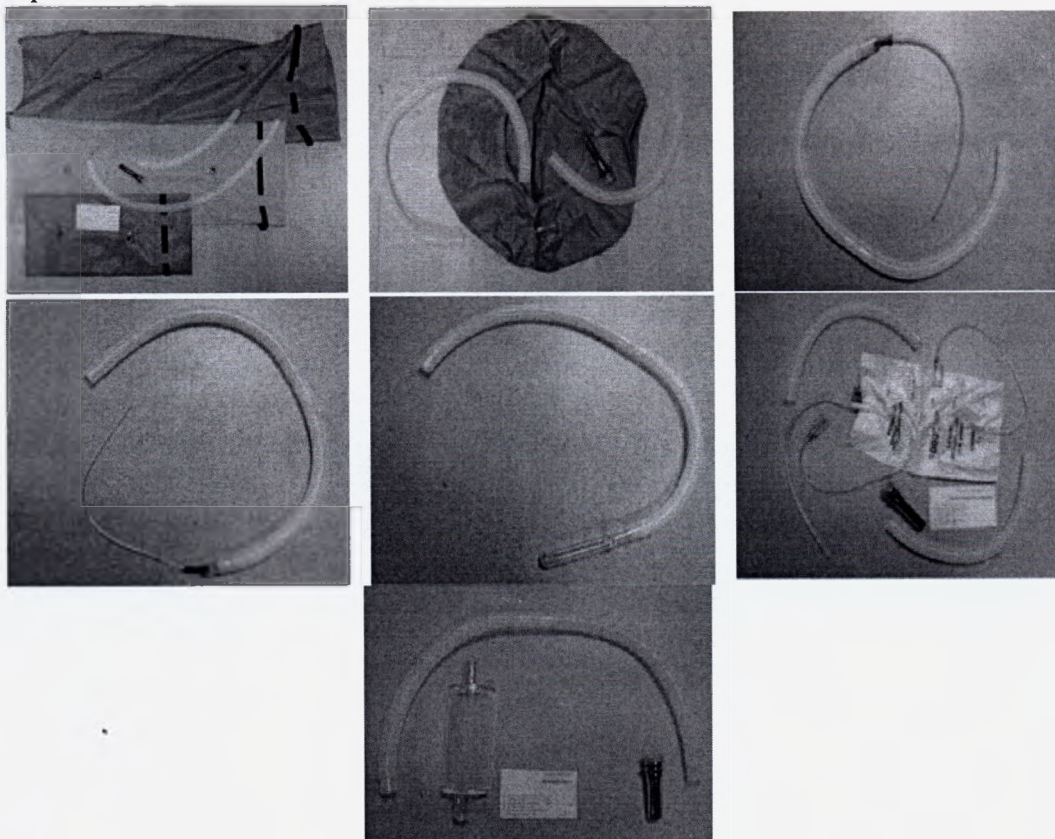

А.А. Семенова