

Вариант исполнения: Набор реагентов

Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А, жидкий

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

« 10 » 2012 г.

**Набор реагентов
«Диагностикумы эритроцитарные менингококковые
полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018**

1. Маркировка внутренней упаковки (флакона):

Размер этикетки: 40x32 мм

Микроген
Диагностикум группы А
Диагностикум эритроцитарный
менингококковый
полисахаридный группы А,
жидкий
3 мл

Серия
Годен до

Микроген
Диагностикум группы А
Сыворотка диагностическая
менингококковая серогруппы А
адсорбированная кроличья
сухая лиофилизат из 0,1 мл

Титр
Серия
Годен до

Микроген
Диагностикум группы А
Натрия хлорида
0,9 % раствор
8 мл

Серия
Годен до

Вариант исполнения: Набор реагентов

Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А, жидкий

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»


А.Е. Ершов

« 10 » 04 2020 г.

Набор реагентов
«Диагностикумы эритроцитарные менингококковые
полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 140x40x90 мм

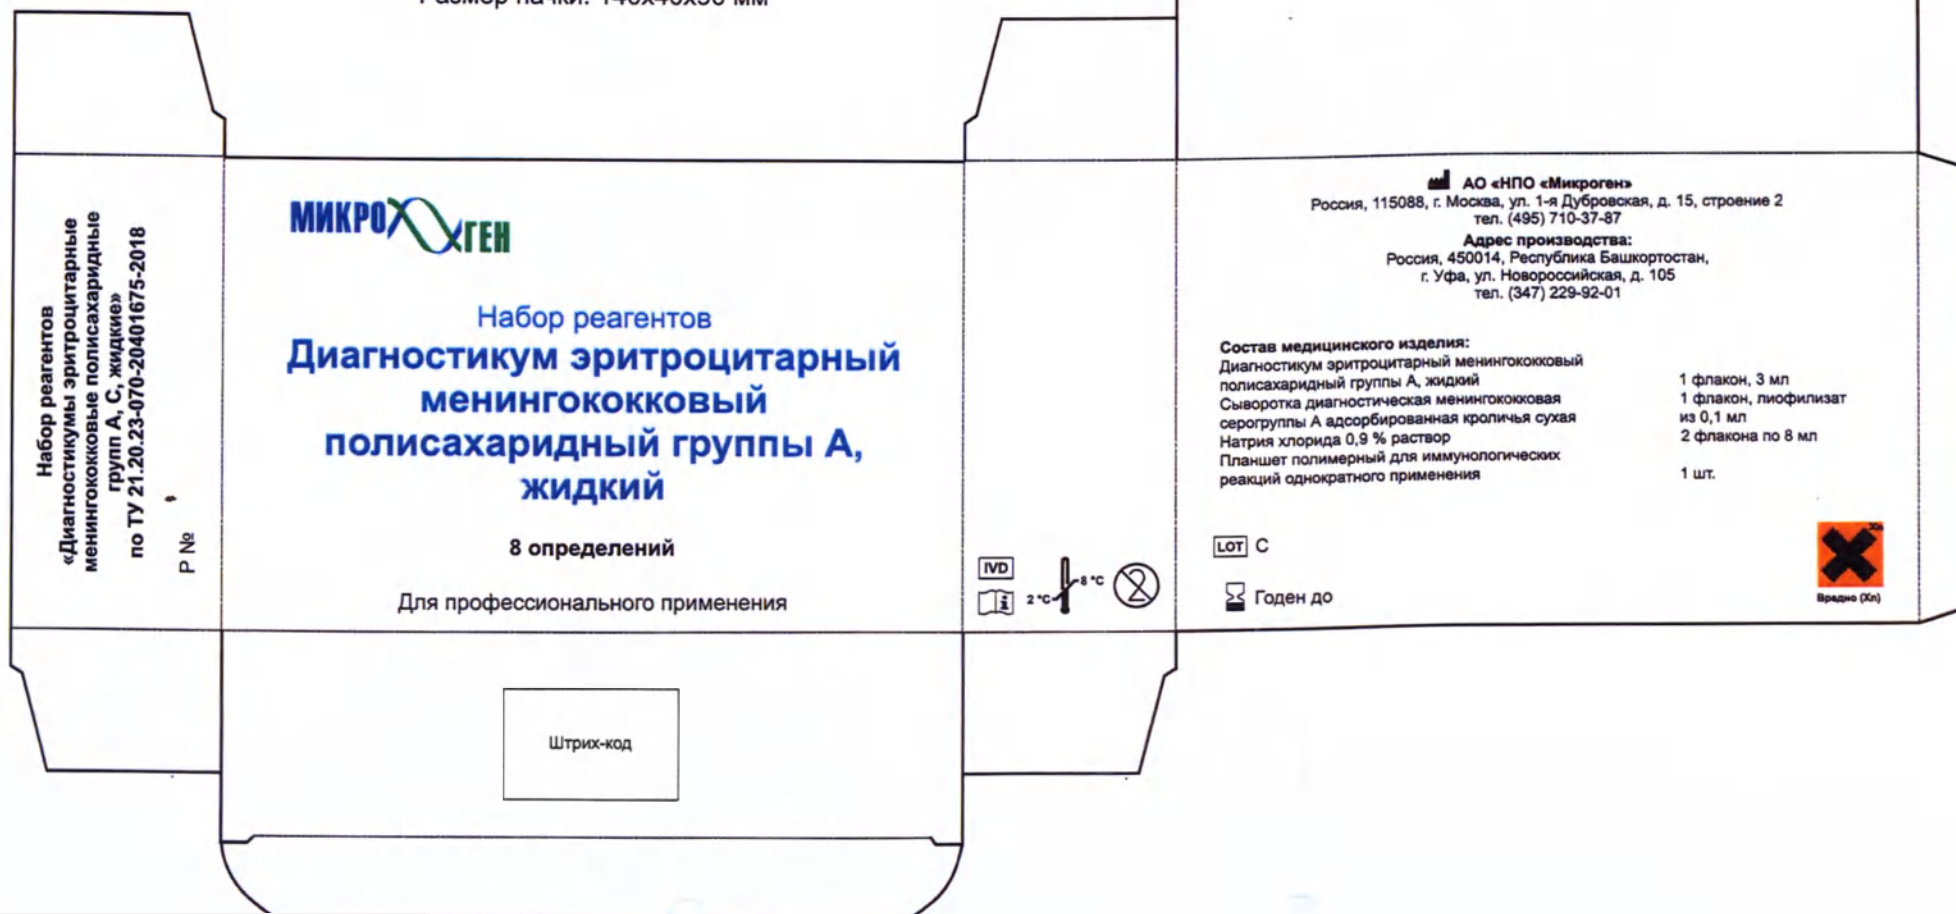


Вариант исполнения: Набор реагентов

Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А, жидкий

Набор реагентов
«Диагностикумы эритроцитарные менингококковые
полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 168x115 мм

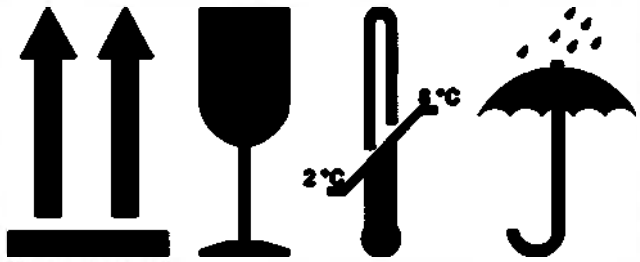Набор реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С, жидкие» по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018	 Не кантовать!	LOT Серия: Годен до:
	Число единиц потребит. упак. изделия:	
	Набор реагентов ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ МЕНИНГОКОККОВЫЙ ПОЛИСАХАРИДНЫЙ ГРУППЫ А, ЖИДКИЙ	
	БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается кратковременно (не более 7 сут) транспортировать при температуре от 9 до 25 °С. Хранить в упаковке производителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С. Хранение компонентов изделия после вскрытия см. инструкцию раздел «Подготовка компонентов для РПГА».		 АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 105 тел. (347) 229-92-01
Масса брутто		
Масса нетто		

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

«10» 2010 г.

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы C, жидкий

А.Е. Ершов

« 10 » 07 КР 2020 г.



1. Маркировка внутренней упаковки (флакона):

Микроген
Диагностикум группы С
Диагностикум эритроцитарный
менингококковый
полисахаридный группы С,
жидкий
3 мл

Серия
Годен до

Микроген
Диагностикум группы С
Сыворотка диагностическая
менингококковая серогруппы С
адсорбированная кроличья
сухая лиофилизат из 0,1 мл
Титр
Серия
Годен до

Микроген
Диагностикум группы С
Натрия хлорида
0,9 % раствор
8 мл

Серия
Годен до

Вариант исполнения: Набор реагентов

Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С, жидкий

Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»


А.Е. Ершов

« 10 » 20 20 г.

Набор реагентов
«Диагностикумы эритроцитарные менингококковые
полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 140x40x90 мм

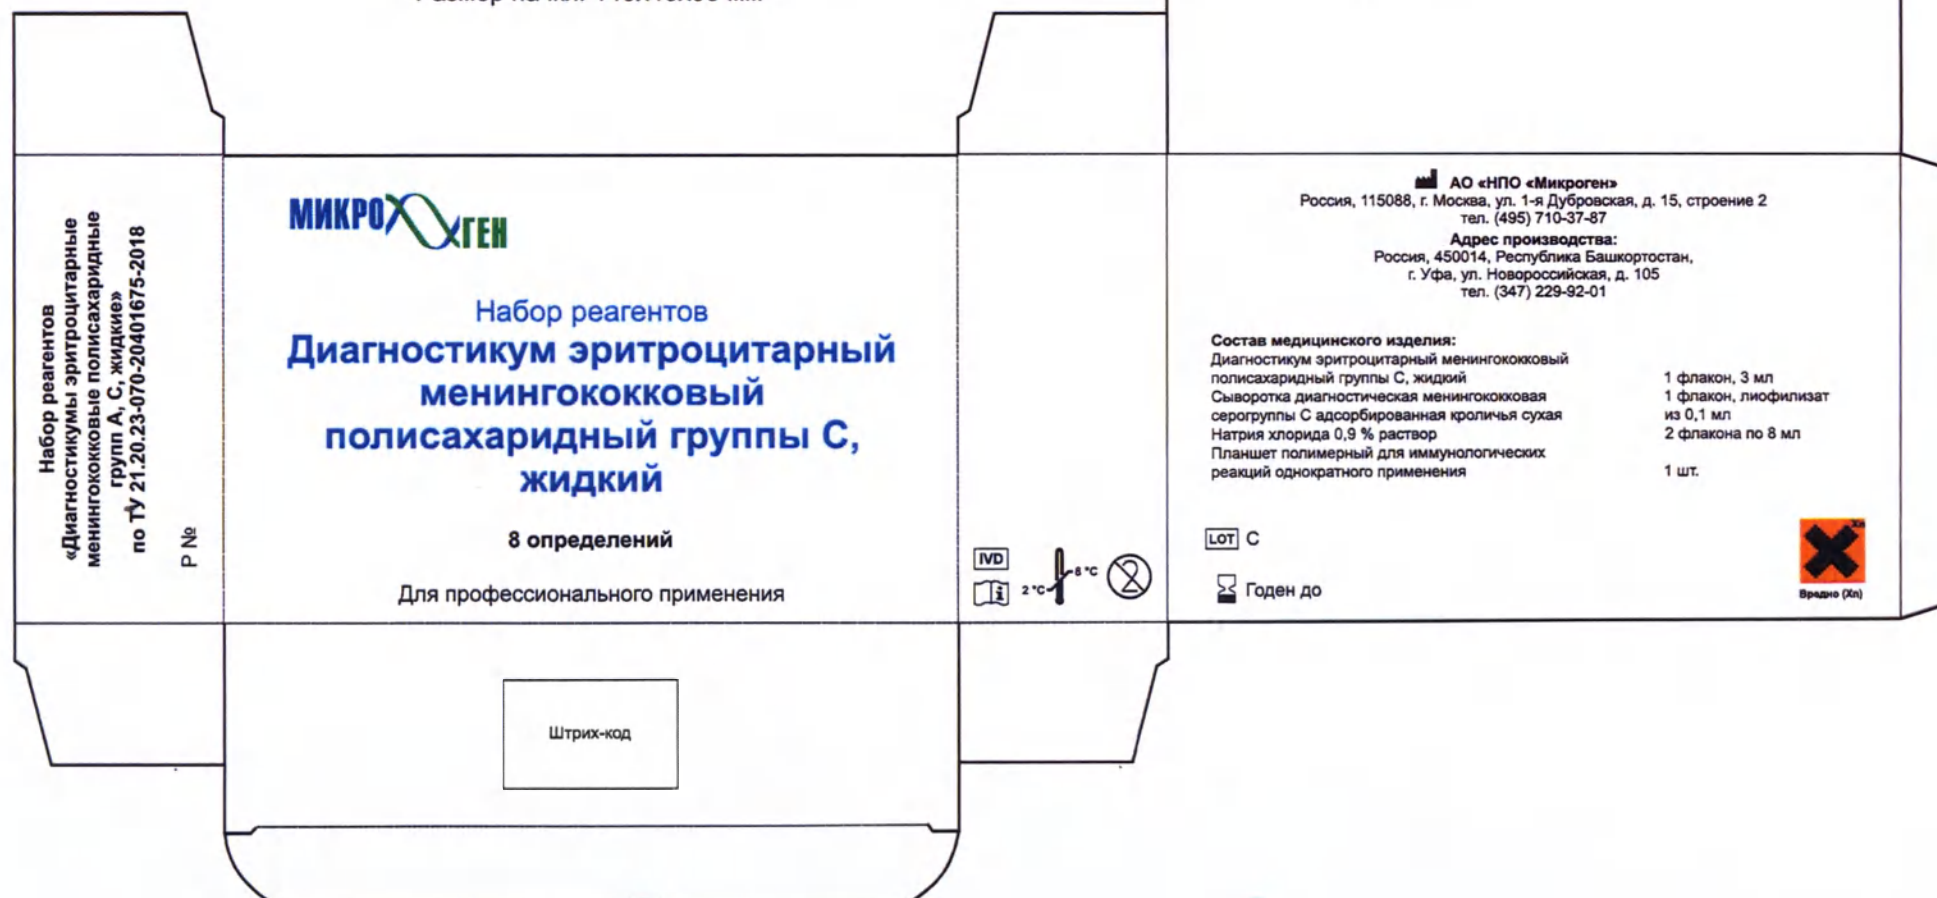

Вариант исполнения: Набор реагентов

Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С, жидкий

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»


А.Е. Ершов

« 10 » 2017 г.

Набор реагентов
«Диагностикумы эритроцитарные менингококковые
полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 168x115 мм

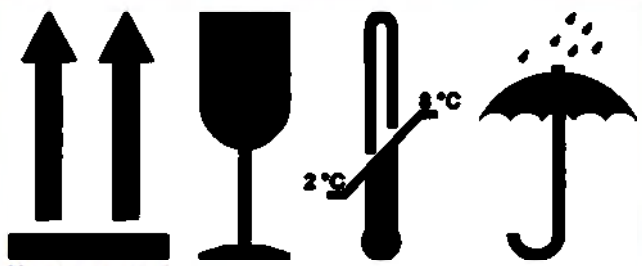Набор реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С, жидкие» по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018	 Не кантовать!		LOT Серия:
			Годен до:
			Число единиц потребит. упак. изделия:
	Набор реагентов ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ МЕНИНГОКОККОВЫЙ ПОЛИСАХАРИДНЫЙ ГРУППЫ С, ЖИДКИЙ		
БИОПРЕПАРАТЫ			
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается кратковременно (не более 7 сут) транспортировать при температуре от 9 до 25 °С. Хранить в упаковке производителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С. Хранение компонентов изделия после вскрытия см. инструкцию раздел «Подготовка компонентов для РПГА».			
Масса брутто		 АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 105 тел. (347) 229-92-01	
Масса нетто			

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

КОПИЯ ВЕРНА
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6 листа(ов)

Представитель
АО НПО Микроген
по доверенности
ОМ Волощук



Набор реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С, жидкие» по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018
 Вариант исполнения: Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А жидкий

Набор реагентов менингококковые
 «Диагностикумы эритроцитарные групп А, С, жидкие»
 по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

Не кантовать!

2°C 8°C

Серия: 190224
 Годен до: 0825
 Число единиц потребит. упак. изделия: 36 шт

Набор реагентов
 ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ МЕНИНГОКОККОВЫЙ
 ПОЛИСАХАРИДНЫЙ ГРУППЫ А, ЖИДКИЙ

БИОПРЕПАРАТЫ

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается кратковременно (не более 7 сут) транспортировать при температуре от 9 до 25 °С. Хранить в упаковке производителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С. Хранение компонентов изделия после вскрытия см. инструкцию раздел «Подготовка компонентов для РПГА».

Масса брутто 5,980 кг
 Масса нетто 5,460 кг


МИКРОХГЕН
 АО «НПО «Микроген»
 Россия, 115088, г. Москва,
 ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2
 тел. (495) 710-37-87
 Адрес производства:
 Россия, 450014, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 100
 тел. (347) 229-92-01

МЕДПОЛМЕР
 Санкт-Петербург

ПЛАНШЕТ ПОЛИМЕРНЫЙ
 ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
 РЕАКЦИЙ
 ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 (с крышкой)
 ТУ 9398-057-00480230-2009
 РУ № РЗН 2015/2664 от 29.08.2022
 СТЕРИЛЬНО
 02.11.2025 ГОДЕН ДО 11.2026

МИКРОХГЕН

Набор реагентов
 Диагностикум эритроцитарный
 менингококковый
 полисахаридный группы А,
 жидкий
 8 определений
 Для профессионального применения

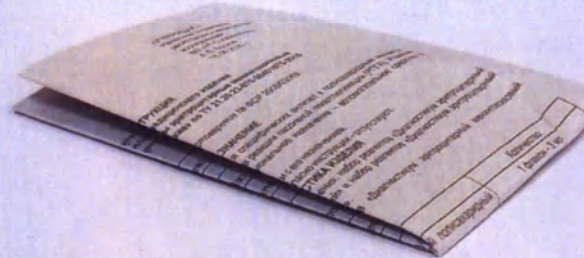

Набор реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококко-вые полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

Вариант исполнения: *Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А жидкий*



АО «НПО «Микроген»

Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:

Россия, 450014, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 105
тел. (347) 229-92-01

Состав медицинского изделия:

Диагностикум эритроцитарный менингококковый
полисахаридный группы А, жидкий

Сыворотка диагностическая менингококковая

серогруппы А адсорбированная кроличья сухая

Натрия хлорида 0,9 % раствор

Планшет полимерный для иммунологических
реакций однократного применения

1 флакон, 3 мл

1 флакон, лиофилизат

из 0,1 мл

2 флакона по 8 мл

1 шт.

IVD



2 °C



8 °C



LOT

C 190224



ГОАЕН АО 0825



Вредно (Xn)

Набор реагентов

«Диагностикумы эритроцитарные
менингококковые полисахаридные
групп А, С, жидкие»

по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

ФСР 2008/03069

МИКРОГЕН

Набор реагентов
**Диагностикум эритроцитарный
менингококковый
полисахаридный группы А,
жидкий**

8 определений

Для профессионального применения

Набор реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С, жидкие» по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018
Вариант исполнения: Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С жидкий

Набор реагентов
«Диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С, жидкие»
 по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

Не кантовать!

Серия: 190224
 Годен до: 0825
 Число единиц потребит. упак. изделия: 36 шт

Набор реагентов
ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ МЕНИНГОКОККОВЫЙ
ПОЛИСАХАРИДНЫЙ ГРУППЫ С, ЖИДКИЙ

БИОПРЕПАРАТЫ

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается кратковременно (не более 7 сут) транспортировать при температуре от 9 до 25 °С. Хранить в упаковке производителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С. Хранение компонентов изделия после вскрытия см. инструкцию раздел «Подготовка компонентов для РПГА».

Масса брутто 5,990 г
 Масса нетто 5,456 г

МИКРОХГЕН
 АО «НПО «Микроген»
 Россия, 115088, г. Москва,
 ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2
 тел. (495) 710-37-87
 Адрес производства:
 Россия, 450014, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 105
 тел. (347) 229-92-01

ПЛАНШЕТ ПОЛИМЕРНЫЙ
ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 (с крышкой)
 ТУ 9398-057-00480230-2009
 РУ № РЗН 2015/2664 от 29.08.2022

СТЕРИЛЬНО



027112023 ГОДЕН ДО 112026

МИКРОХГЕН

Набор реагентов
Диагностикум эритроцитарный
менингококковый
полисахаридный группы С,
жидкий



8 определений

Для профессионального применения

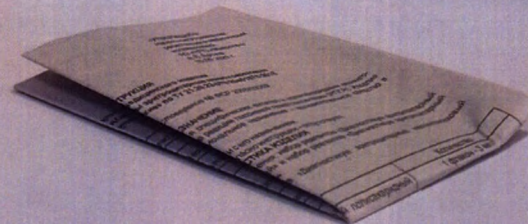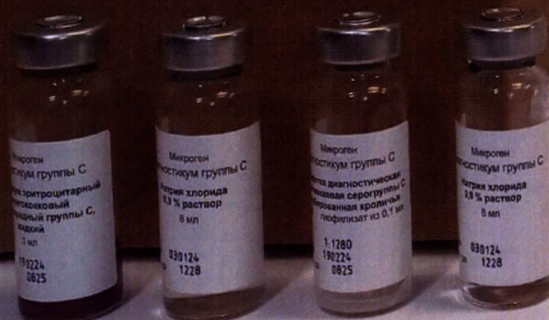

Набор реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококко-вые полисахаридные групп А, С, жидкие»
по ТУ 21.20.23-070-20401675-2018

Вариант исполнения: Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С жидкий

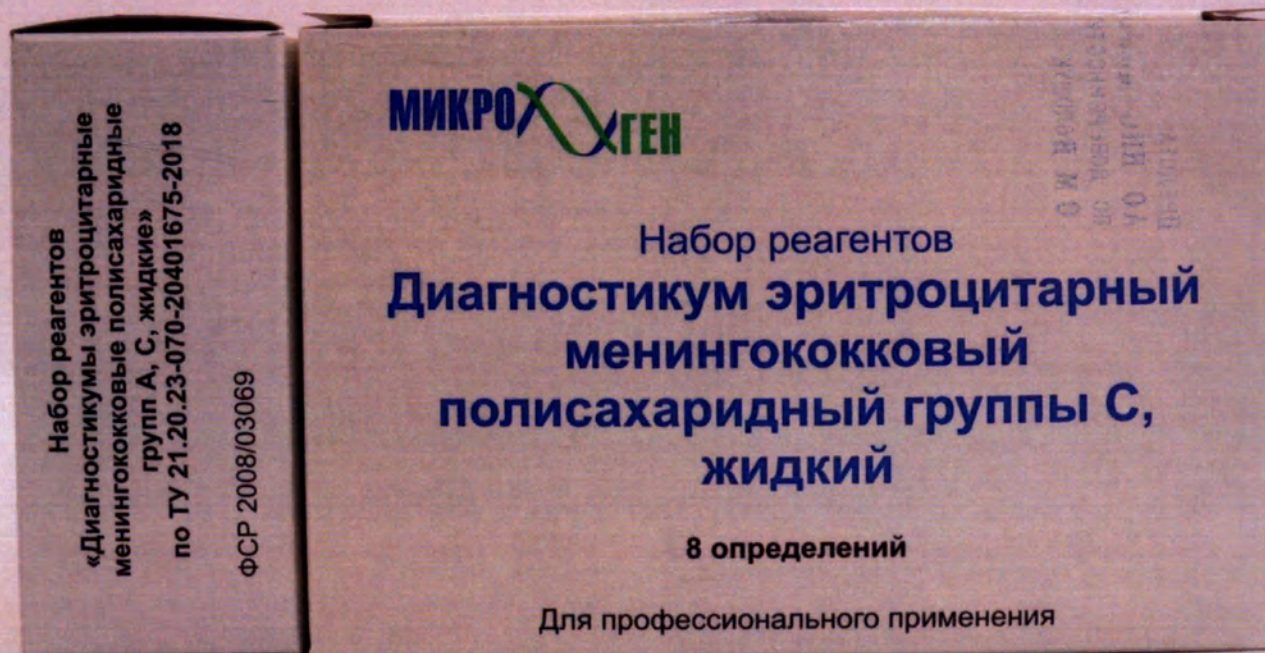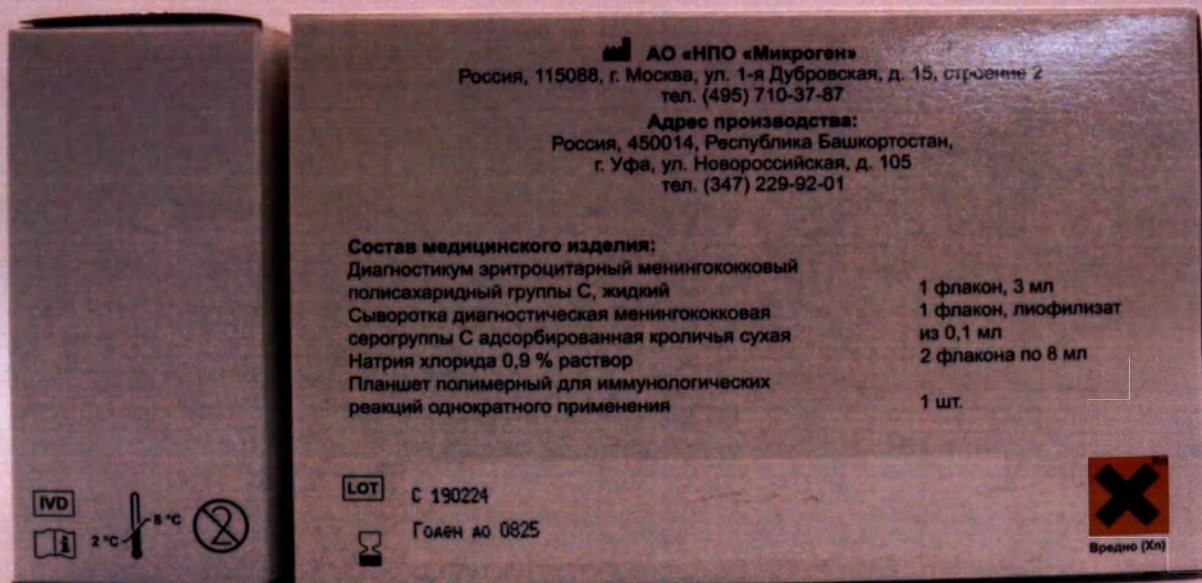

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
4 листа(ов)

Представитель
АО НПО МИКРОГЕН
по доверенности
ОМ Вощук

