



SistemaBioTech

УТВЕРЖДАЮ

Представитель, действующий
по доверенности № 10/20 от 03.07.2020

ООО «Система-Биотех»

Позднякова Н.В.



М.П

«21» июля 2020 г.


МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов

для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую
респираторную инфекцию, в биологическом материале методом петлевой
изотермической амплификации

«SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL», партия 360-214

1. Макет маркировки МИ - Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации «SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR», партия 350-204 - потребительская упаковка коробка - раскладка.

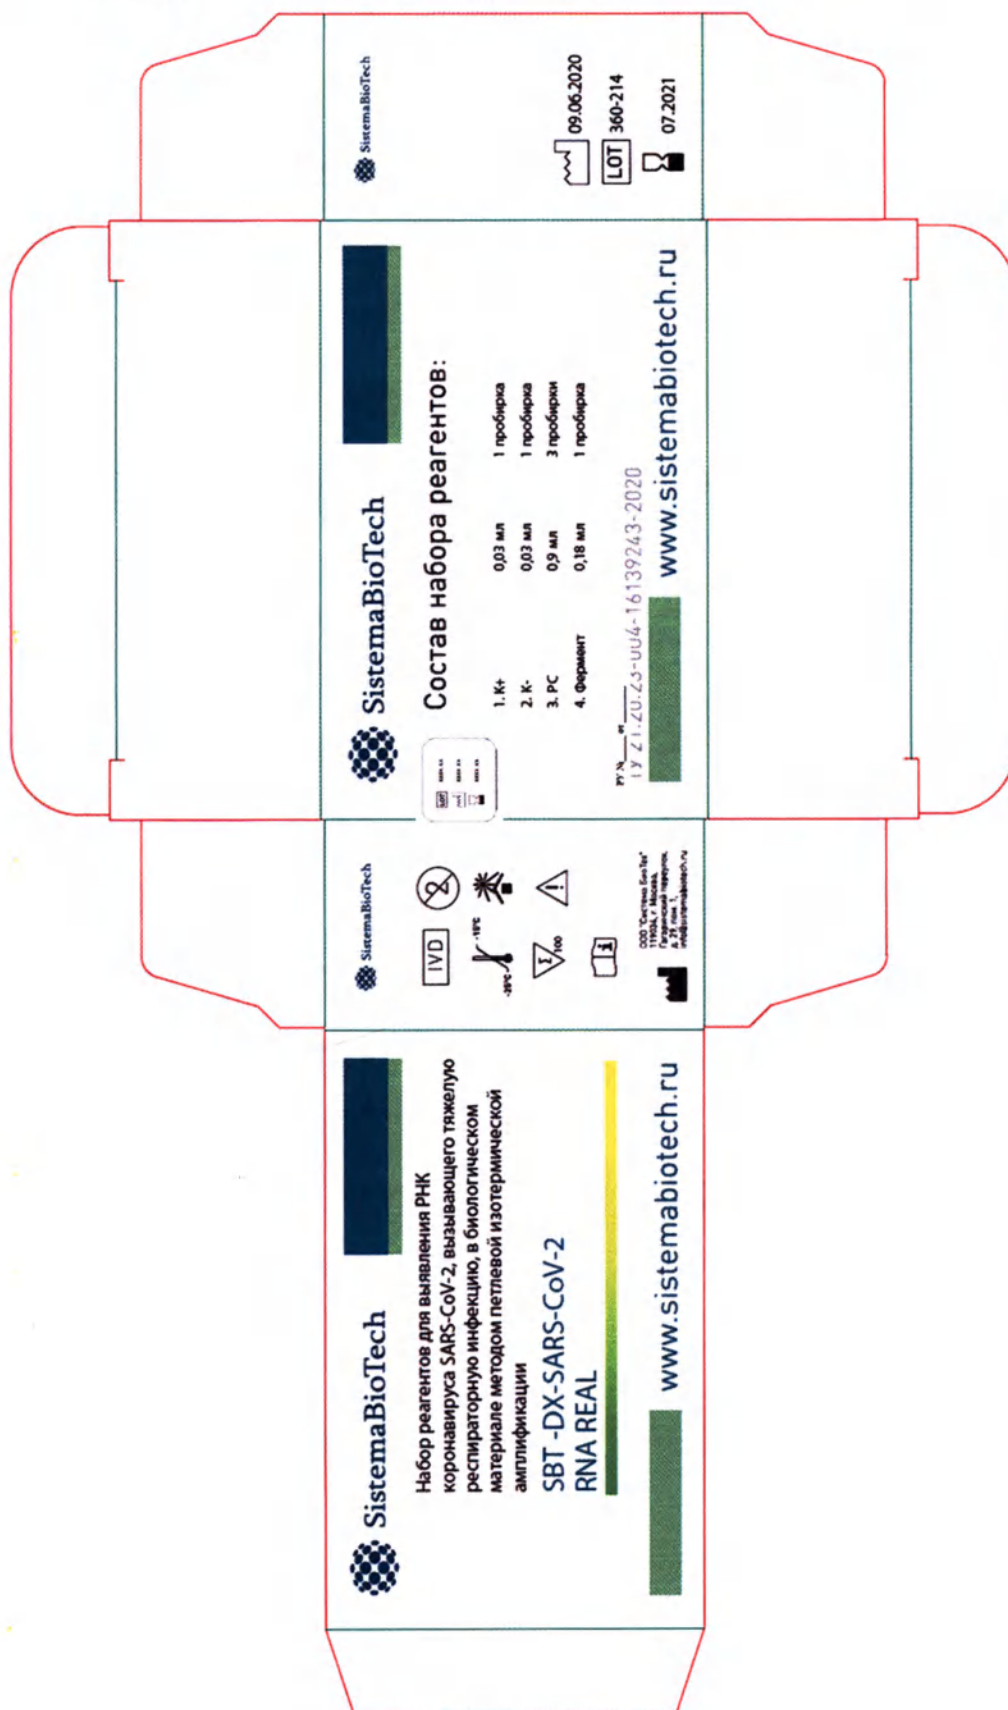

2. Макет маркировки компонента МИ – «К+» – положительный контроль – прозрачная бесцветная жидкость.



SistemaBioTech

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«К+» – положительный контроль

0,02 мл

LOT X145X6

07.2021



WWW.SISTEMABIOTECH.RU

3. Макет маркировки компонента МИ – «К-» – отрицательный контроль – прозрачная бесцветная жидкость.



SistemaBioTech


SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«К-» – отрицательный контроль

0,02 мл

LOT X145X6

07.2021



WWW.SISTEMABIOTECH.RU

4. Макет маркировки компонента МИ – «РС» – реакционная смесь – прозрачная розовая жидкость.



SistemaBioTech

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«РС» - реакционная смесь

0,9 мл

LOT X145X6



07.2021



WWW.SISTEMABIOTECH.RU

5. Макет маркировки компонента МИ – «Фермент» – ДНК-полимераза – прозрачная бесцветная вязкая жидкость.



SistemaBioTech

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«Фермент» – ДНК

полимераза 0,06 мл

LOT X145X6



07.2021








WWW.SISTEMABIOTECH.RU

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

(четыре) лист 2




Представитель, действующий по
доверенности № 10/20 от 03.07.2020
«Система-БиоТех»
Позднякова Наталья Вячеславовна

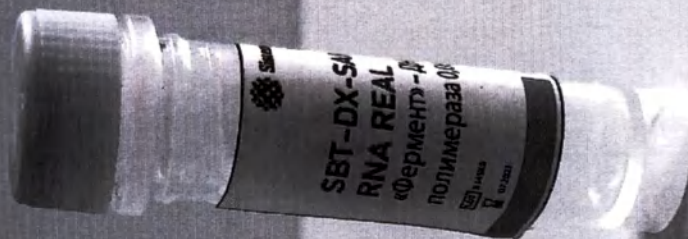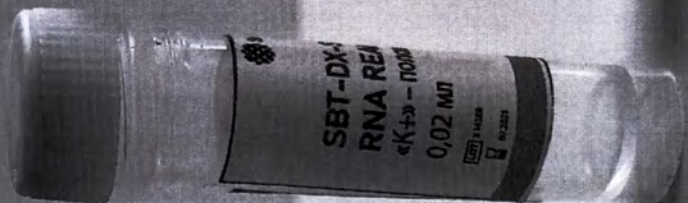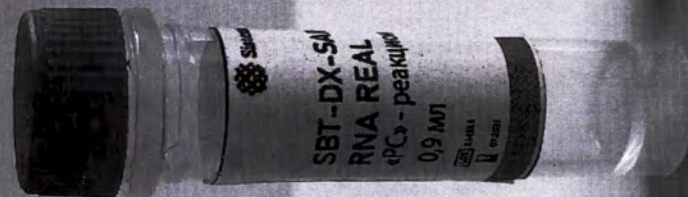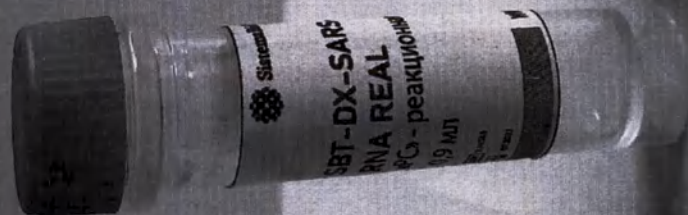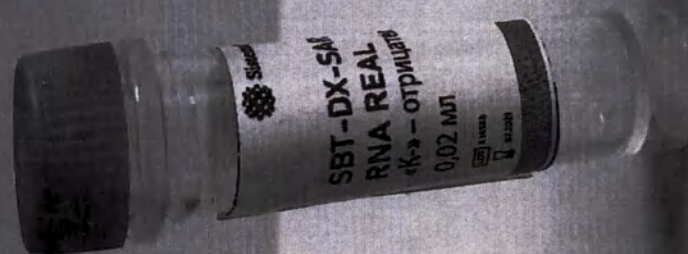

КОПИЯ ВЕРНА
подпись *И.В. Лопина*
И.В. Лопина
директор
Федерального центра
ветеринарной
диагностики
и профилактики
зооинфекций
от 03.07.2020

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1177746831369
ОСХА



SistemaBioTech

Набор реагентов для выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую
респираторную инфекцию, в биологическом
материале методом петлевой изотермической
амплификации

SBT-DX-SARS-CoV-2
RNA REAL

09.06.2020

LOT 360-214

06.2021

www.sistemabiotech.ru

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

И.В. Борина
Представитель,
действующий
по доверенности

