

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Аудиотехник»
К.В. Терехов
«11.07.20» 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат слуховой audifon воздушной проводимости, цифровой,
программируемый




1. Аппарат слуховой audifon rega P, заушный.




2. Аппарат слуховой audifon rega S, заушный.




3. Аппарат слуховой audifon rega XS, заушный

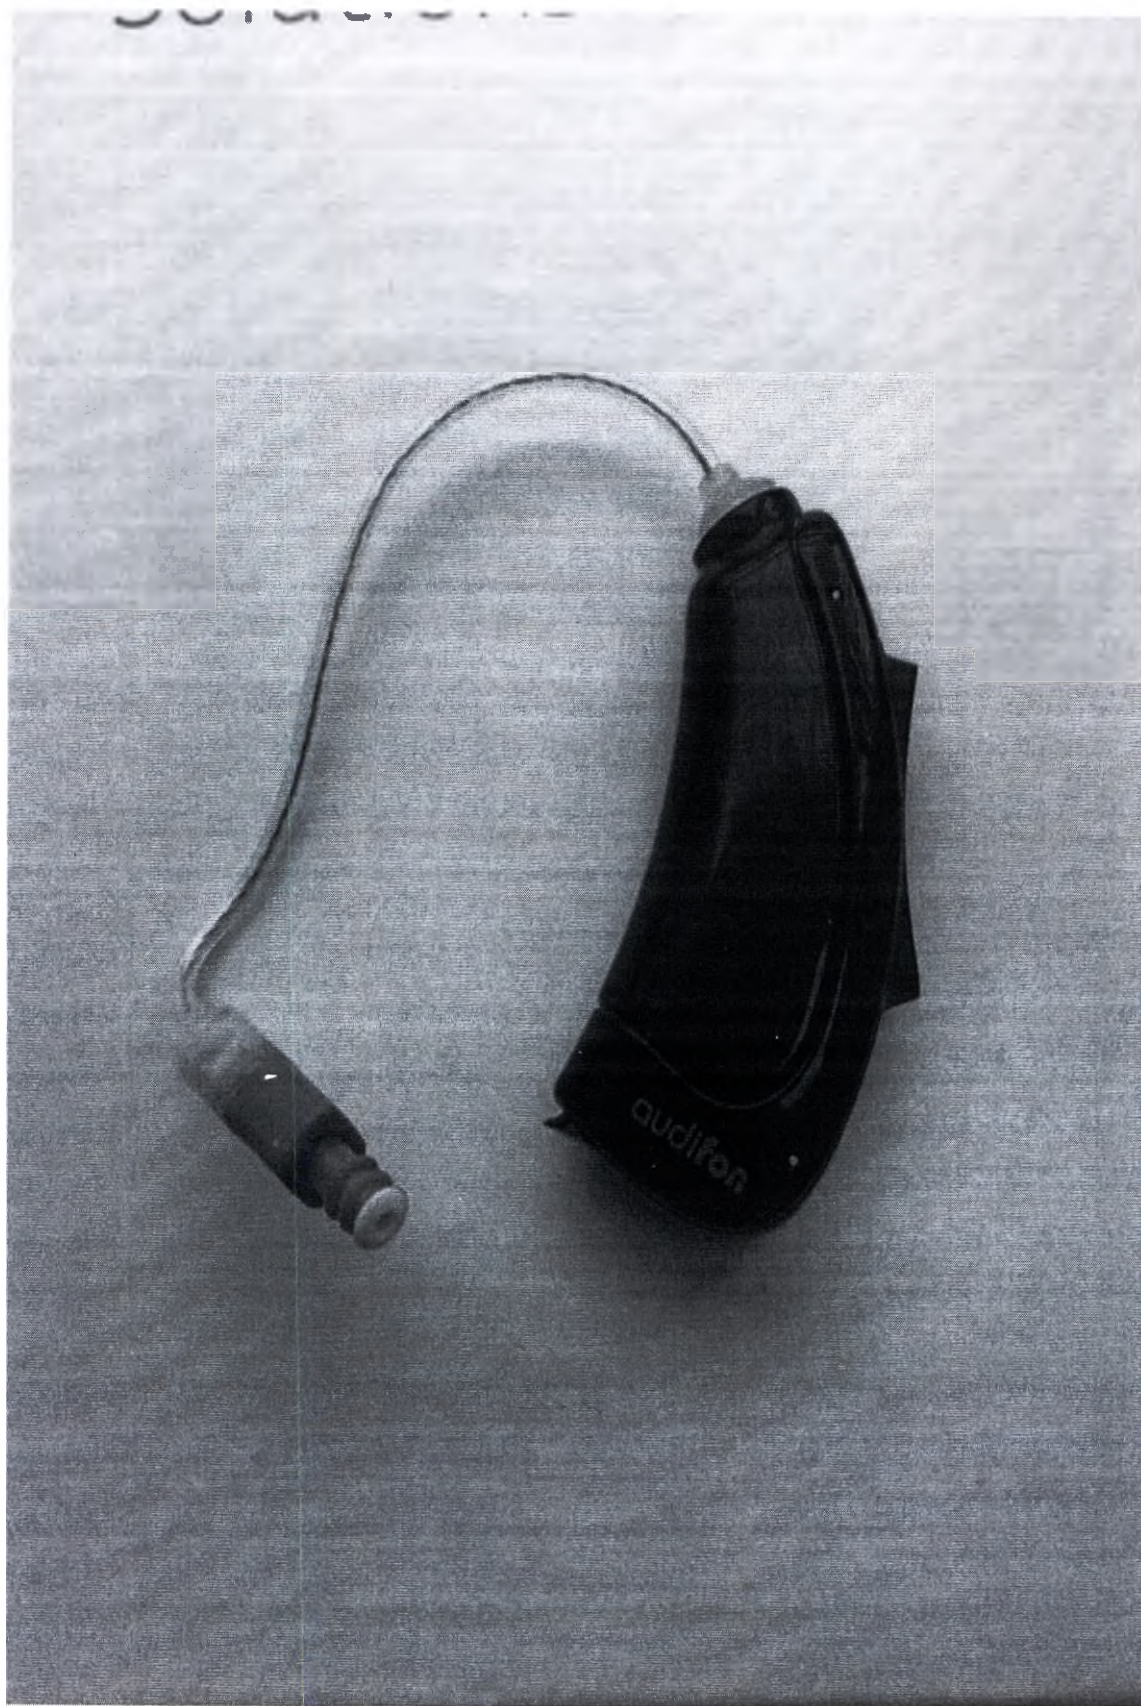


4. Аппарат слуховой audifon rega R, заушный.

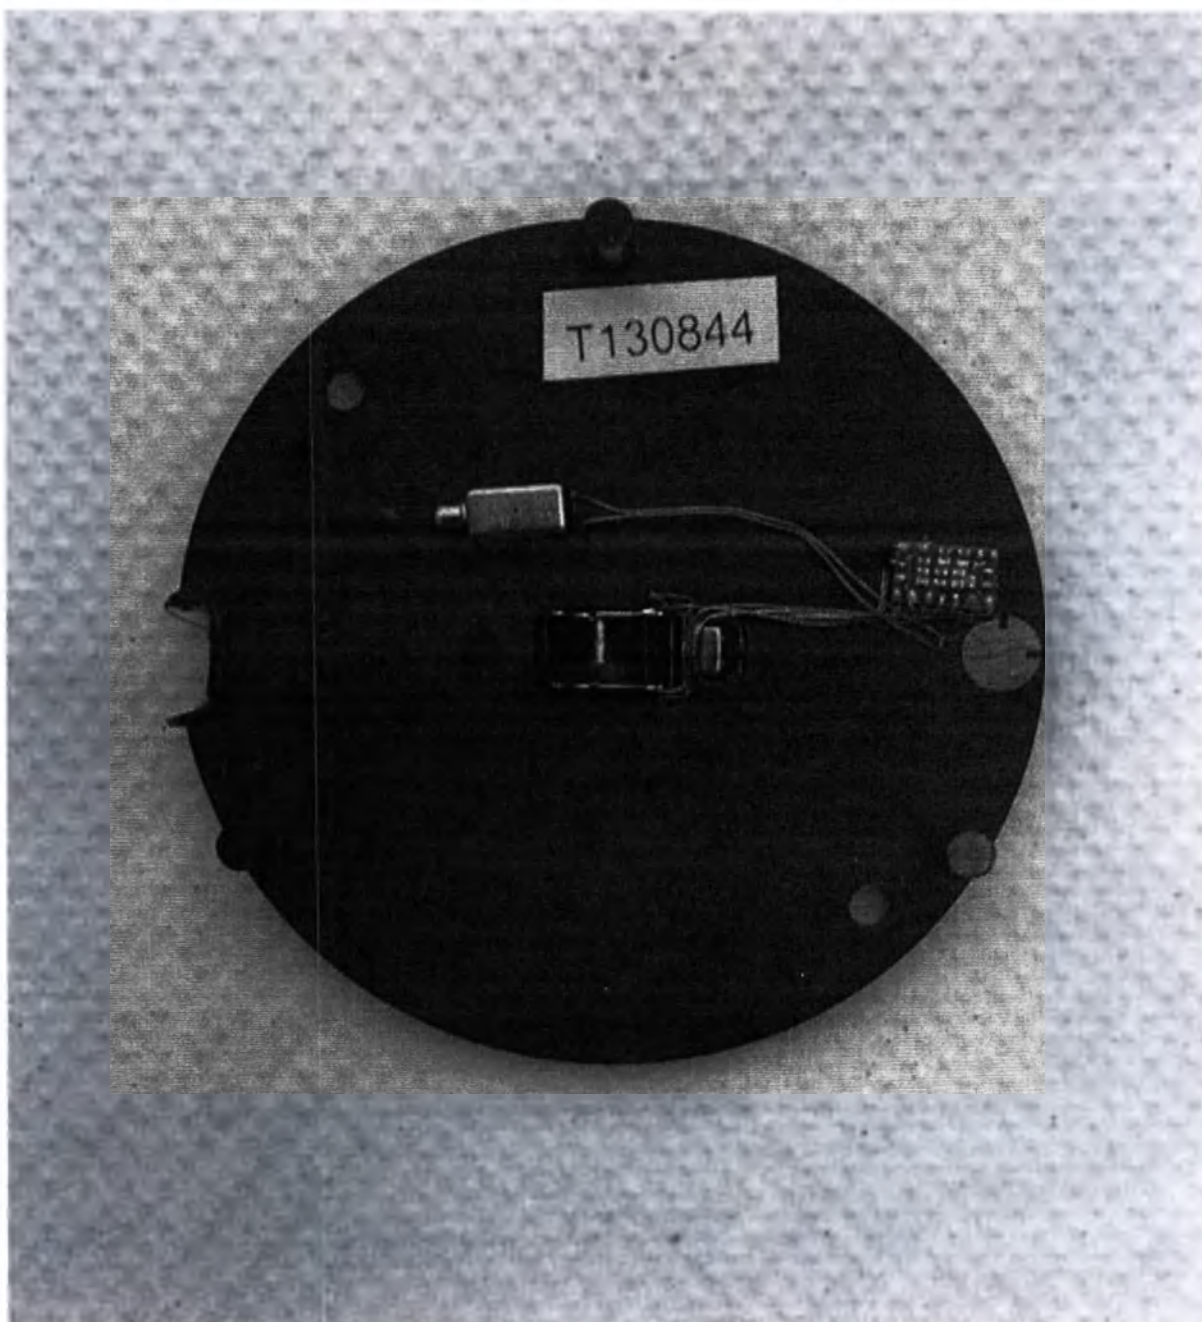


5. Аппарат слуховой audifon rega pico faceplate, внутриканальный.

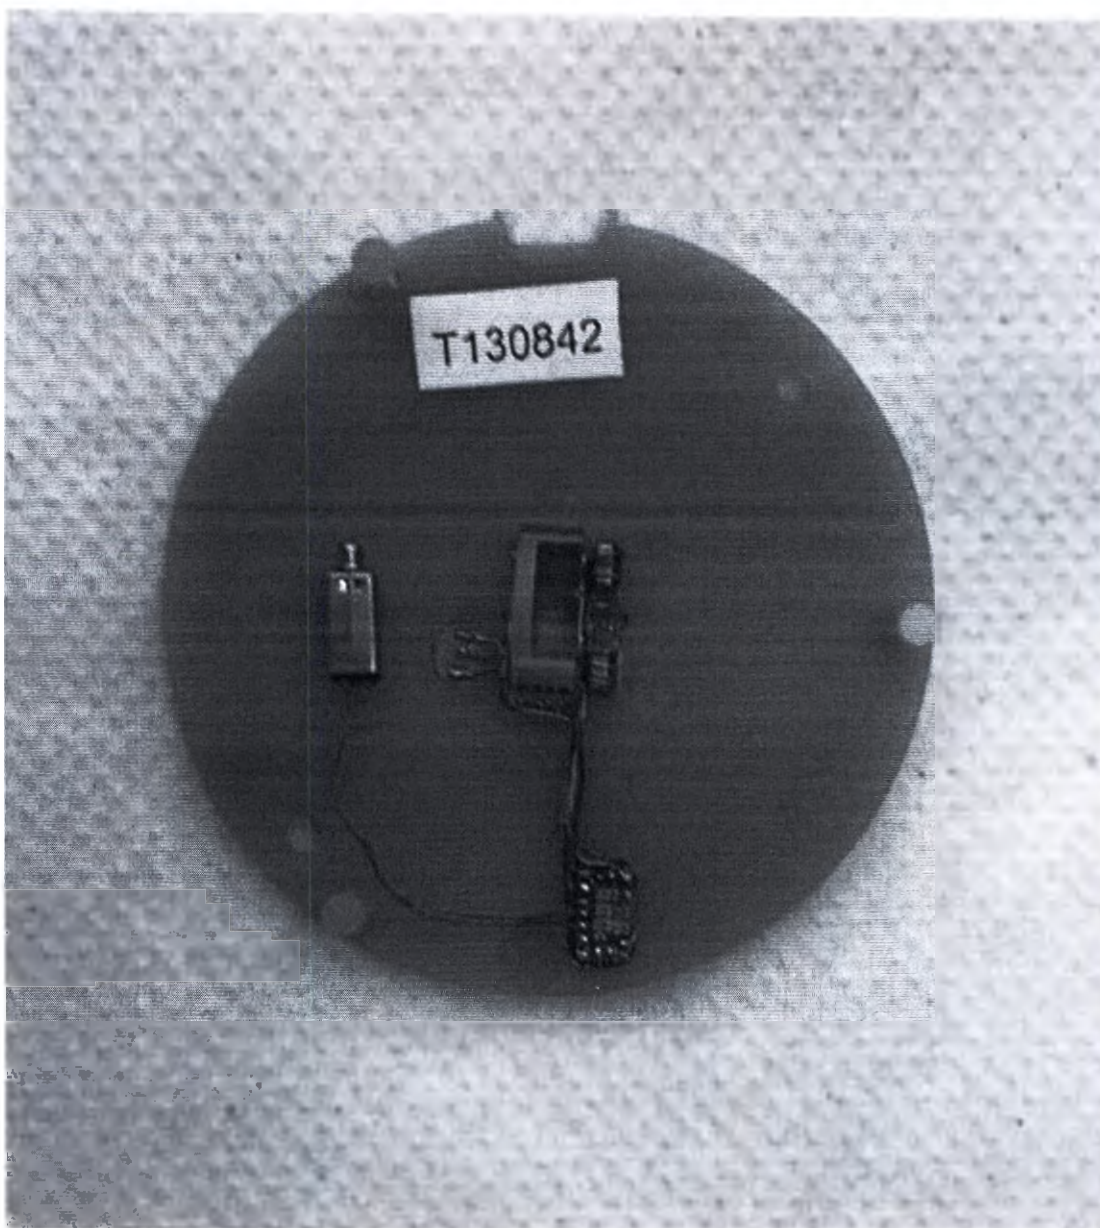


6. Аппарат слуховой audifon rega CIC faceplate, внутриканальный.

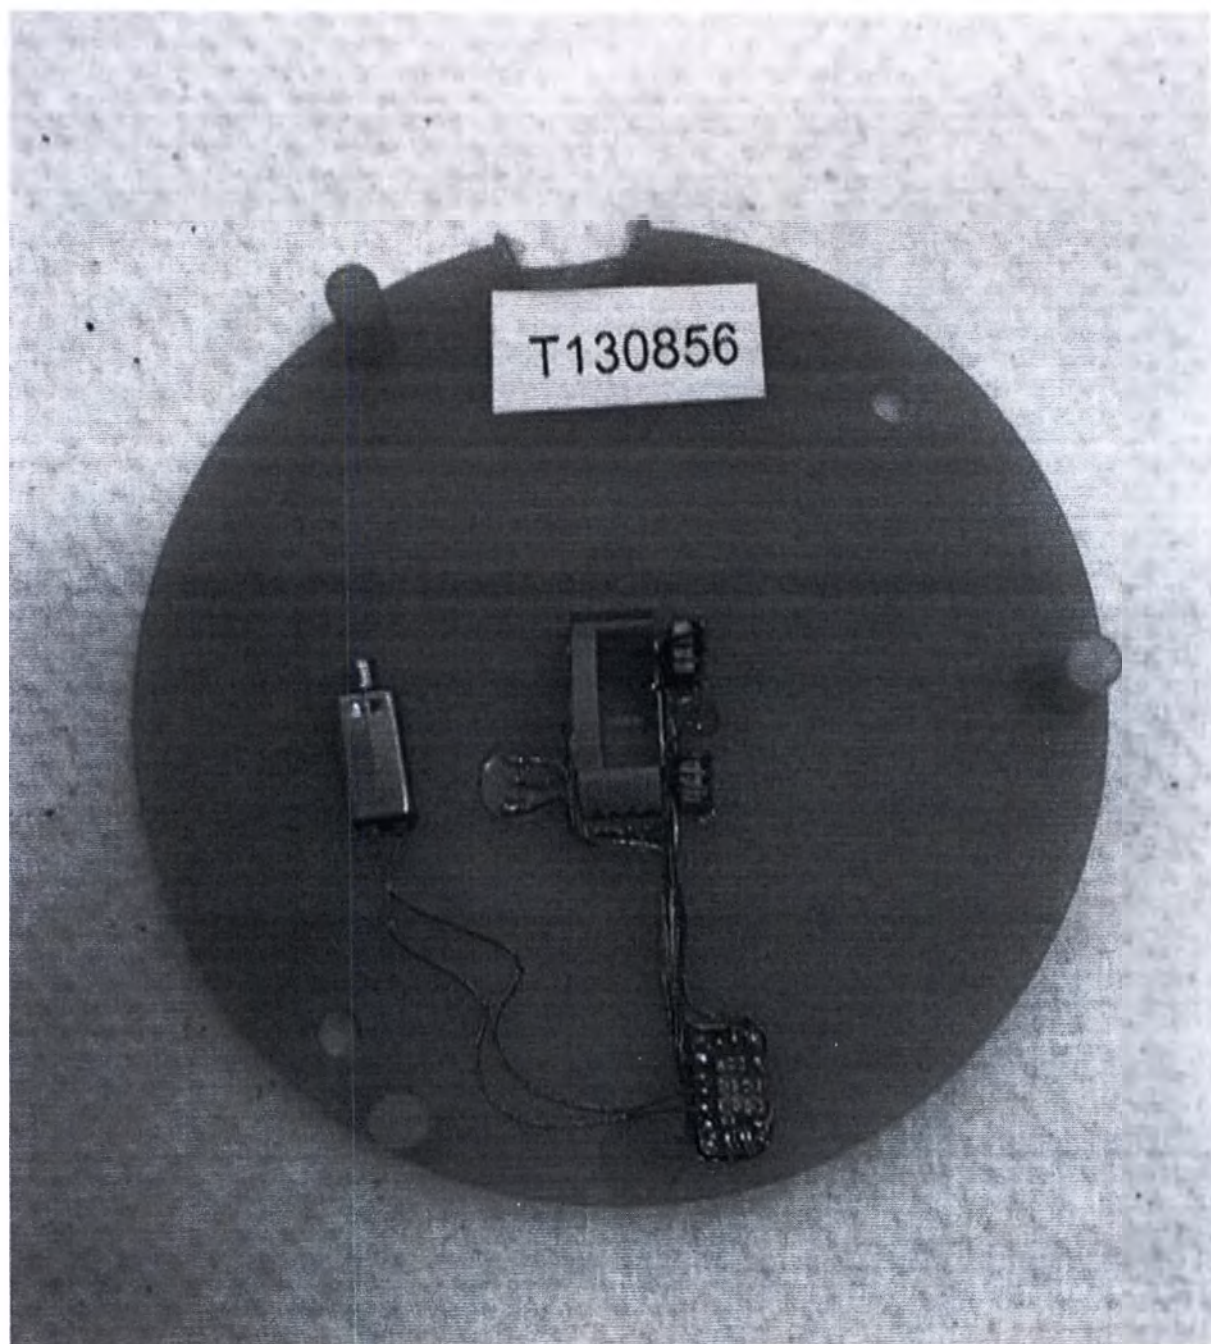


7. Аппарат слуховой audifon rega ITE V50 faceplate, внутриушной.

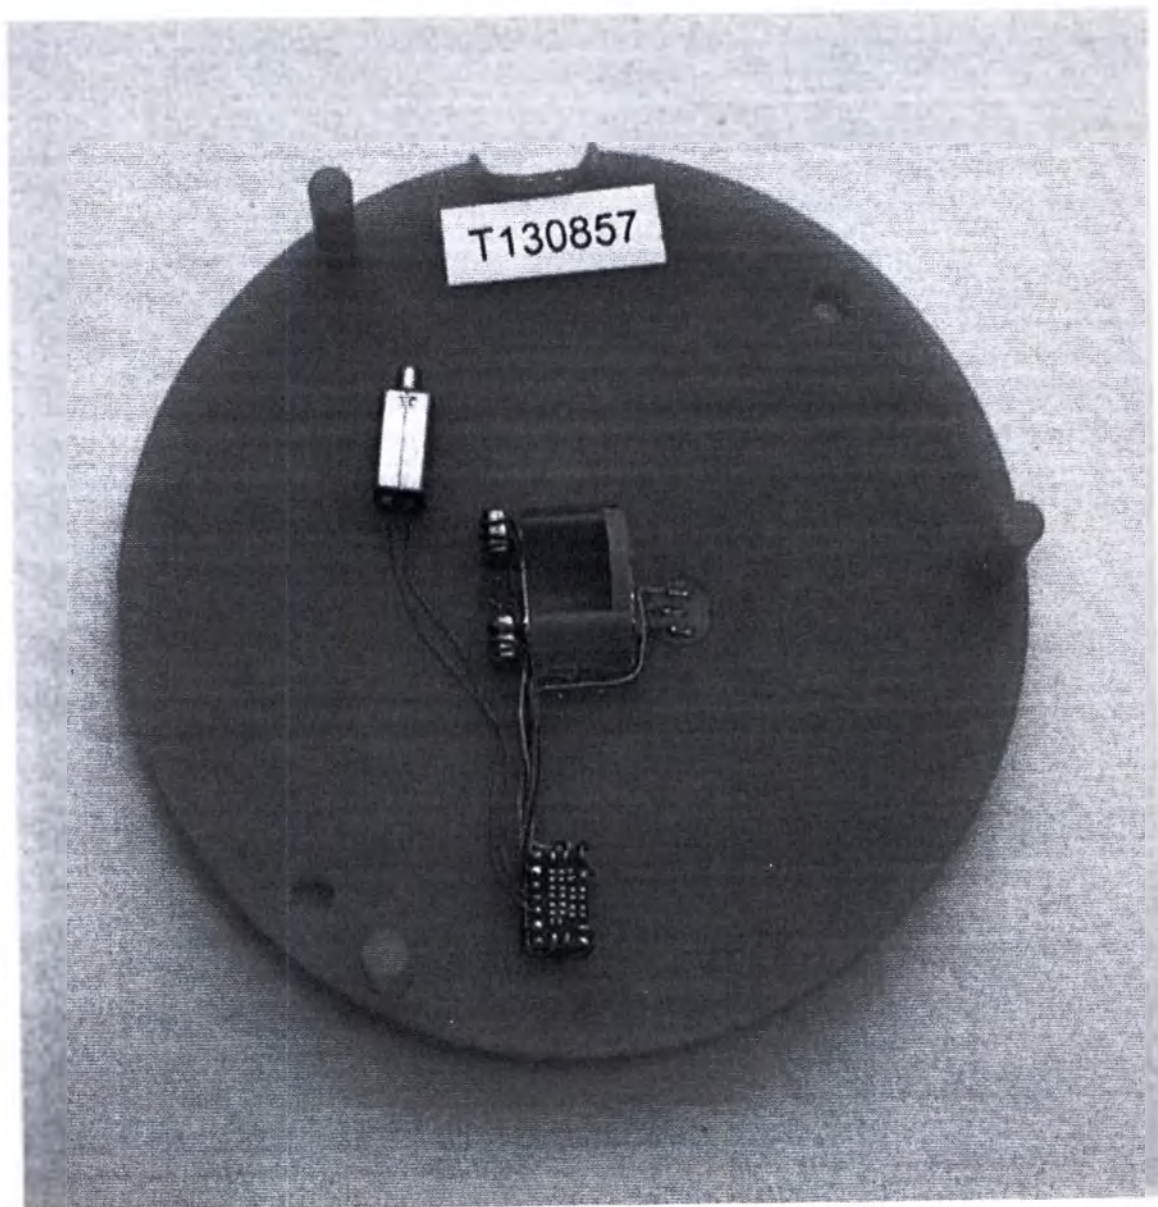


8. Аппарат слуховой audifon rega ITE V60 faceplate, внутриушной.

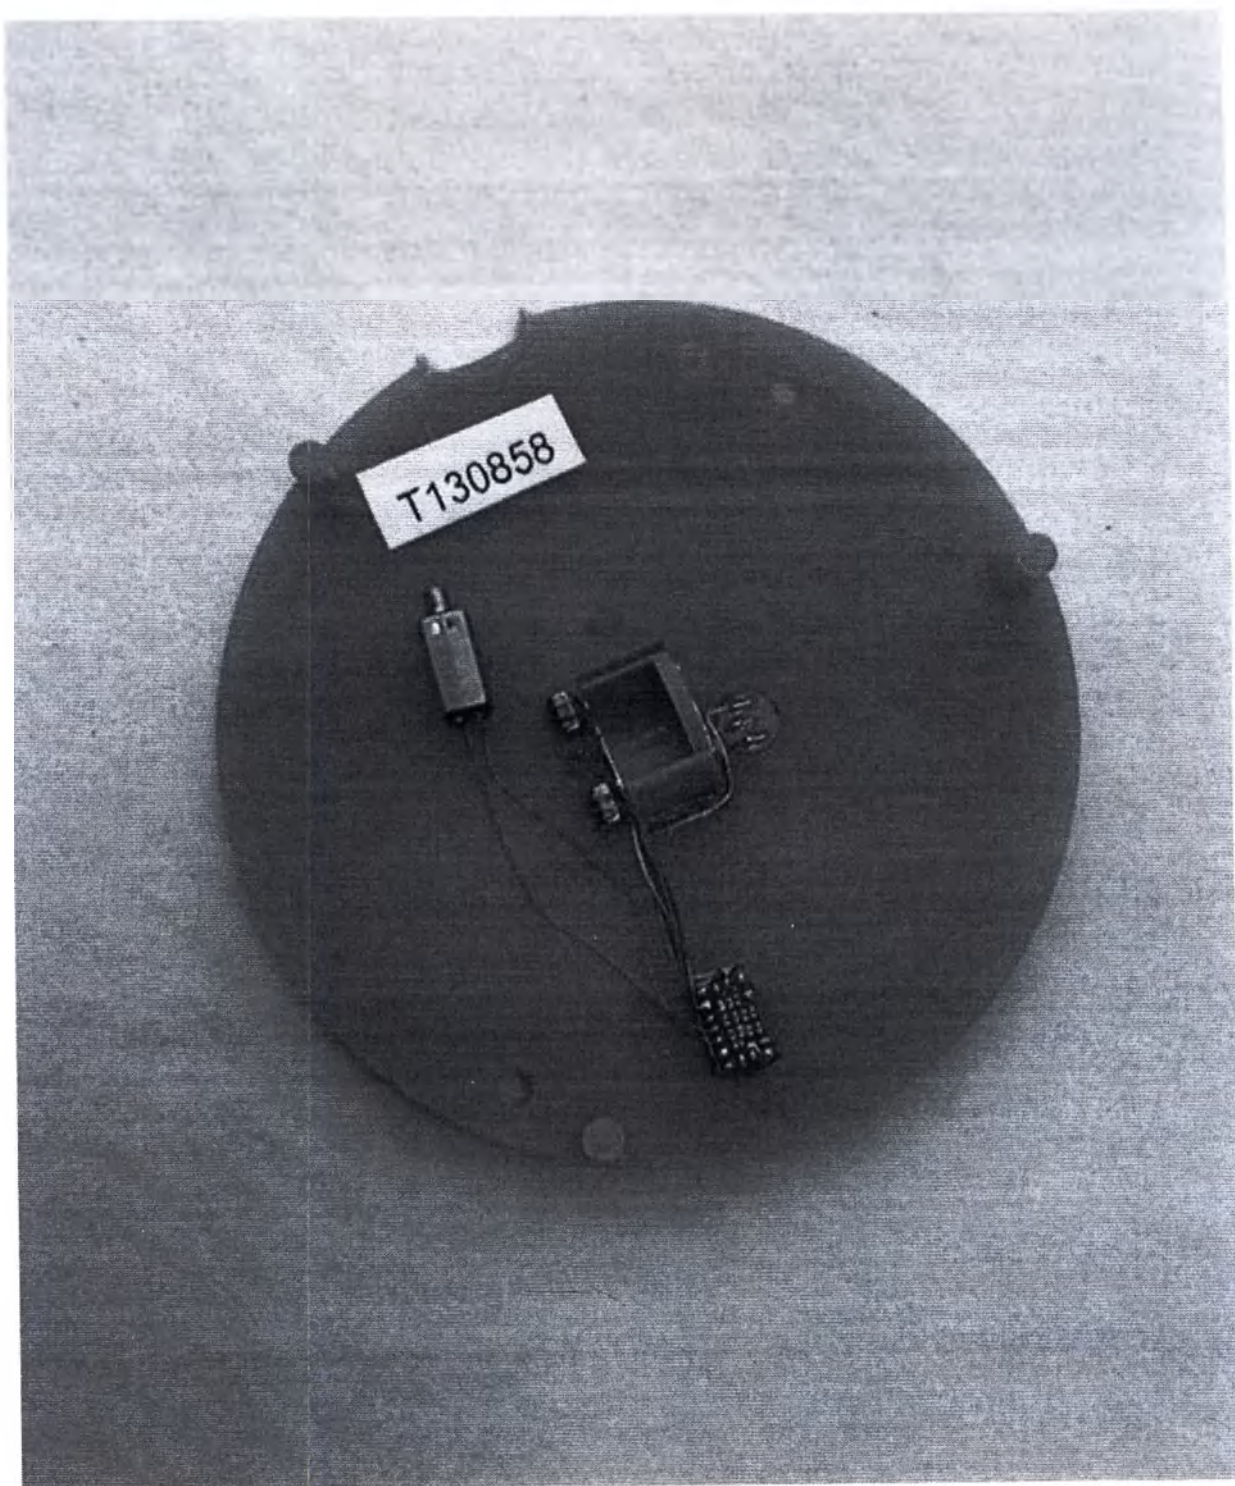


9. Аппарат слуховой audifon rega ITE V70 faceplate, внутриушной.

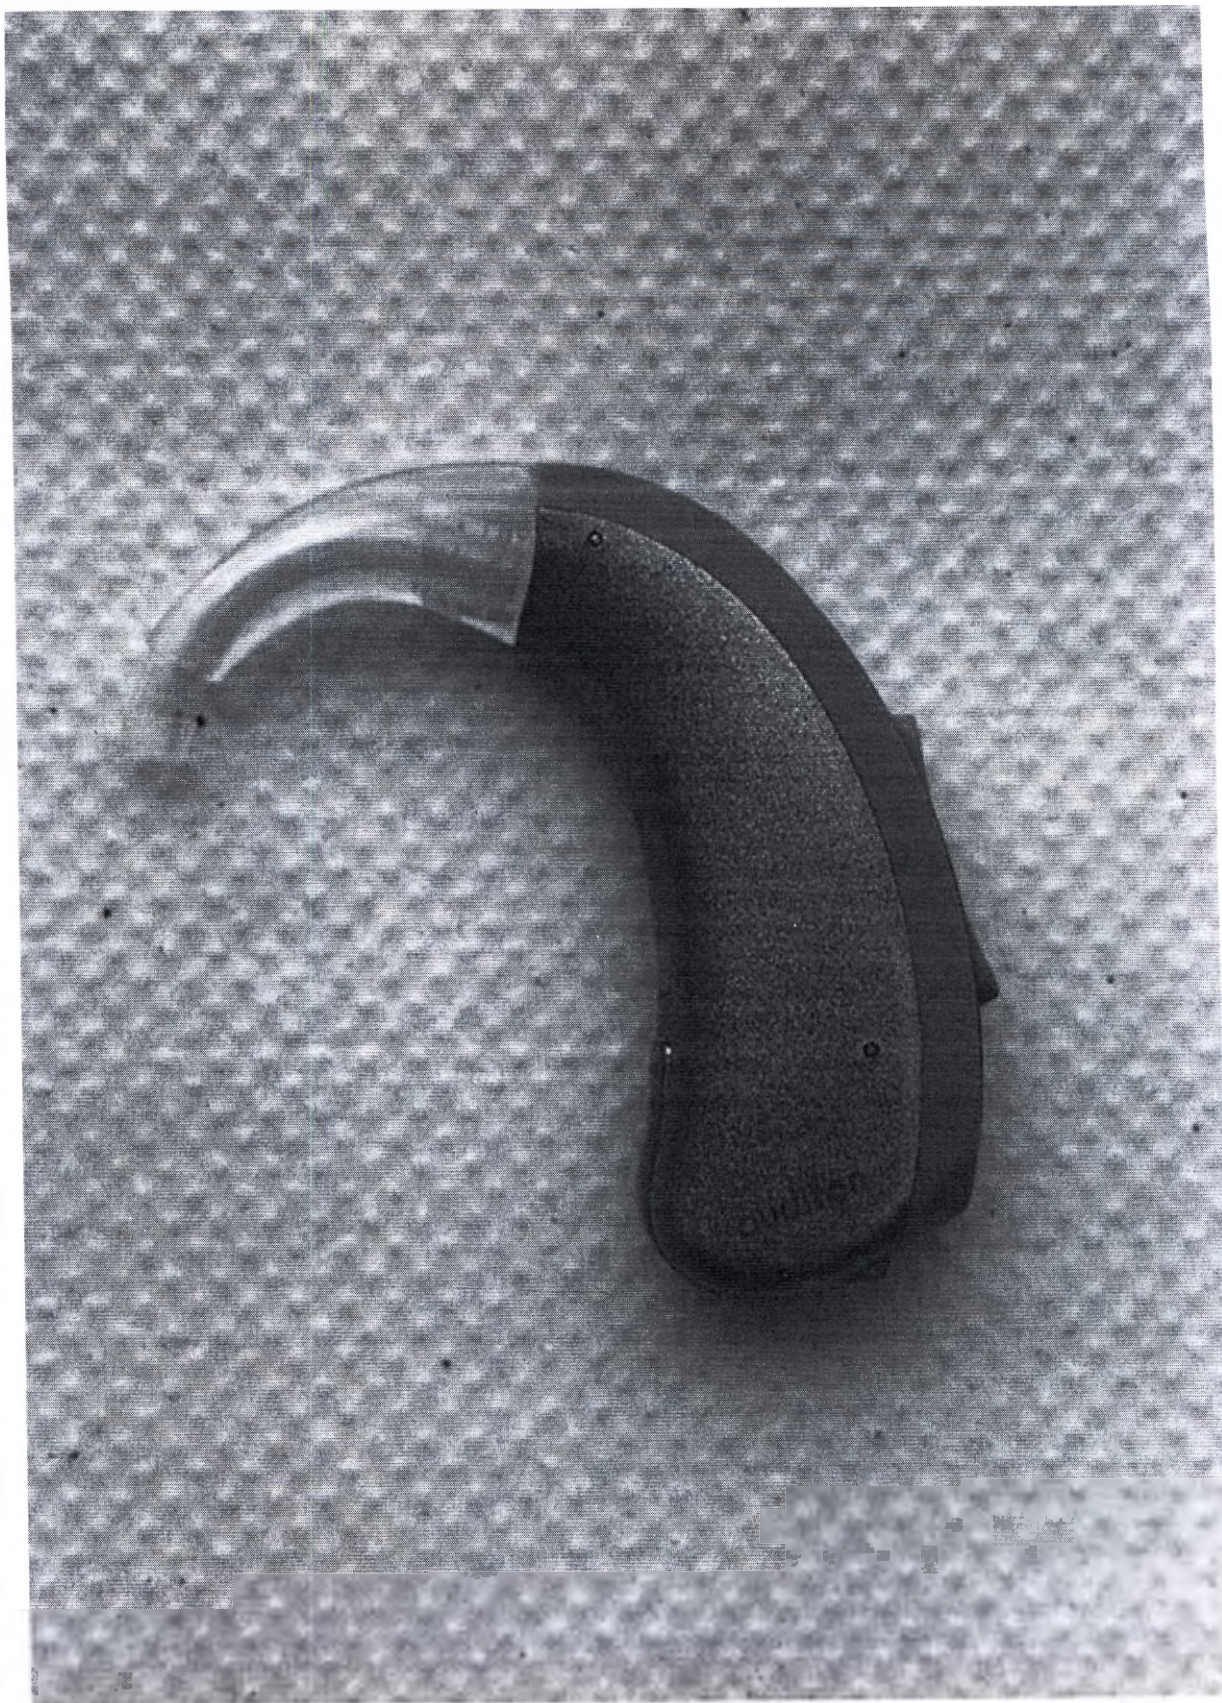


10. Аппарат слуховой audifon kami P, заушный.

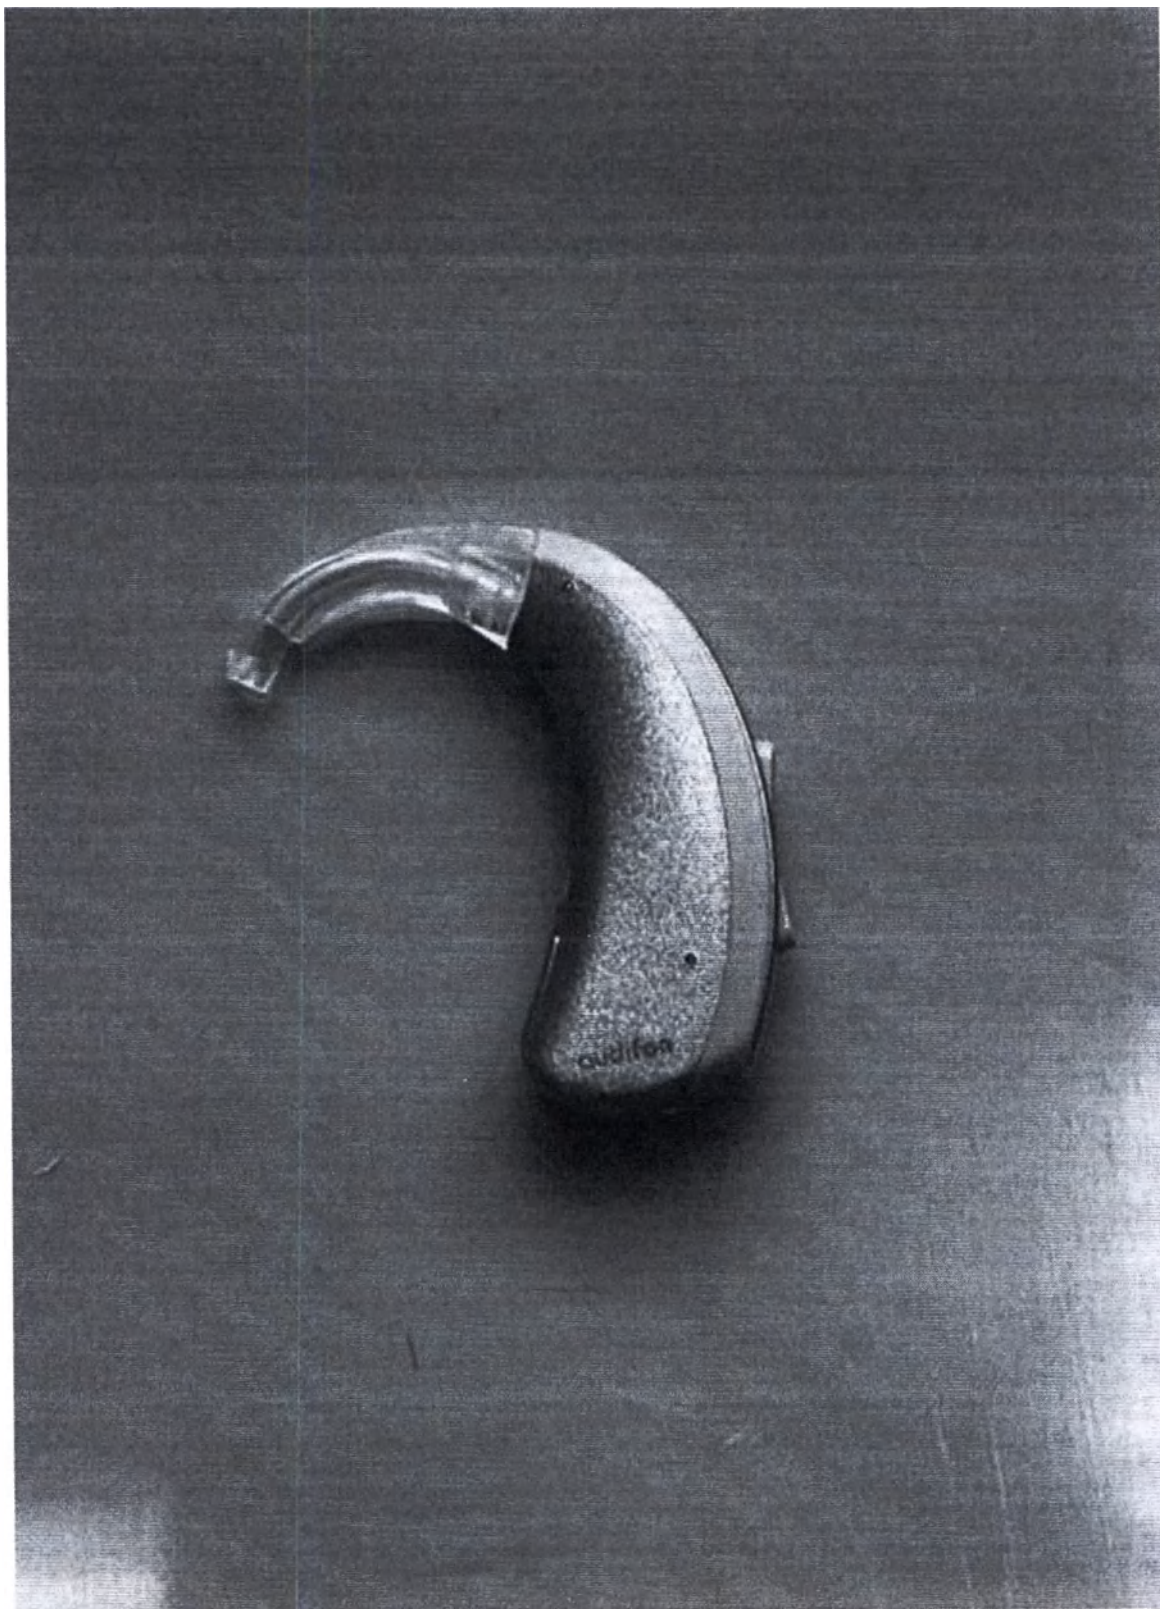


12. Аппарат слуховой audifon kamі XS, заушний.

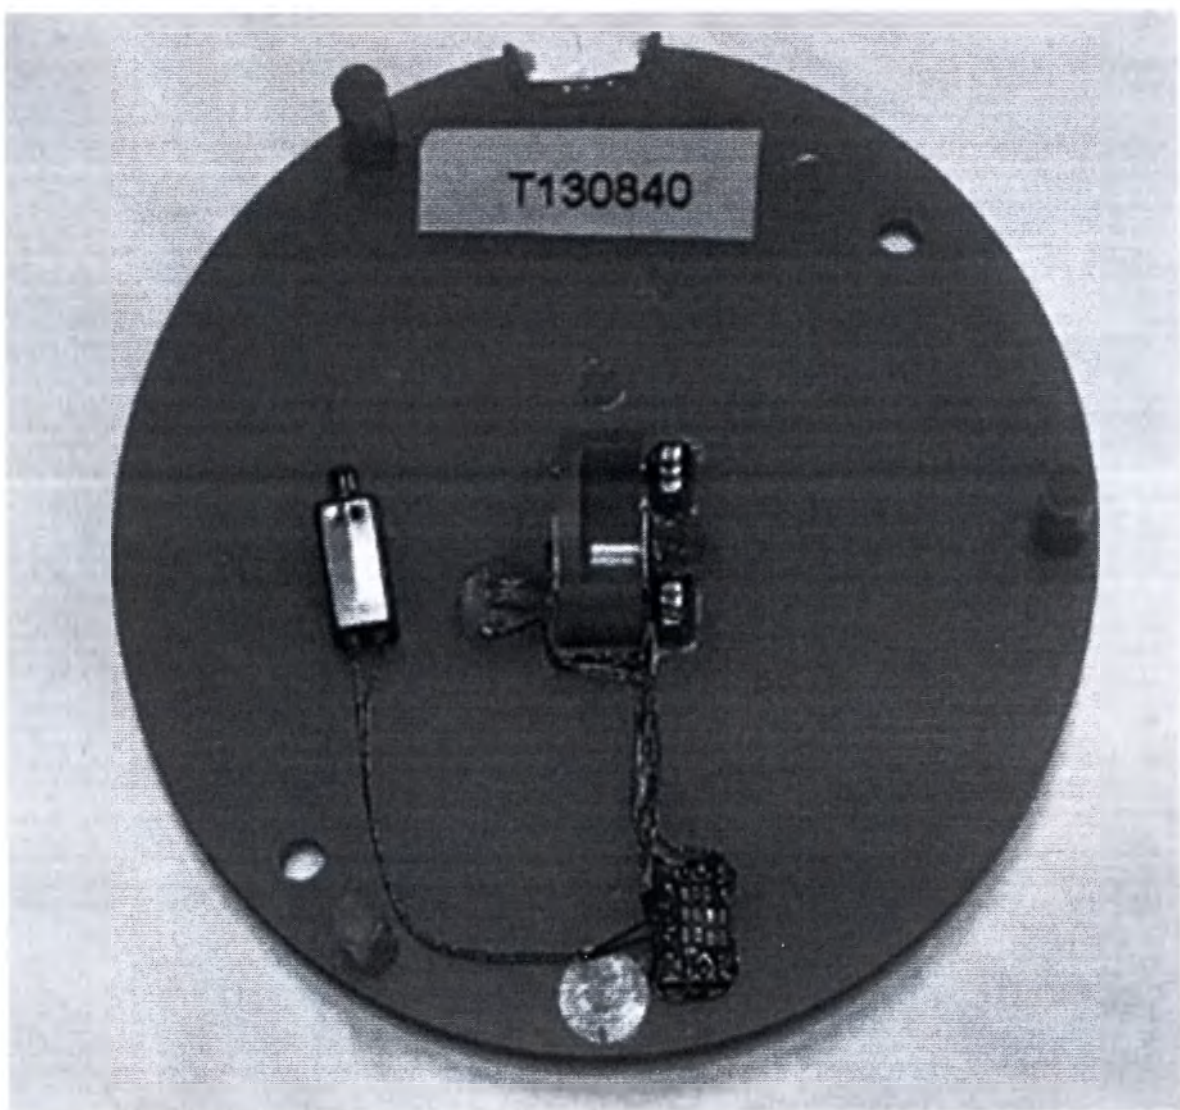


14. Аппарат слуховой audifon kami CIC faceplate, внутриканальный.

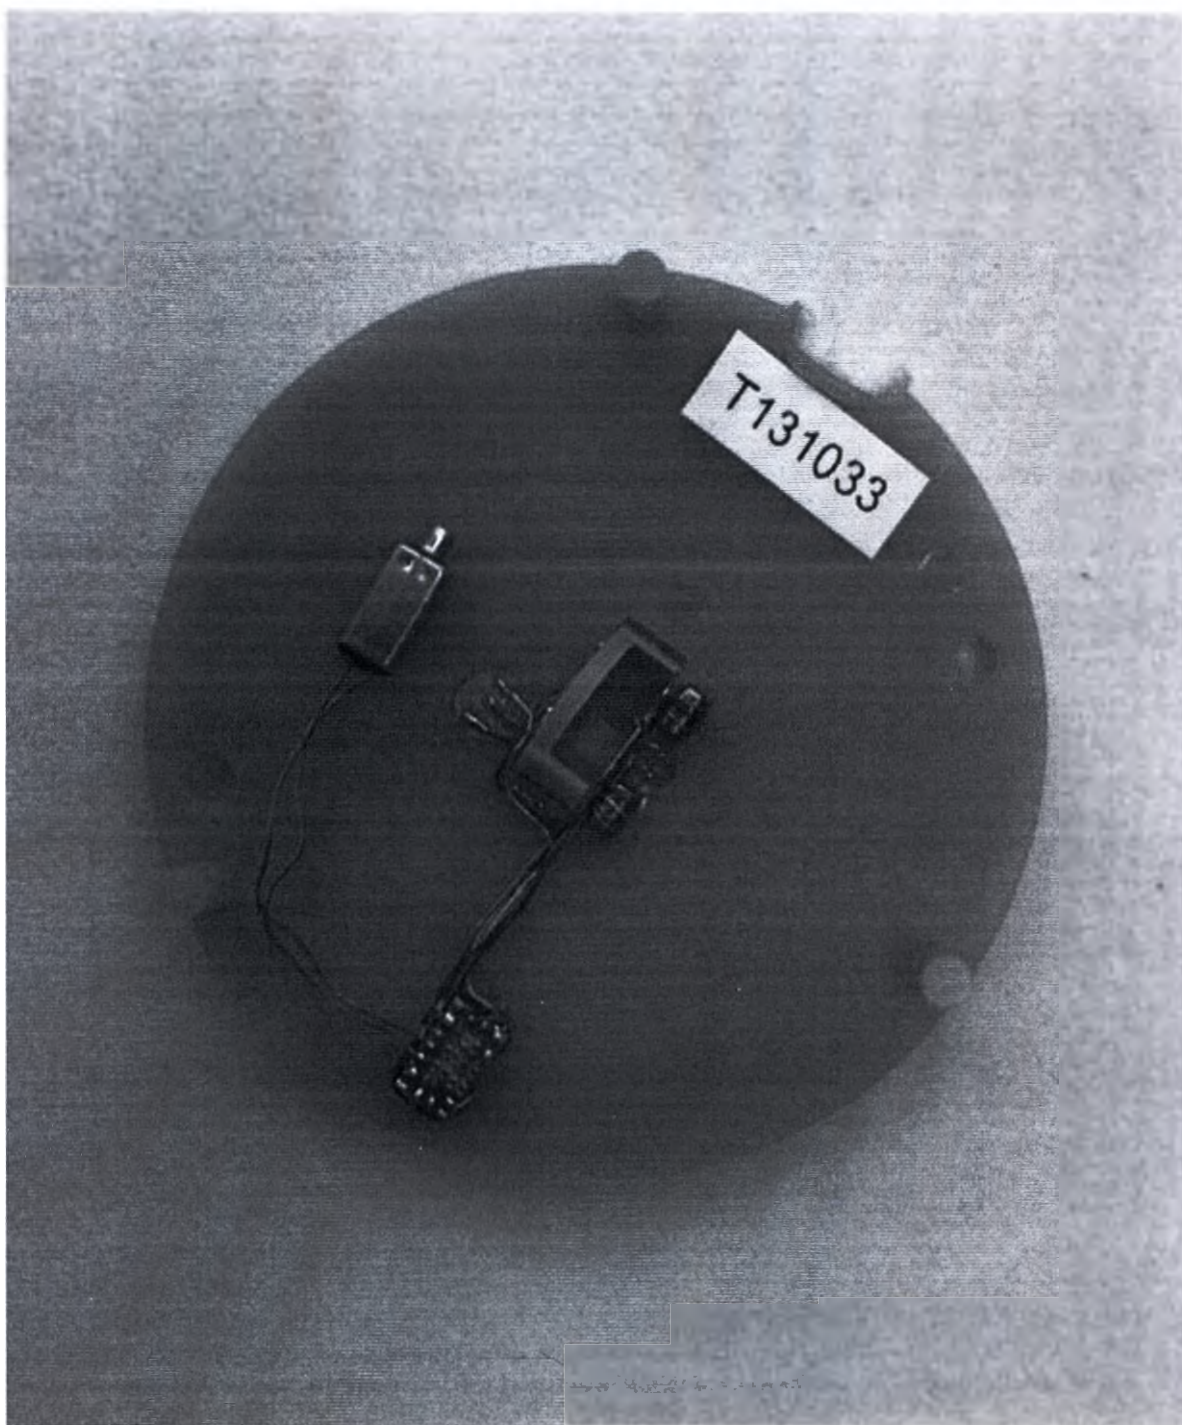

15. Аппарат слуховой audifon kami ITE V50 faceplate, внутриушной.

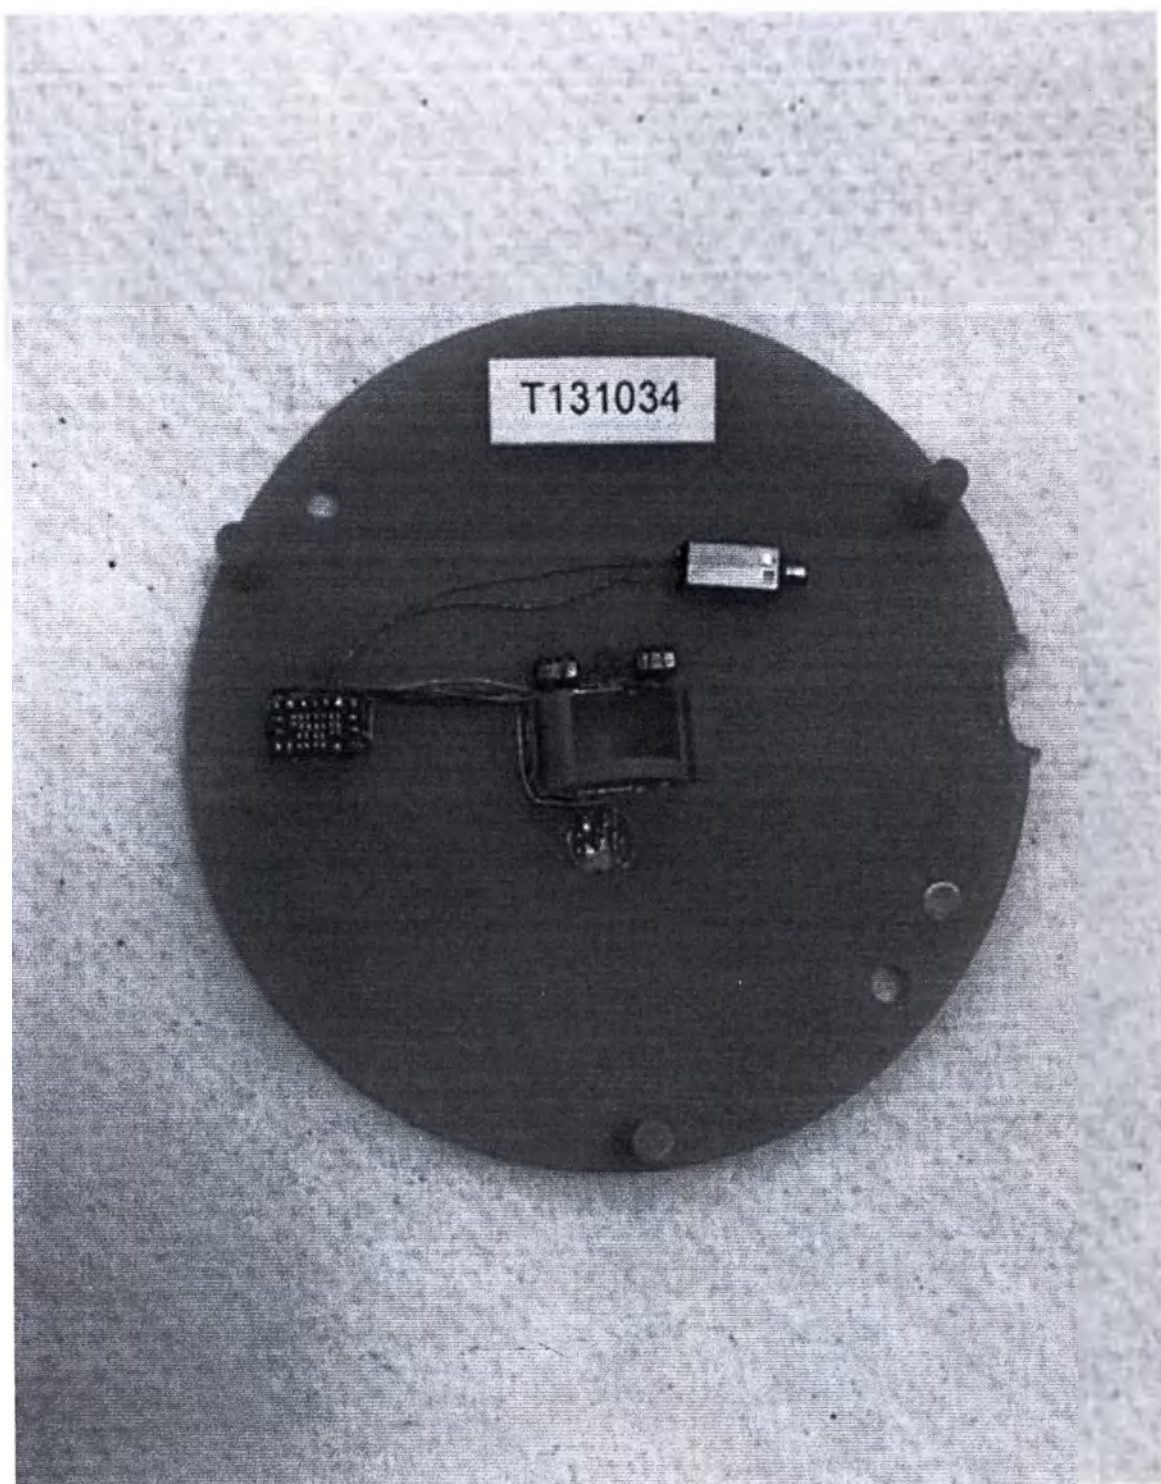


16. Аппарат слуховой audifon kami ITE V60 faceplate, внутриушной

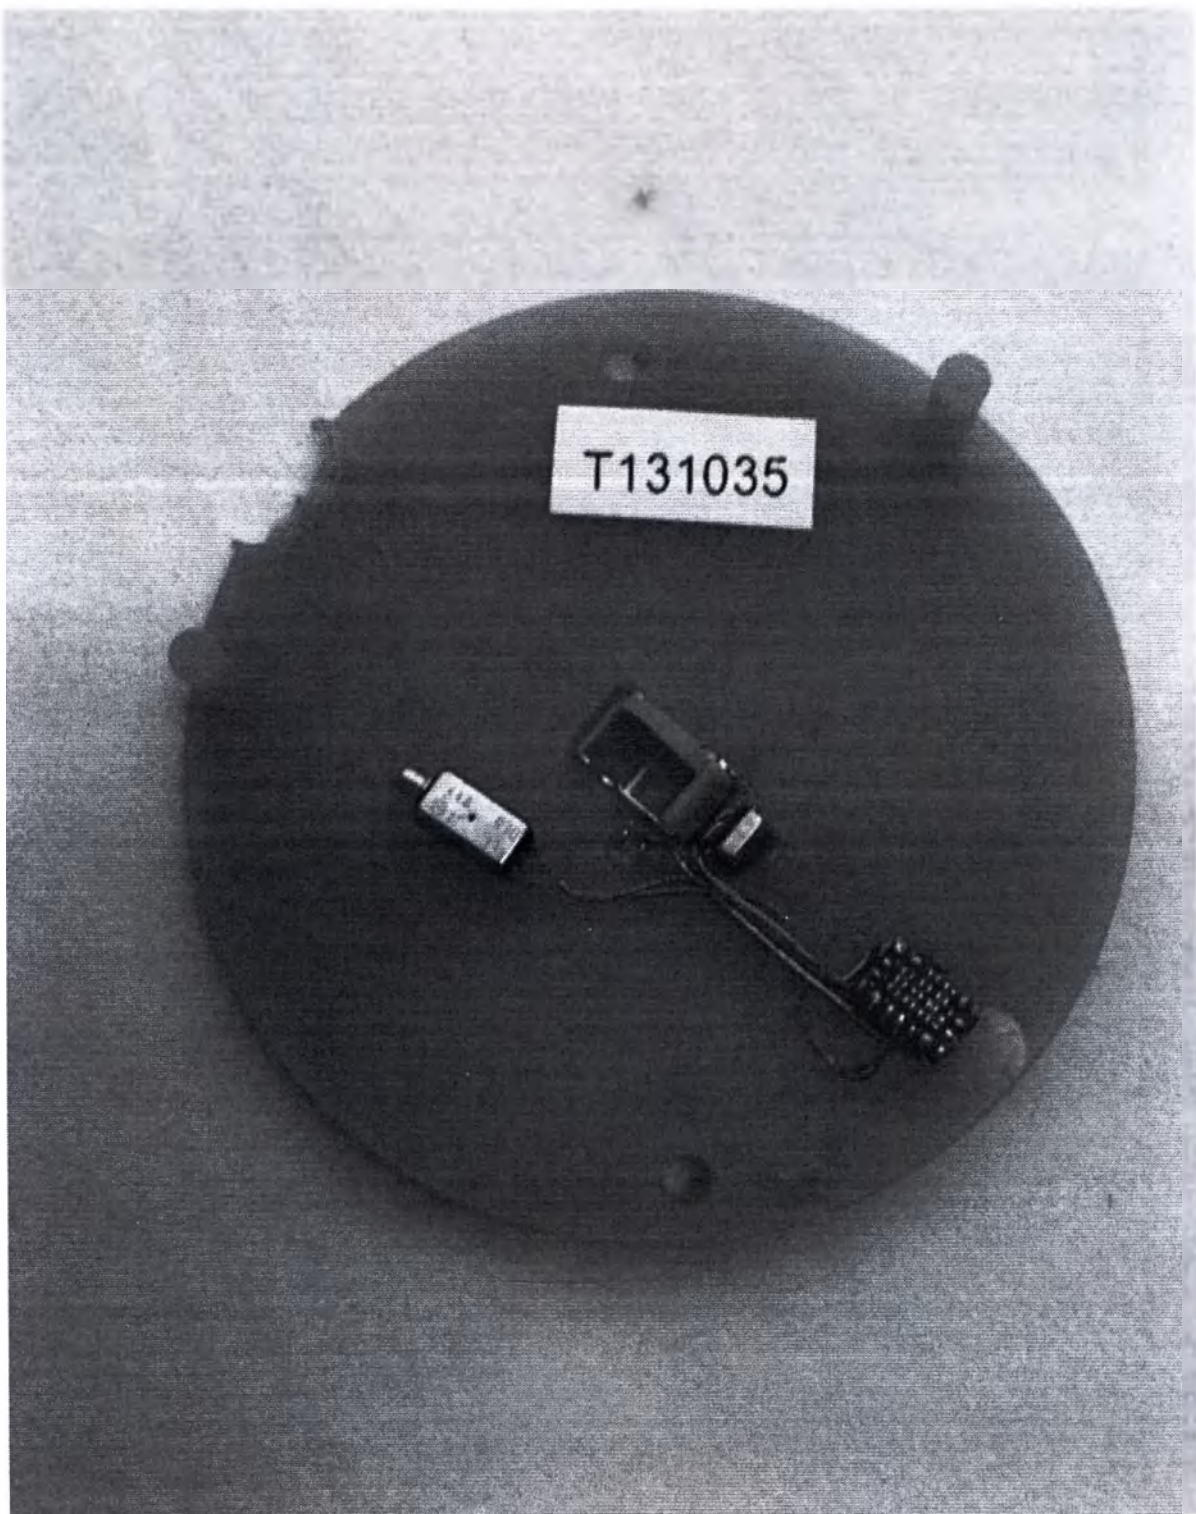

17. Аппарат слуховой audifon kami ITE V70 faceplate, внутриушной.



18. Аппарат слуховой audifon sino P, заушный.

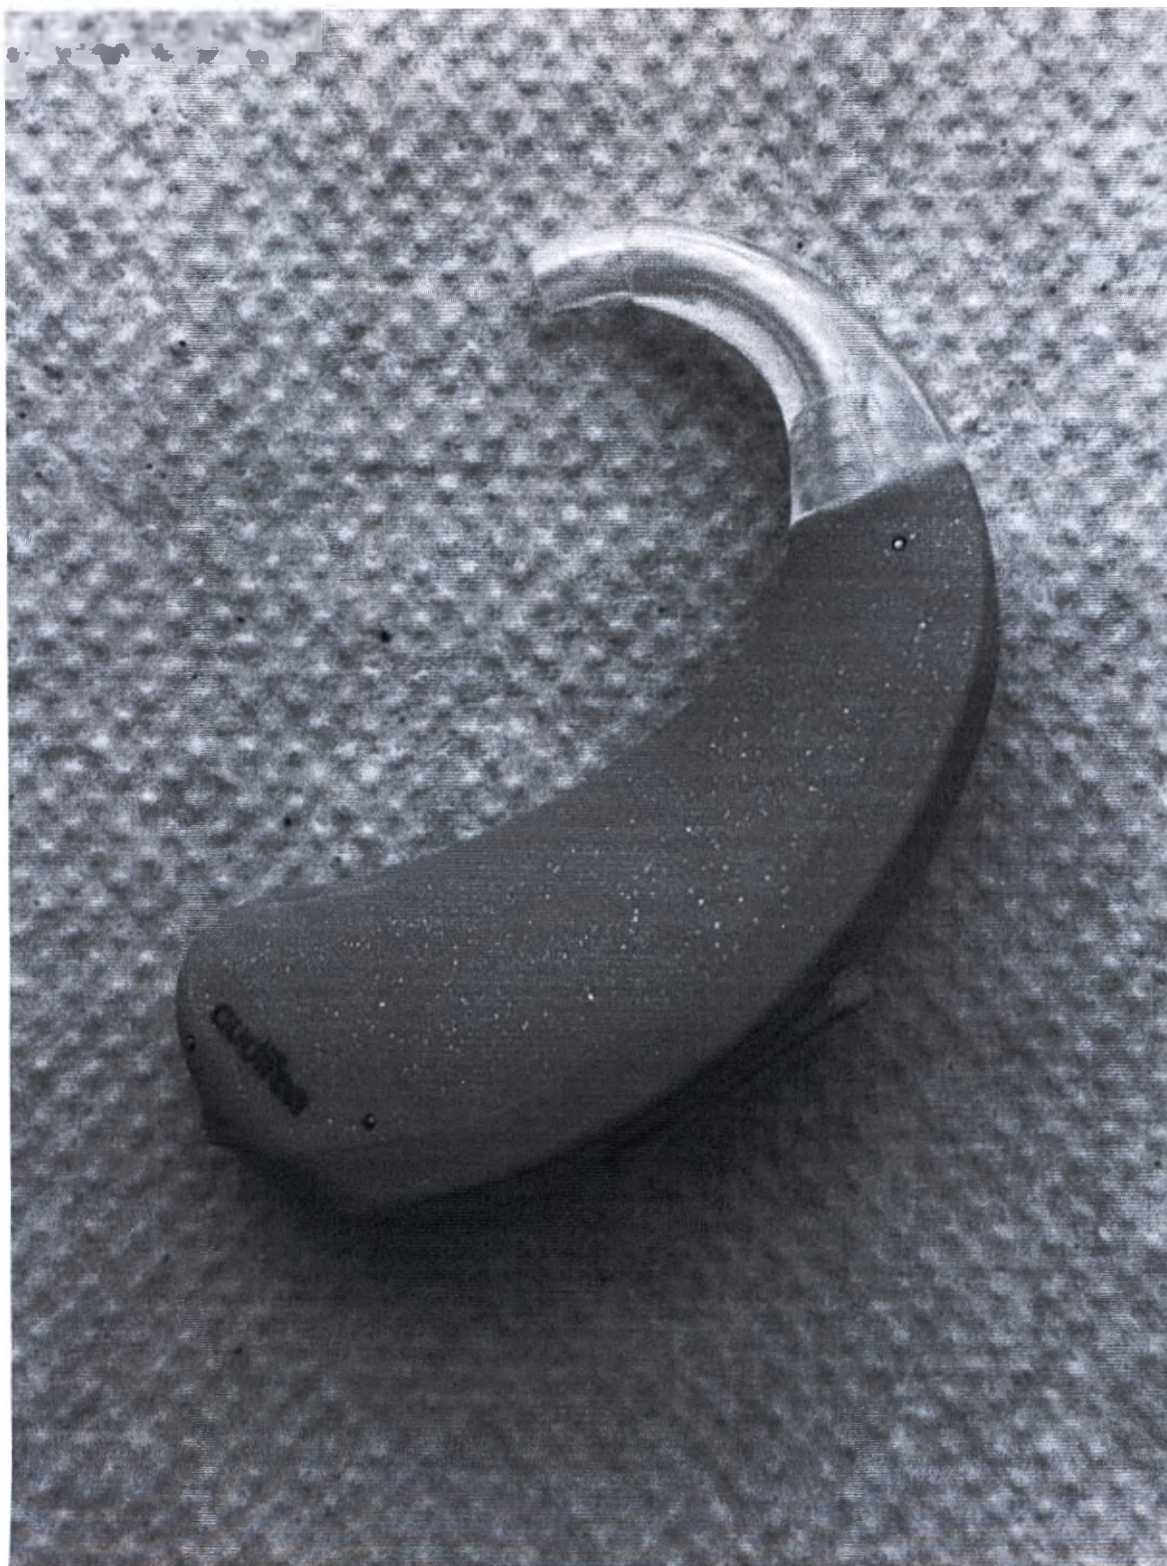


19. Аппарат слуховой audifon sino S, заушный.




20. Аппарат слуховой audifon sino XS, заушный.




21. Аппарат слуховой audifon sino R, заушный.

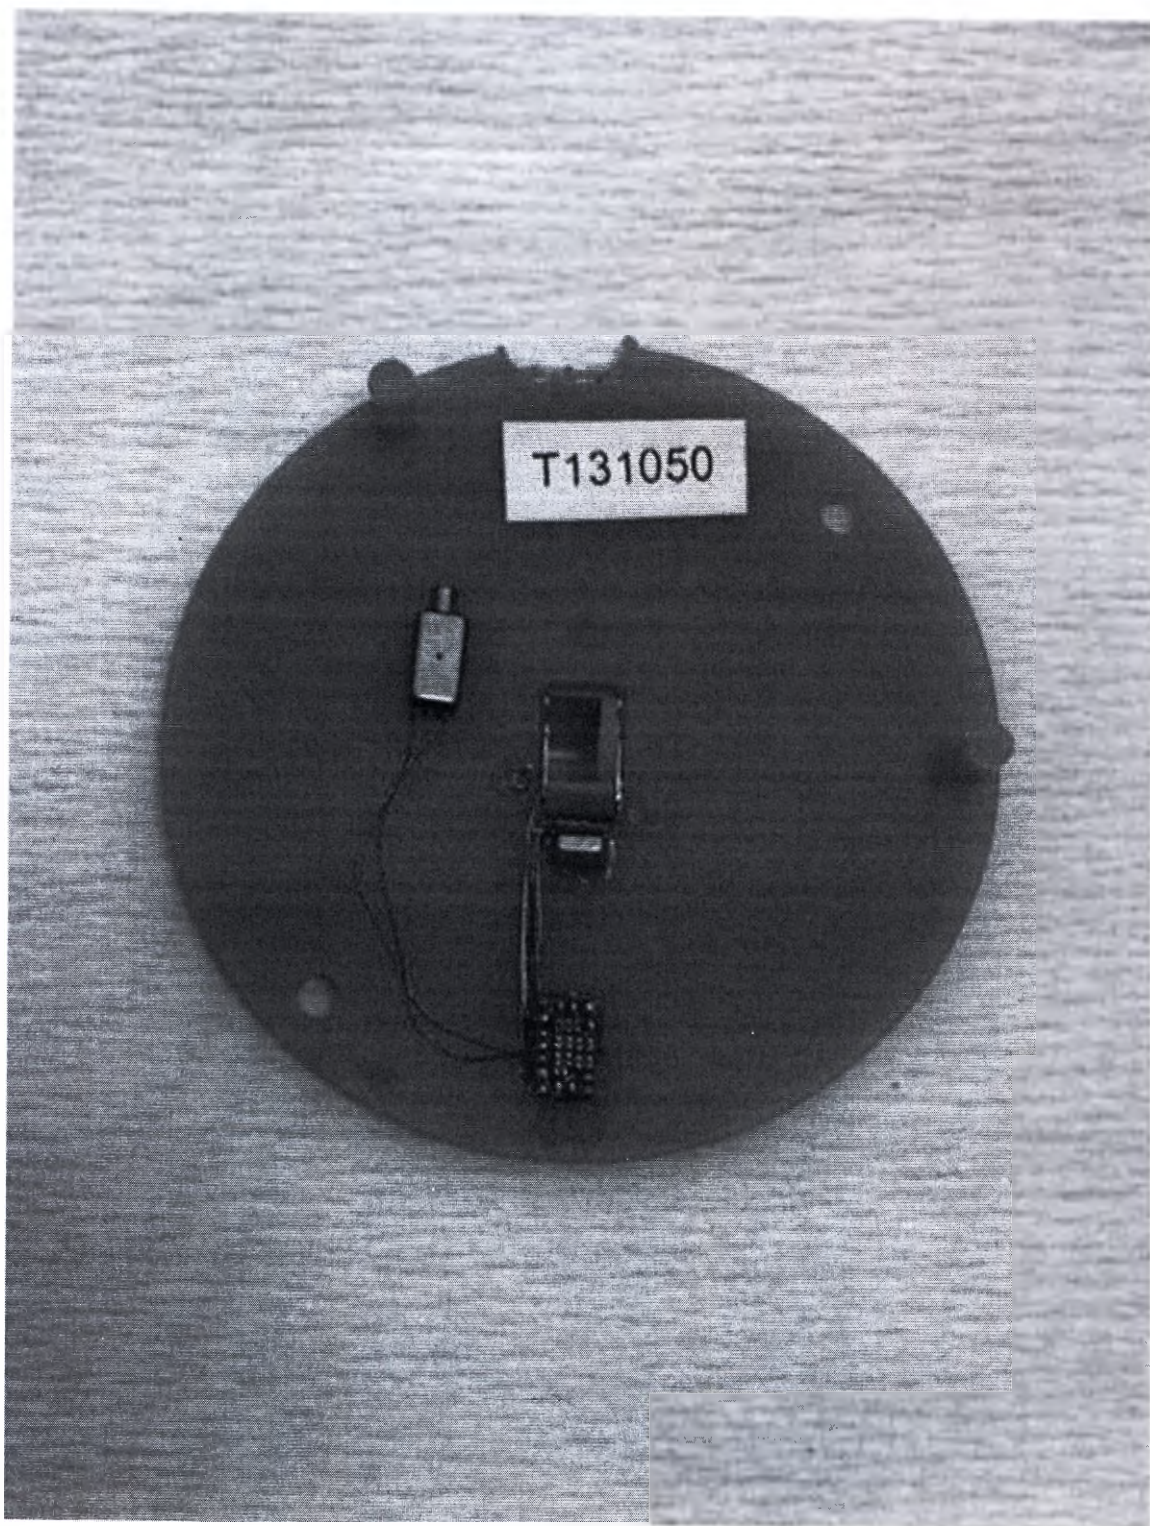


22. Аппарат слуховой audifon sino CIC faceplate, внутриканальный.

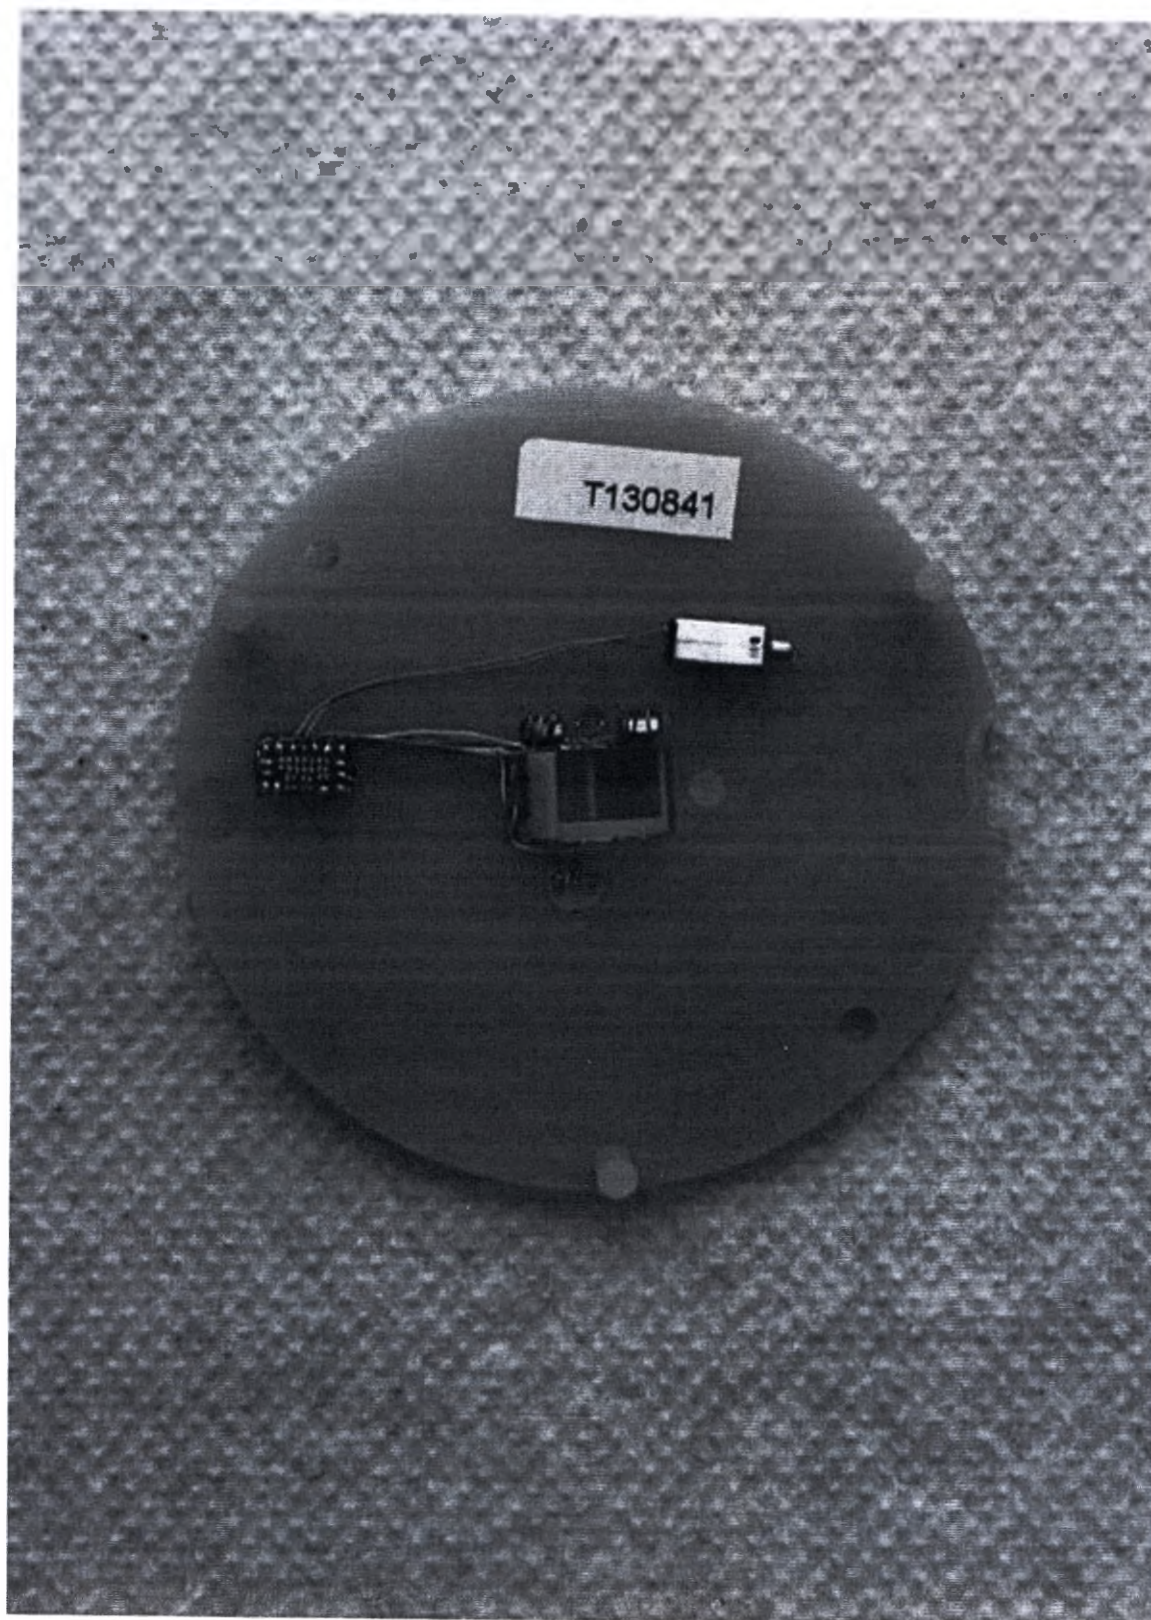

23. Аппарат слуховой audifon sino ITE V50 faceplate, внутриушной.

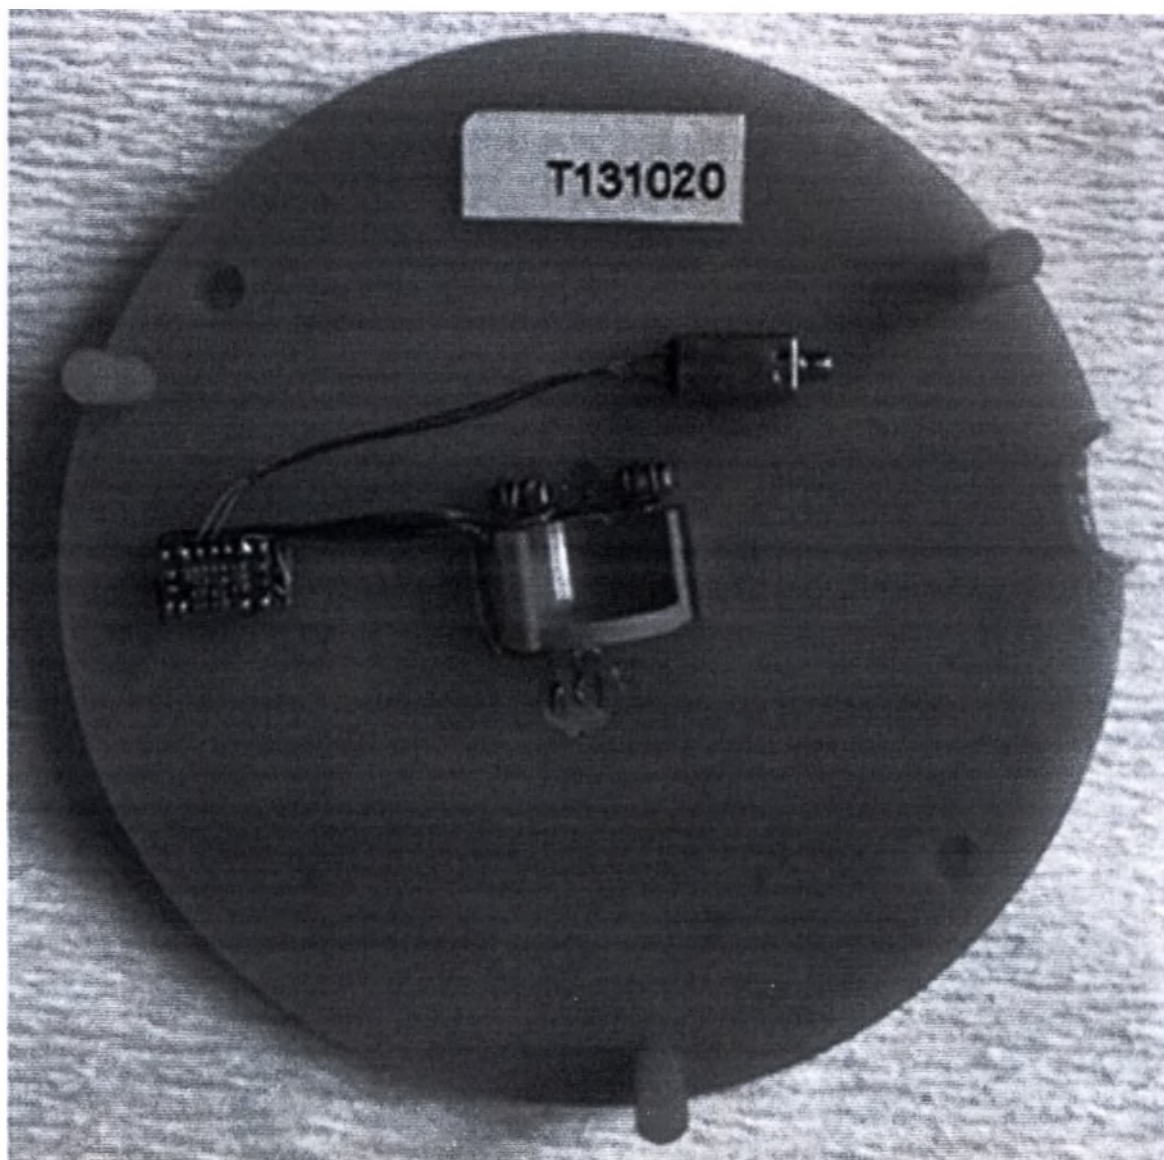


24. Аппарат слуховой audifon sino ITE V60 faceplate, внутриушной.

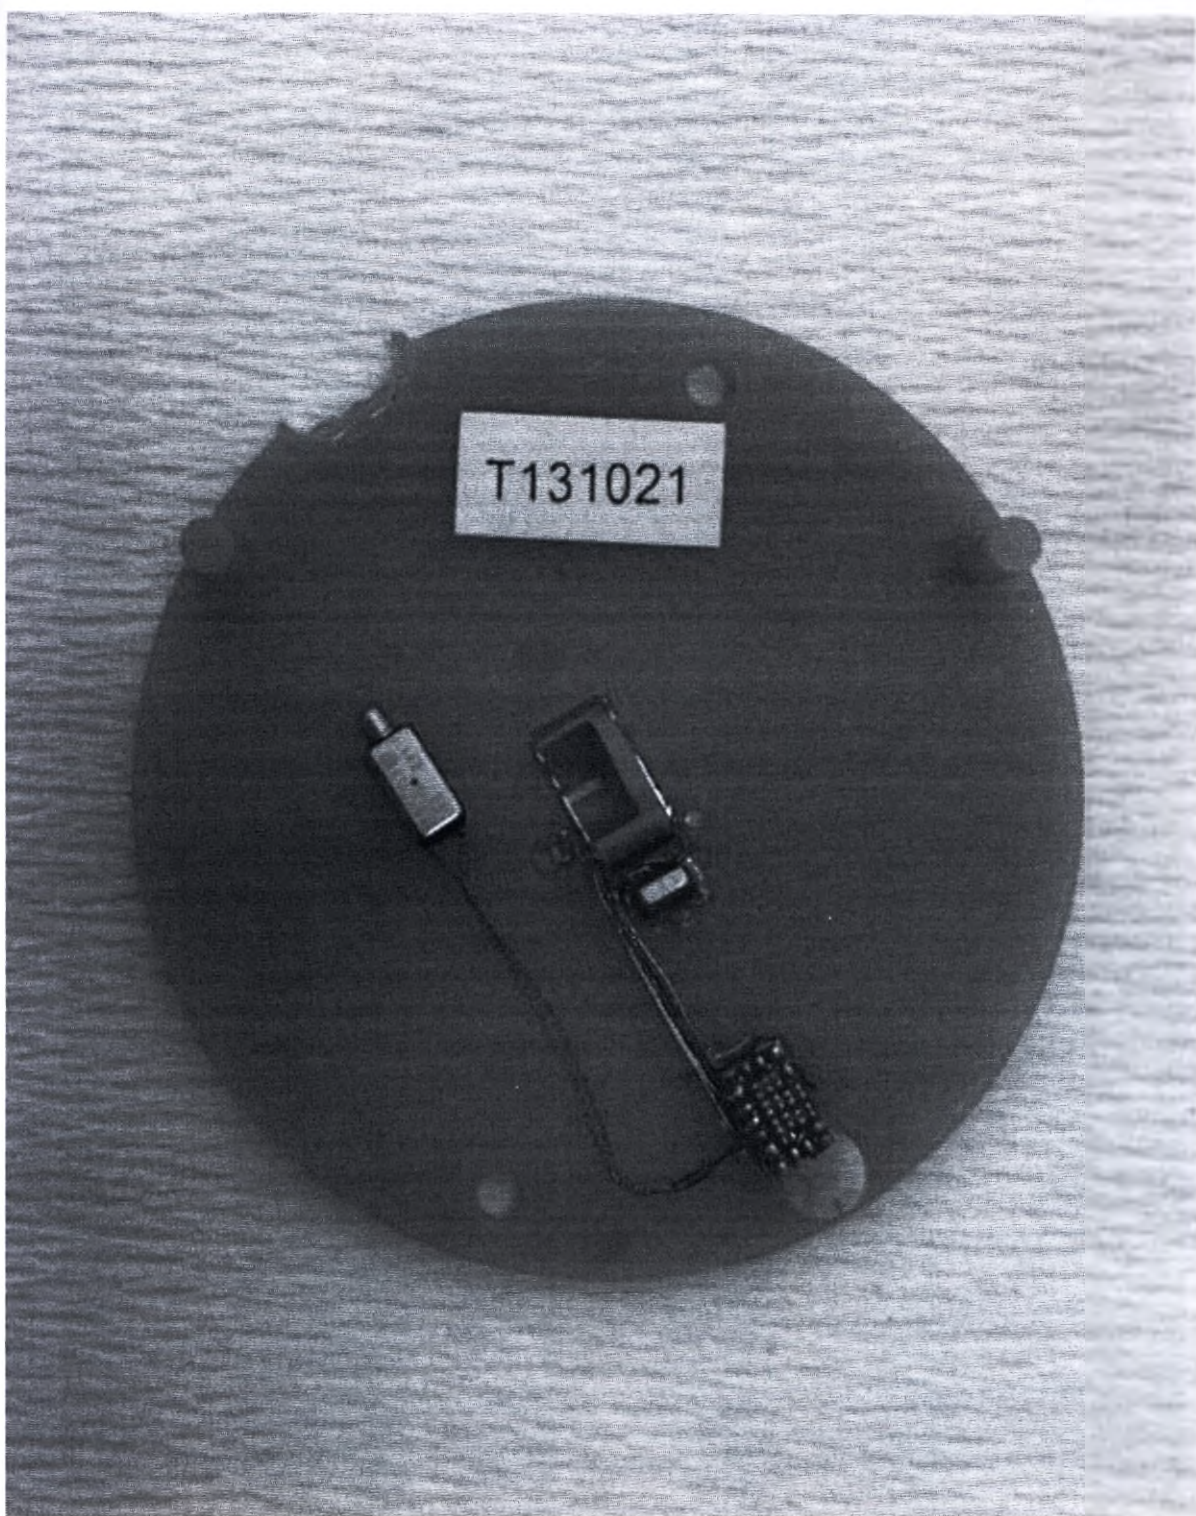


25. Аппарат слуховой audifon sino ITE V70 faceplate, внутриушной.




26. Аппарат слуховой audifon faro P, заушный.

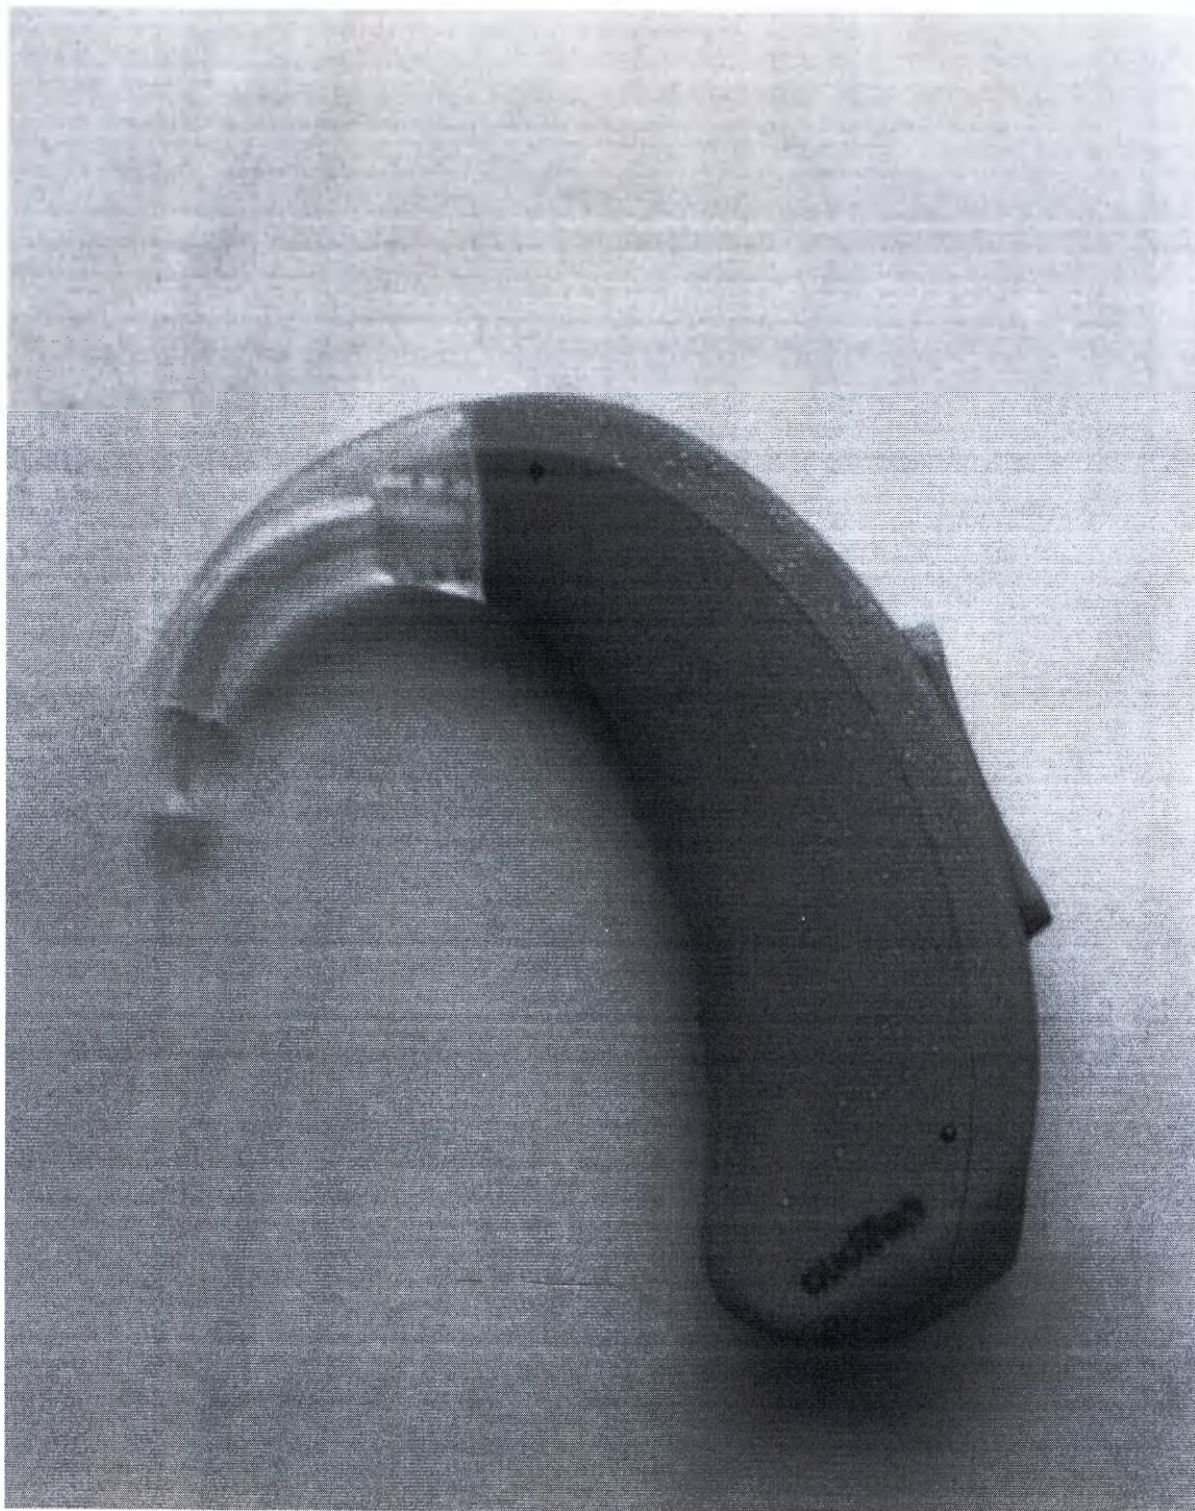

27. Аппарат слуховой audifon faro S+, заушный.

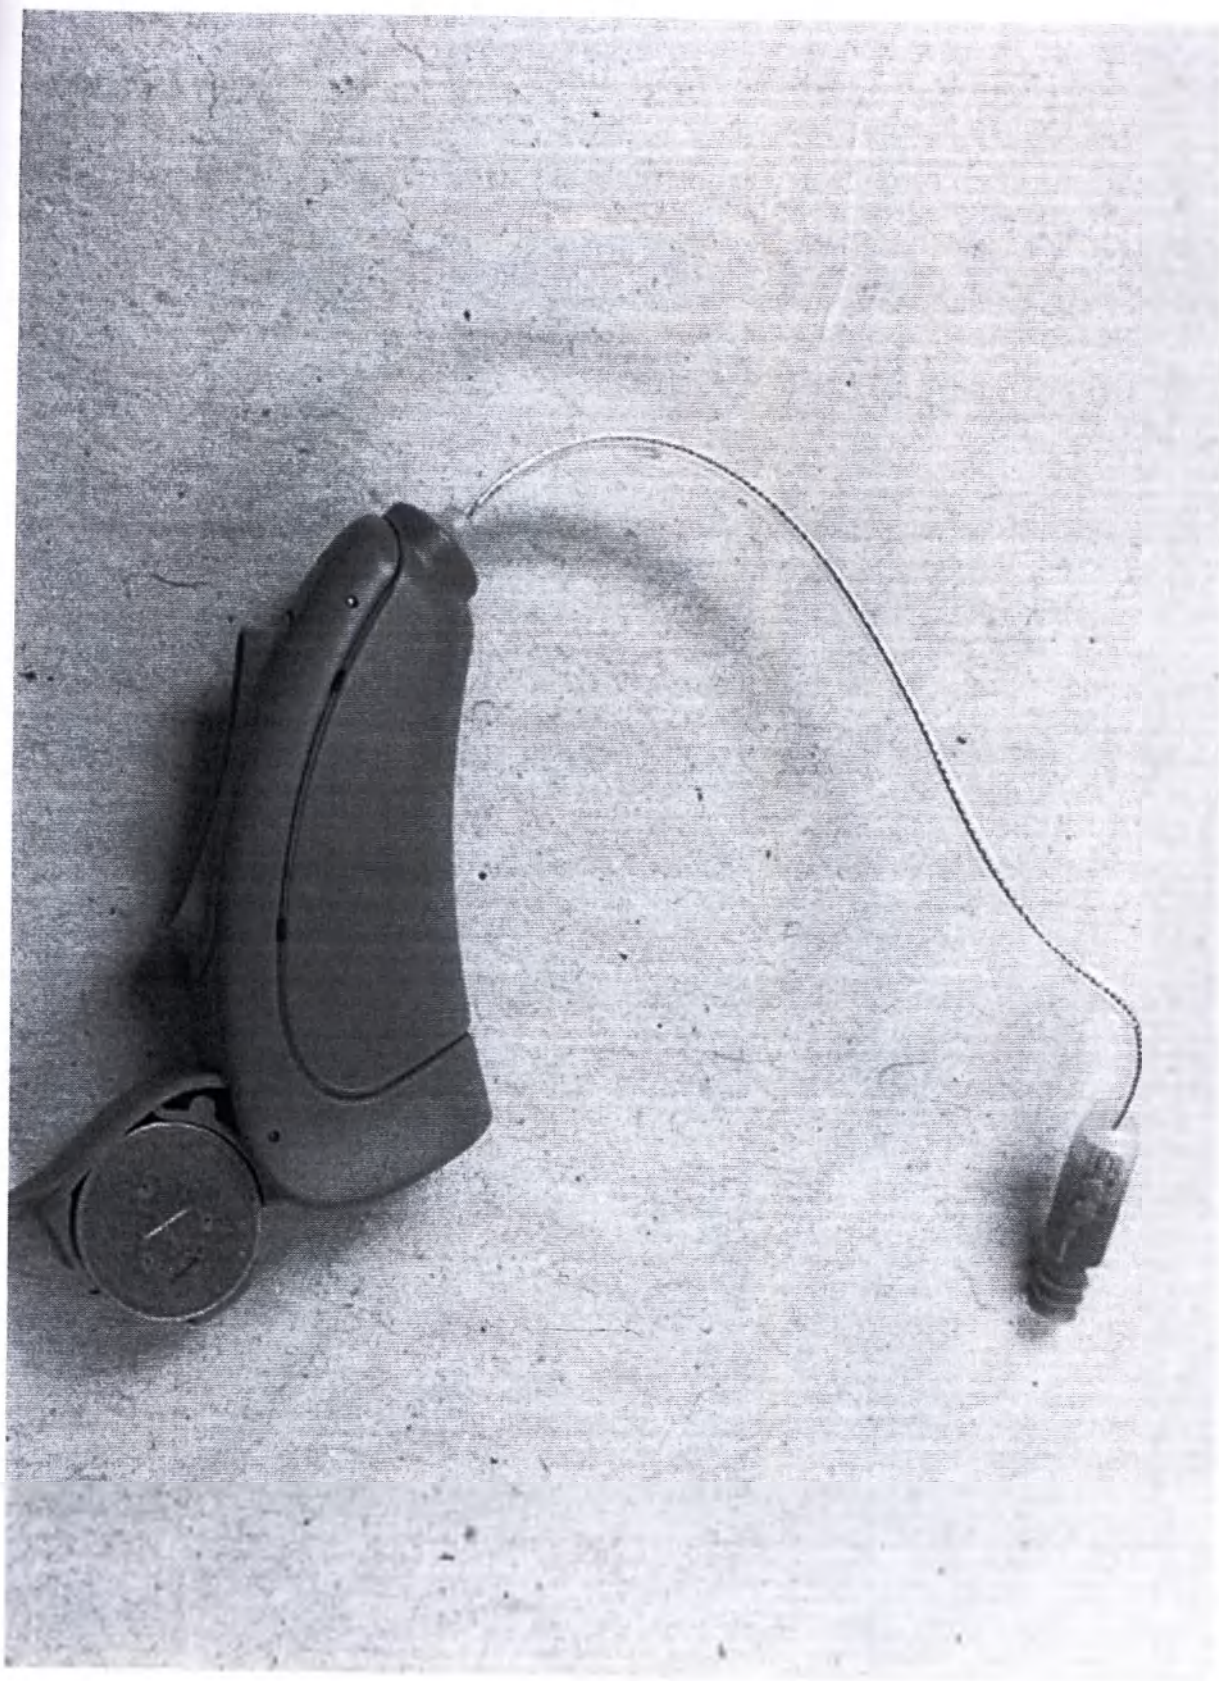

28. Аппарат слуховой audifon faro R, заушный.

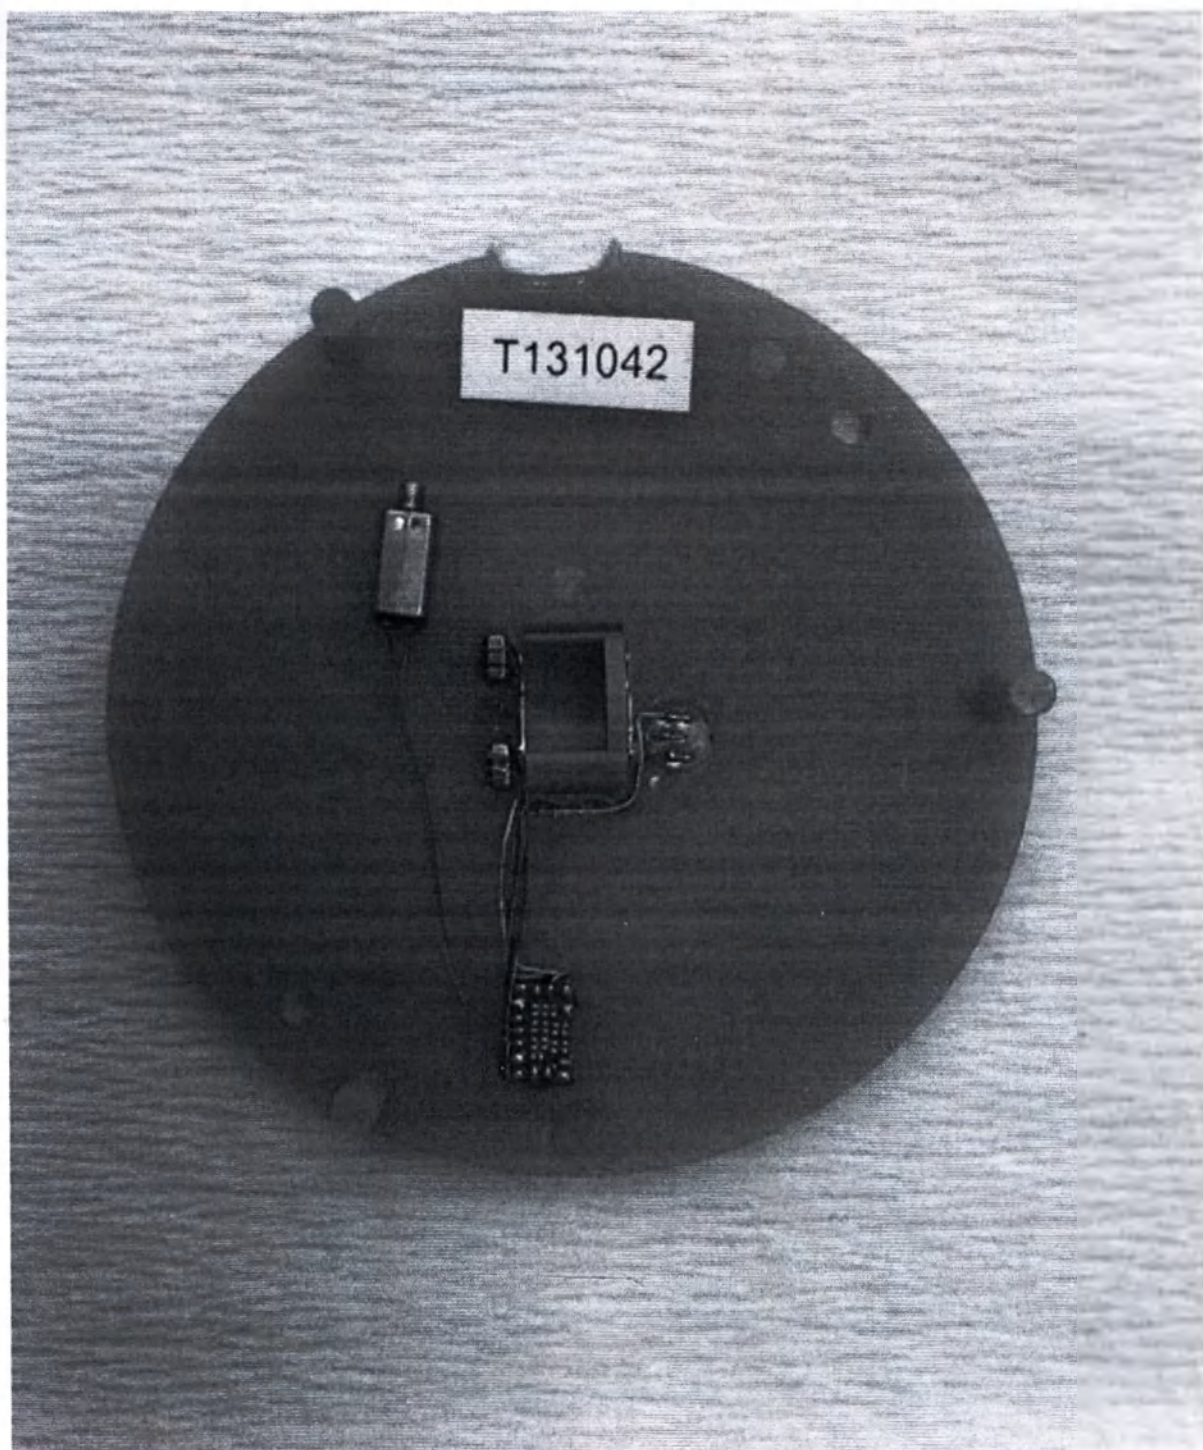

29. Аппарат слуховой audifon faro IS faceplate, внутриканальный.



31. Аппарат слуховой audifon via pro P, заушный, в составе:

- аппарат слуховой audifon via pro P (Rx), заушный;
- аппарат слуховой audifon via pro P (Tx), заушный




32. Аппарат слуховой audifon via pro S+, заушный, в составе:


- аппарат слуховой audifon via pro S+ (Rx), заушный;
- аппарат слуховой audifon via pro S+ (Tx), заушный



33. Аппарат слуховой audifon via pro R, заушный, в составе:
- аппарат слуховой audifon via pro R (Rx), заушный – 1 шт.;
- аппарат слуховой audifon via pro R (Tx), заушный

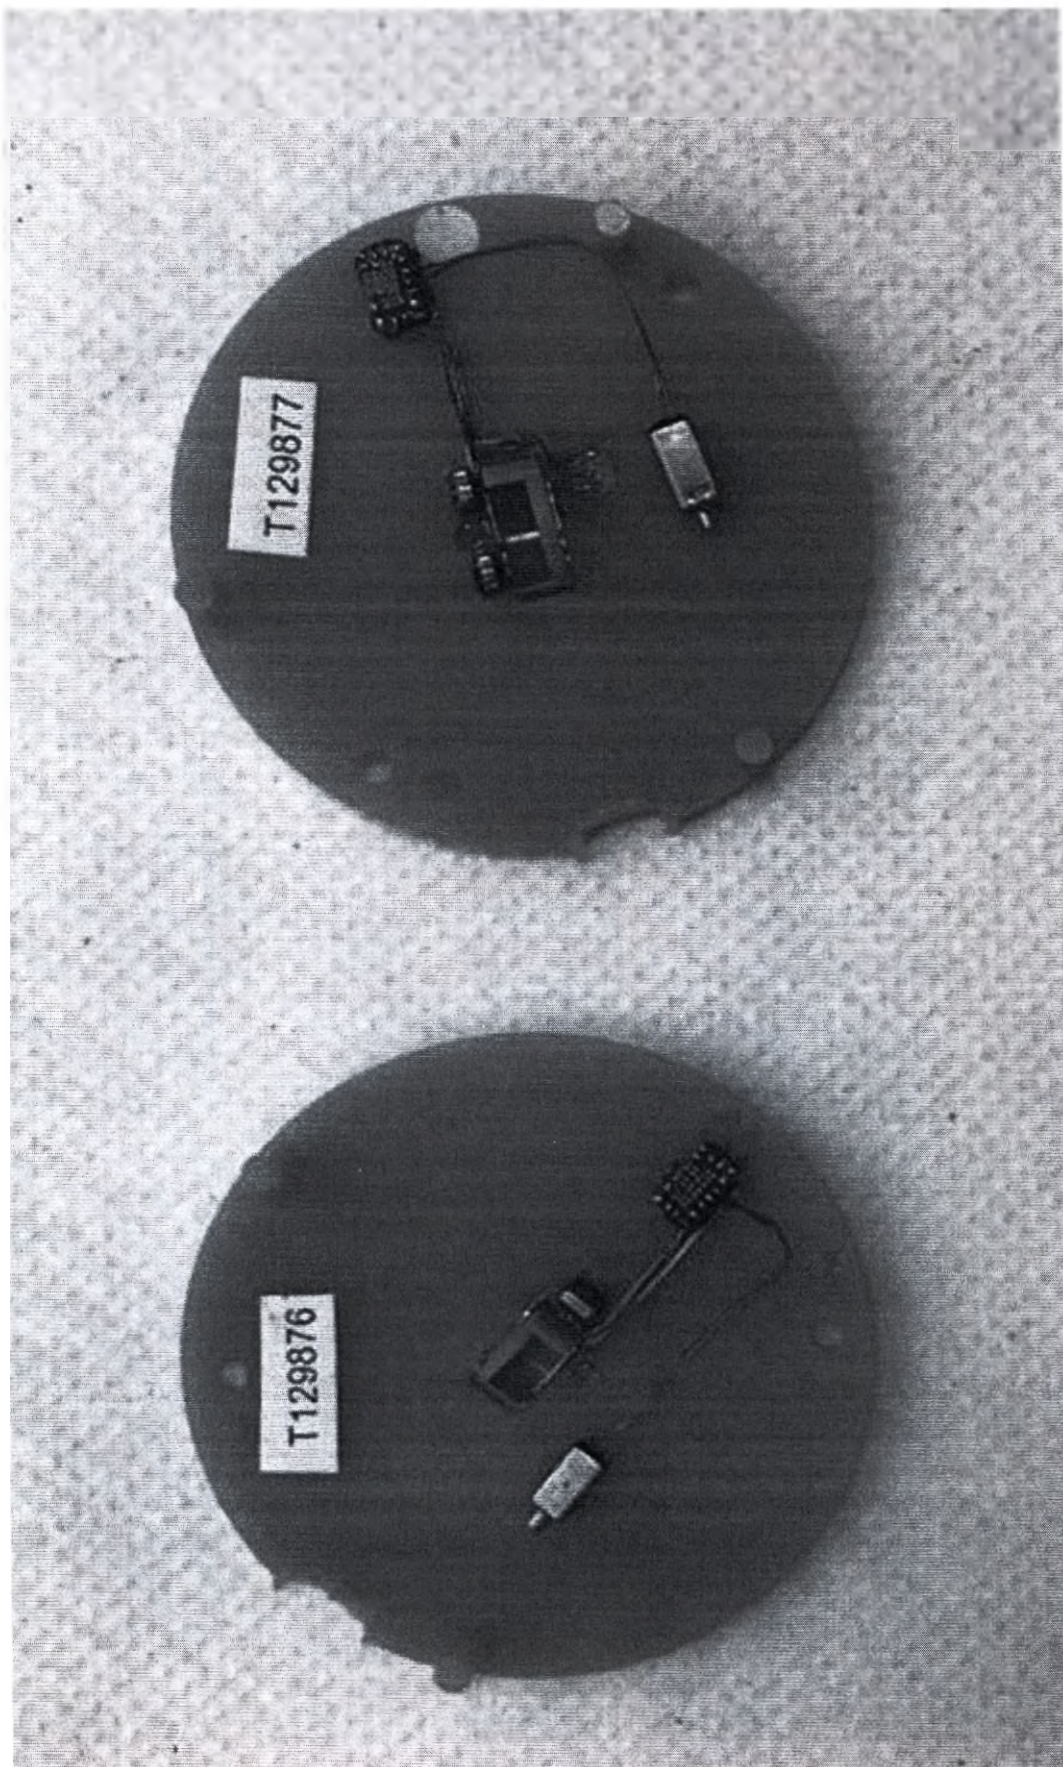

34. Аппарат слуховой audifon via pro IS faceplate, внутриканальный, в составе:
- аппарат слуховой audifon via pro IS faceplate (Rx), внутриканальный;
 - аппарат слуховой audifon via pro IS faceplate (Tx), внутриканальный

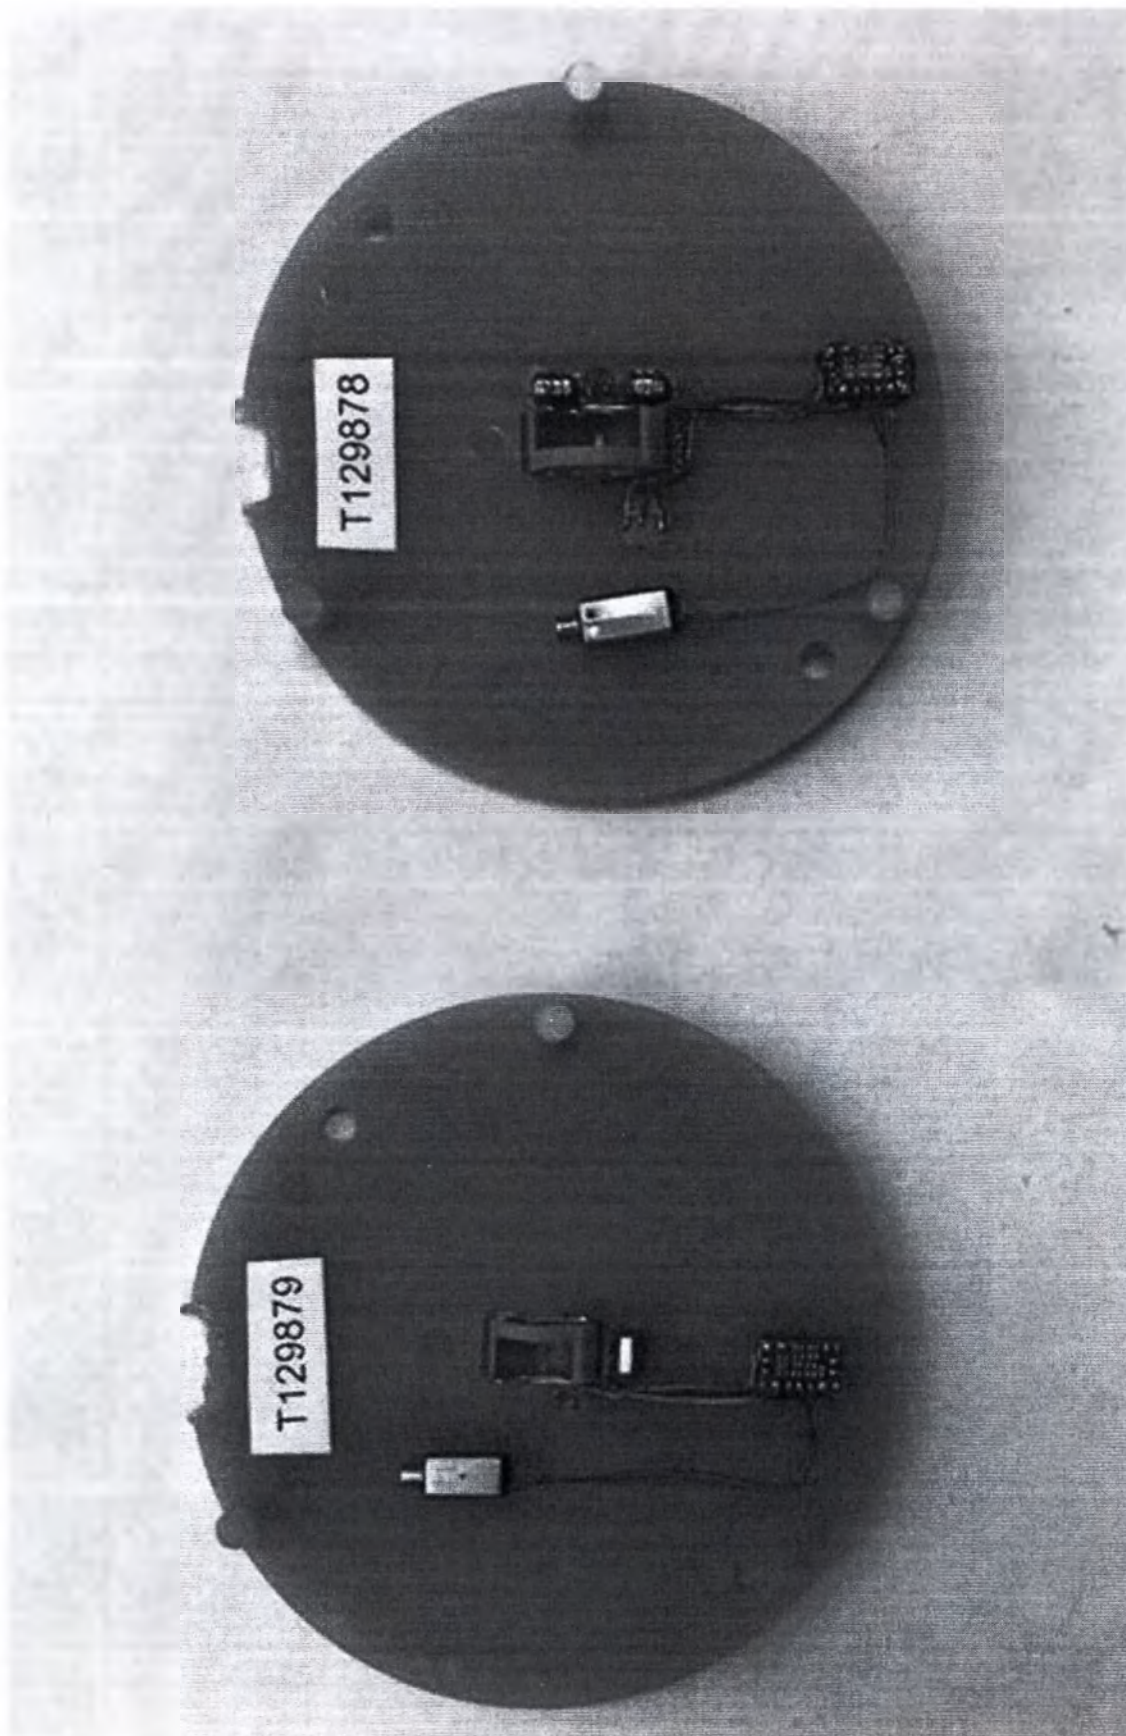


35. Аппарат слуховой audifon via pro IS+ faceplate, внутриушной, в составе:
- аппарат слуховой audifon via pro IS+ faceplate (Rx), внутриушной;
 - аппарат слуховой audifon via pro IS+ faceplate (Tx), внутриушной



36. Аппарат слуховой audifon vico P, заушный.




37. Аппарат слуховой audifon vico S+, заушный.

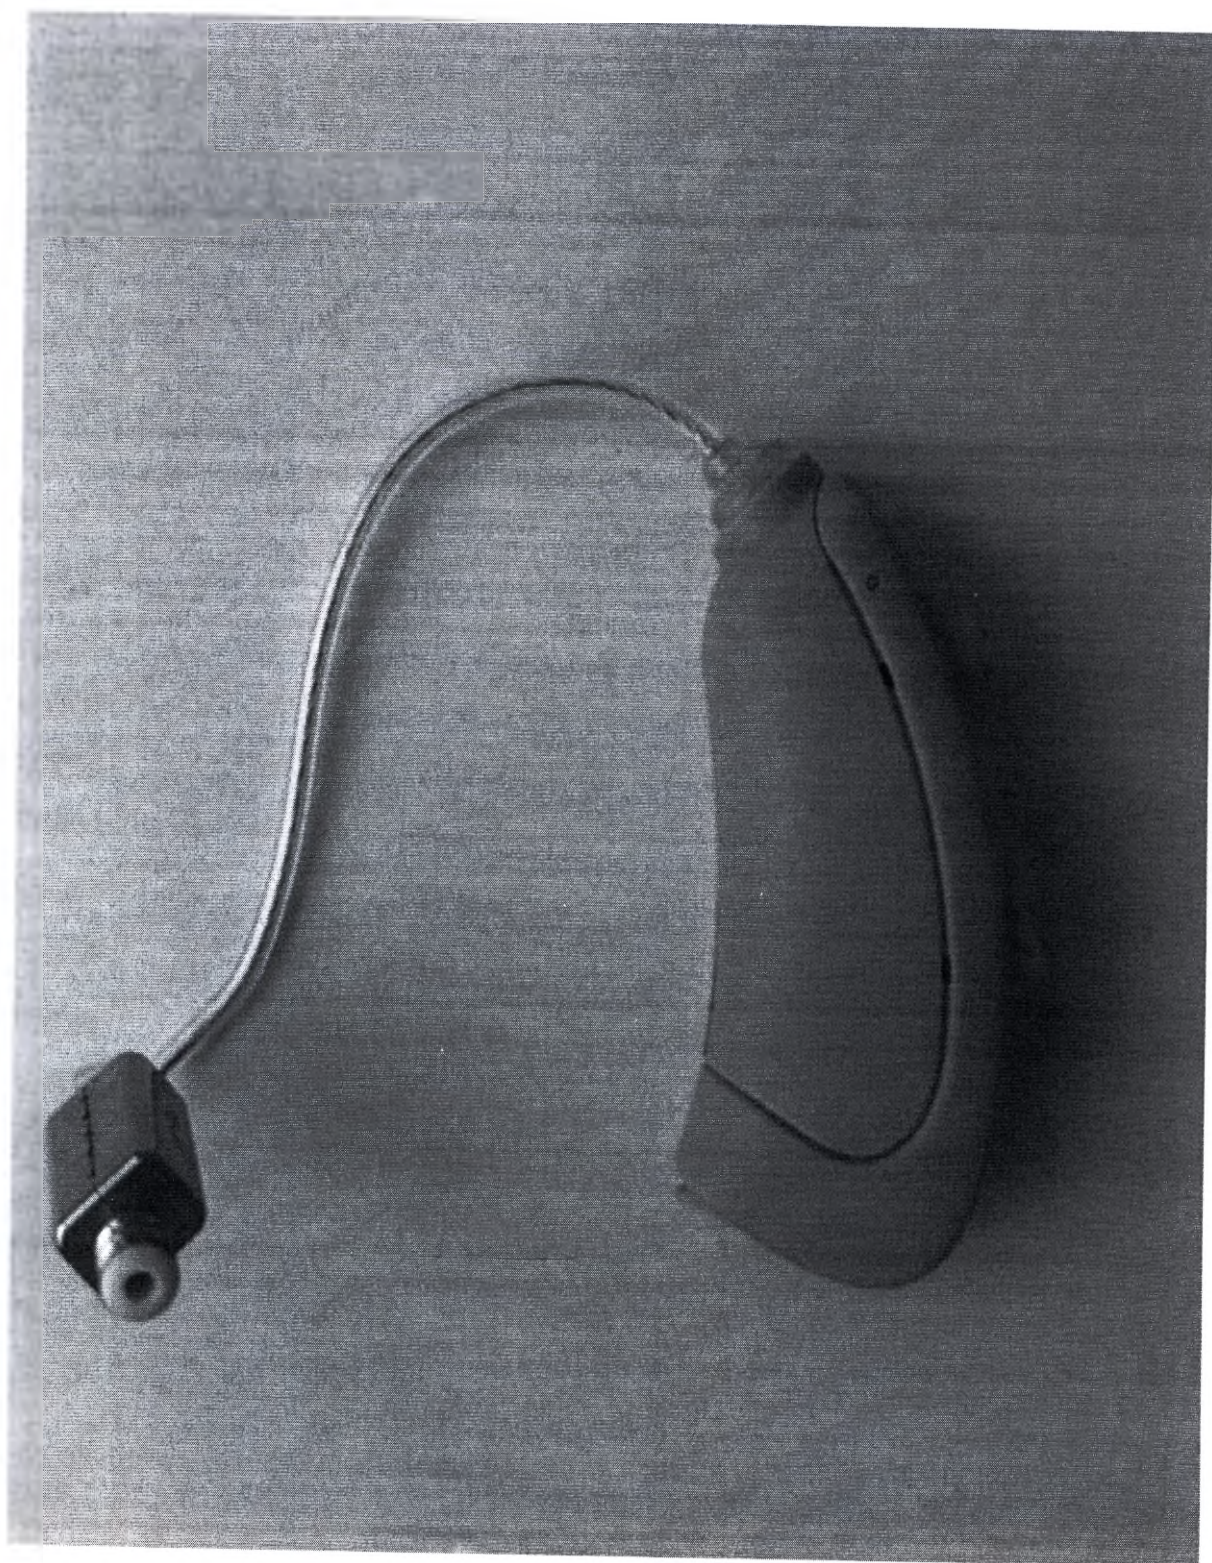

39. Аппарат слуховой audifon risa R, заушный.



40. Аппарат слуховой audifon lewi S, заушный.

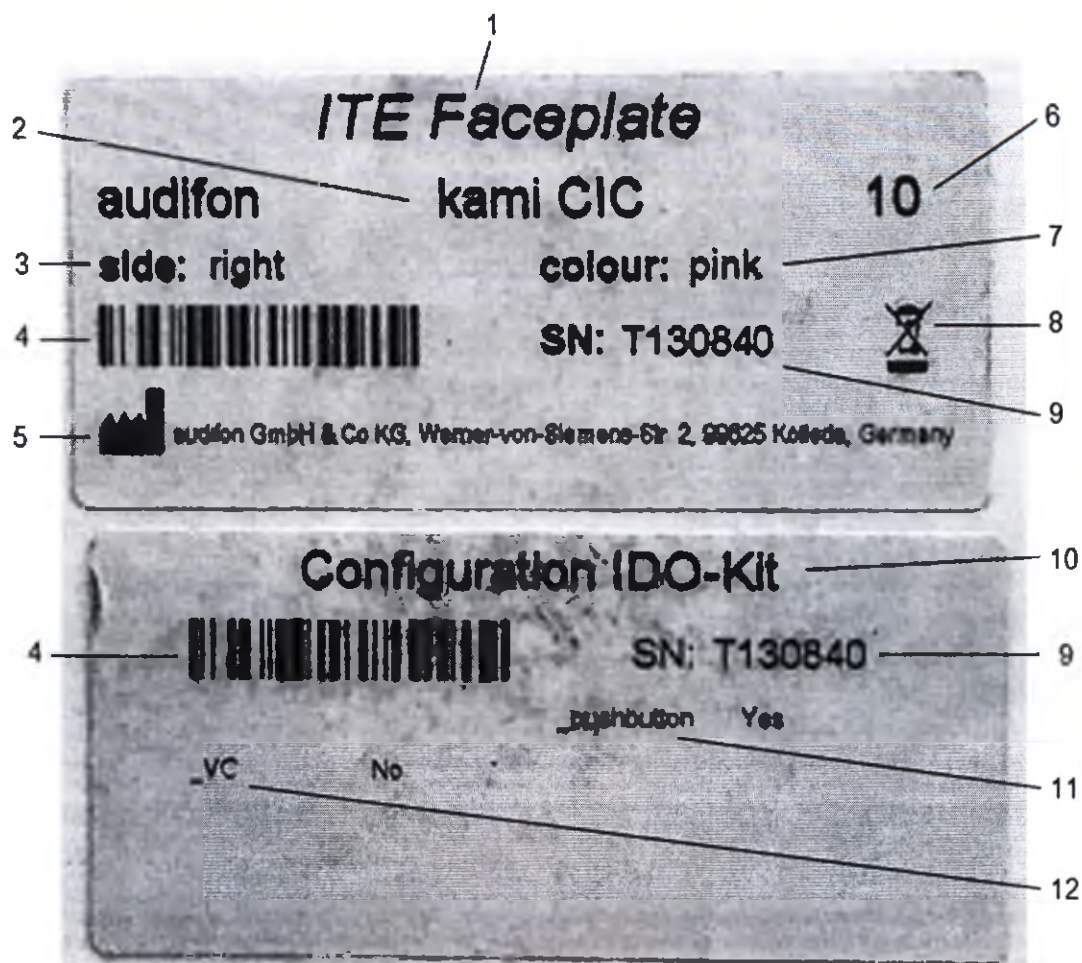

1. Модель слухового аппарата
2. Вариант исполнения

3. Сторона: правый
4. Штрих код изделия

5. Наименование и адрес производителя
6. Тип батарейки 10


7. Цвет: розовый
8. Не утилизировать вместе с бытовым мусором

9. Серийный номер

10. Конфигурация индивидуальной заготовки (набор опций)


11. Кнопка переключения программ: Да
12. Регулировка громкости: Нет

42. Маркировка на футляре транспортировочном аппарата слухового audifon (CIC, ITC, ITE), на примере варианта исполнения kami CIC faceplate

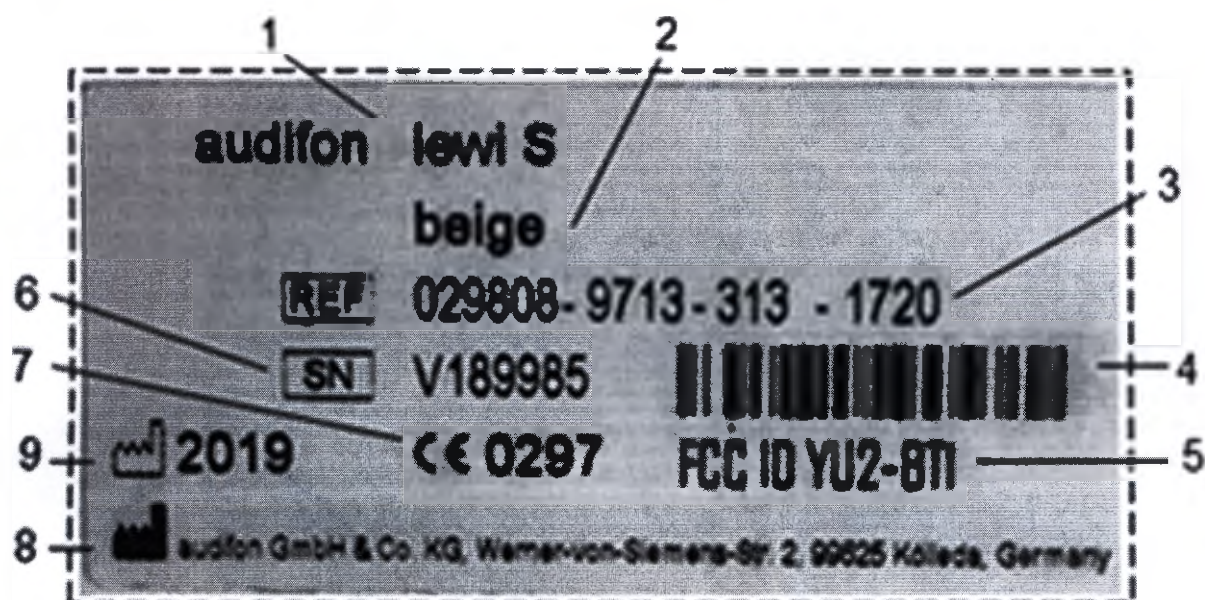

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 1. Вариант исполнения | 4. Штрих код изделия | 7. Соответствие CE |
| 2. Цвет бежевый | 5. Соответствие стандарту электромагнитных помех | 8. Наименование и адрес производителя |
| 3. Номер по каталогу | 6. Серийный номер | 9. Дата производства |

43. Маркировка на коробке индивидуальной потребительской Аппарата слухового audifon (BTE, BTE-RITE) на примере варианта исполнения: lewi S.

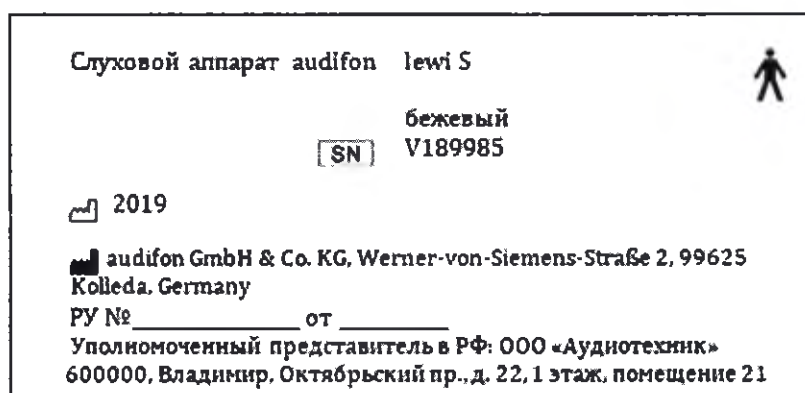

44. Пример русскоязычного стикера

Прошнуровано и пронумеровано

44 лист (a)

Генеральный Директор

ООО "Аудиотехник"

К.В. Терехов

