

SONY

АО «Сони Электроникс»
123103 Москва, Карамышевский проезд, 6
Тел: +7(495) 258 7667 Факс: +7(495) 258 7650

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Сони Электроникс»
Такаси Абэ




2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Жидкокристаллический монитор медицинского назначения в вариантах исполнения LMD-1951MD, LMD-2110MD, LMD-2765MD, LMD-2760MD, LMD-2451MD, LMD-2451MT, LMD-X310MD, LMD-X550MD, LMD-2435MD, LMD-2735MD, LMD-X550MT, LMD-X310MT, LMD-X2705MD, LMD-X2700MD, в составе, с принадлежностями»

I. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-1951MD. Основной состав:
1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-1951MD

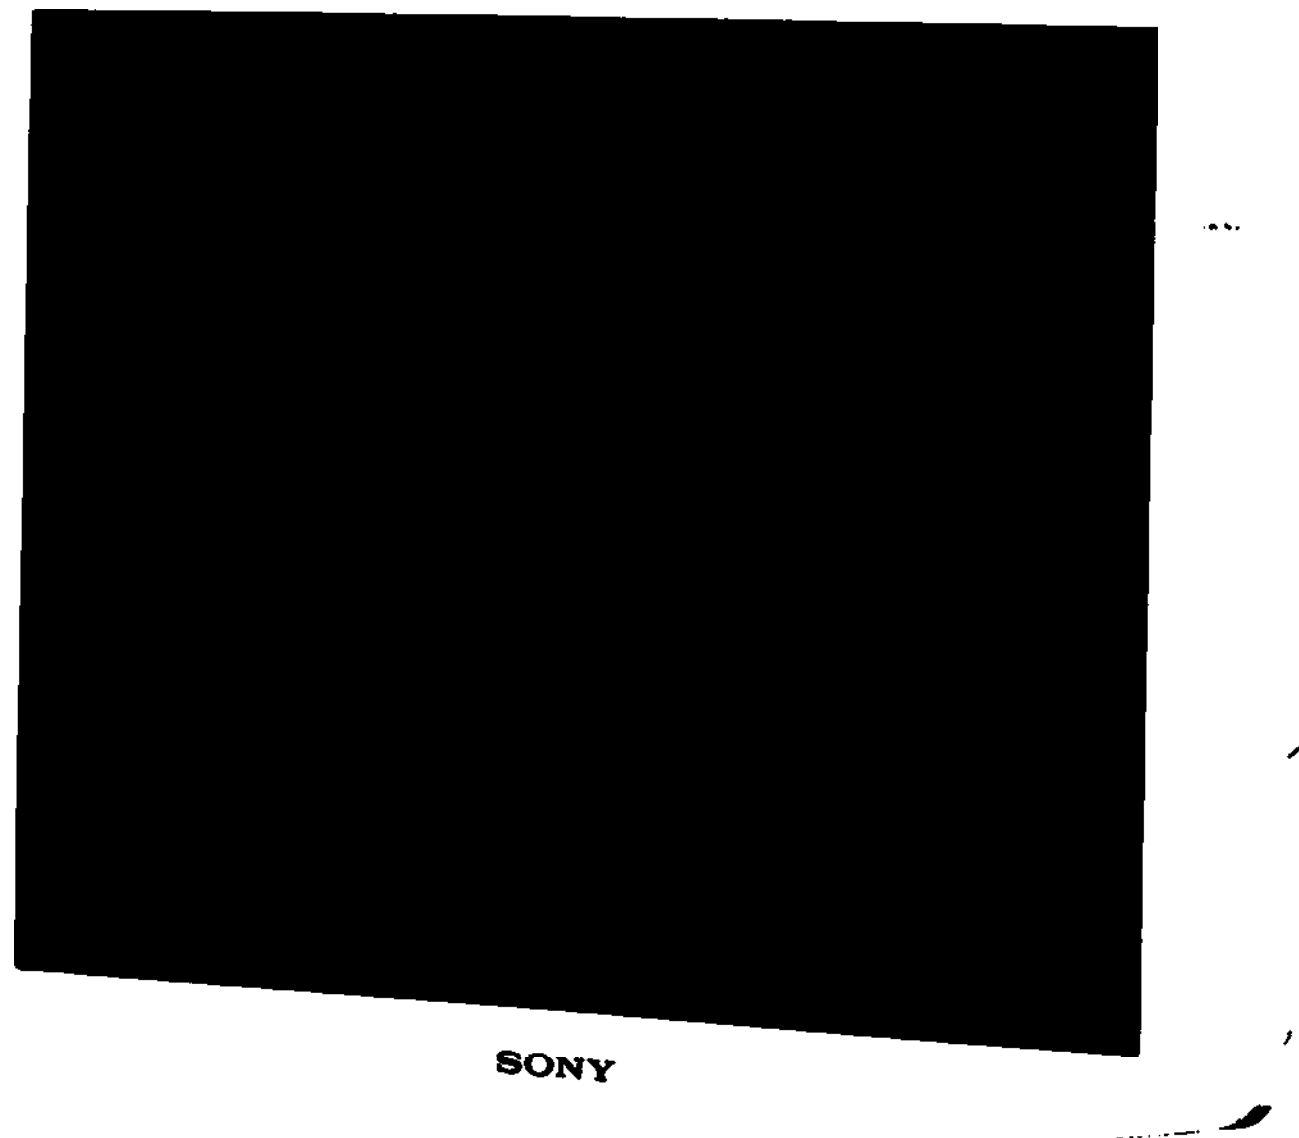

2. Кабель электропитания



3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе



Manuals for

LCD Monitor

LMD-1951MD

SONY®



4 2 9 1 8 4 4 0 6 1

COMPACT
disc

4-291-844-06

Multilingual manuals

日本語 / English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 繁體中文 /
한국어 / Nederlands / Português / Dansk / Suomi / Norsk / Svenska /
Ελληνικά / Русский / Қазақ тілі / Bahasa Indonesia

You can view these manuals using Adobe Reader.

Adobe, Adobe Reader, and their respective logos are trademarks of
Adobe Systems Incorporated.

©2011 Sony Corporation All rights reserved.
Made in China


Принадлежности:

1. Адаптер переменного тока AC-110MD




II. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2110MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2110MD

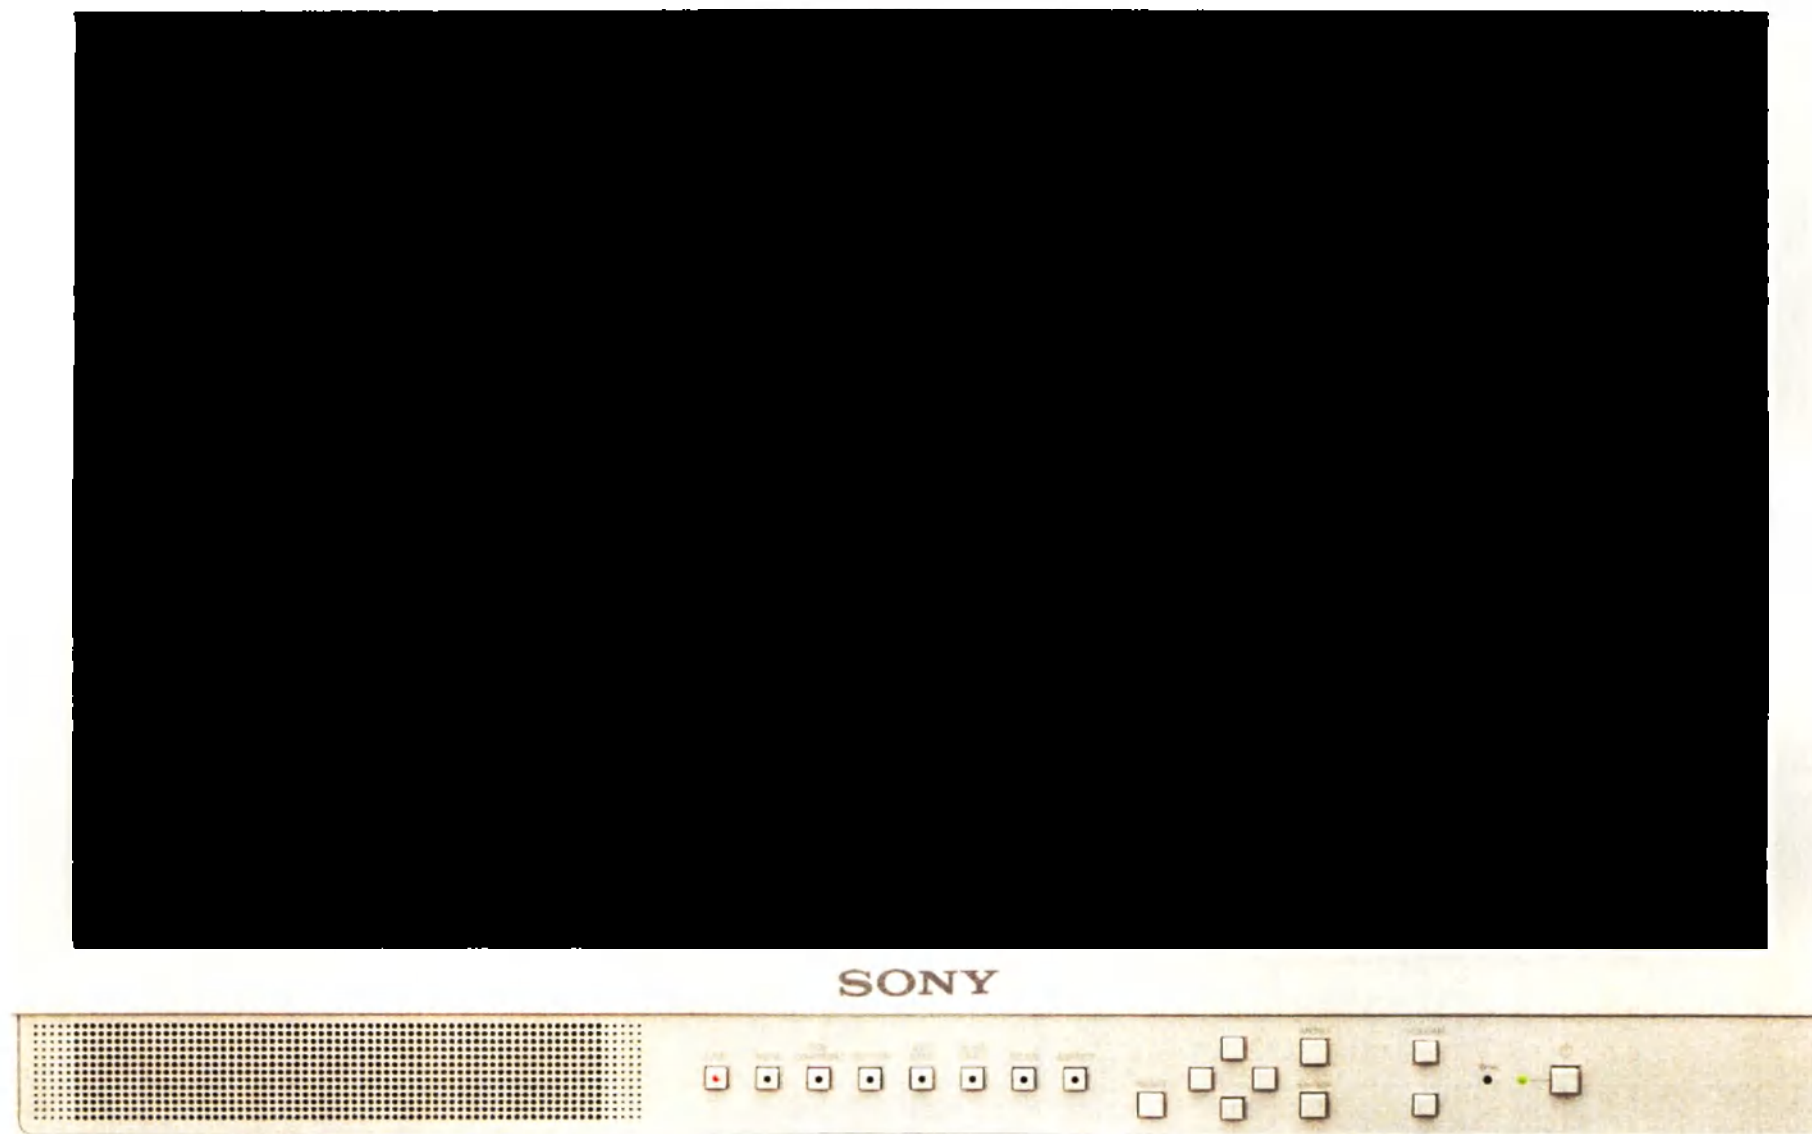

2. Кабель электропитания

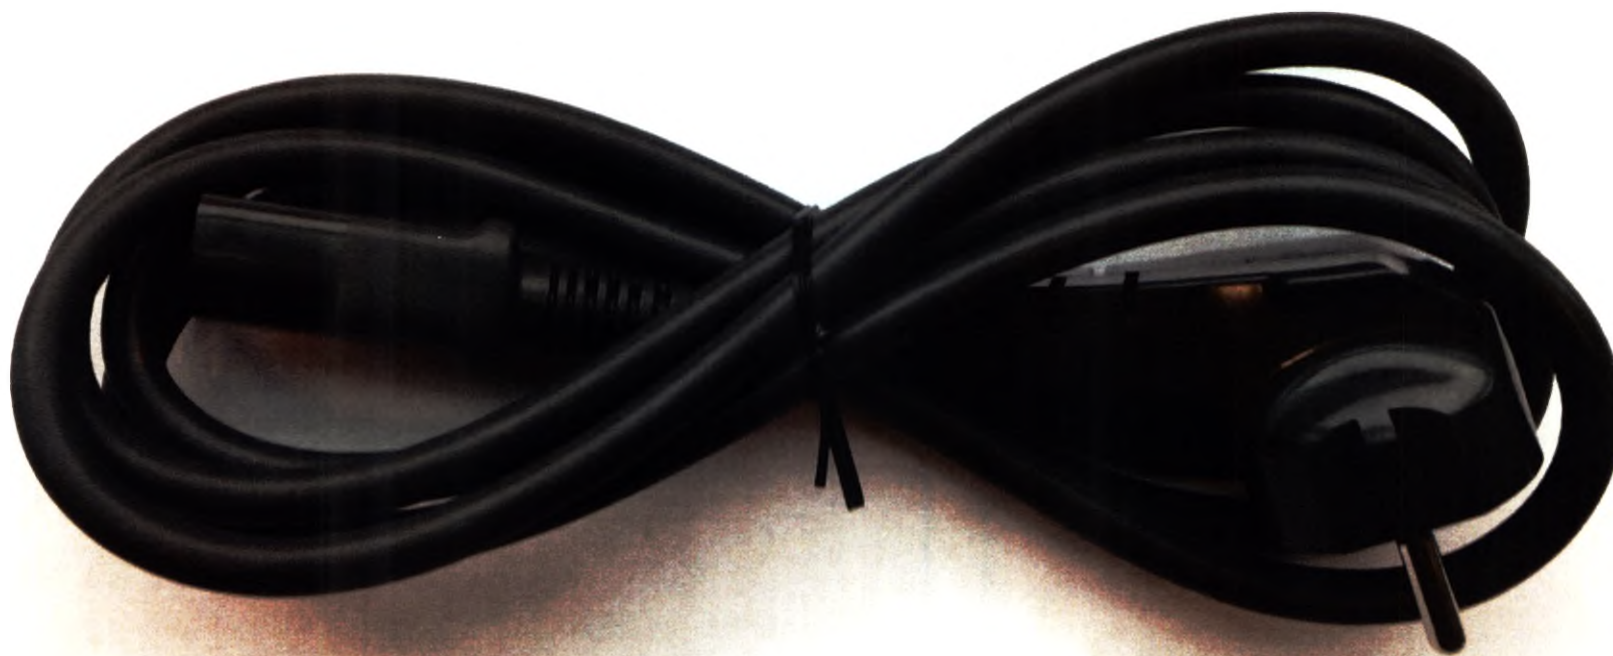

3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе



Manuals for

LCD Monitor

LMD-2110MD

SONY



4 2 8 1 1 3 9 1 0 1

COMPACT
disc

4-281-139-10

Multilingual manuals

日本語 / English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 繁體中文 / Nederlands /
Português / Dansk / Suomi / Norsk / Svenska / Ελληνικά / Русский / Қазақ тілі /
Bahasa Indonesia / Български / Český / Română / Türkçe


You can view these manuals using Adobe Reader.

Adobe, Adobe Reader, and their respective logos are trademarks of
Adobe Systems Incorporated.

©2010 Sony Corporation. All rights reserved.
Made in China

III. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2765MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2765MD




SONY


2. Кабель электропитания



3. Адаптер переменного тока AC-120MD

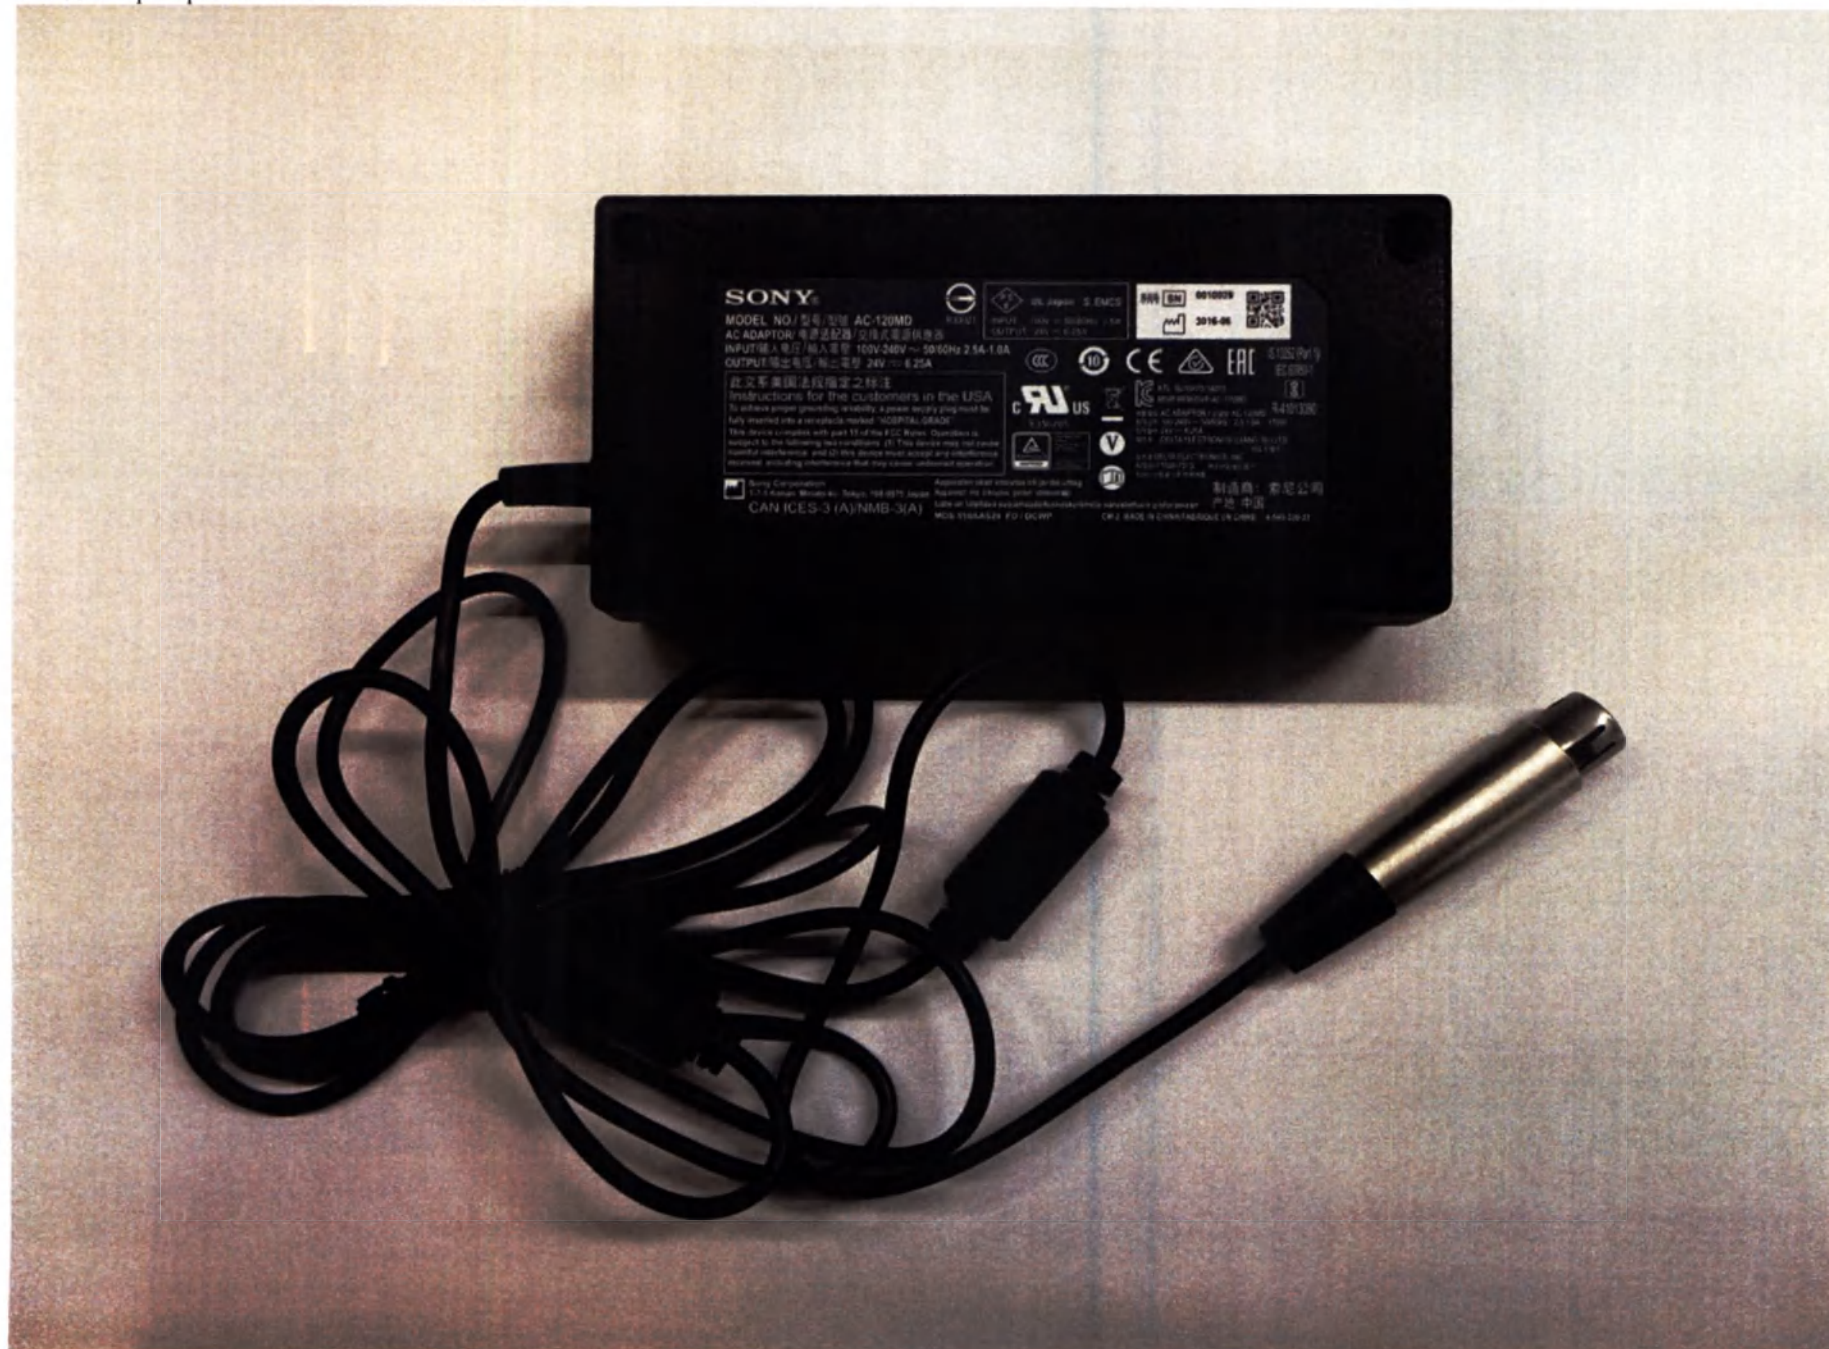


4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

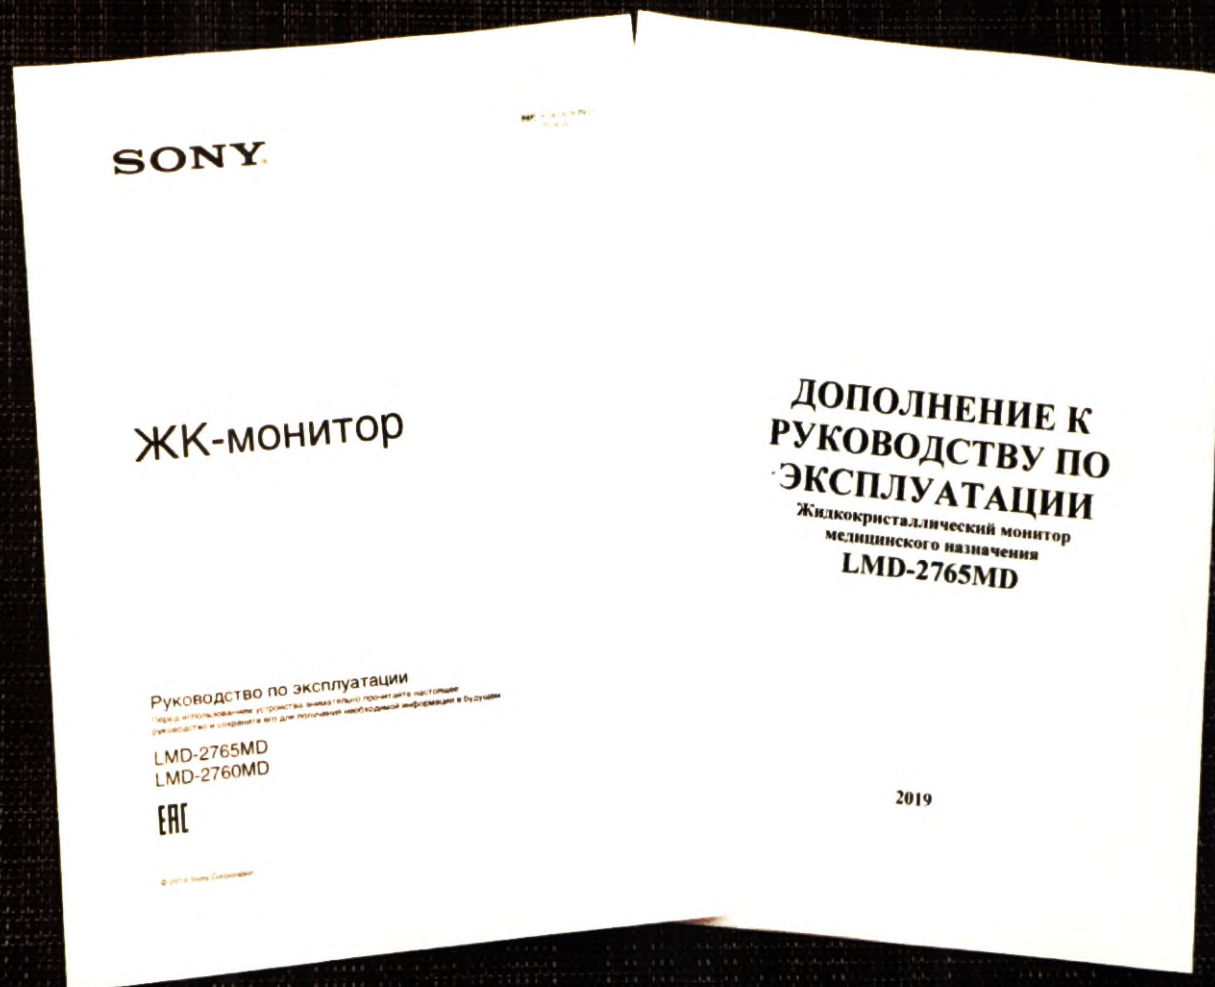

IV. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2760MD. Основной состав:


1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2760MD

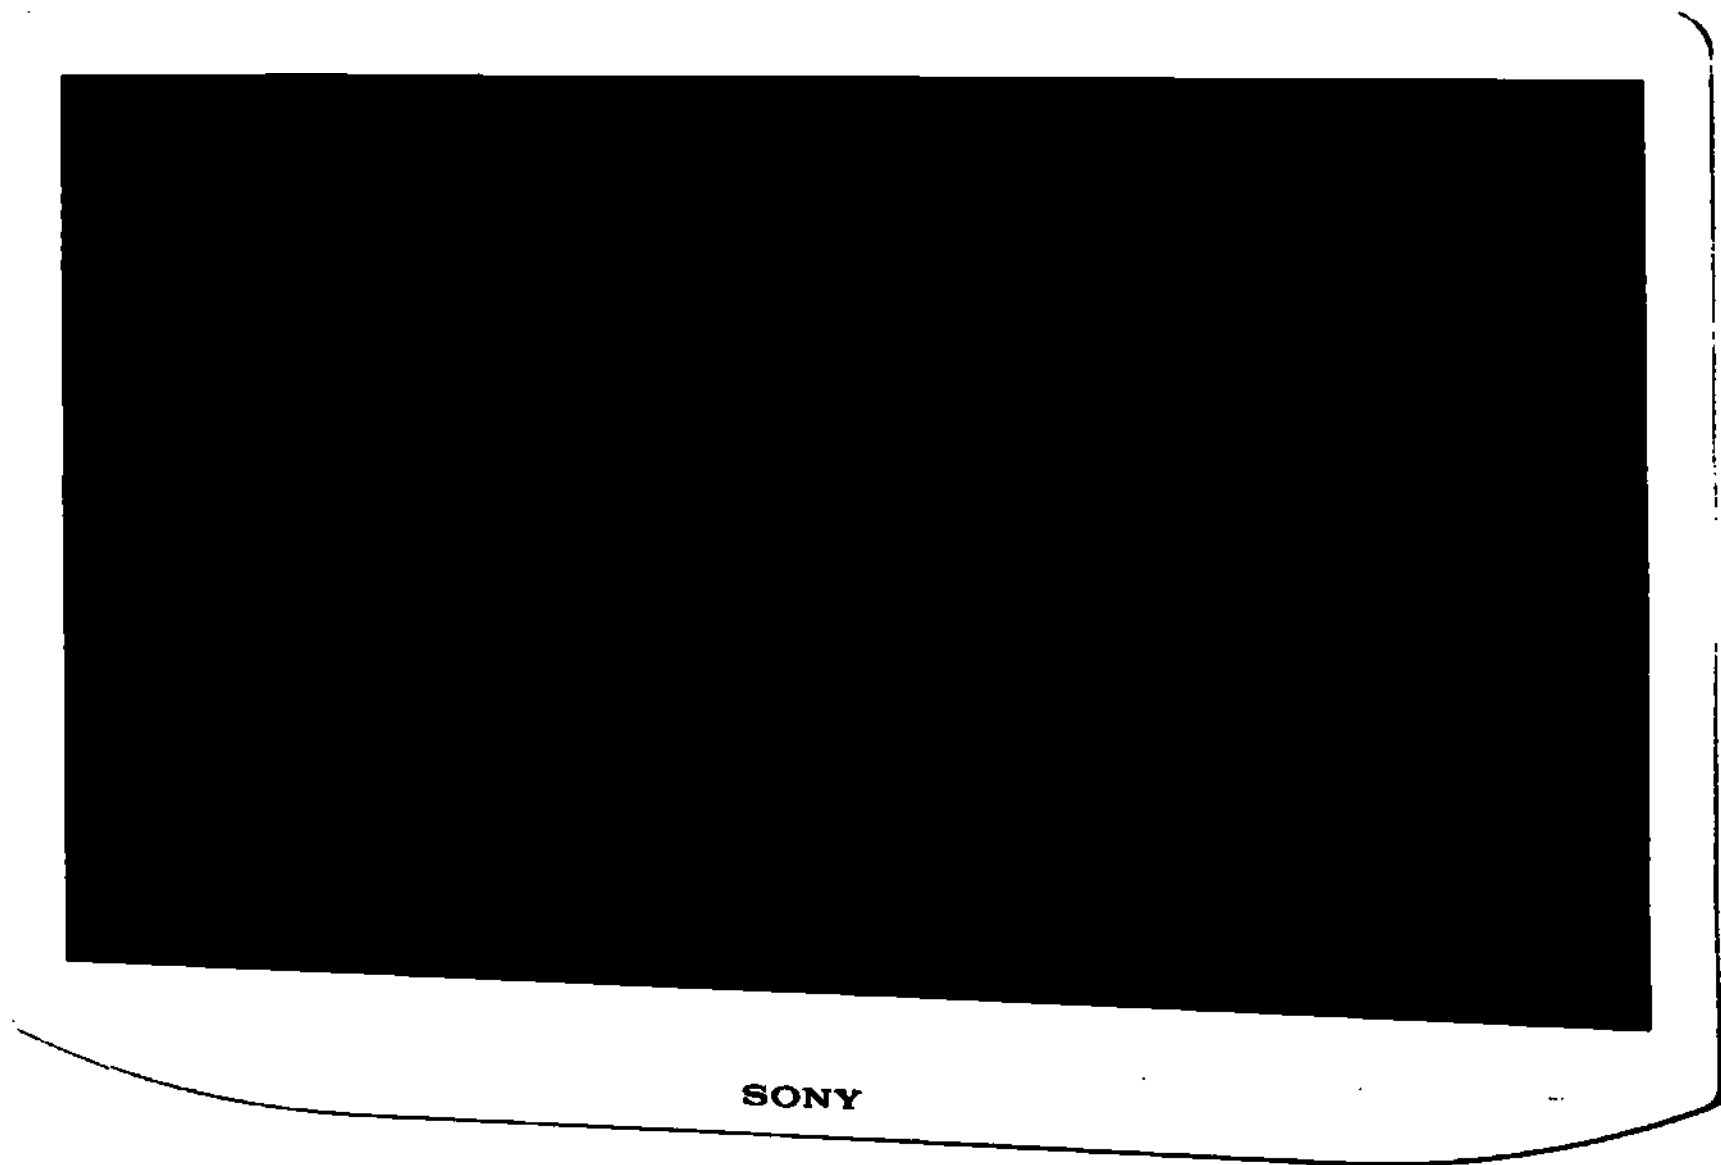

2. Кабель электропитания




3. Адаптер переменного тока AC-120MD

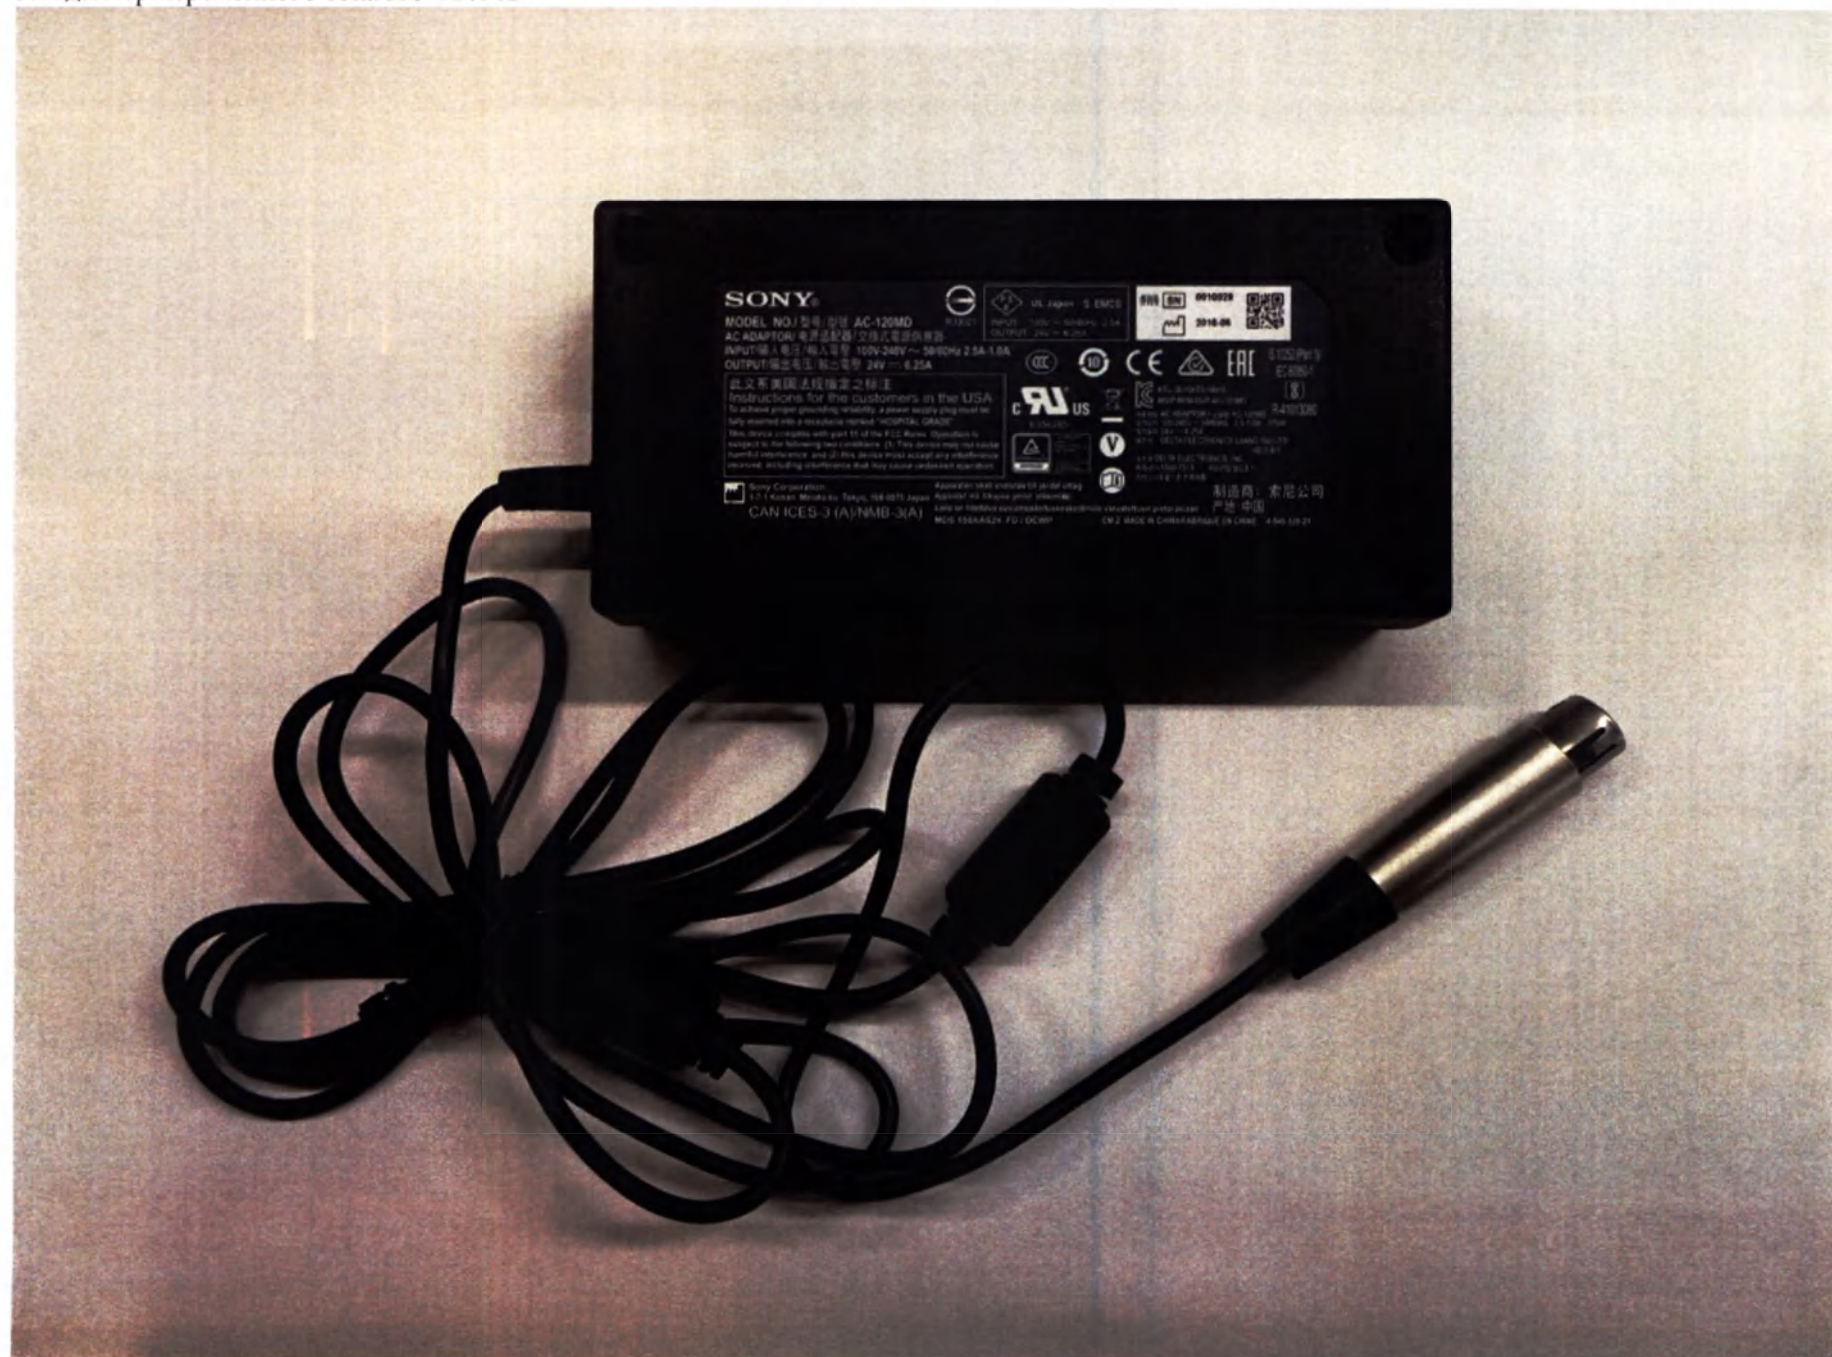


4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе



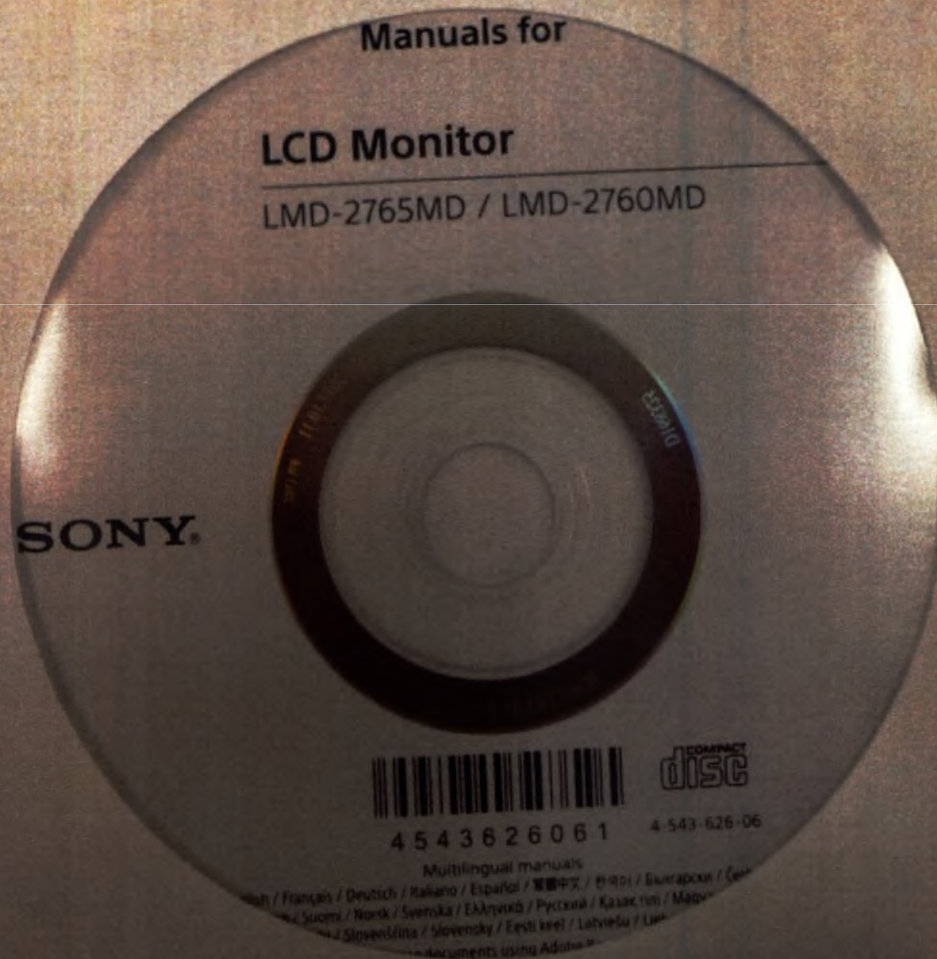

V. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2451MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2451MD



2. Адаптер переменного тока AC-110MD



3. Кабель электропитания



4. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



5. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

SONY

ЖК-монитор

Руководство по эксплуатации
Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящее
руководство и сохраните его для получения необходимой информации в будущем

LMD-2451MD

ЕАС

© 2014 Sony Corporation

ДОПОЛНЕНИЕ К
РУКОВОДСТВУ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Жидкокристаллический монитор
медицинского назначения
LMD-2451MD


2019




Принадлежности:
1. Входной адаптер BKM-243HSM




2. Входной адаптер BKM-250TGM

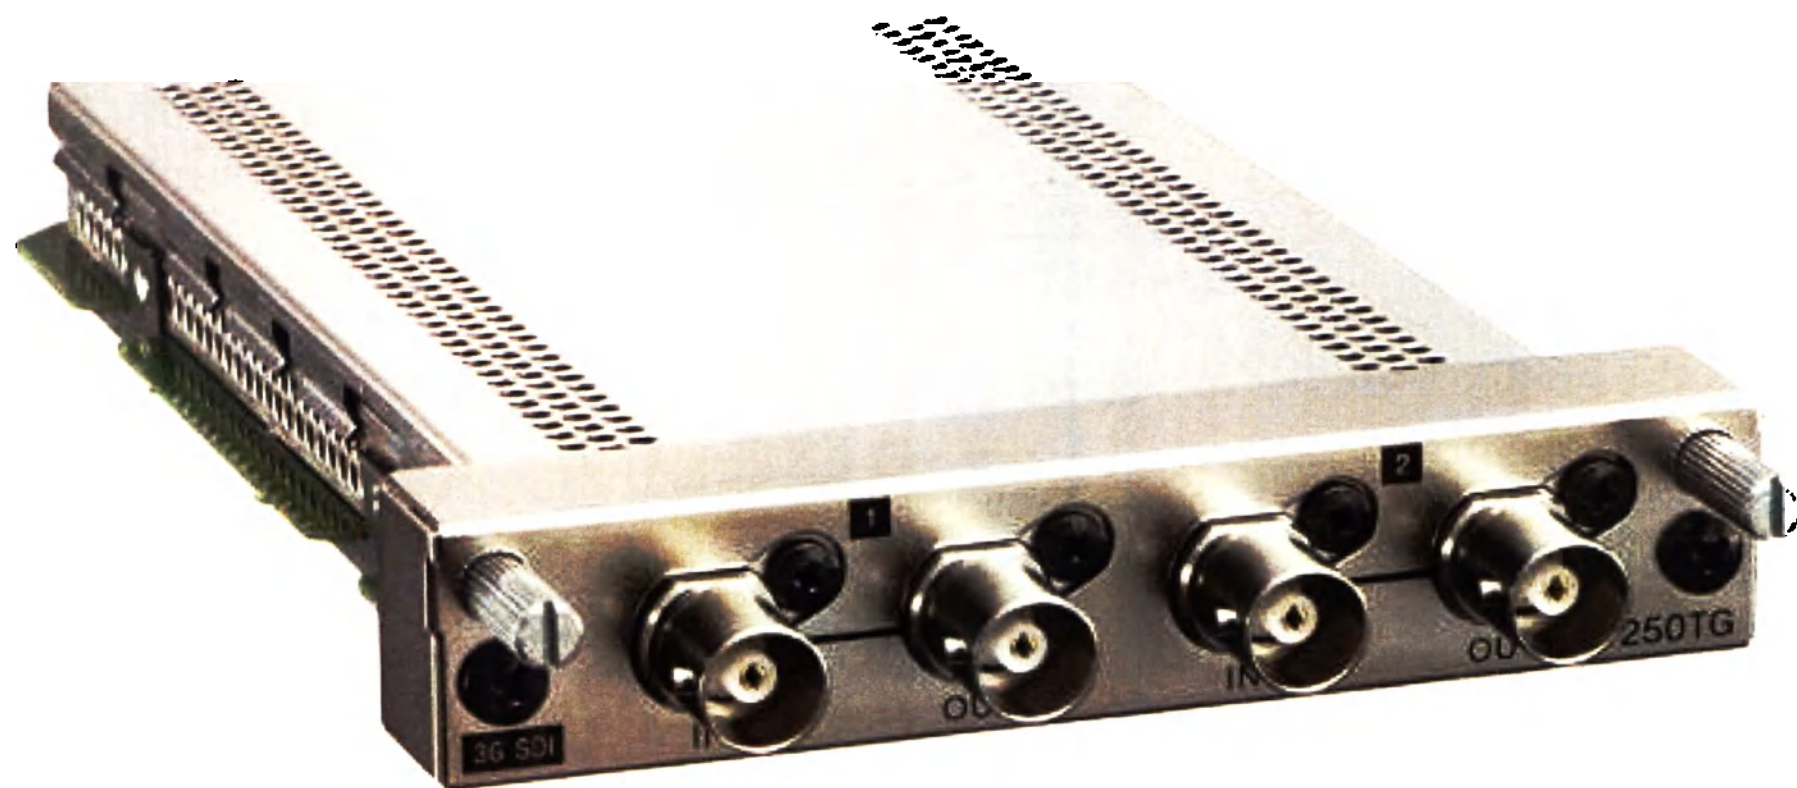


3. Входной адаптер ВКМ-256DD – не более 5 шт.

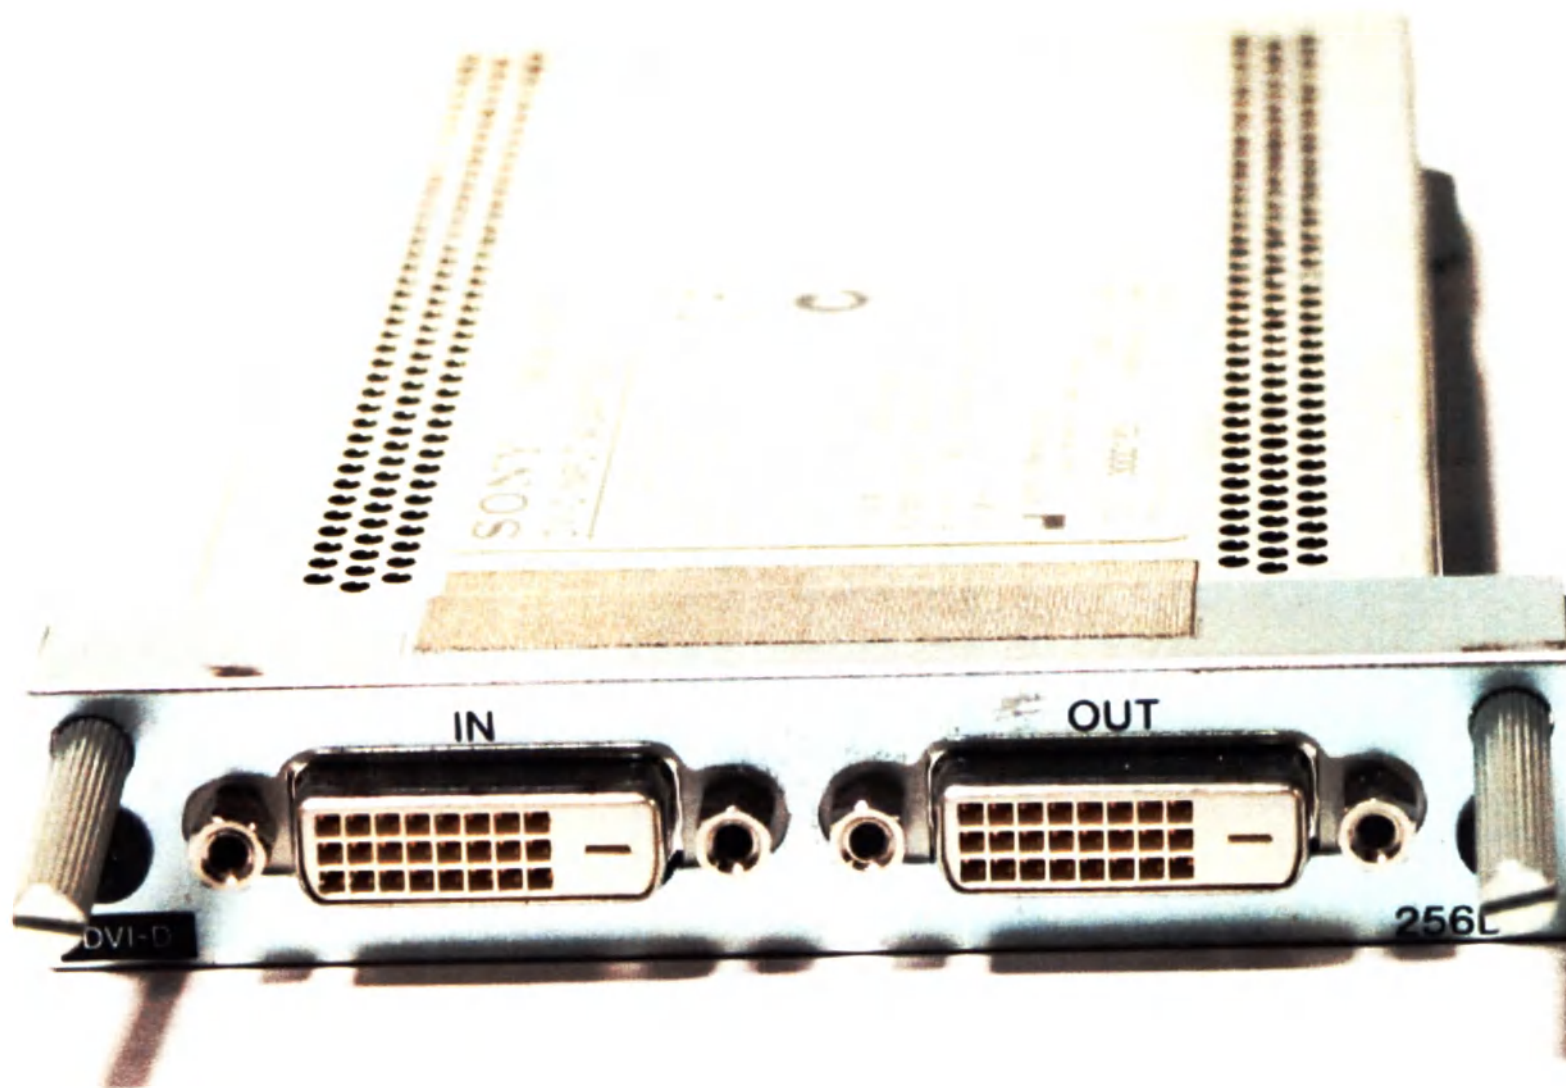

4. Подставка под монитор SU-560

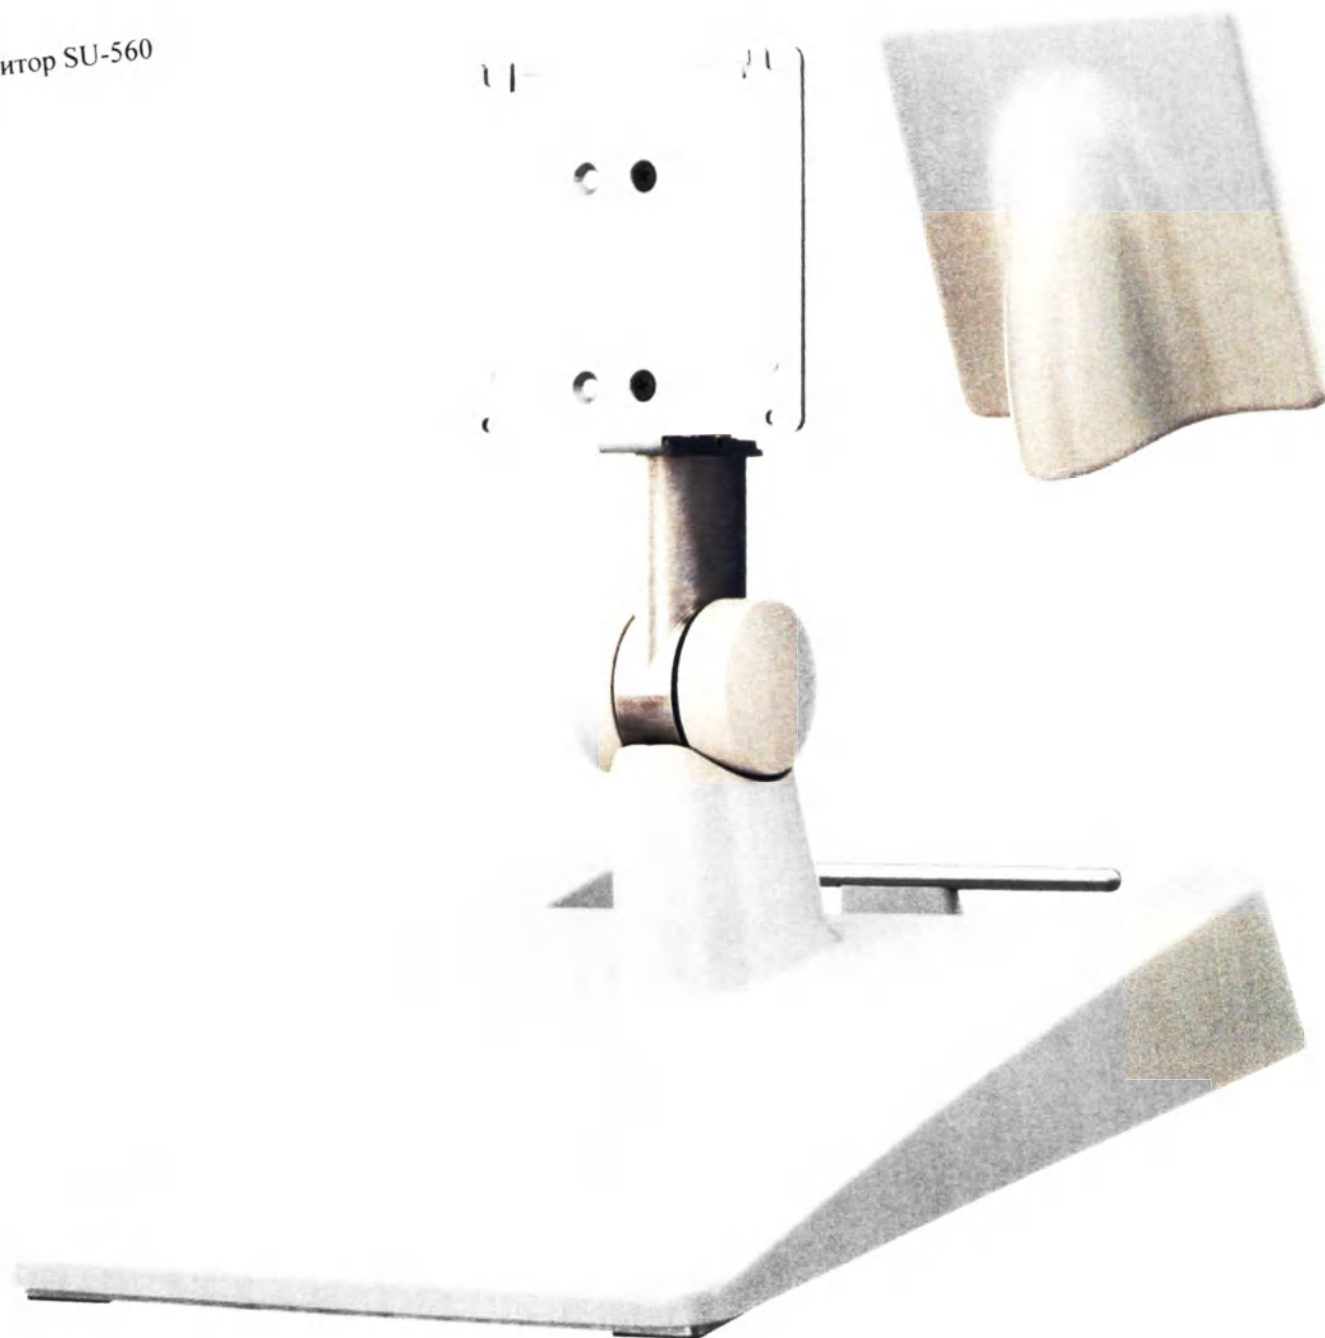


5. Сигнальный кабель SMF-405

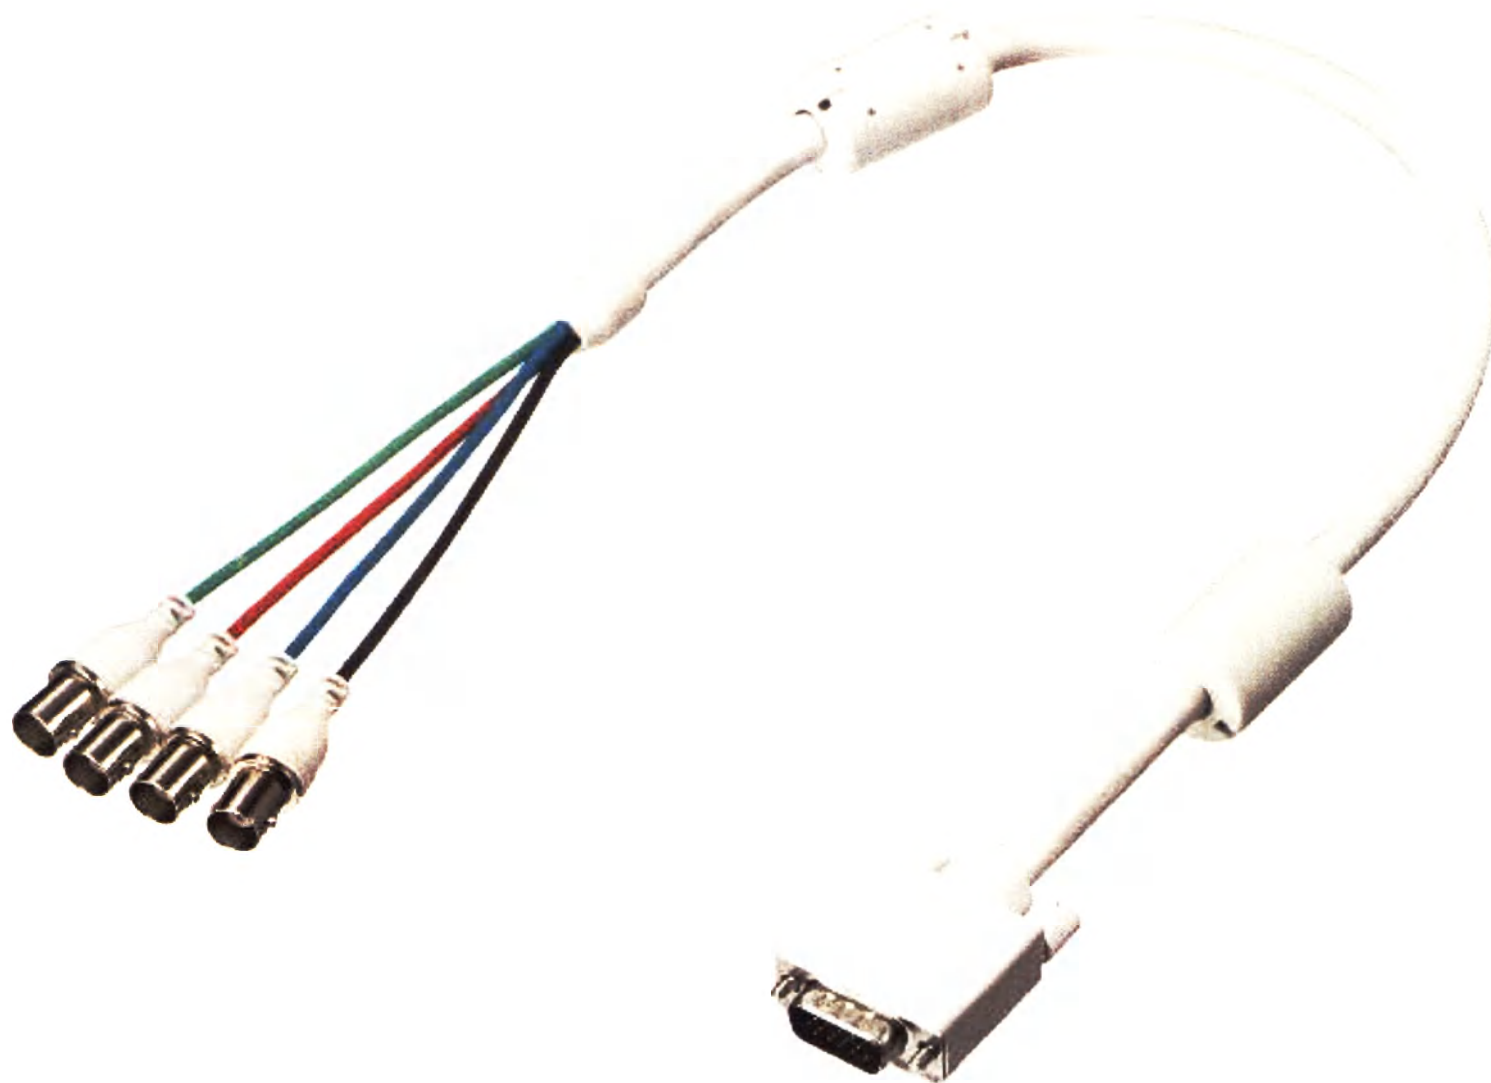

VI. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2451MT. Основной состав:


I. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2451MT




2. Адаптер переменного тока AC-110MD




3. Кабель электропитания

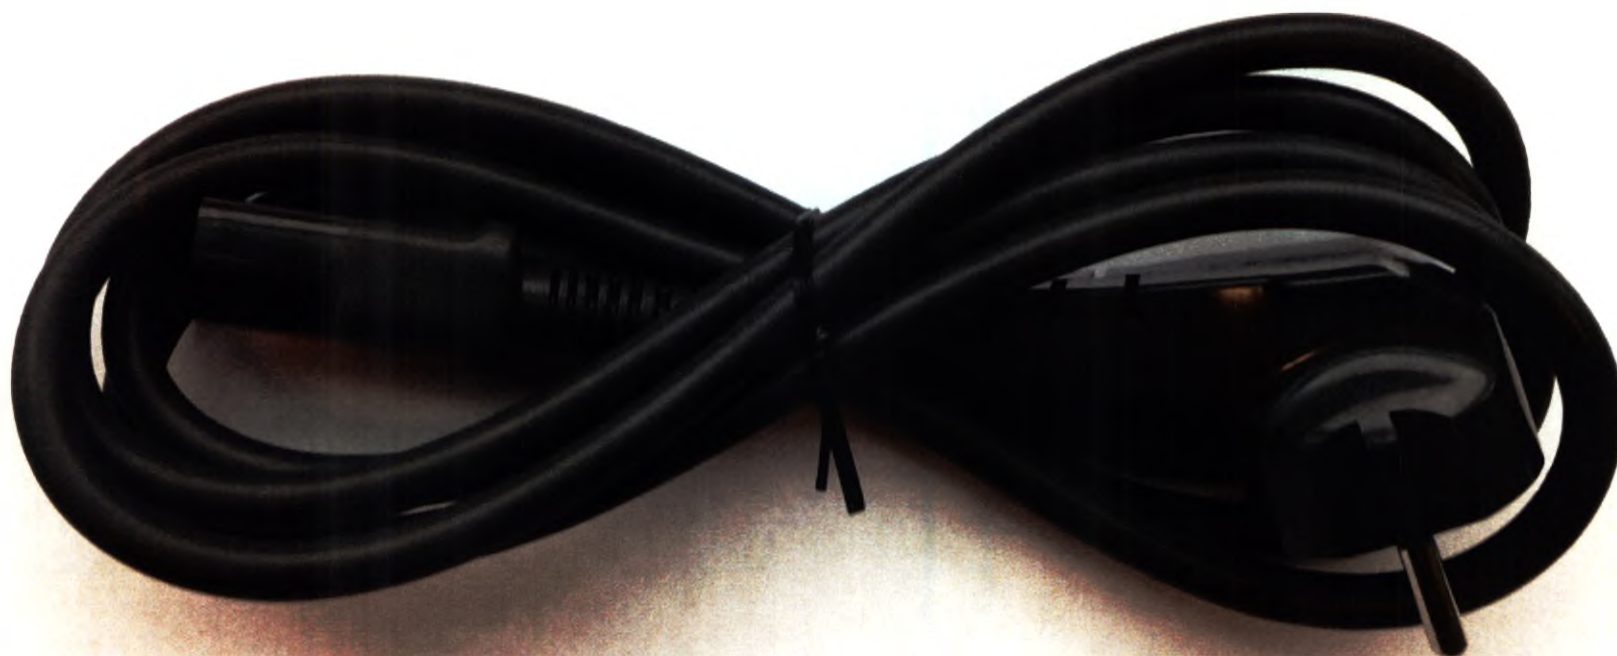


4. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.

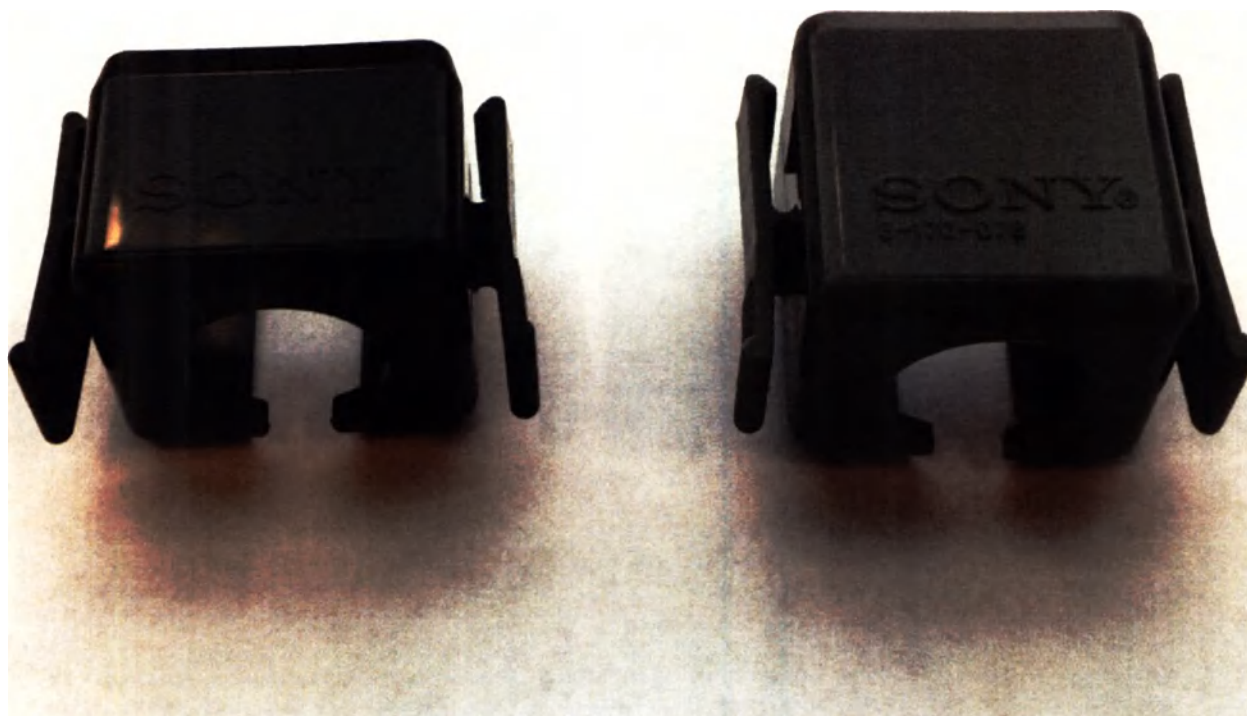

5. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

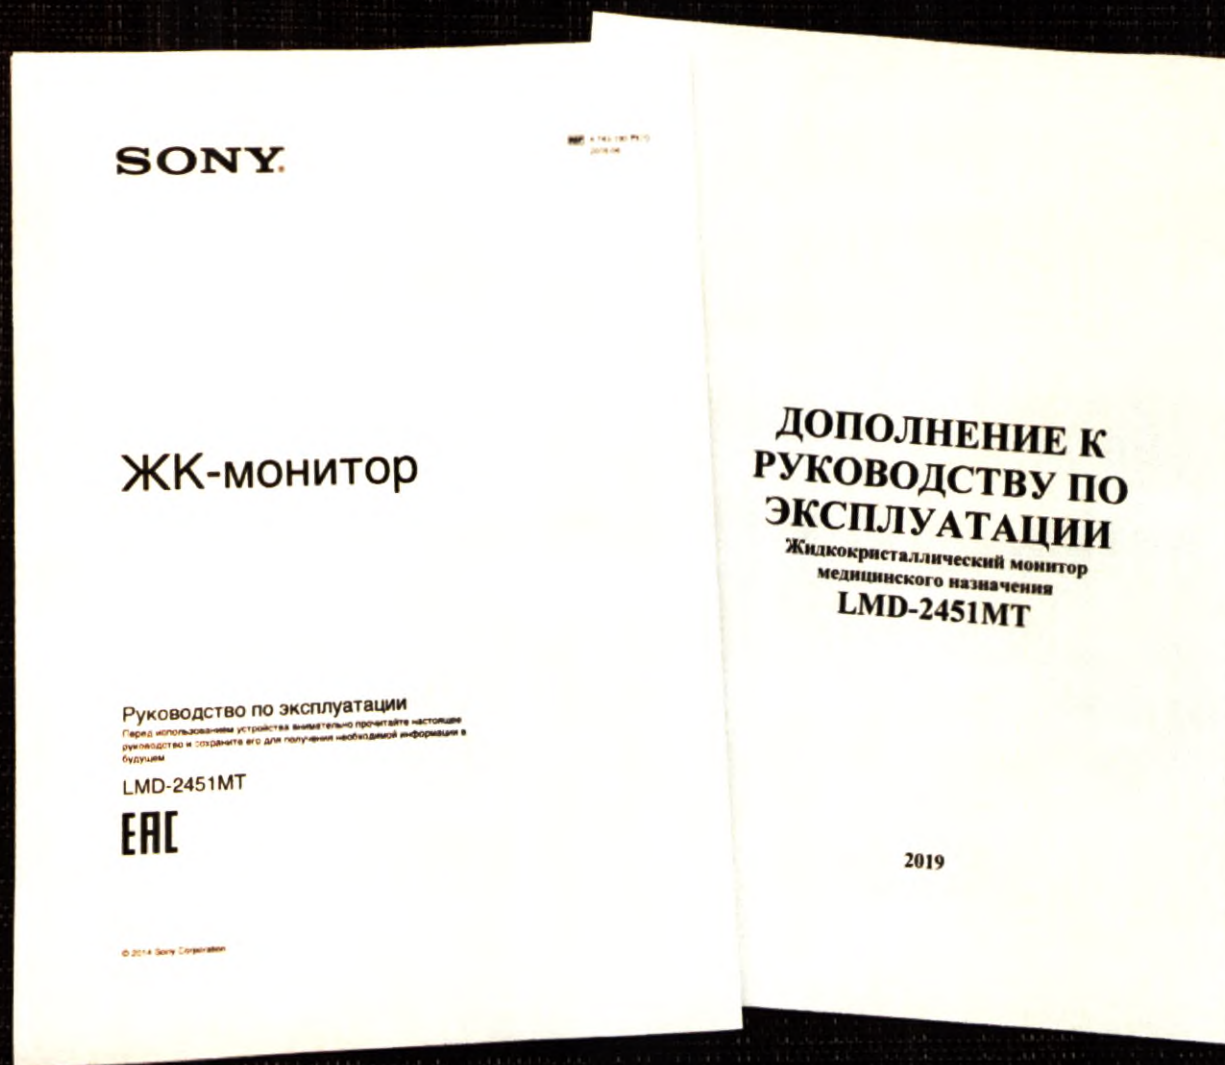

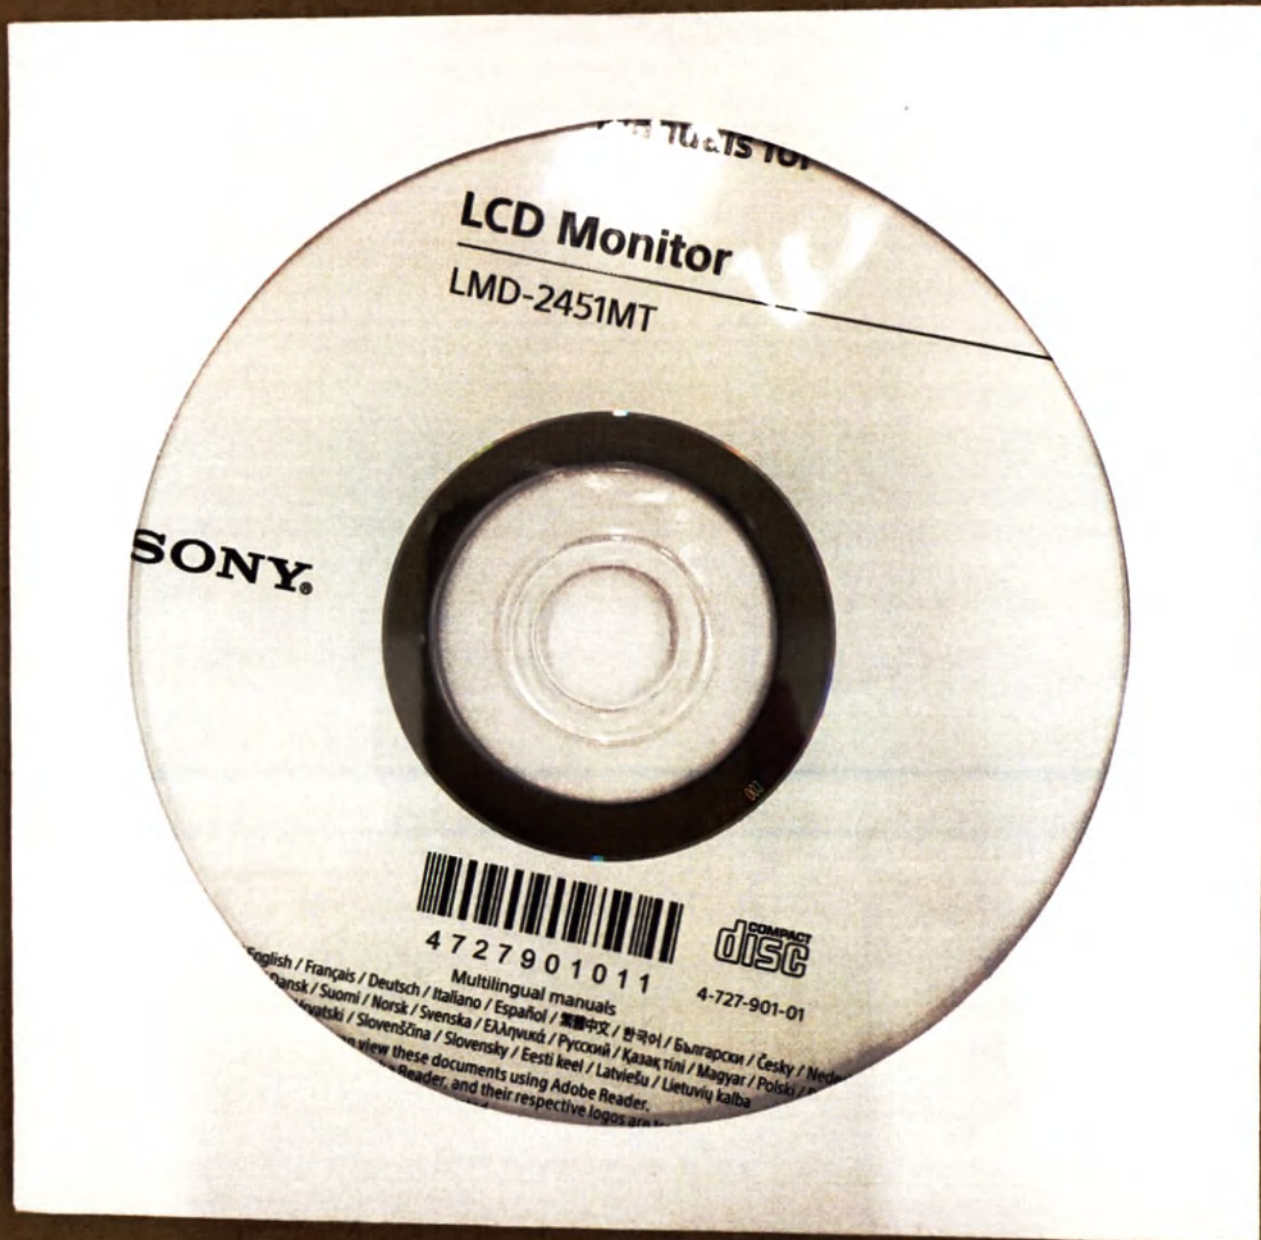

6. Комплект 3D очков, модели CFV-E30SK, состоящий из 1 оправы, 3-х 3D фильтров, эксплуатационной документации на бумажном носителе



SONY

REF 4-578-951-0
2015-07

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

取り付け方法

Attachment Procedure

Procédure de fixation

Montageanleitung

Procedura di montaggio

Procedimiento de fijación

Montageprocedure

Procedimento de instalação

Fastgørelsesprocedure

Liittämishjeet

Festeprosedyre

Fästande

Διαδικασία στερέωσης

Процедура за прикрепване

Postup připojení

Összeszerelési útmutató

Procedura mocowania

Procedură de montaj

Postopek namestitve

Postup upevnenia

Piestiprināšanas procedūra

Pritvirtinimo procedūra

Kinnitusprotseduur

Postupak pričvrščivanja

Bağlama Prosedürü

Procedura za pričvrščivanje

Процедура закреплення

Бекіту процедурасы

连接方法

安裝程序

부착 절차

CE

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



457

SONY

REF 4-578-939-42-1
2017-06

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

Upute za upotrebu

Kullanım Talimatları

Uputstvo za upotrebu

Руководство по эксплуатации
Пайдалану нұсқаулығы

CFV-B100

CFV-E30SK/E30D/E20SK/E20D

CE

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



4578839420

Принадлежности:

1. Комплект 2D очков, модели CFV-E20SK, состоящий из 1 оправы, 3-х 2D фильтров, эксплуатационной документации на бумажном носителе



SONY

REF 4-578-951-0
2015-07

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

取り付け方法

Attachment Procedure

Procédure de fixation

Montageanleitung

Procedura di montaggio

Procedimiento de fijación

Montageprocedure

Procedimento de instalação

Fastgørelsesprocedure

Liittämishjeet

Festeprosedyre

Fästande

Διαδικασία στερέωσης

Процедура за прикрепване

Postup připojení

Összeszerelési útmutató

Procedura mocowania

Procedură de montaj

Postopek namestitve

Postup upevnenia

Piestiprināšanas procedūra

Pritvirtinimo procedūra

Kinnitusprotseduur

Postupak pričvrščivanja

Bağlama Prosedürü

Procedura za pričvrščivanje

Процедура закреплення

Бекіту процедурасы

连接方法

安裝程序

부착 절차

CE

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



457

SONY

REF 4-578-839-42-1
2017-06

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

Upute za upotrebu

Kullanım Talimatları

Uputstvo za upotrebu

Руководство по эксплуатации
Пайдалану нұсқаулығы

CFV-B100

CFV-E30SK/E30D/E20SK/E20D

CE

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan




4578839420


2. Входной адаптер BKM-243HSM




3. Входной адаптер ВКМ-250TGM

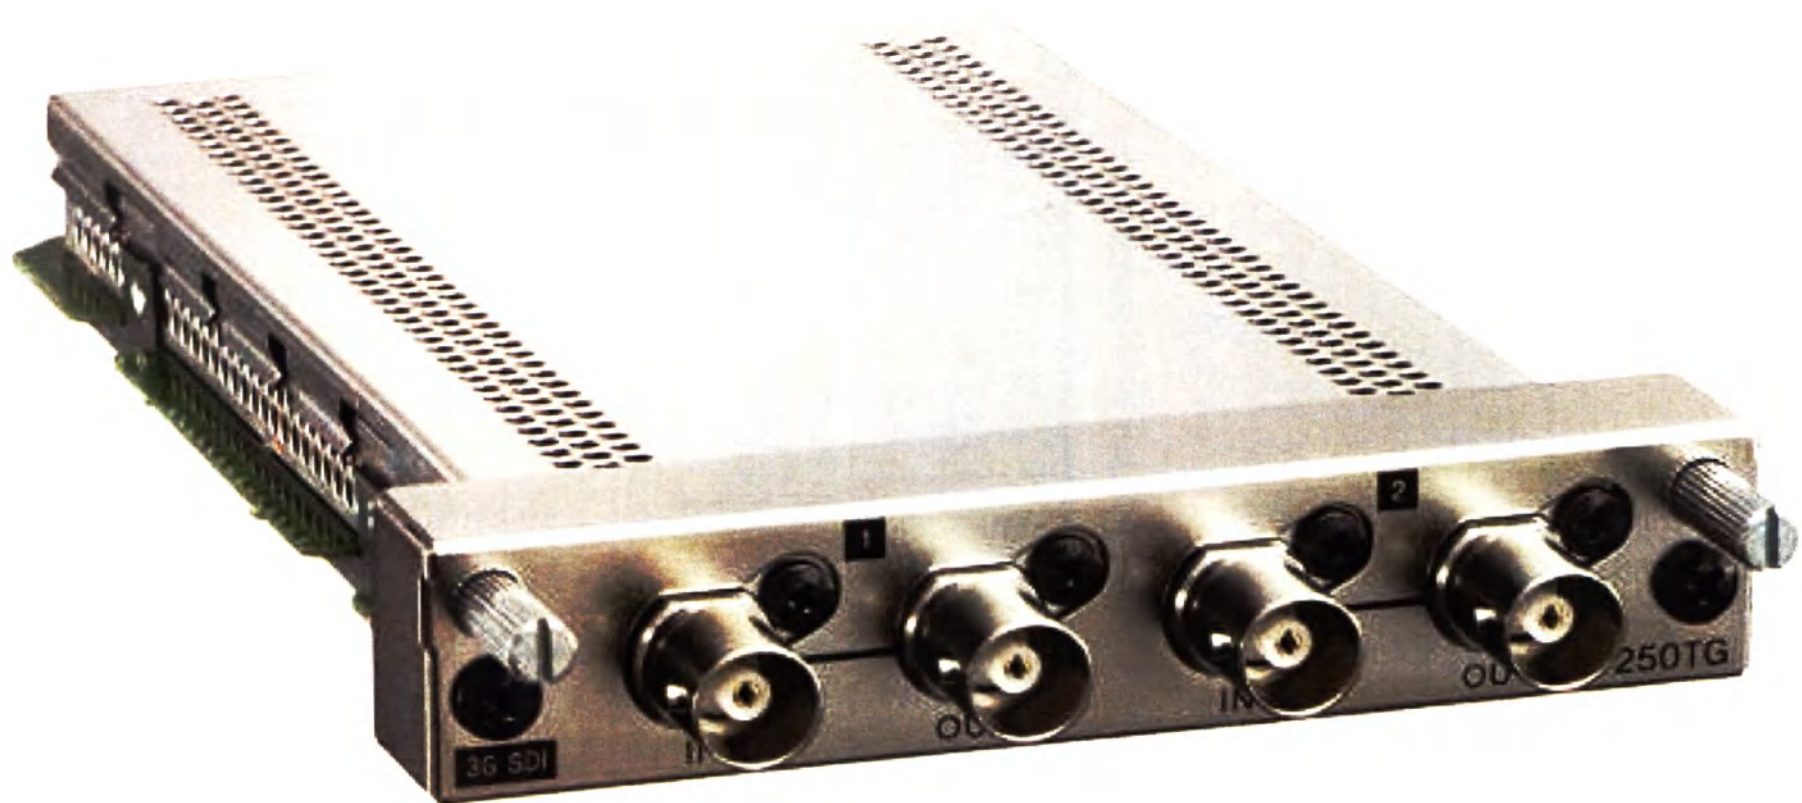

4. Входной адаптер ВКМ-256DD – не более 5 шт.

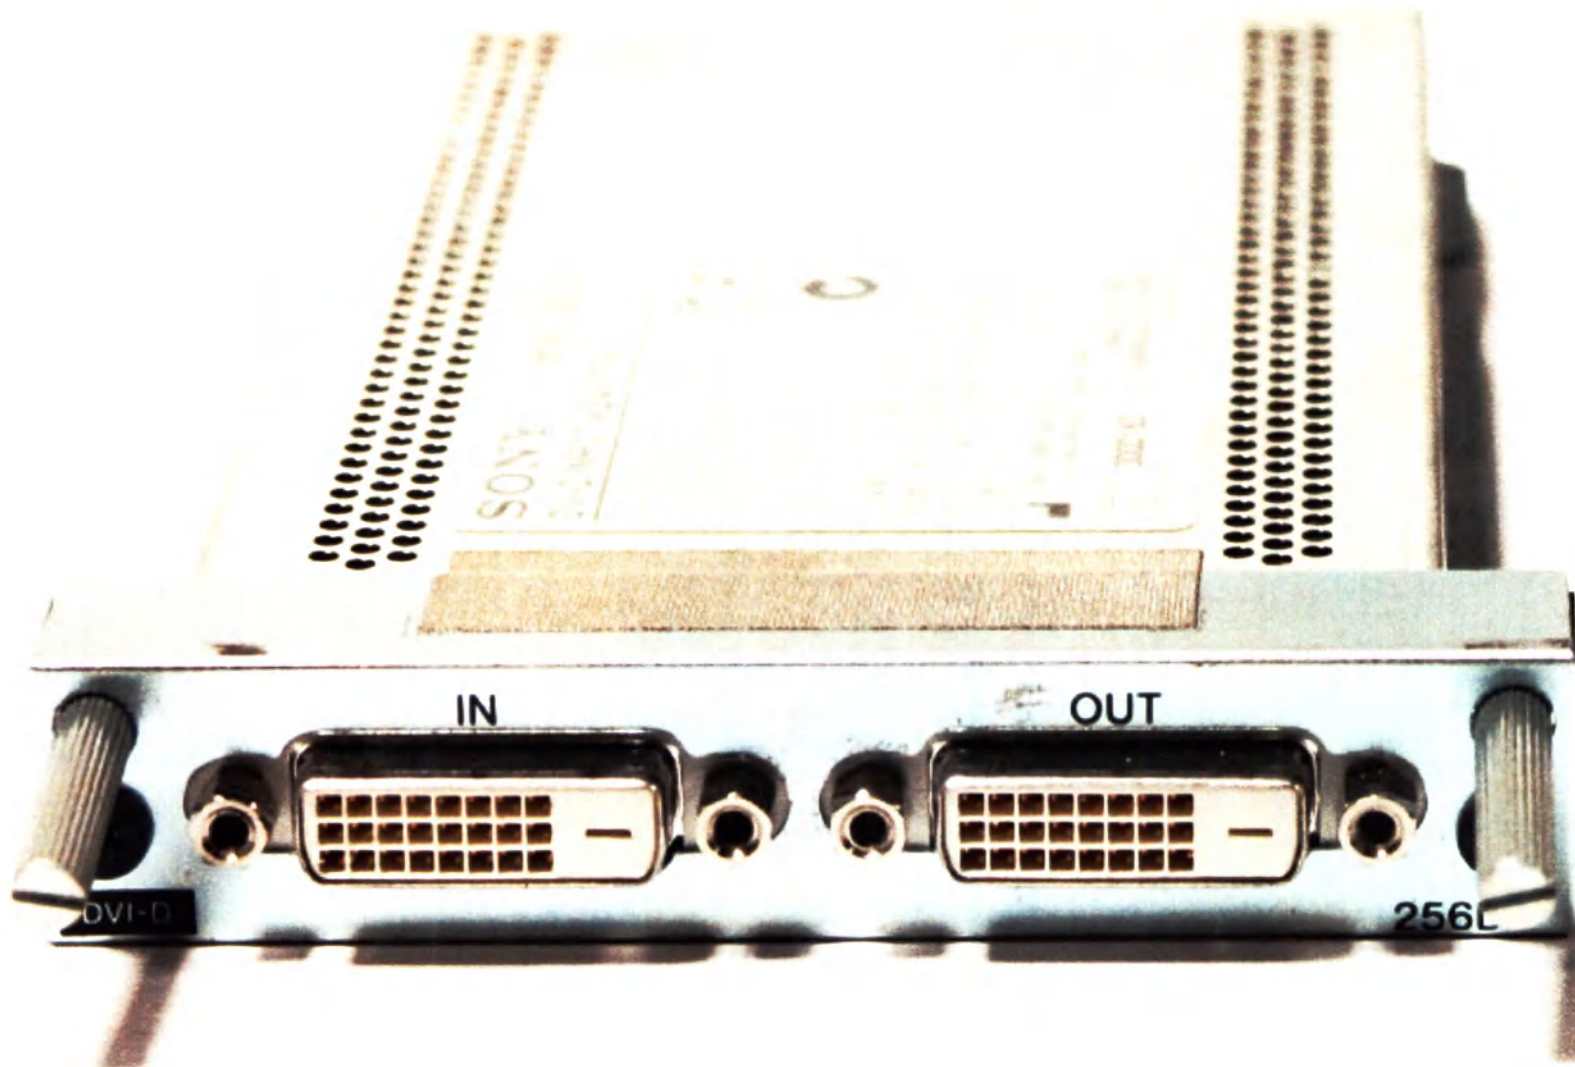


5. Подставка под монитор SU-560

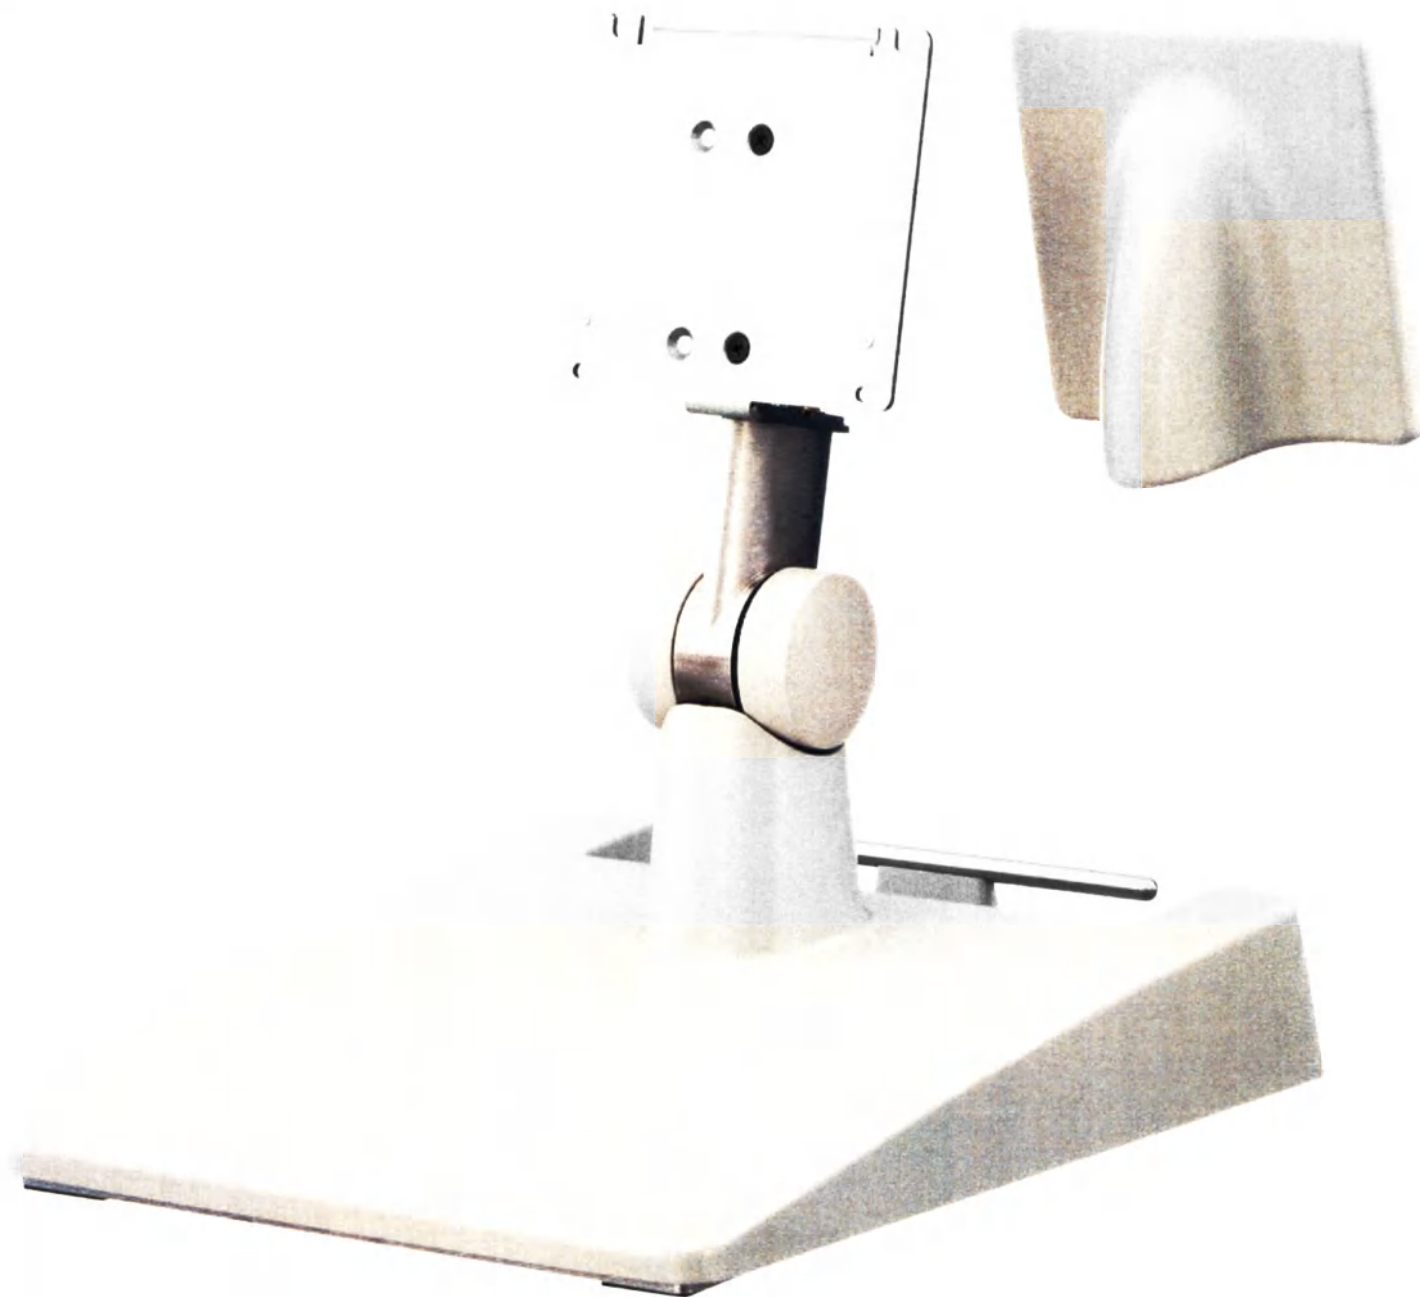


VII. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X310MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X310MD

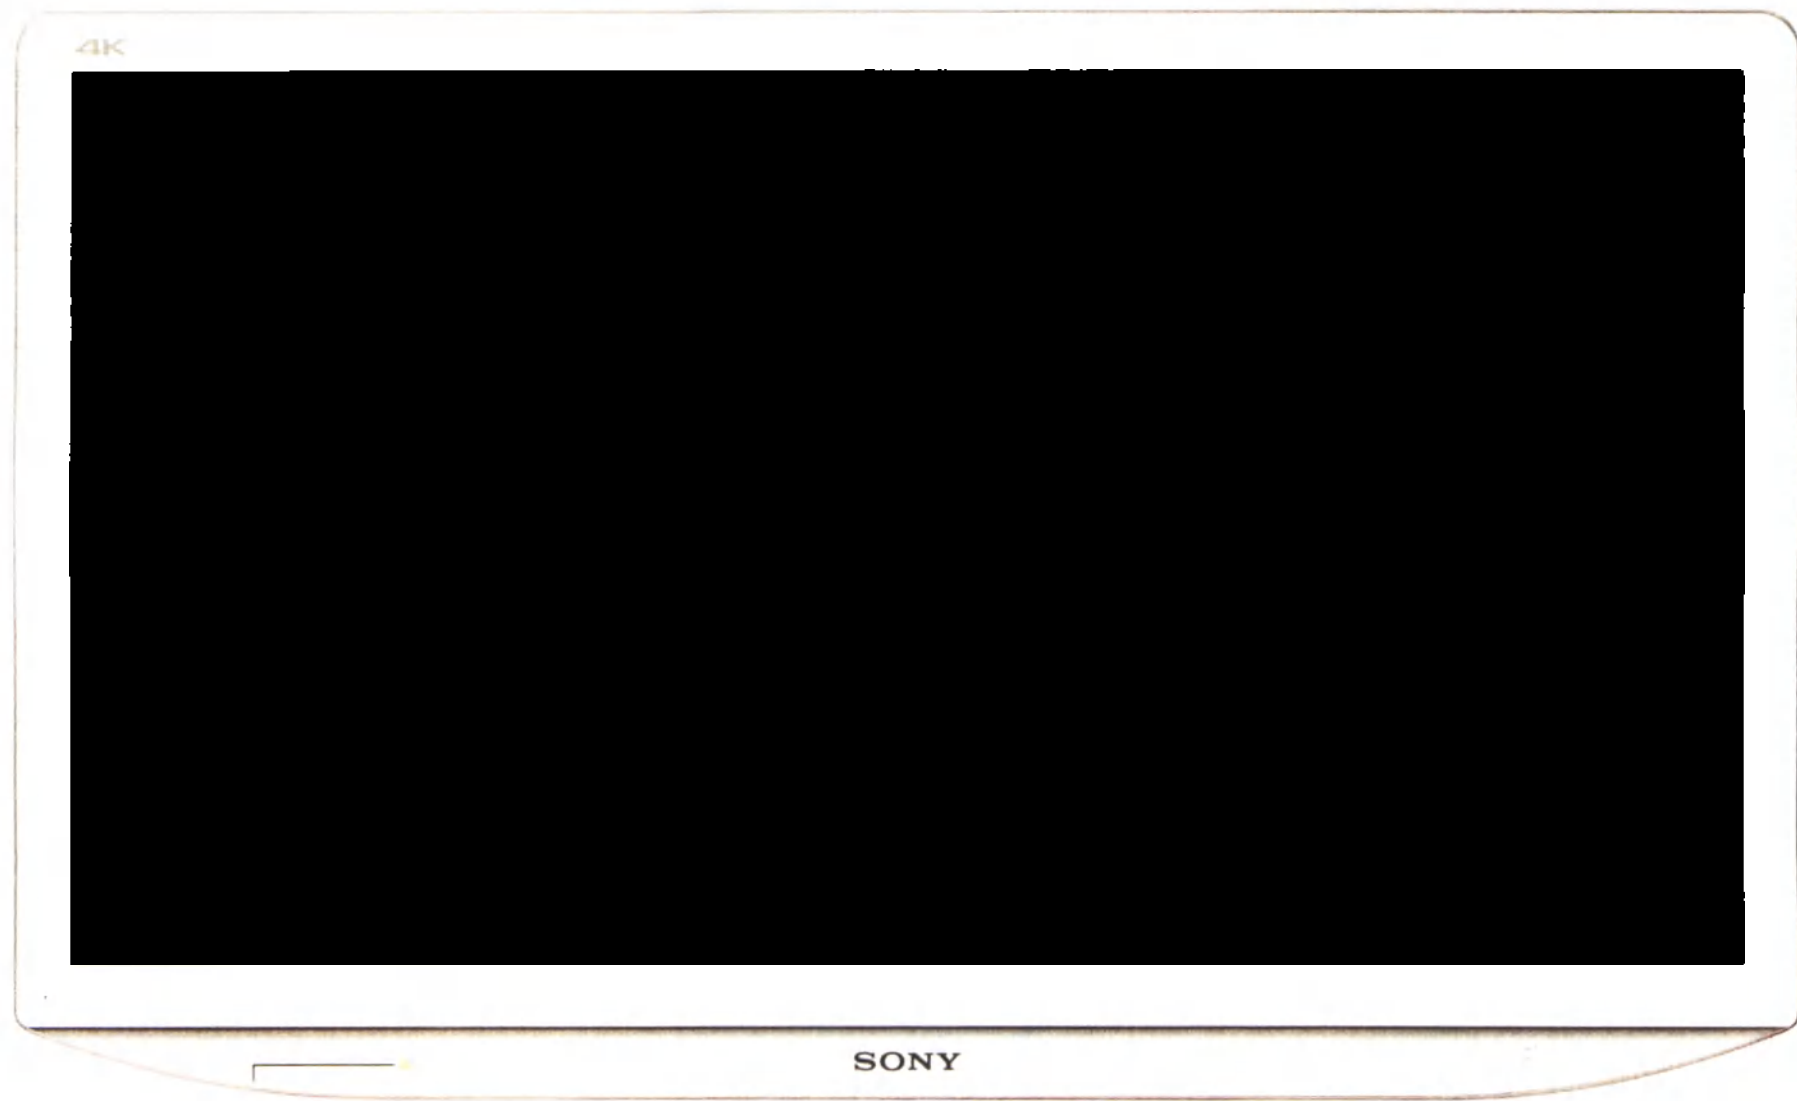

2. Блок питания AC-300MD

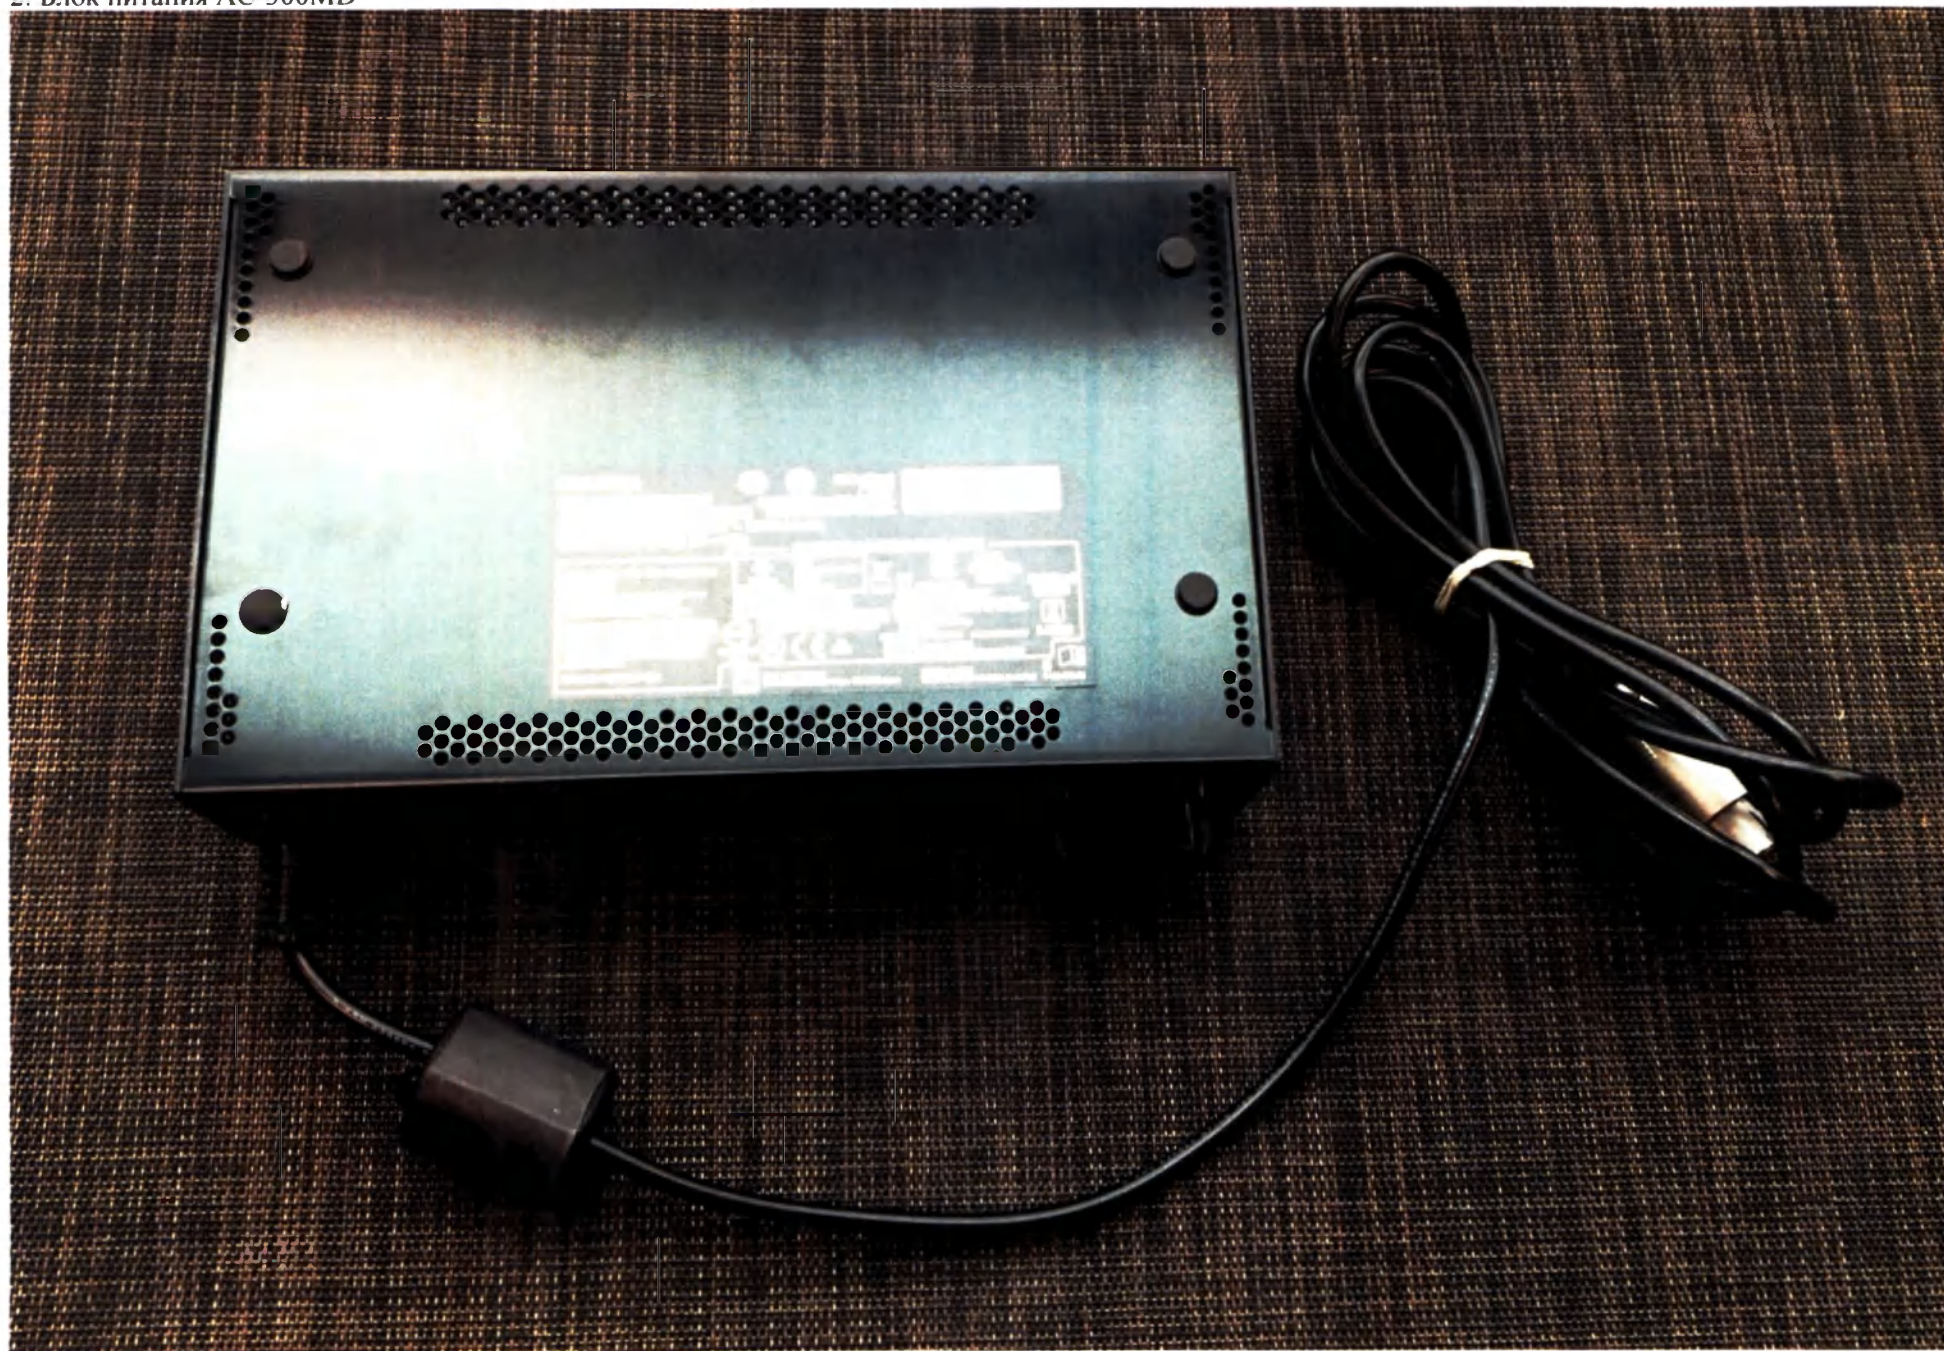

SONY

AC Adaptor 电源适配器 交換式電源供應器 БЛОК ПИТАНИЯ КУАТ КӨЗІ БЛОГТЫ

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

お読み上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らねば、
火災や人身事故に及ぶことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたが示されています。
この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全に取扱いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

AC-300MD

CE FRI


© 2014 Sony Corporation

取扱説明書	JP
Instructions for Use	GB
Instructions d'utilisation	FR
Gebrauchsanweisung	DE
Istruzioni per l'uso	IT
Manual de instrucciones	ES
使用说明	CS
操作説明	CT
사용 설명서	KR
Руководство по эксплуатации	RU
Пайддалану нускалмалы	KZ
Gebruiksaanwijzing	NL
Manual de instruções	PT
Brugervejledning	DK
Käyttöohjeet	FI
Brúkaravísning	NO
Brúkanvísning	SE
Обръщ. Хрѣтос	GR
Инструкции за употреба	BG
Uživatelská příručka	CZ
Használati útmutató	HU
Instrukcja obsługi	PL
Instruccioni de utilizare	RO
Navodila za uporabo	SI
Návod na obsluhu	SK
Lietošanas instrukcija	LV
Naudojimo instrukcija	LT
Kasutusjuhend	EE
Upute za uporabu	HR
Kullanım Talimatları	TR
Uputstvo za upotrebu	SR



4549346030

4. Кабель электропитания

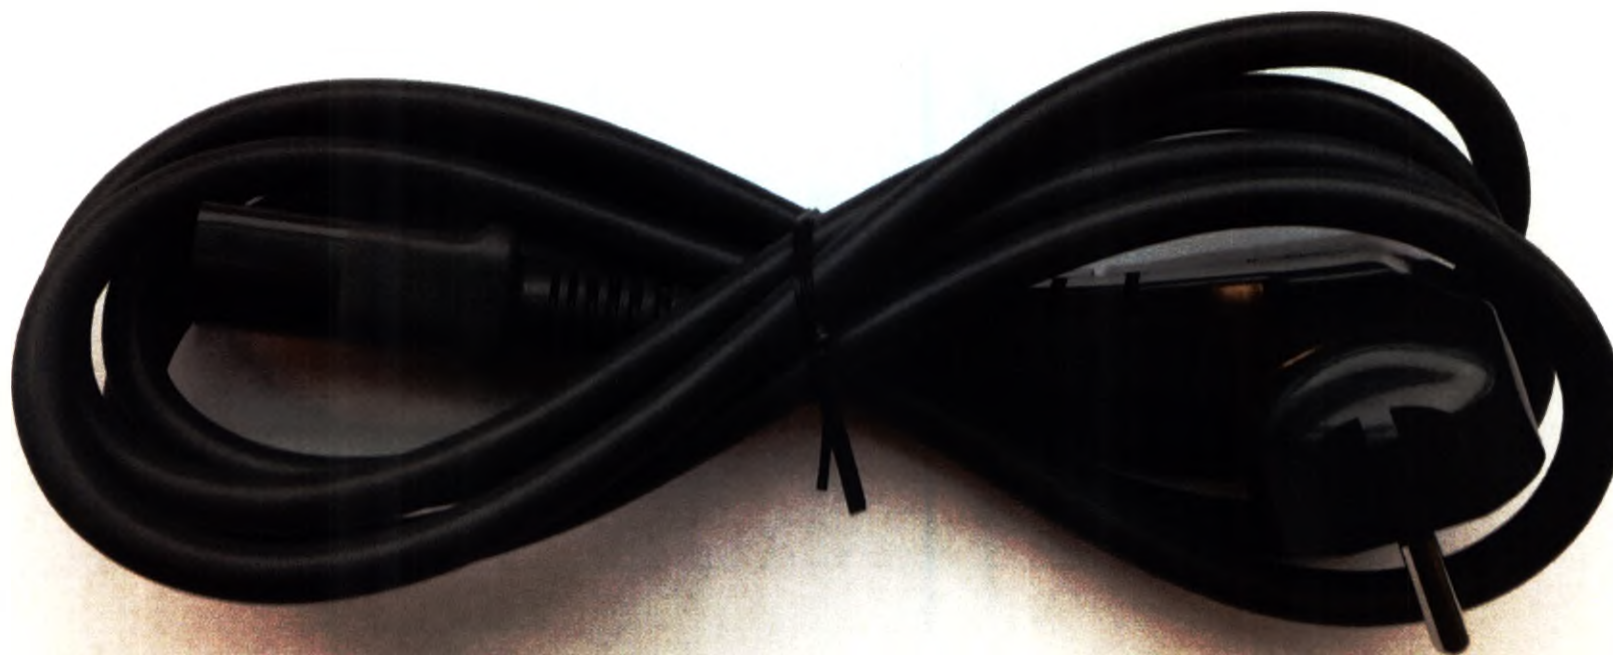

5. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



6. Винты для крепления VESA, М4 × 12 мм – 4 шт.



7. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

SONY

ЖК-монитор

Руководство по эксплуатации
Полное руководство по эксплуатации, а также руководство по эксплуатации
устройства и инструкции по эксплуатации можно скачать на сайте www.sony.com

LMD-X310MD
LMD-X550MD

ЕАС HDMI


© 2011 Sony Corporation

ДОПОЛНЕНИЕ К
РУКОВОДСТВУ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жидкокристаллический монитор
медицинского назначения
LMD-X310MD


2019

Принадлежности:
1. Подставка SU-600MD

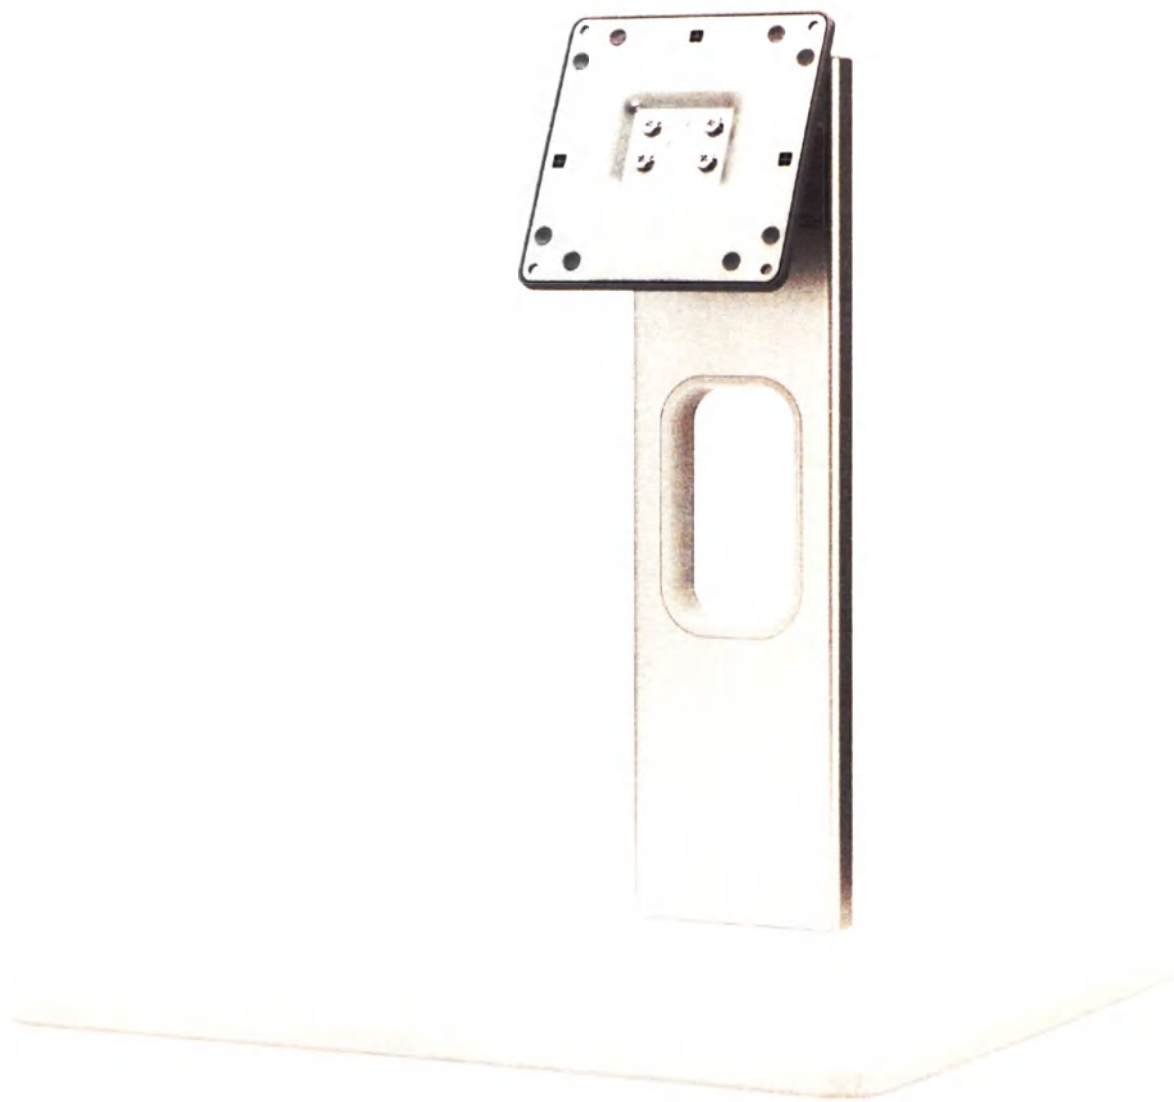

VIII. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X550MD. Основной состав:

I. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X550MD

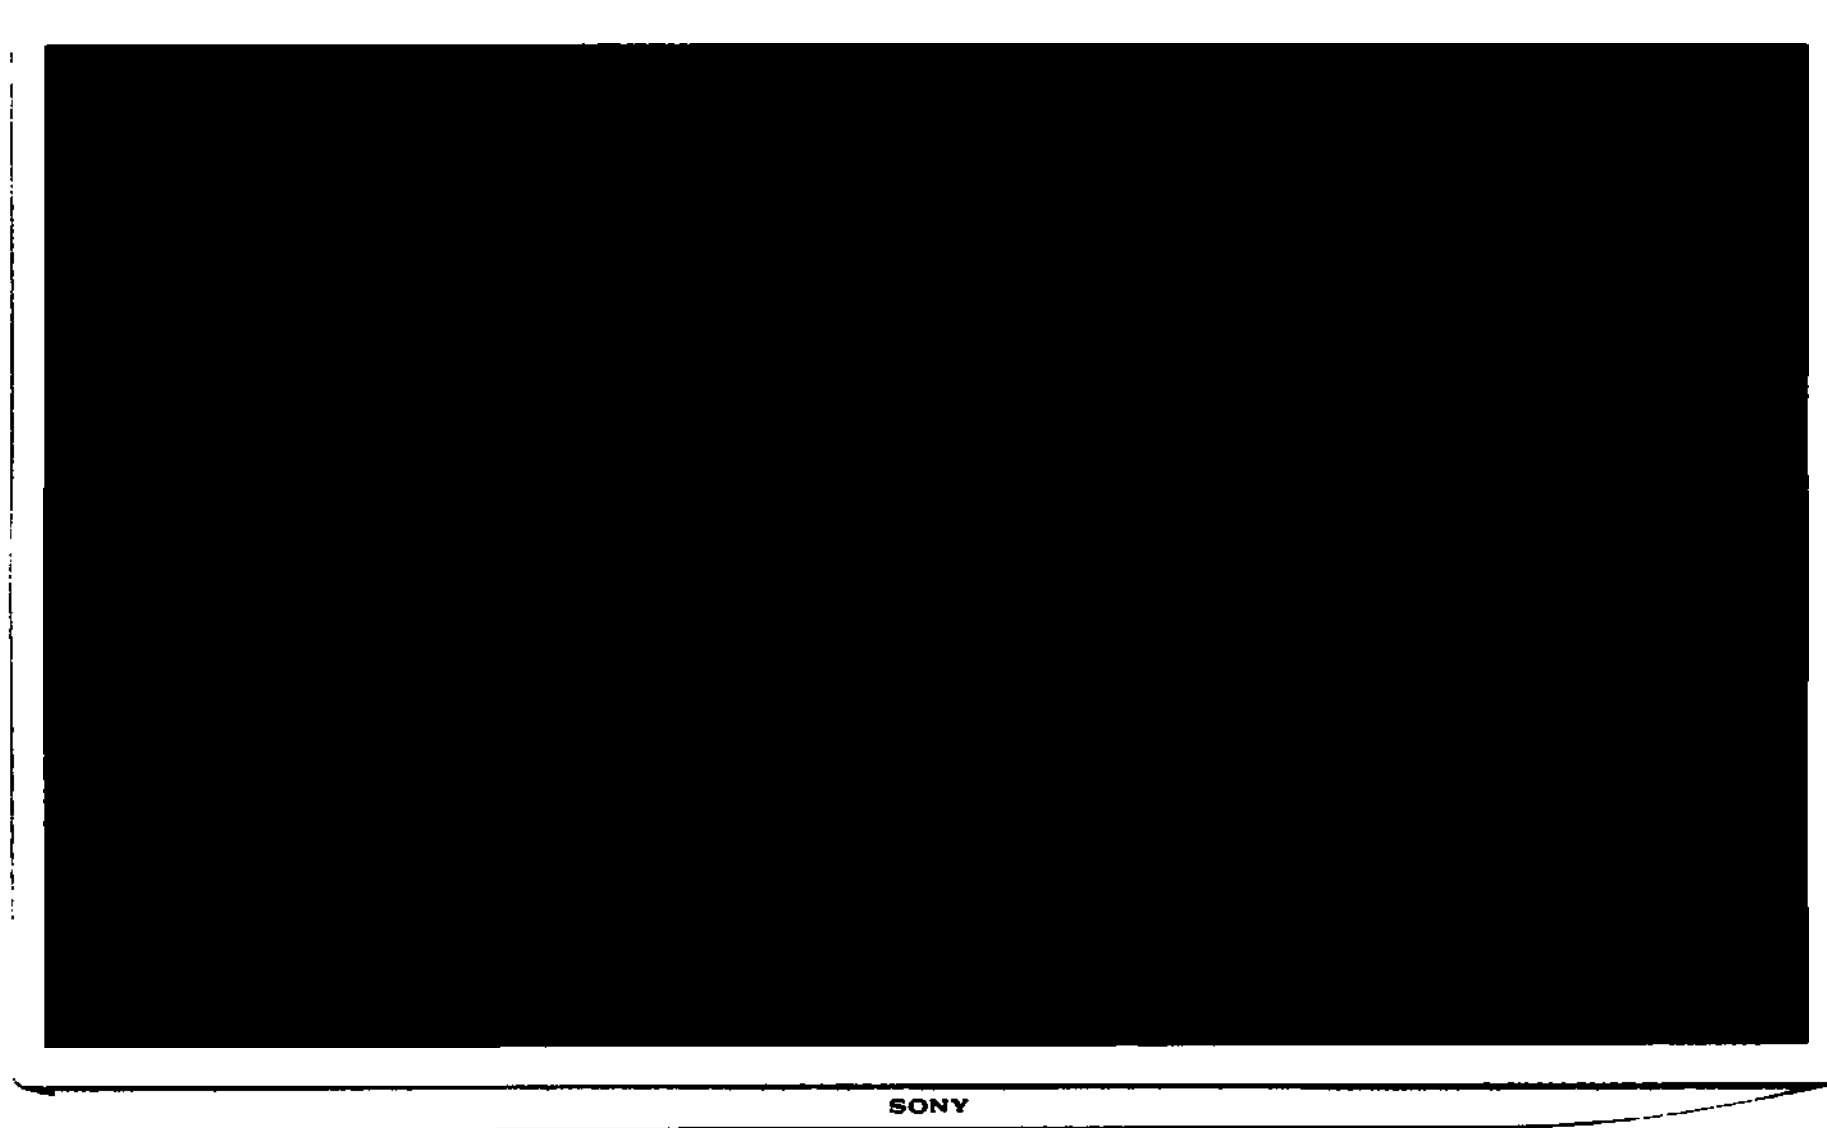


2. Кабель электропитания




3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.




4. Винты для крепления VESA, M6 × 12 мм – 4 шт.

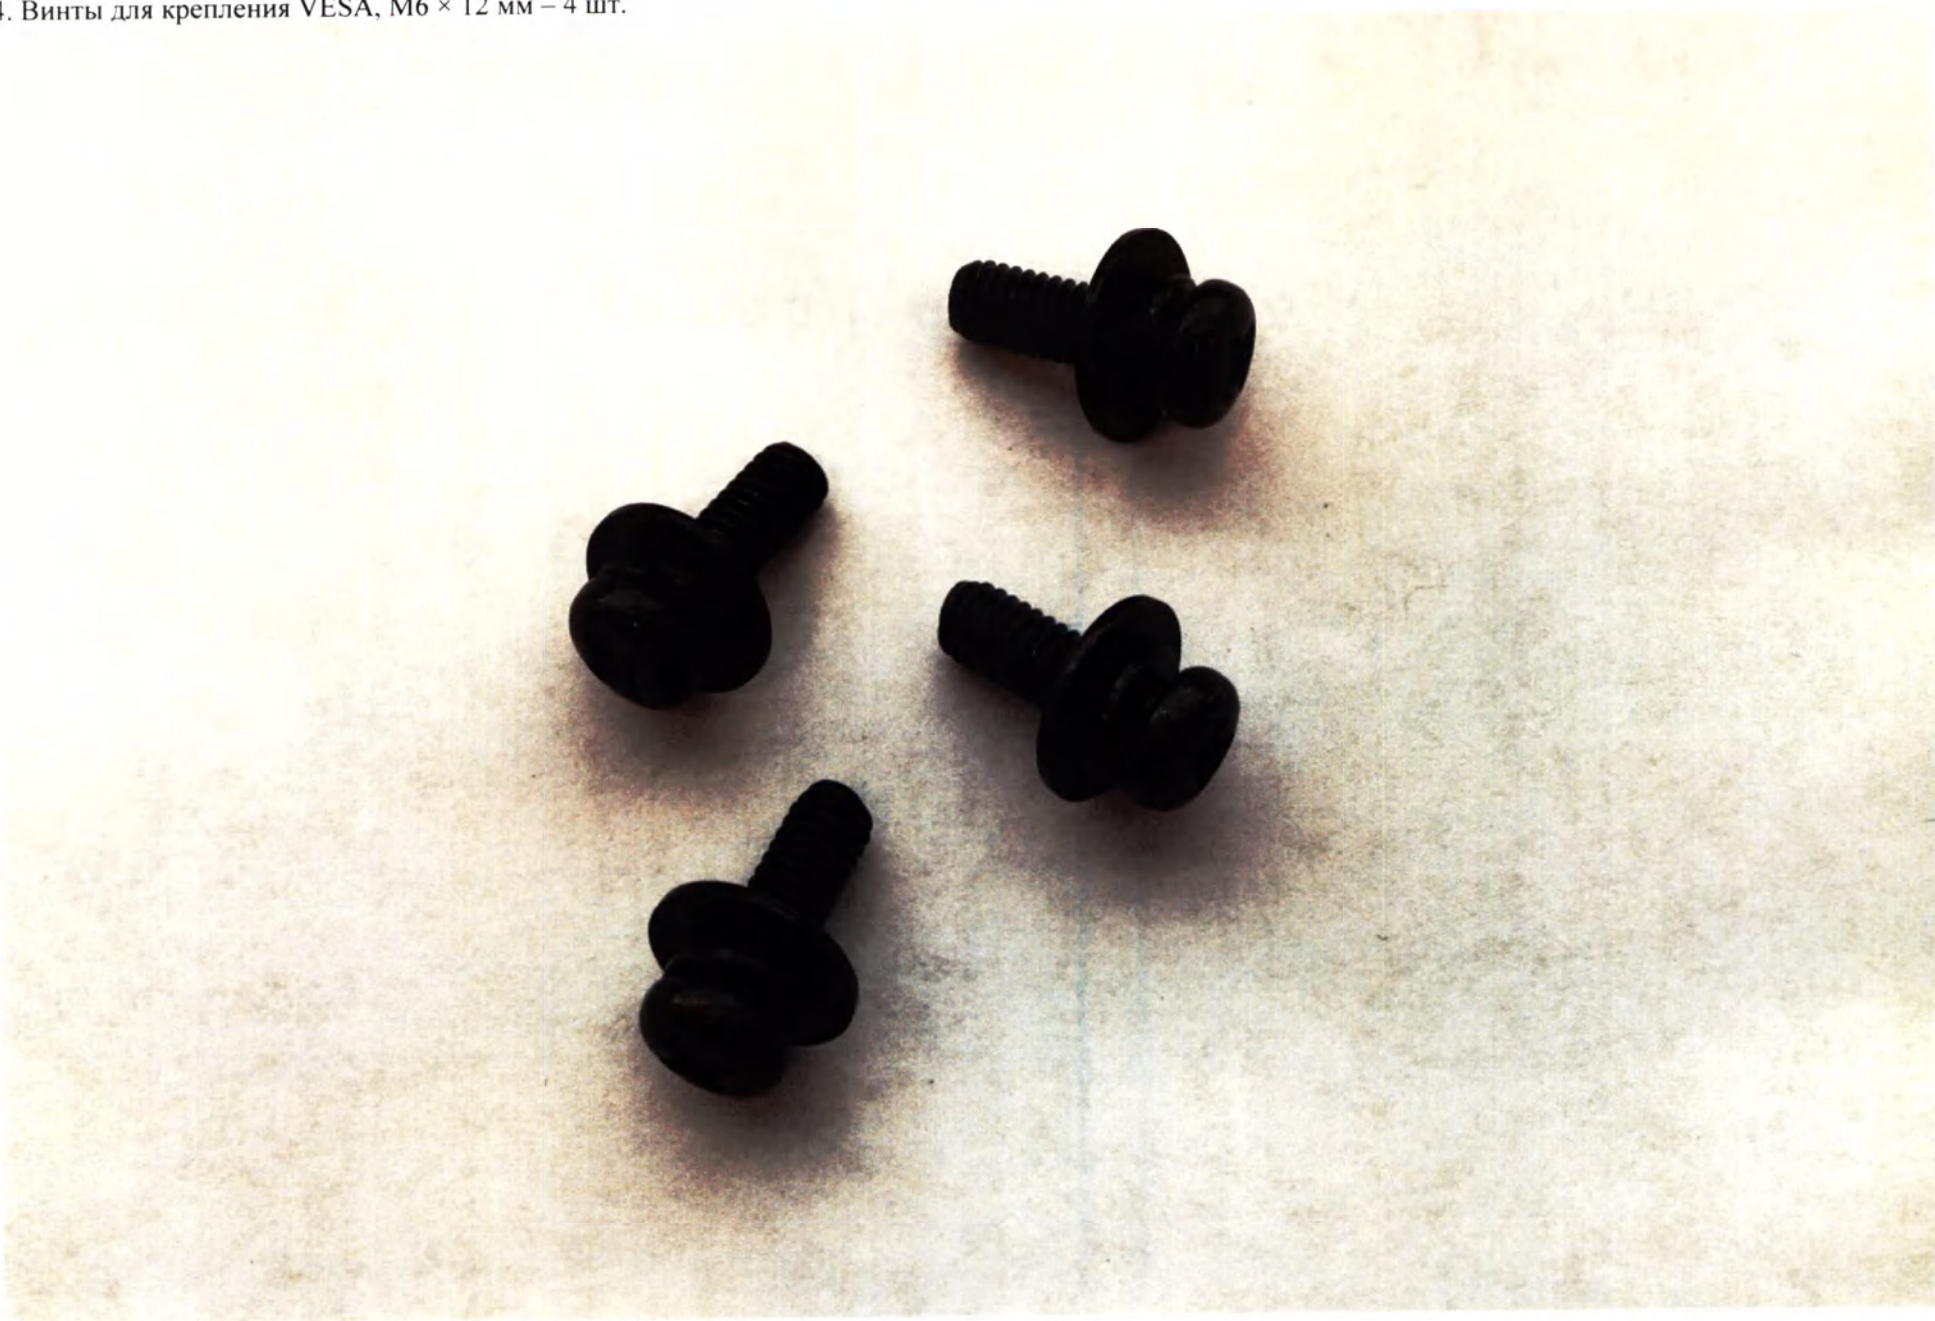


5. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

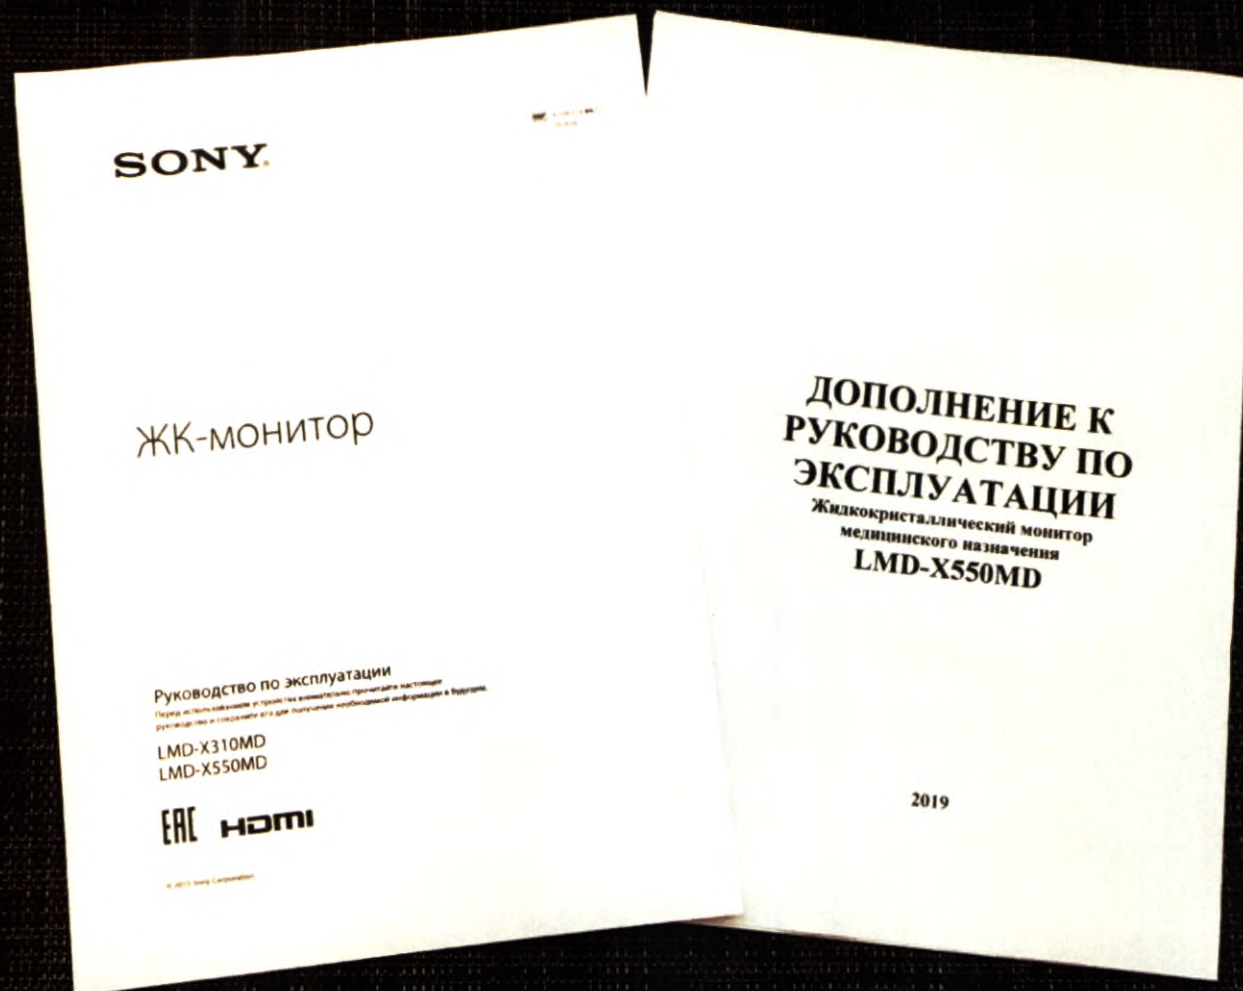

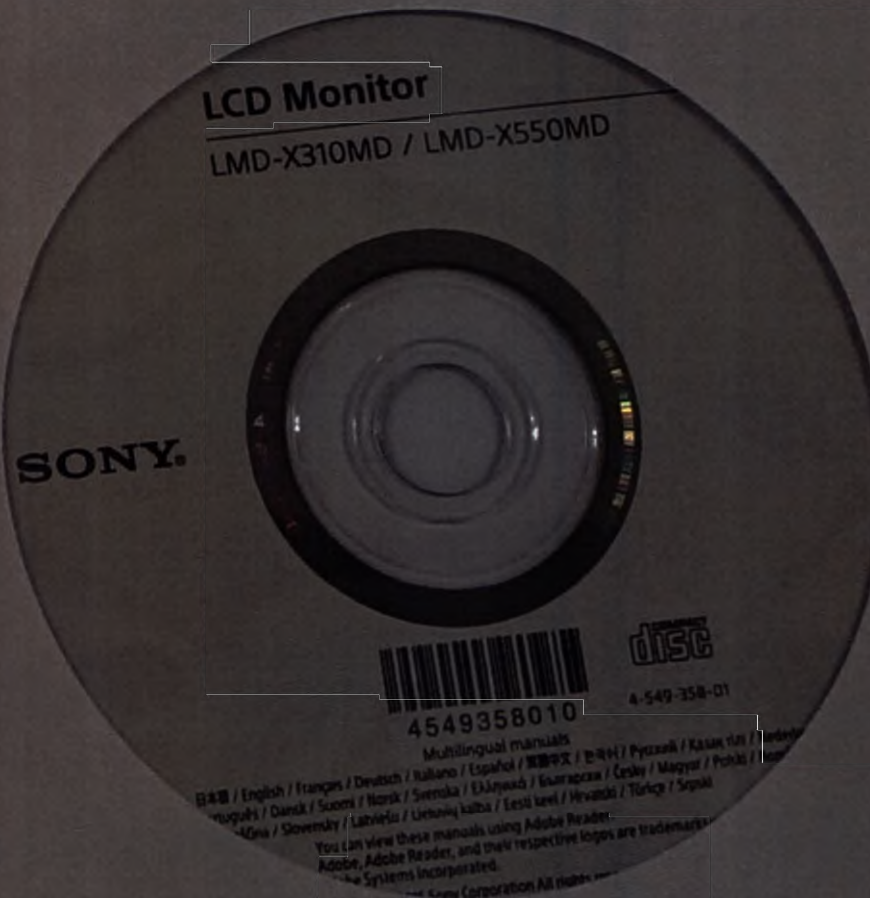

IX. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2435MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2435MD



SONY

2. Кабель электропитания



3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе



SONY.

LCD Monitor

LMD-2735MD / LMD-2435MD



4584950020

compact disc

4-584-950-02

Multilingual manuals

日本語 / English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 繁體中文 / 한국어 / Nederlands / Português

한국어 / Suomi / Norsk / Svenska / Ελληνικά / Български / Hrvatski / Češki / Magyar / Română


Беларускі / Slovenščina / Türkçe / Русский / Қазақ / Бұрыс / Бұрыс

Беларускі / Slovenščina / Türkçe / Русский / Қазақ / Бұрыс / Бұрыс


Беларускі / Slovenščina / Türkçe / Русский / Қазақ / Бұрыс / Бұрыс

Беларускі / Slovenščina / Türkçe / Русский / Қазақ / Бұрыс / Бұрыс


Принадлежности:
1. Сигнальный кабель SMF-405

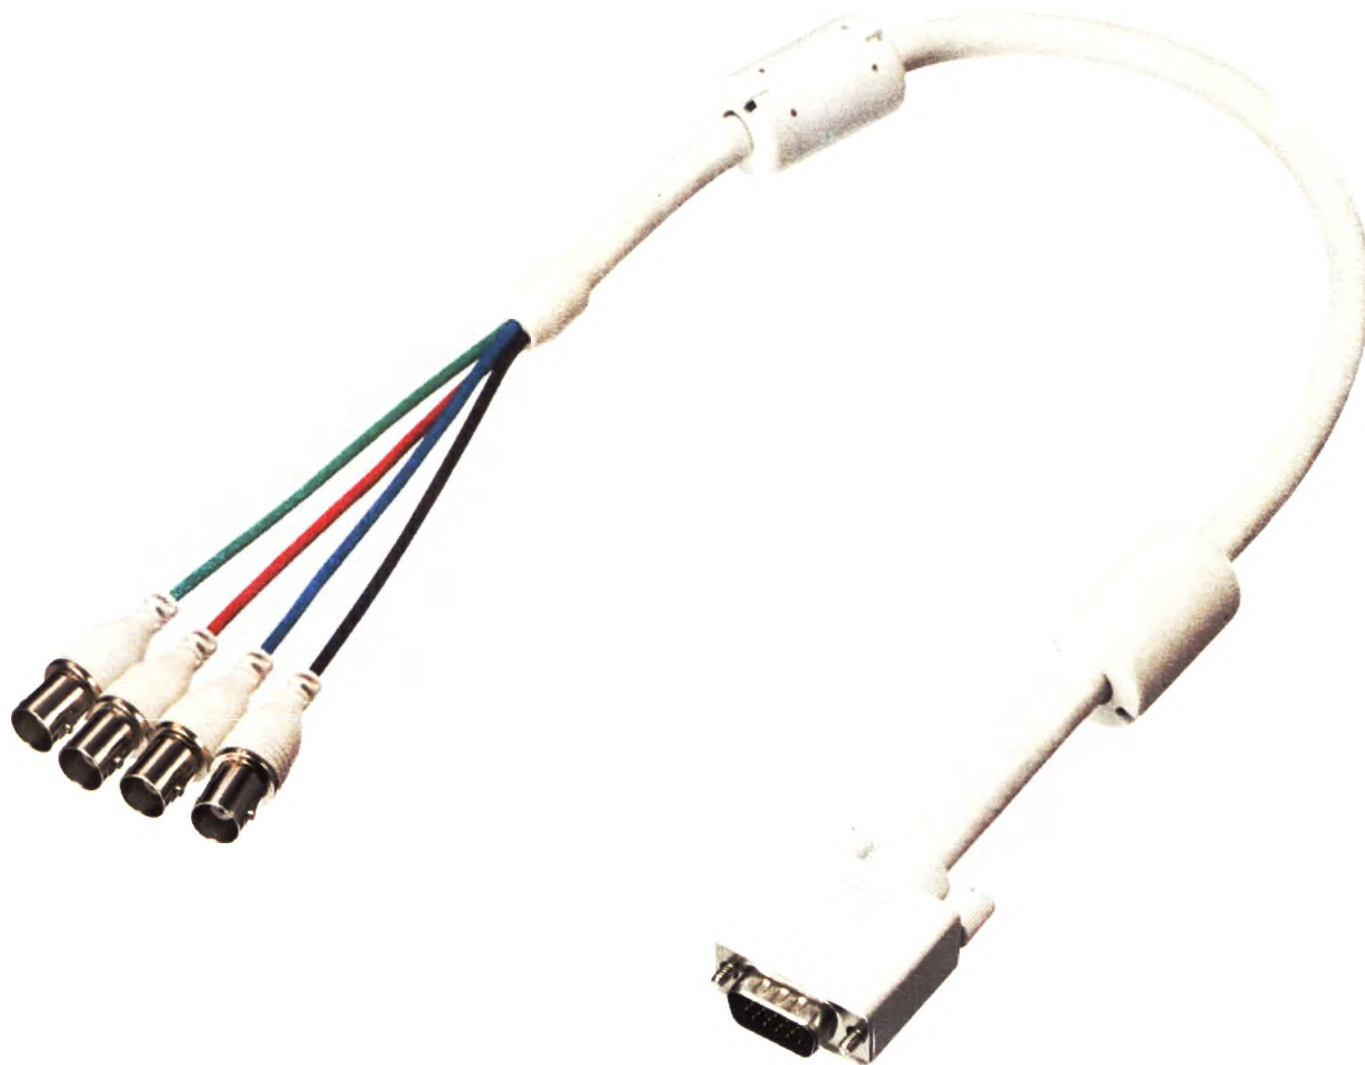

2. Адаптер переменного тока AC-120MD

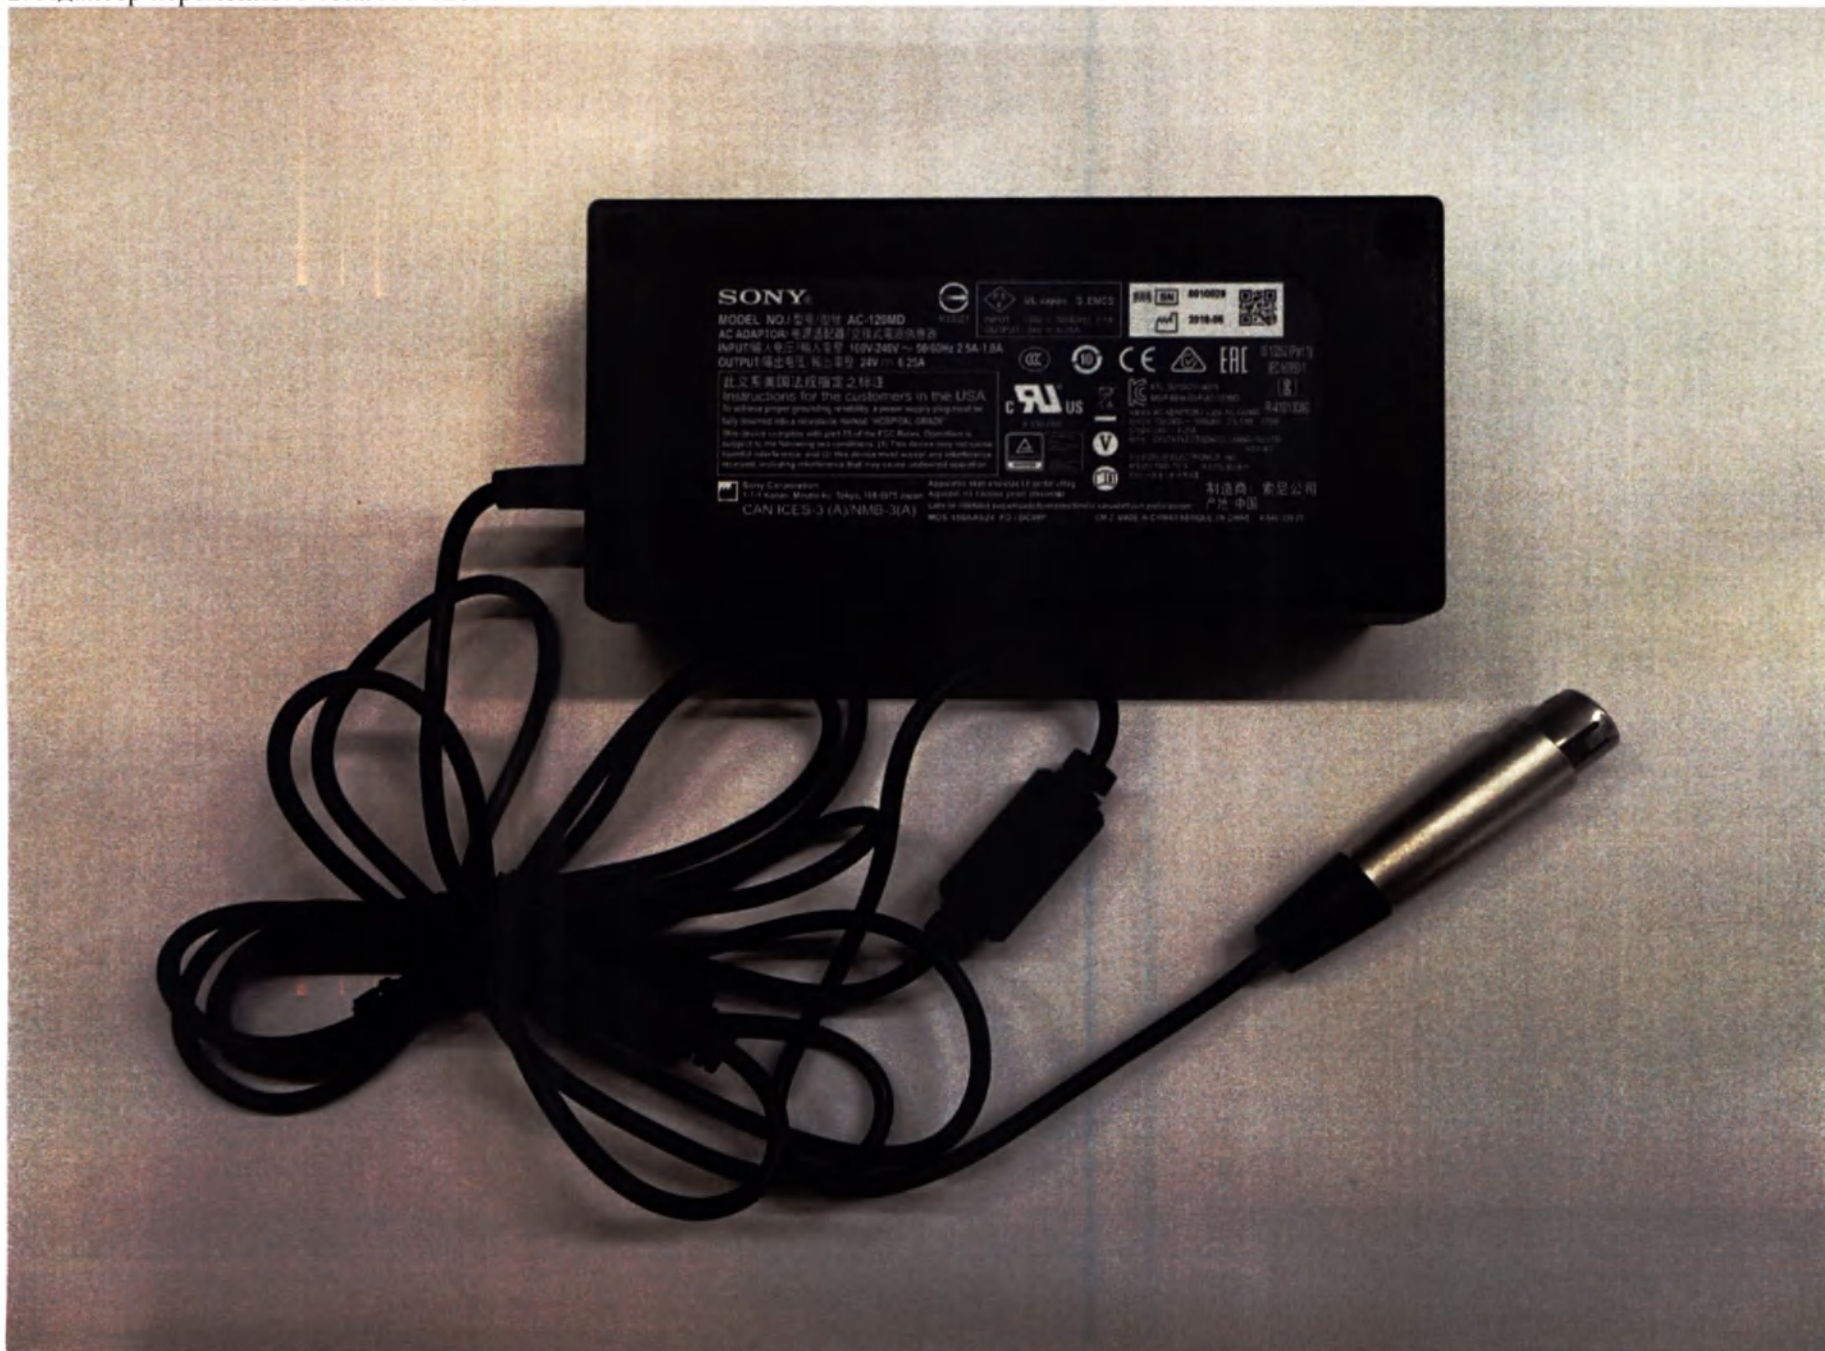


3. Подставка SU-600MD

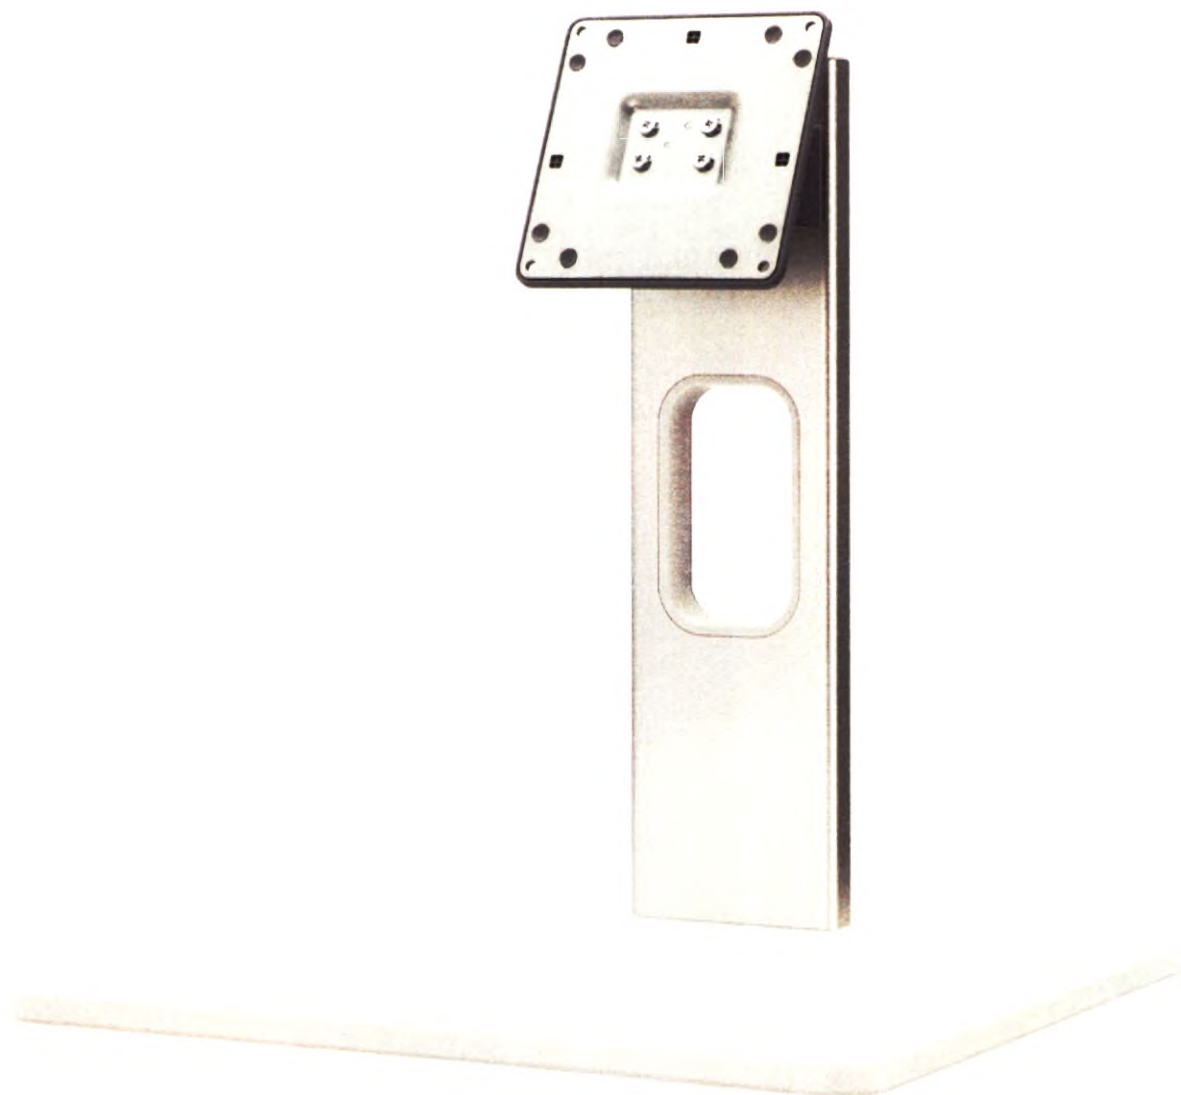

Х. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2735MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-2735MD



SONY


2. Кабель электропитания



3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

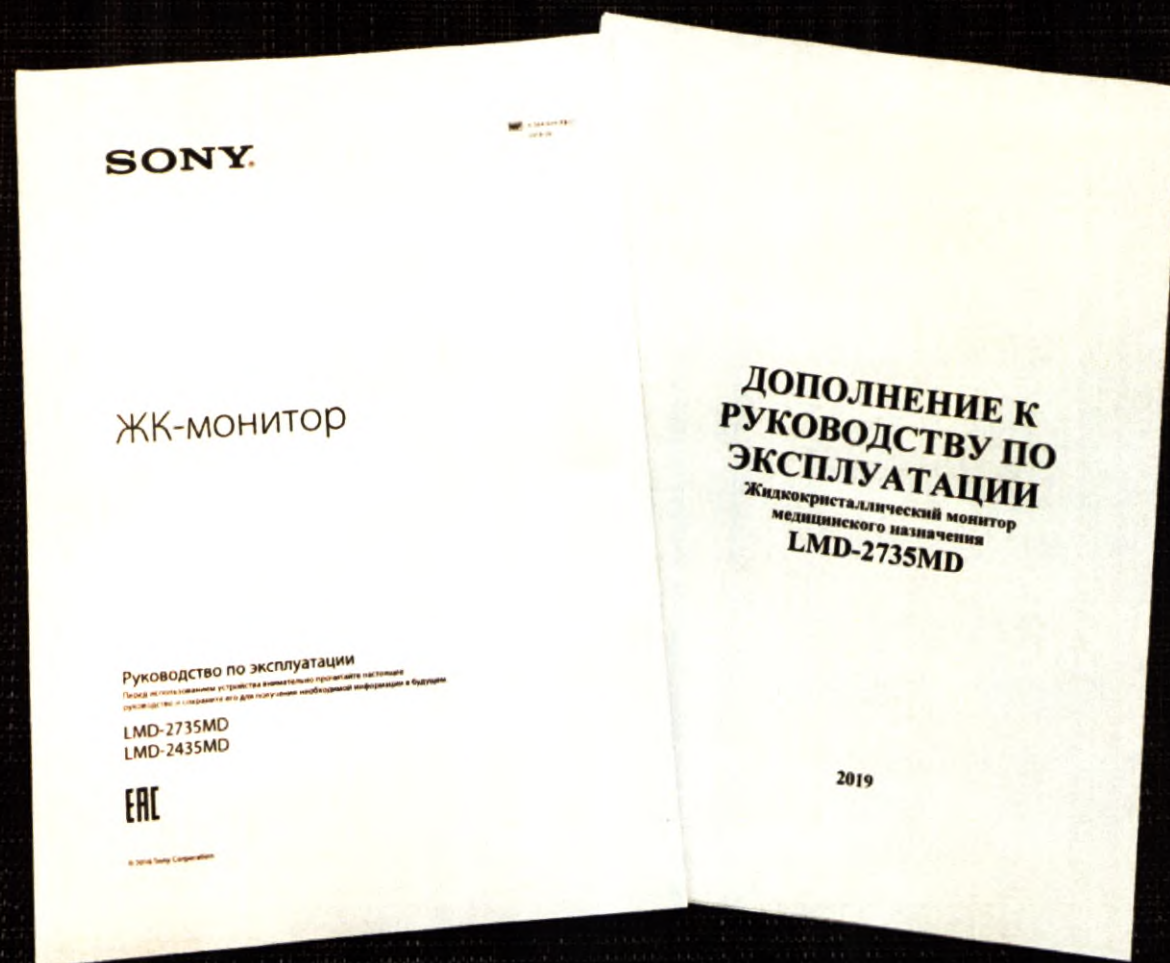

Manuals for
LCD Monitor

LMD-2735MD / LMD-2435MD

SONY.



4584950020

disc

4-584-950-02


Multilingual manuals

日本語 / English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 繁體中文 / 한국어 / Nederlands / Português / Suomi / Norsk / Svenska / Ελληνικά / Български / Hrvatski / Český / Magyar / Slovenščina / Srpski / Slovensky / Slovenščina / Türkçe / Pyccкий / Қазақ тілі / Bahasa Indonesia


You can view these manuals using Adobe Reader.

Adobe Reader, and their respective logos are trademarks of Adobe Systems Incorporated.


Принадлежности:
1. Сигнальный кабель SMF-405

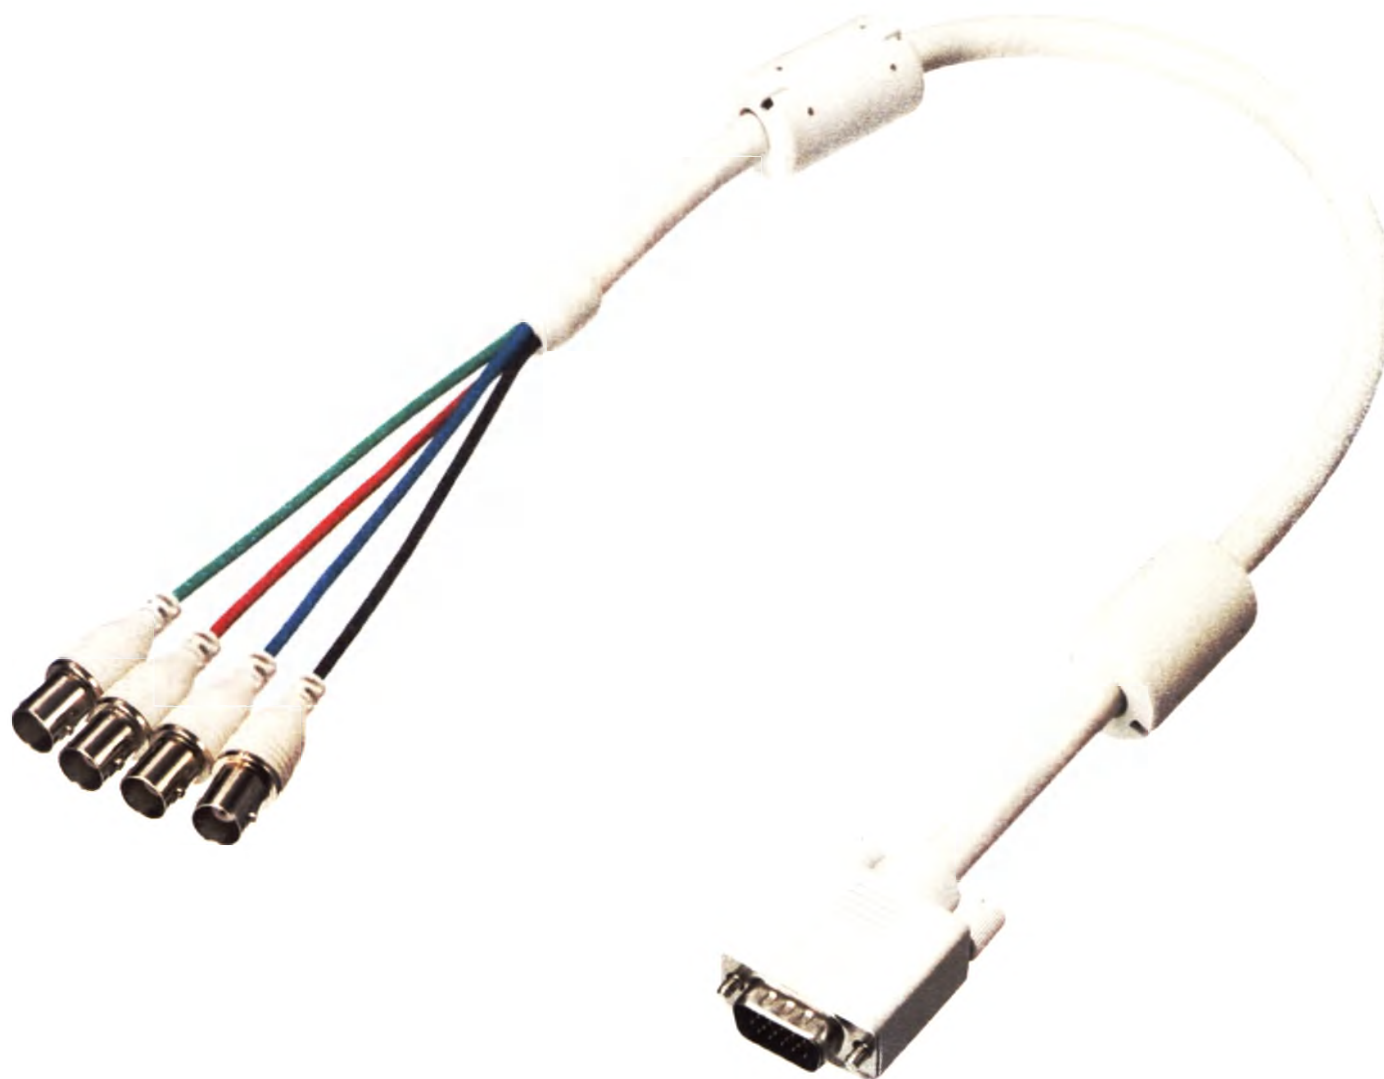

2. Адаптер переменного тока AC-120MD

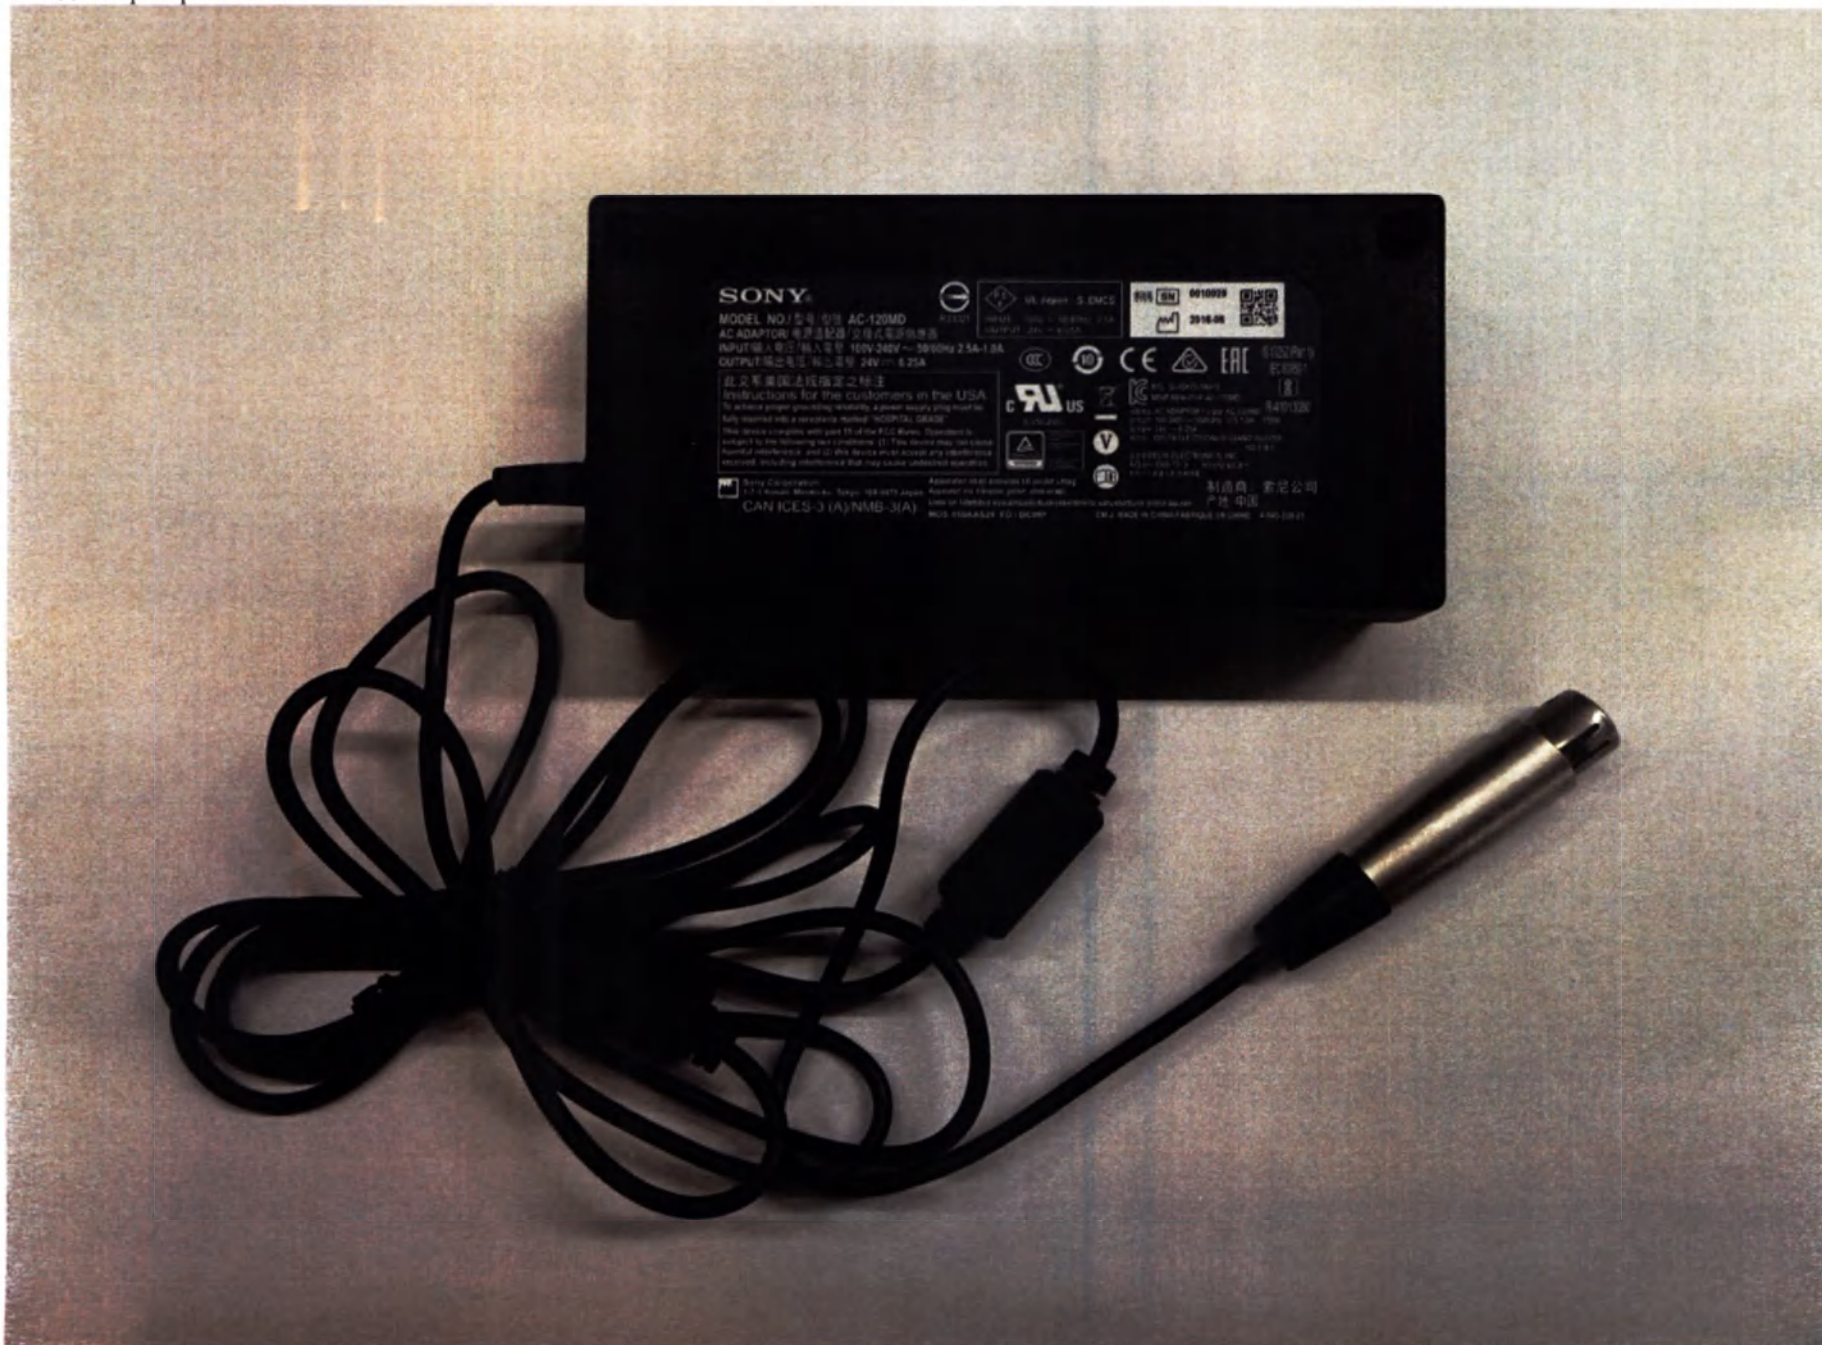

3. Подставка SU-600MD

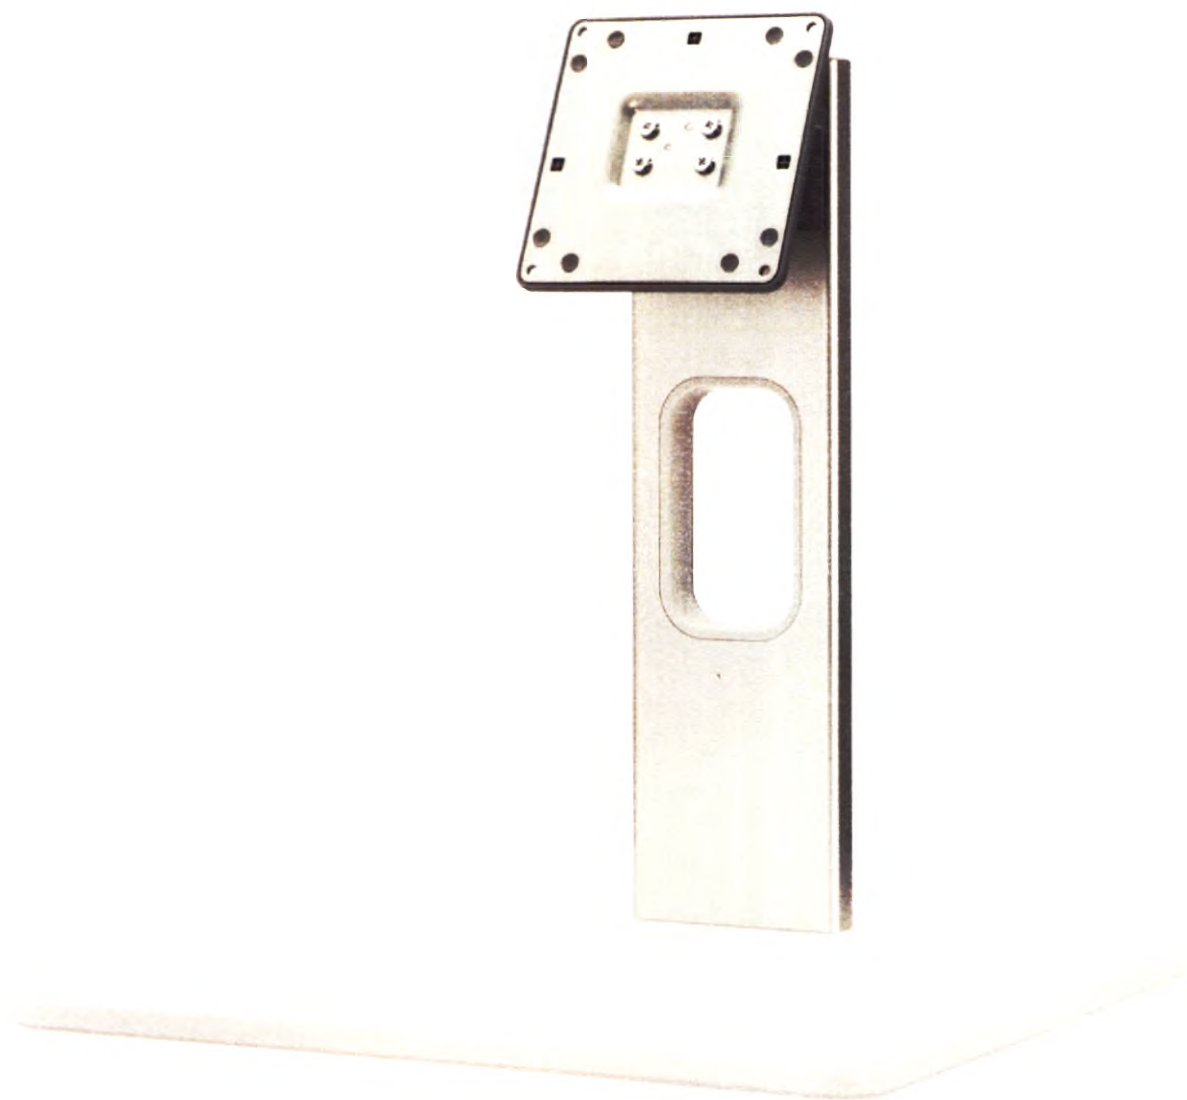

XI. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X550MT. Основной состав:
1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X550MT



2. Кабель электропитания




3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



4. Винты для крепления VESA, M4 × 12 мм – 4 шт.



5. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

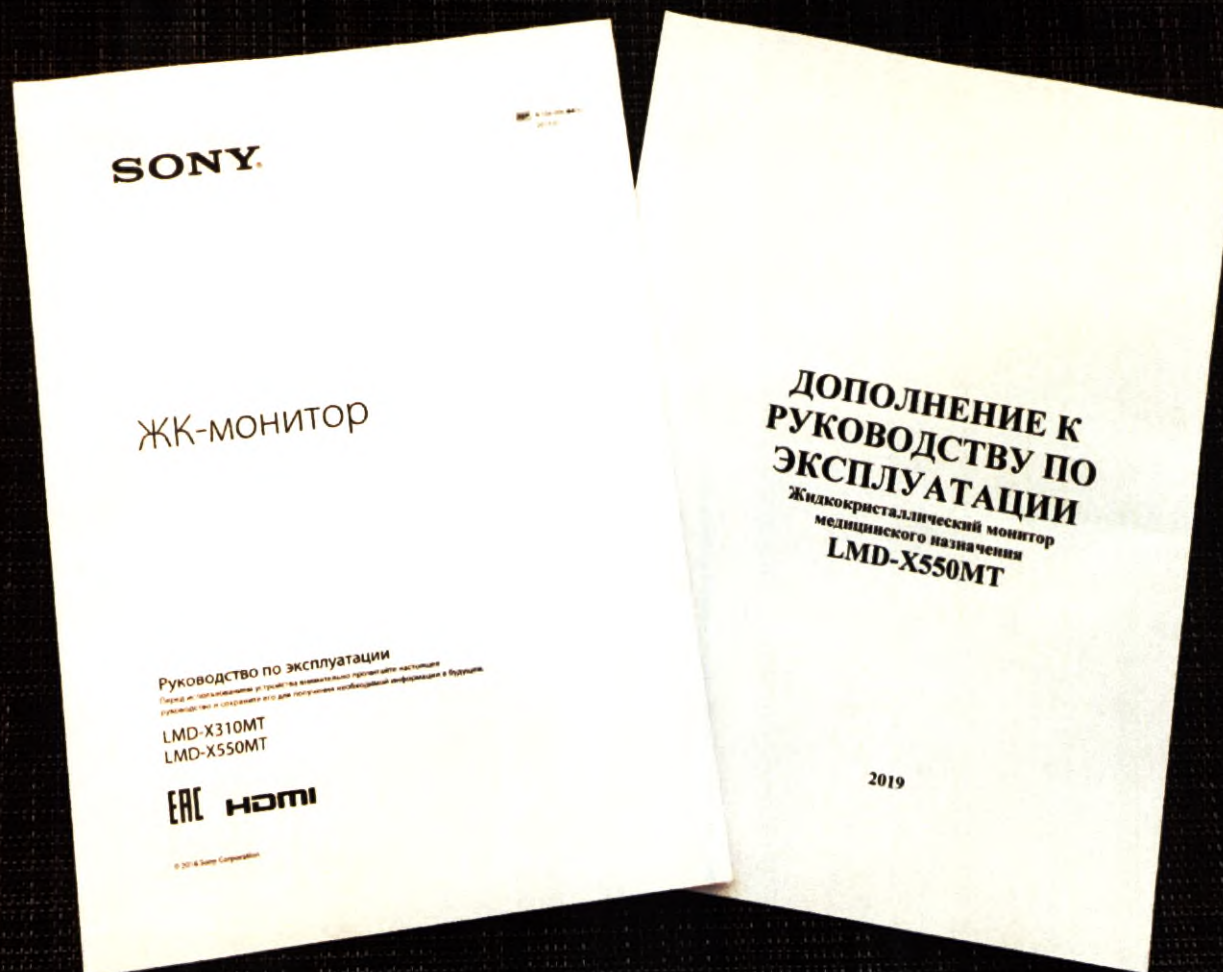



6. Комплект 3D очков, модели CFV-E30SK, состоящий из 1 оправы, 3-х 3D фильтров, эксплуатационной документации на бумажном носителе



SONY

REF 4-578-951-0
2015-07

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

取り付け方法

Attachment Procedure

Procédure de fixation

Montageanleitung

Procedura di montaggio

Procedimiento de fijación

Montageprocedure

Procedimento de instalação

Fastgørelsesprocedure

Liittämishjeet

Festeprosedyre

Fästande

Διαδικασία στερέωσης

Процедура за прикрепване

Postup připojení

Összeszerelési útmutató

Procedura mocowania

Procedură de montaj

Postopek namestitve

Postup upevnenia

Piestiprināšanas procedūra

Pritvirtinimo procedūra

Kinnitusprotseduur

Postupak pričvrščivanja

Bağlama Prosedürü

Procedura za pričvršćivanje

Процедура закреплення

Бекіту процедурасы

连接方法

安裝程序

부착 절차



© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



457

SONY

REF 4-578-639-42(1)
2017-06

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

Upute za upotrebu

Kullanım Talimatları

Uputstvo za upotrebu

Руководство по эксплуатации

Пайдалану нұсқаулығы

CFV-B100

CFV-E30SK/E30D/E20SK/E20D



© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



4578839420

Принадлежности:

1. Комплект 2D очков, модели CFV-E20SK, состоящий из 1 оправы, 3-х 2D фильтров, эксплуатационной документации на бумажном носителе



SONY

REF 4-578-9514-0
2015-07

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

取り付け方法

Attachment Procedure

Procédure de fixation

Montageanleitung

Procedura di montaggio

Procedimiento de fijación

Montageprocedure

Procedimento de instalação

Fastgørelsesprocedure

Liittämishjeet

Festeprosedyre

Fästande

Διαδικασία στερέωσης

Процедура за прикрепване

Postup připojení

Összeszerelési útmutató

Procedura mocowania

Procedură de montaj

Postopek namestitve

Postup upevnenia

Piestiprināšanas procedūra

Pritvirtinimo procedūra

Kinnitusprotseduur

Postupak pričvrščivanja

Bağlama Prosedürü

Procedura za pričvrščivanje

Процедура закреплення

Бекіту процедурасы

连接方法

安裝程序

부착 절차



© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



457

SONY

REF 4-578-839-42(1)
2017-06

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

Upute za upotrebu

Kullanım Talimatları

Uputstvo za upotrebu

Руководство по эксплуатации

Пайдалану нұсқаулығы

CFV-B100

CFV-E30SK/E30D/E20SK/E20D




© 2015 Sony Corporation Printed in Japan




4578839420

ХII. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X310MT. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X310MT



2. Блок питания AC-300MD

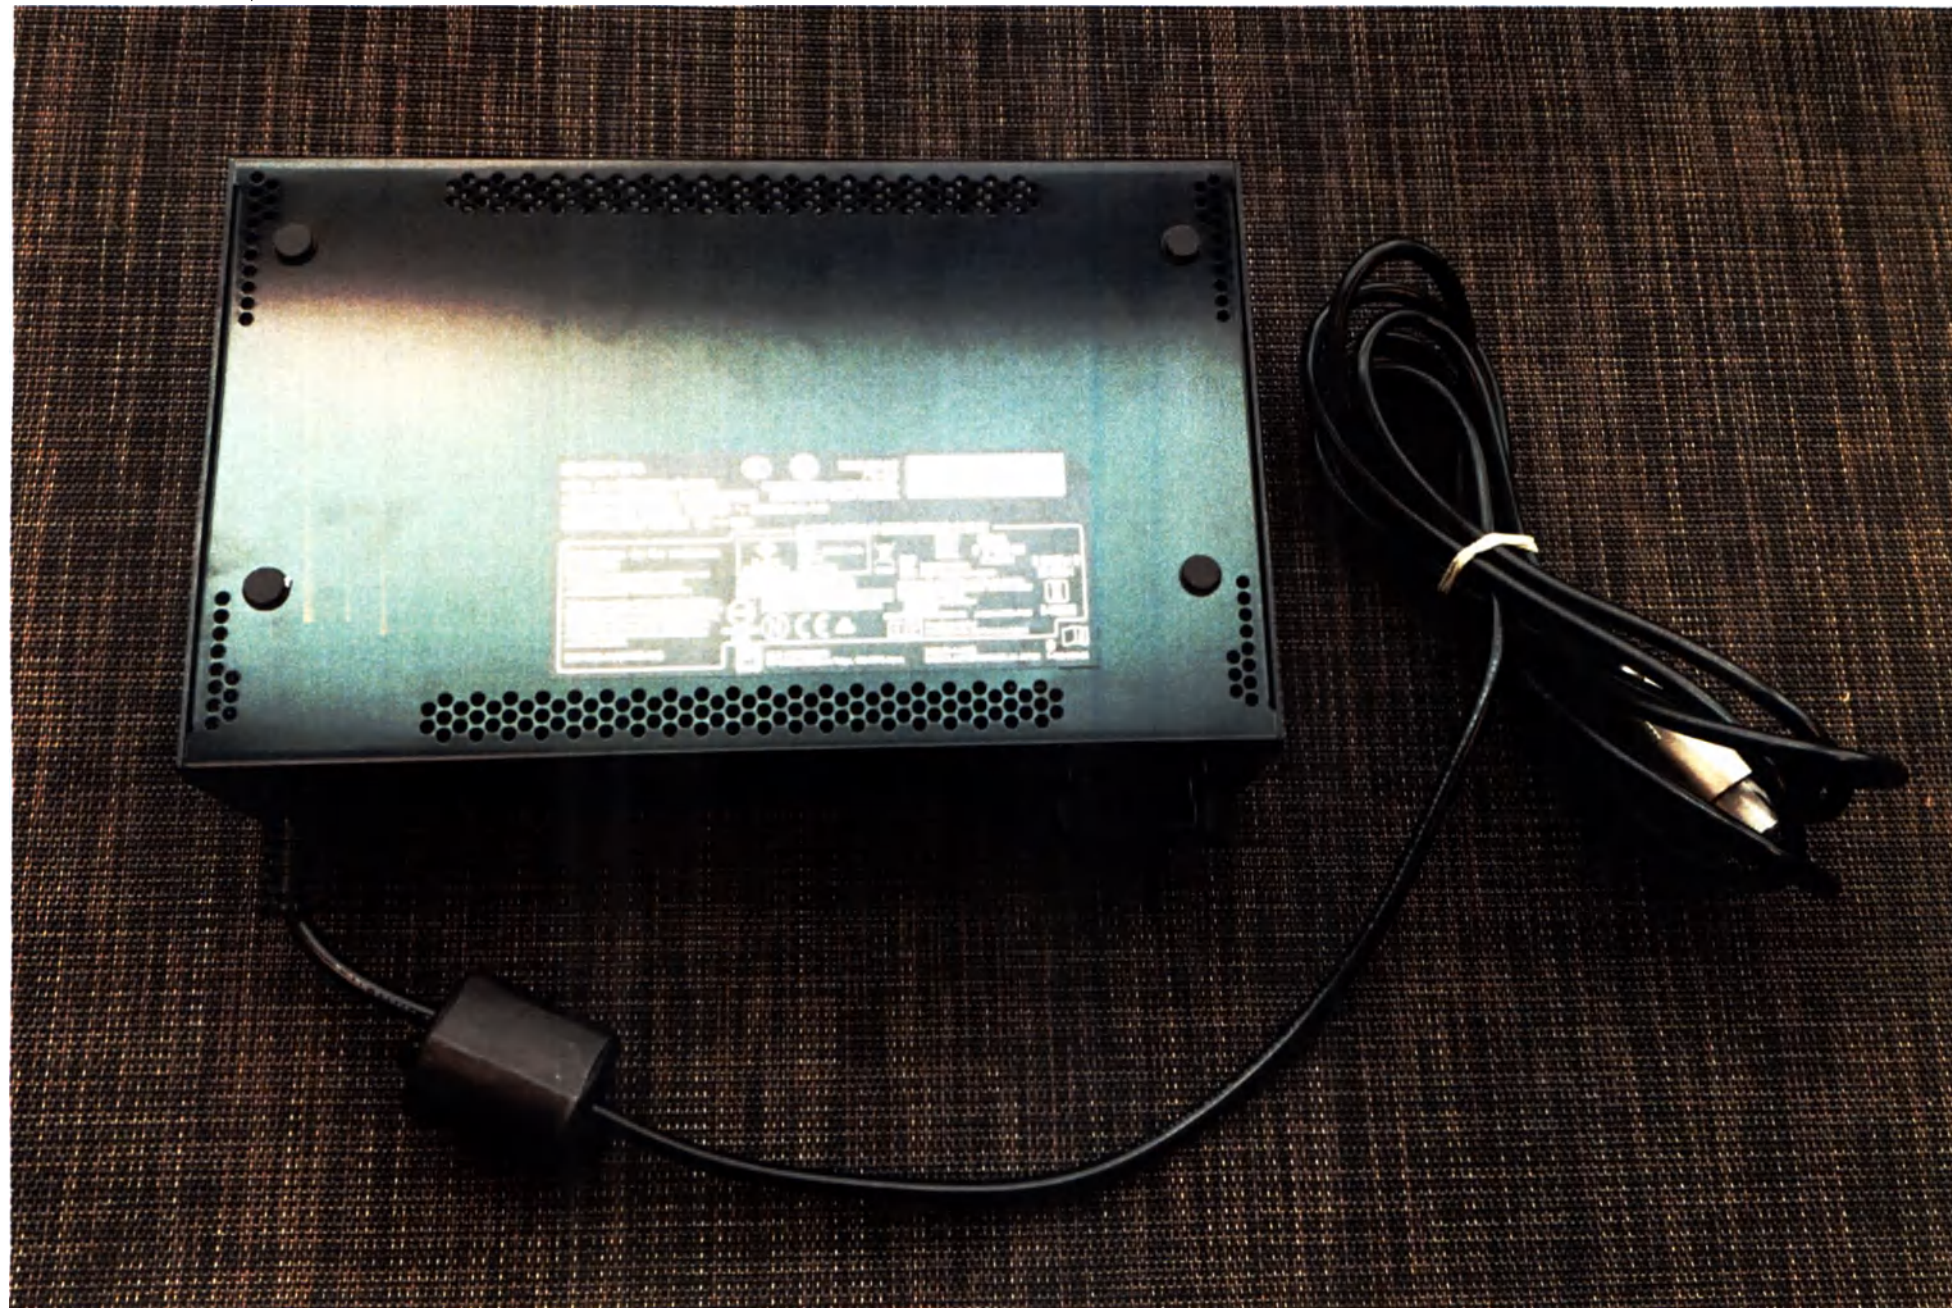

SONY

REF: S-5497-140-01
2017/08

AC Adaptor 电源适配器 交換式電源供應器 БЛОК ПИТАНИЯ ҚУАТ КӨЗІ БЛОҒЫ

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

お買い上げいただきありがとうございます。

警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、安全を助けるための重要な注意事項と製品の正しい使い方を示しております。
この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全に扱いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず置してください。

AC-300MD

CE ENEC

© 2014 Sony Corporation

取扱説明書	JP
Instructions for Use	GB
Instructions d'utilisation	FR
Gebruiksaanwijzing	DE
Istruzioni per l'uso	IT
Manual de instrucciones	ES
使用说明	CS
操作說明	CH
사용 설명서	KH
Руководство по эксплуатации	RU
Пайдалану нускаллы	KZ
Gebruiksaanwijzing	NL
Manual de instruções	PT
Brugervejledning	DK
Käyttöohjeet	FI
Brugsanvisning	NO
Brüksanvísing	SE
Объяснение	GR
Инструкции за употреба	BG
Užívateľská príručka	CZ
Návod na použitie	HU
Instrukcja obsługi	PL
Instructiuni de utilizare	RO
Navodila za uporabo	SI
Návod na obsluhu	SK
Lietojšanas instrukcija	LV
Naudojimo instrukcija	LT
Kasutusjuhend	EE
Upute za uporabu	HR
Kullanım Talimatları	TR
Uputstvo za upotrebu	SR



4549346030

4. Кабель электропитания



5. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.



6. Винты для крепления VESA, M4 × 12 мм – 4 шт.



7. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе



8. Комплект 3D очков, модели CFV-E30SK, состоящий из 1 оправы, 3-х 3D фильтров, эксплуатационной документации на бумажном носителе



SONY

REF 4-578-951-C
2015-07

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

取り付け方法

Attachment Procedure

Procédure de fixation

Montageanleitung

Procedura di montaggio

Procedimiento de fijación

Montageprocedure

Procedimento de instalação

Fastgørelsesprocedure

Liittämishjeet

Festprosedyre

Fästande

Διαδικασία στερέωσης

Процедура за прикрепване

Postup připojení

Összeszerelési útmutató

Procedura mocowania

Procedură de montaj

Postopek namestitve

Postup upevnenia

Piestiprināšanas procedūra

Pritvirtinimo procedūra

Kinnitusprotseduur

Postupak pričvrščivanja

Bağlama Prosedürü

Procedura za pričvršćivanje

Процедура закреплення

Бекіту процедурасы

连接方法

安裝程序

부착 절차



© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



457

SONY

REF 4-578-839-42(1)
2017-06

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

Upute za upotrebu

Kullanım Talimatları

Uputstvo za upotrebu

Руководство по эксплуатации

Пайдалану нұсқаулығы

CFV-B100

CFV-E30SK/E30D/E20SK/E20D



© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



4578839420

Принадлежности:

1. Комплект 2D очков, модели CFV-E20SK, состоящий из 1 оправы, 3-х 2D фильтров, эксплуатационной документации на бумажном носителе



SONY

REF 4-578-9514
2015-07

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

取り付け方法

Attachment Procedure

Procédure de fixation

Montageanleitung

Procedura di montaggio

Procedimiento de fijación

Montageprocedure

Procedimento de instalação

Fastgørelsesprocedure

Liittämishjeet

Festeprosedyre

Fästande

Διαδικασία στερέωσης

Процедура за прикрепване

Postup připojení

Összeszerelési útmutató

Procedura mocowania

Procedură de montaj

Postopek namestitve

Postup upevnenia

Piestiprināšanas procedūra

Pritvirtinimo procedūra

Kinnitusprotseduur

Postupak pričvrščivanja

Bağlama Prosedürü

Procedura za pričvršćivanje

Процедура закреплення

Бекіту процедурасы

连接方法

安裝程序

부착 절차

CE

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



457

SONY

REF 4-578-839-42(1)
2017-06

Shield Frame 3D Eye Shield 2D Eye Shield

Upute za upotrebu

Kullanım Talimatları

Uputstvo za upotrebu

Руководство по эксплуатации

Пайдалану нұсқаулығы

CFV-B100

CFV-E30SK/E30D/E20SK/E20D


CE

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan




4578839420

2. Подставка для монитора SU-600MD

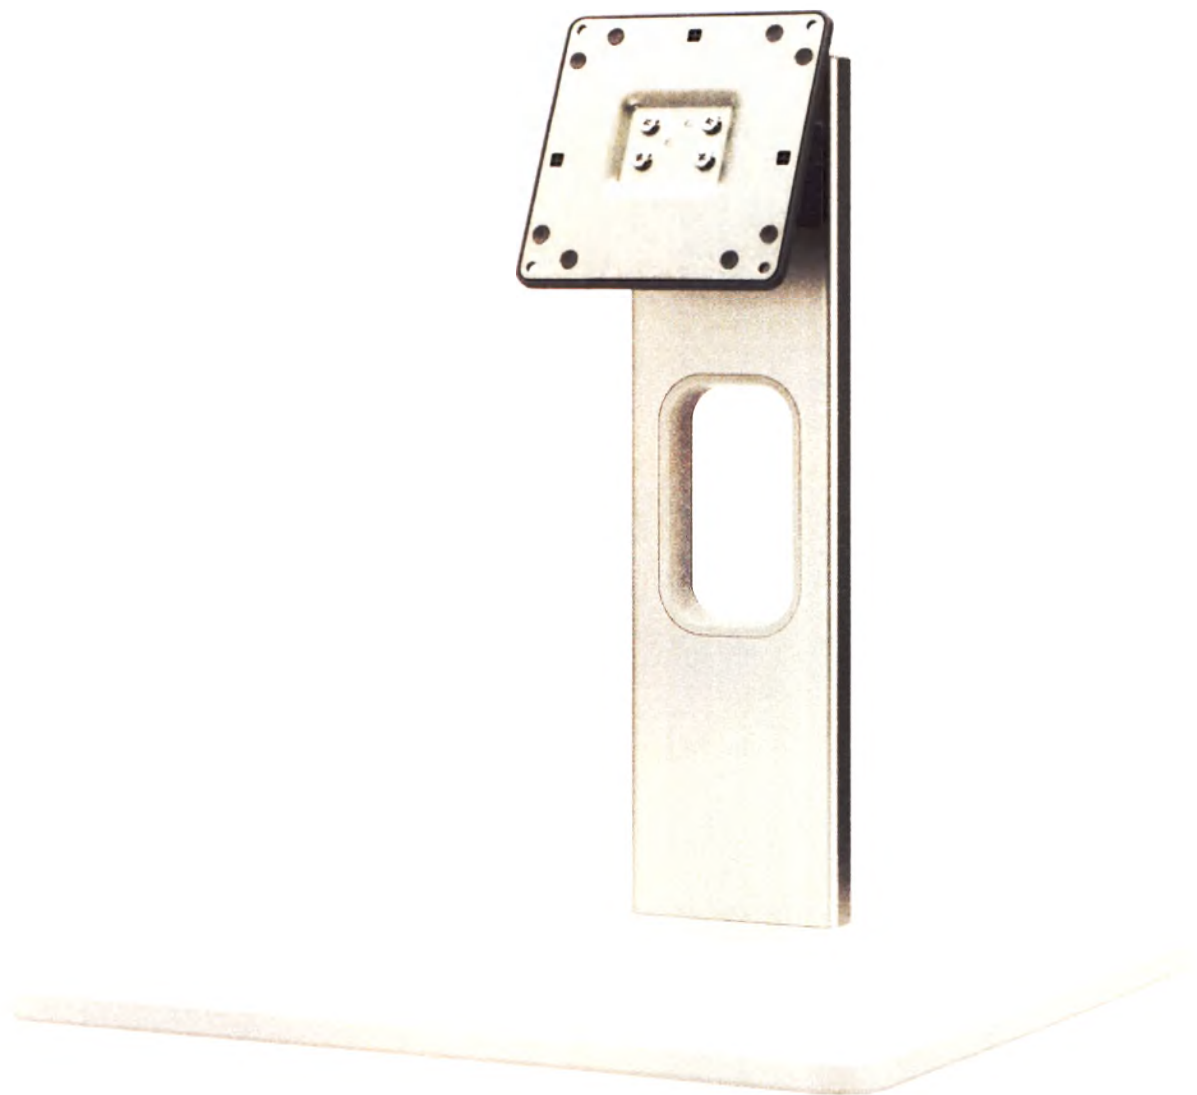

ХIII. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X2705MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X2705MD

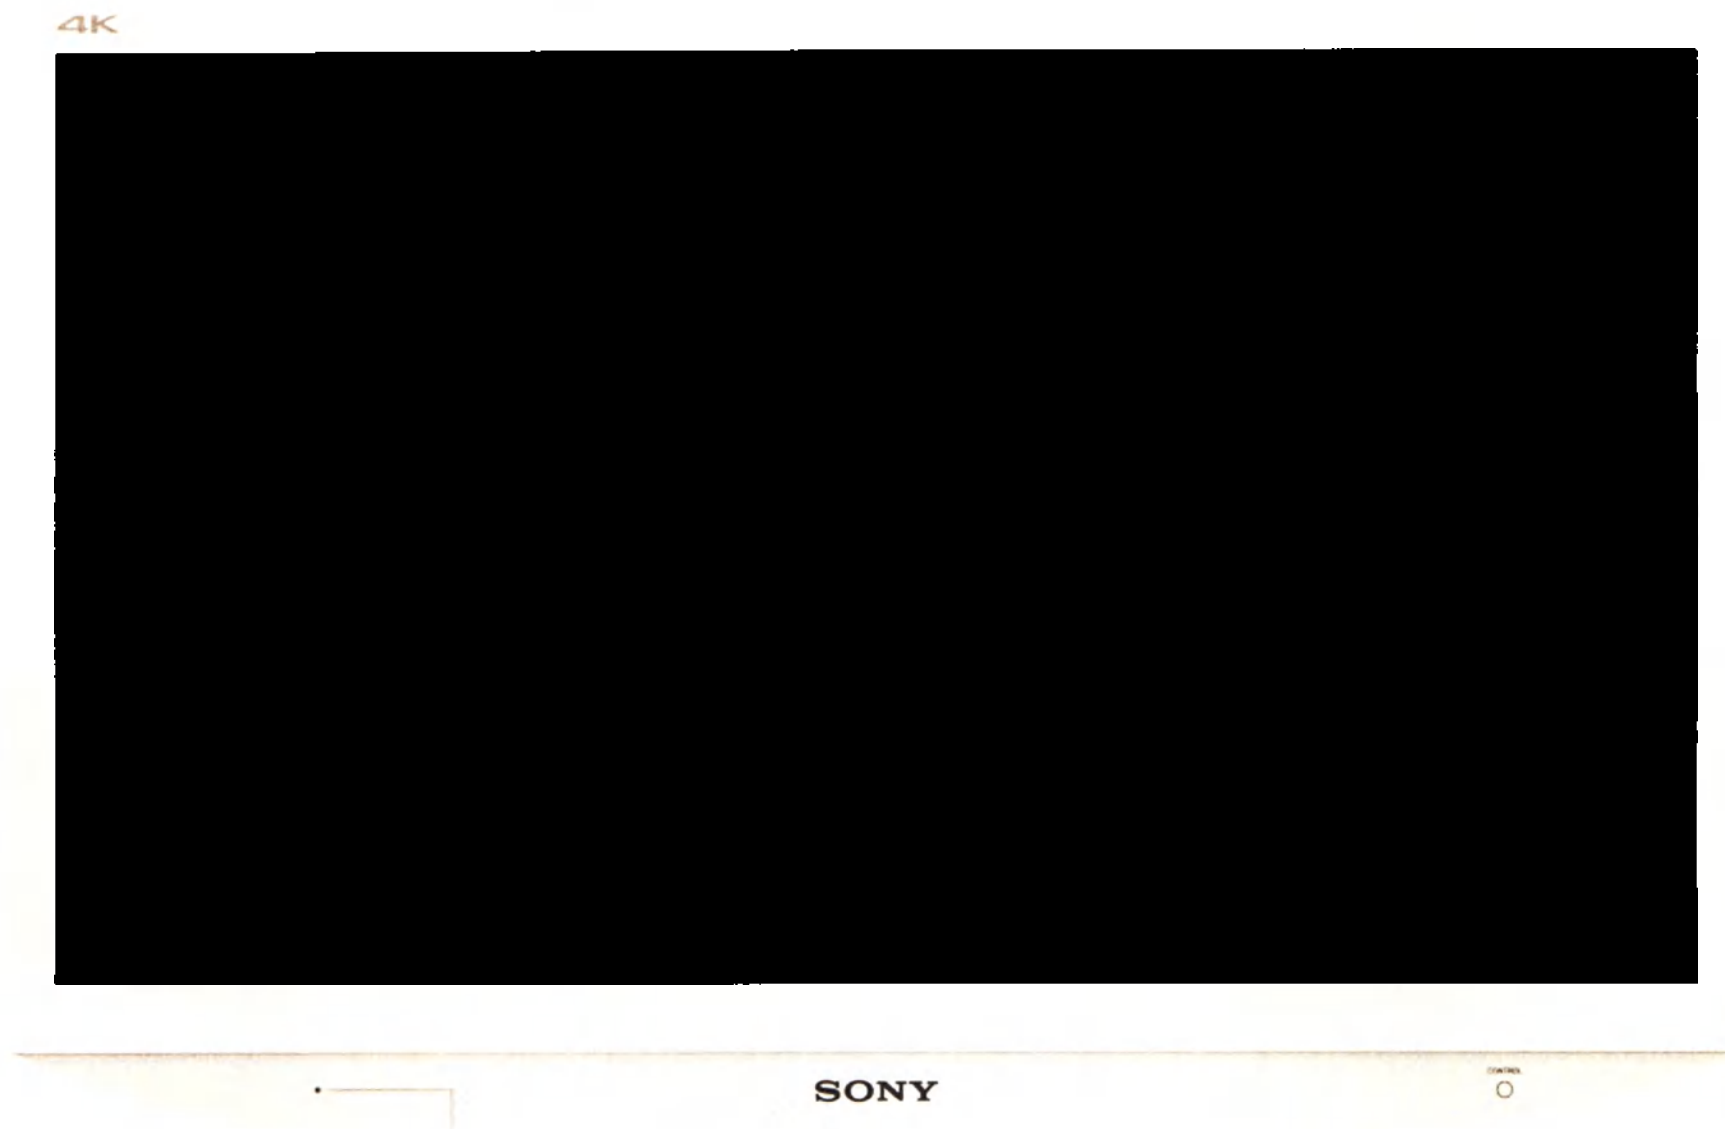


2. Кабель электропитания




3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.




4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

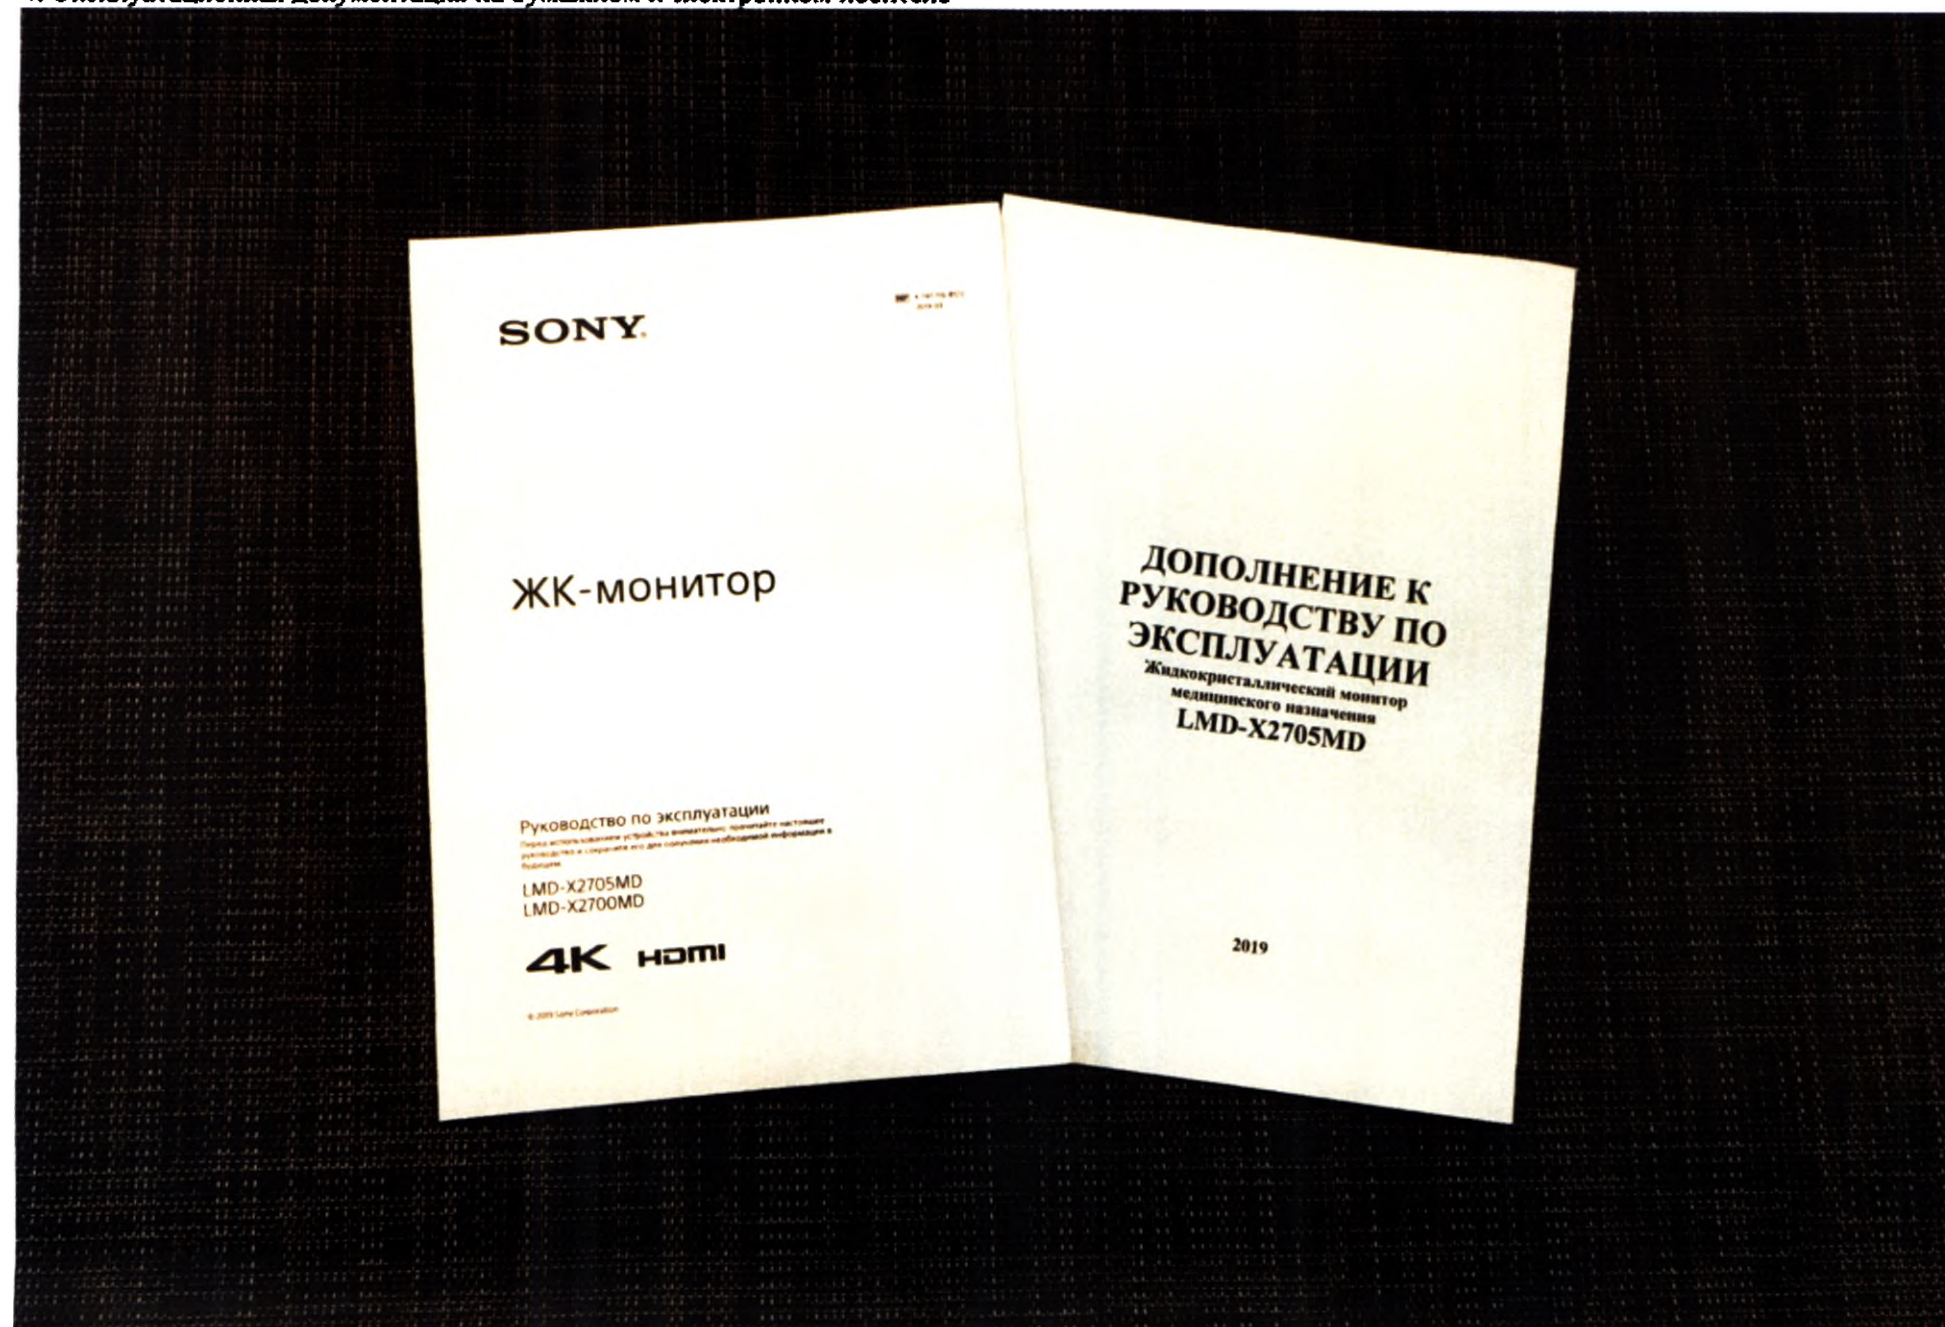


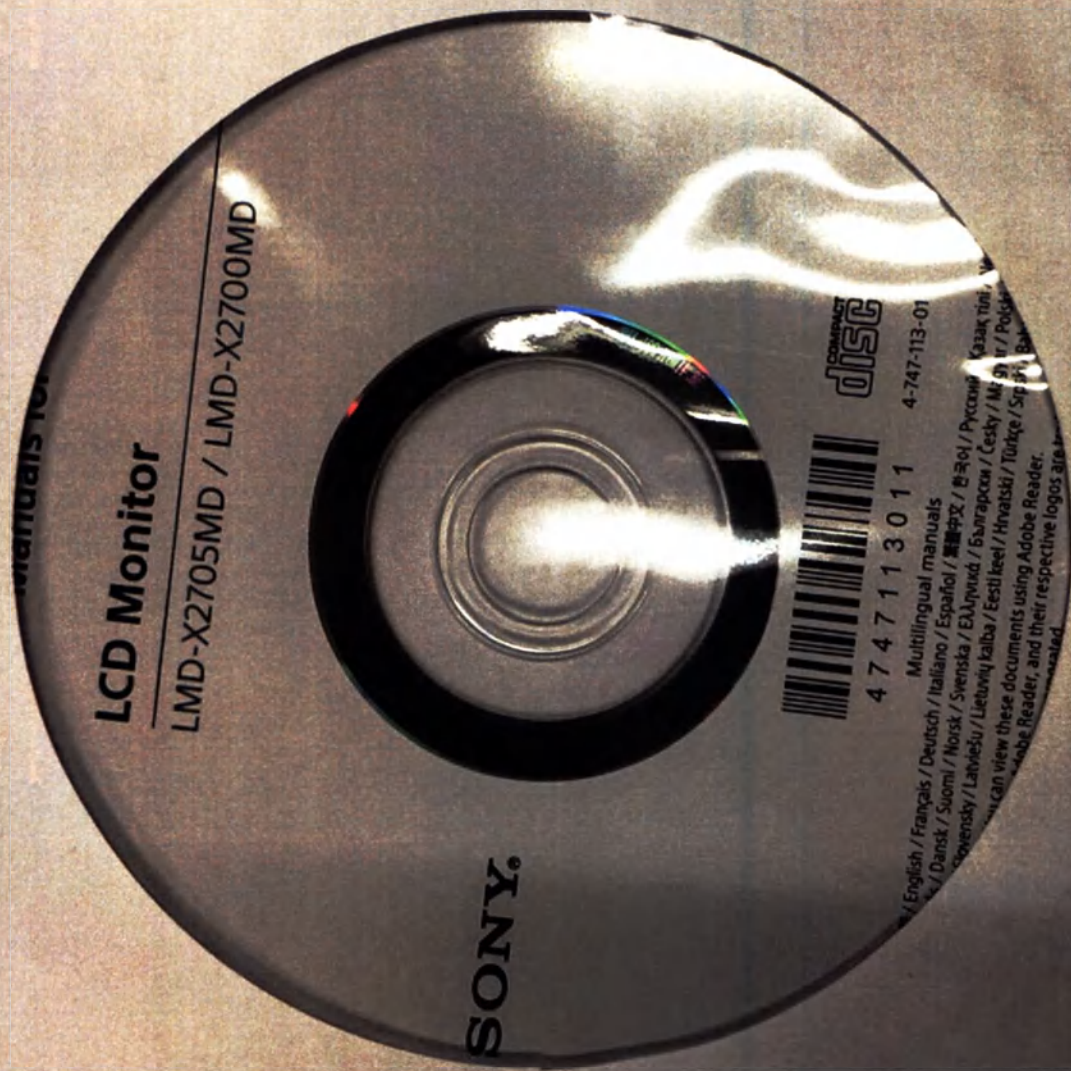

Принадлежности:
1. Подставка SU-600MD

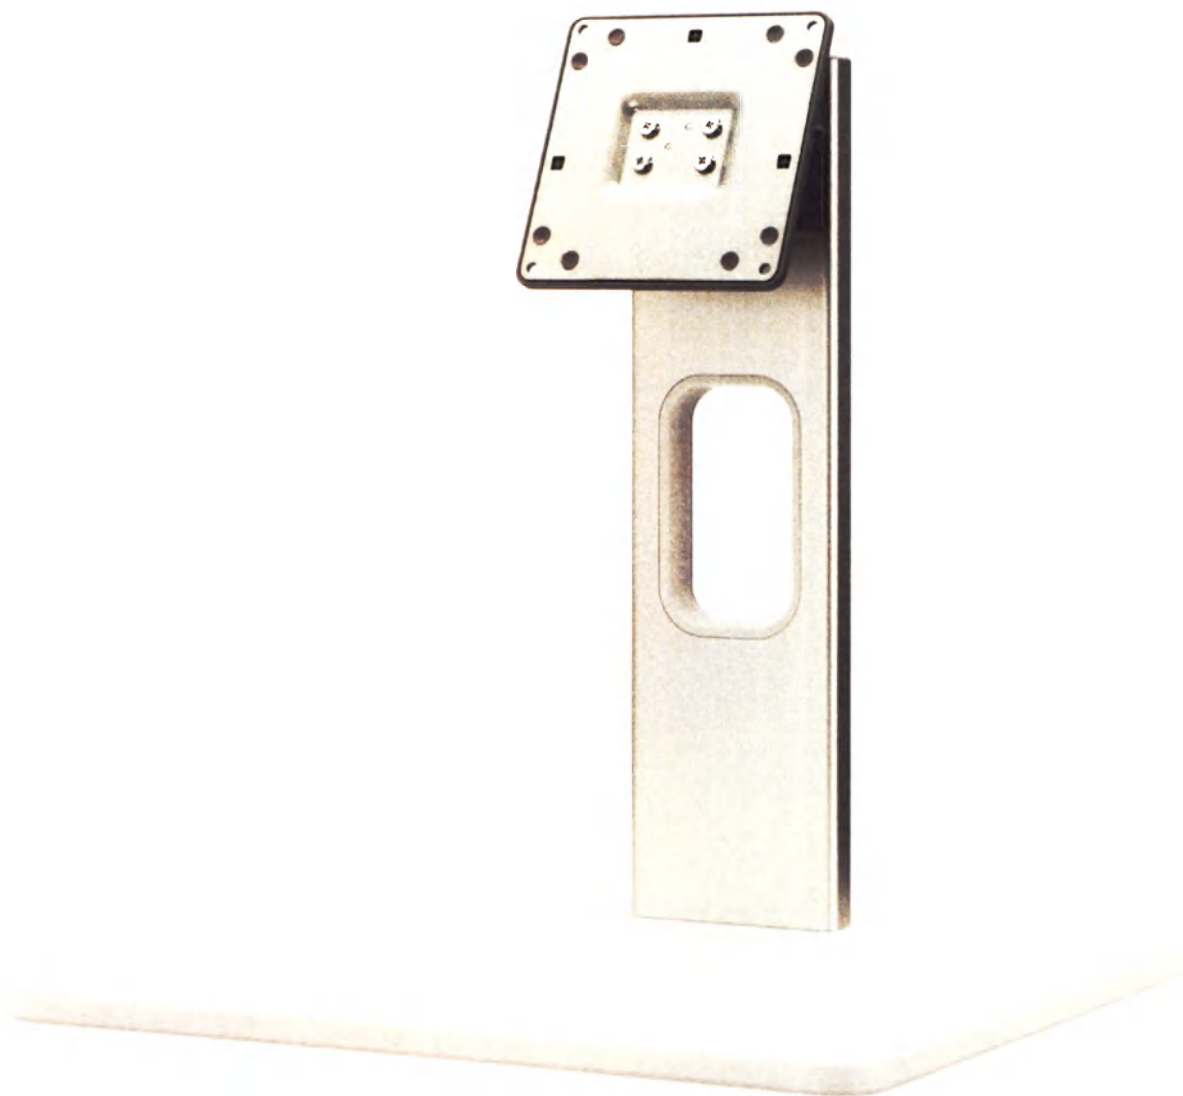

2. Блок питания AC-300MD

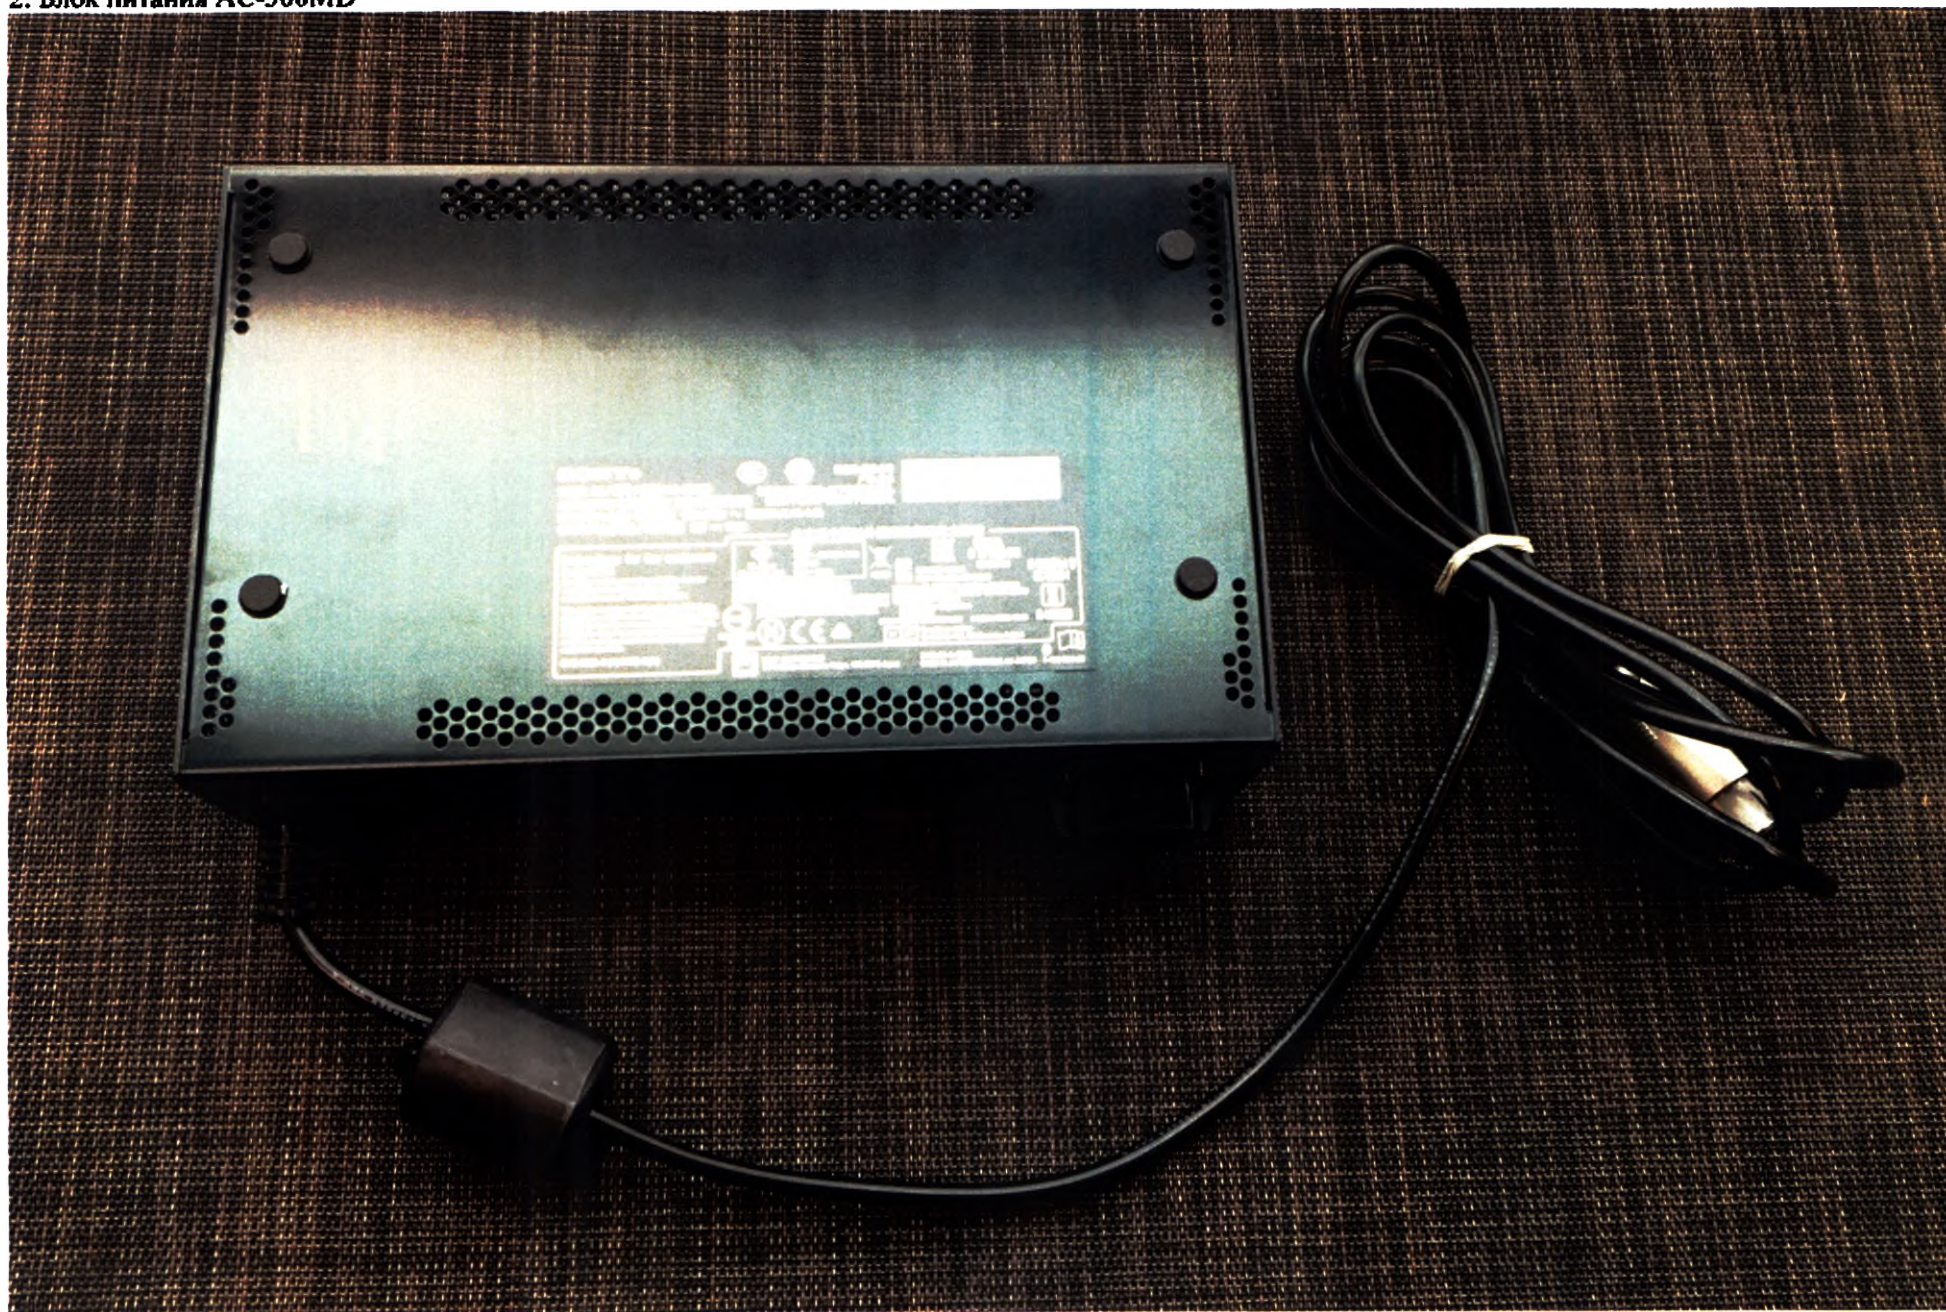

SONY

AC Adaptor 电源适配器 交換式電源供應器 БЛОК ПИТАНИЯ ҚАҒАТ КӨЗІ БЛОҒЫ

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 本製品は安全のための注意事項を守らねば、
火災や人身事故に繋がる場合があります。

この取扱説明書には、電源を接続するための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しております。
この取扱説明書をよく読み、製品の安全に留意してください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

AC-300MD

CE FCC

© 2014 Sony Corporation

REF: A-REP-300-0311
2014-08

取扱説明書	JP
Instructions for Use	GB
Instructions d'utilisation	FR
Gebrauchsanweisung	DE
Istruzioni per l'uso	IT
Manual de instrucciones	ES
使用说明	CS
操作説明	OT
사용 설명서	KR
Руководство по эксплуатации	RU
Пайддалану нускалматчы	KZ
Gebruiksaanwijzing	NL
Manual de instrucções	PT
Brugervejledning	DK
Käyttöohjeet	FI
Bruksanvisning	NO
Bruksanvisning	SE
Obryllec, xpořiz	GR
Инструкция за употреба	EG
Uživatelská příručka	CZ
Használati útmutató	HU
Instrukcija obsługi	PL
Instrucțiuni de utilizare	RO
Navodila za uporabo	SI
Navod na obsluhu	SK
Lietošanas instrukcija	LV
Naudojimo instrukcija	LT
Kasutusjuhised	EE
Upute za uporabu	HR
Kullanım Talimatları	TR
Uputstvo za upotrebu	SR




4549346030

XIV. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X2700MD. Основной состав:

1. Жидкокристаллический монитор медицинского назначения LMD-X2700MD

4K



SONY




2. Кабель электропитания



3. Держатель штекера кабеля питания – 2 шт.




4. Эксплуатационная документация на бумажном и электронном носителе

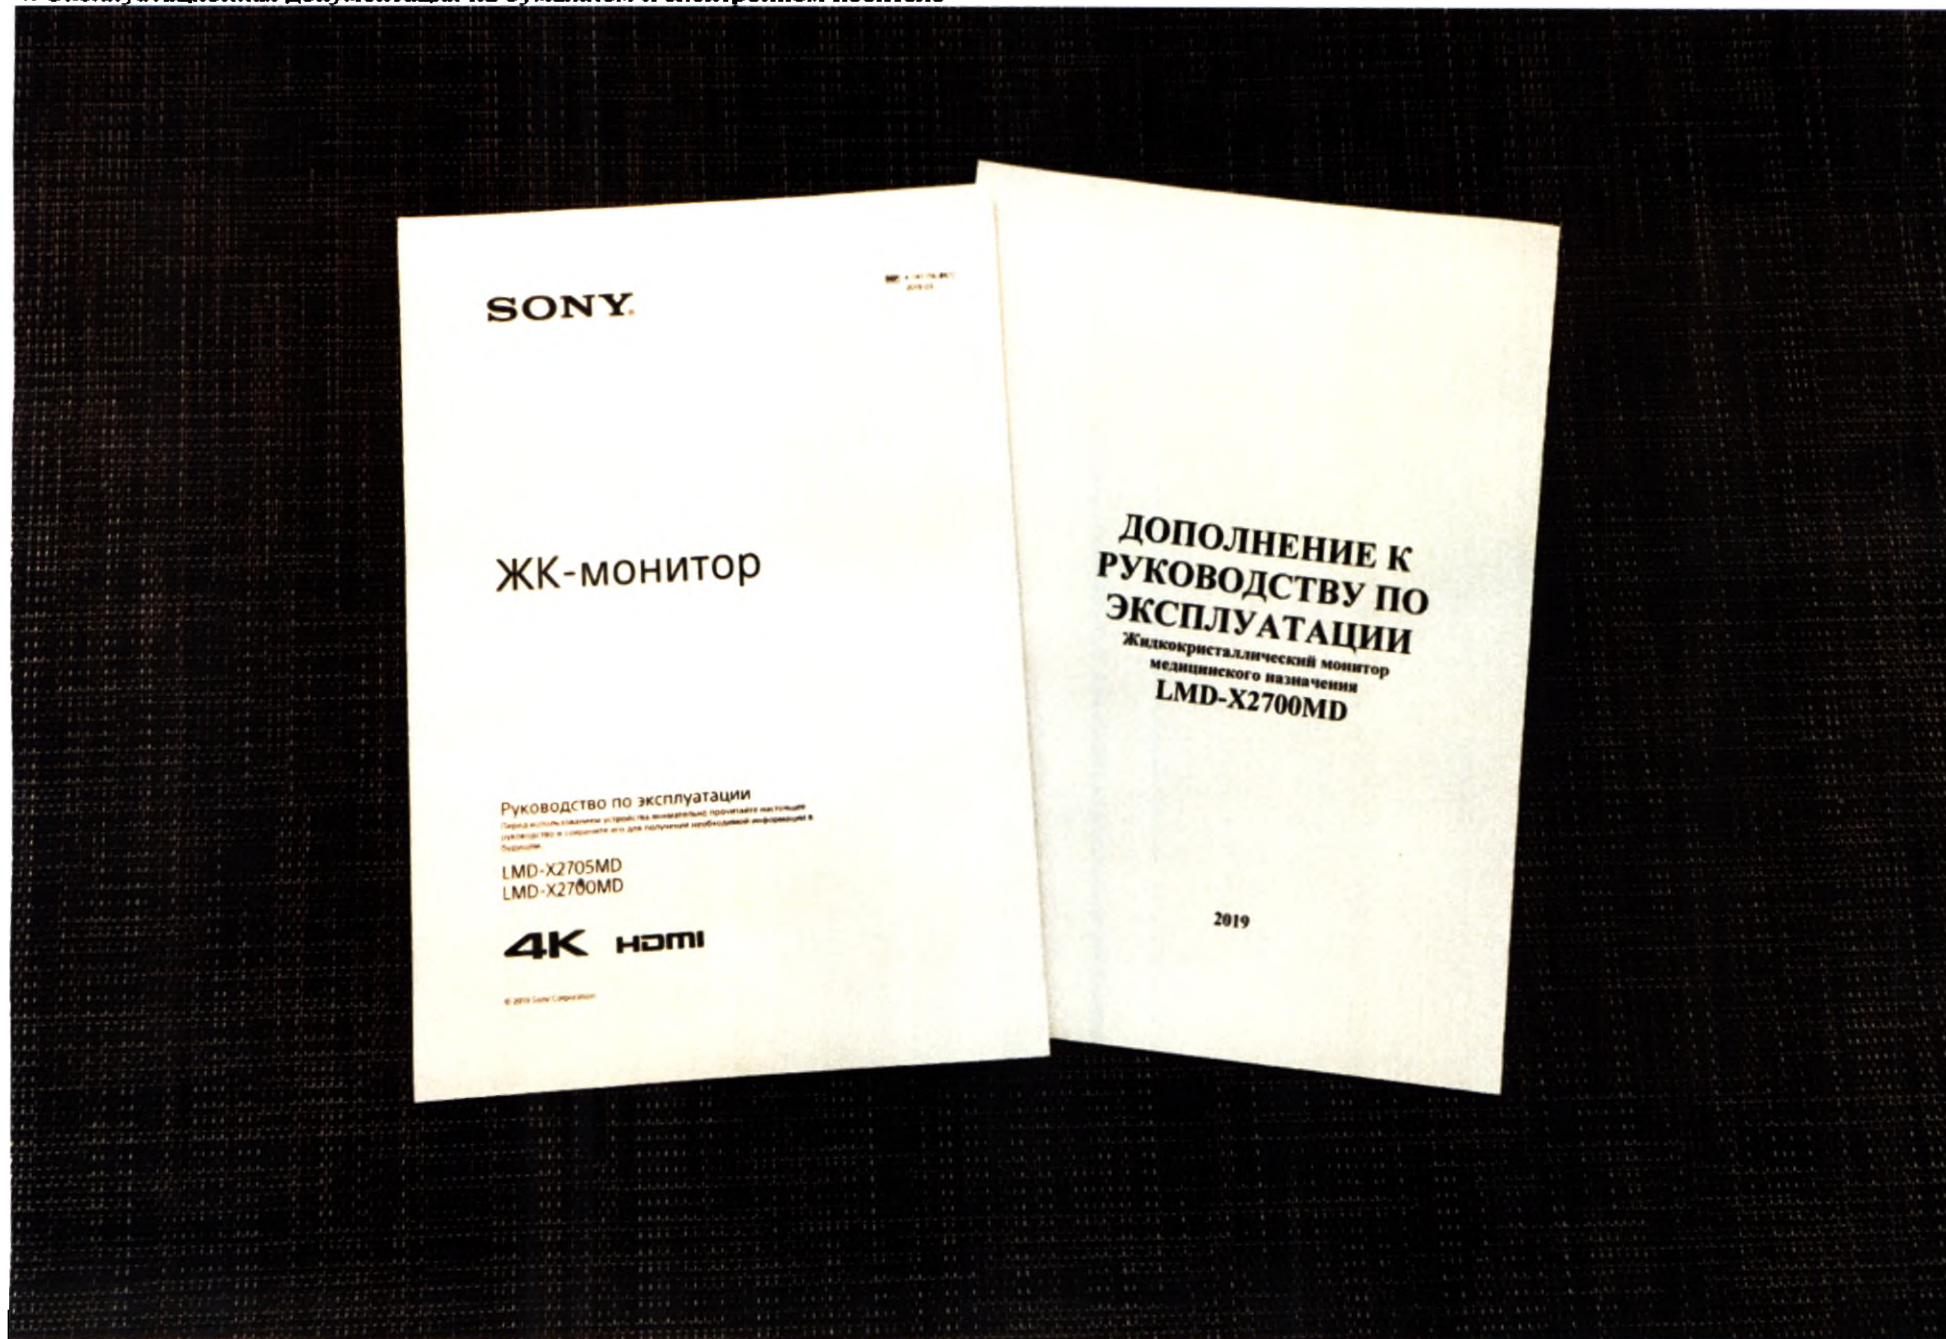




Принадлежности:
1. Подставка SU-600MD

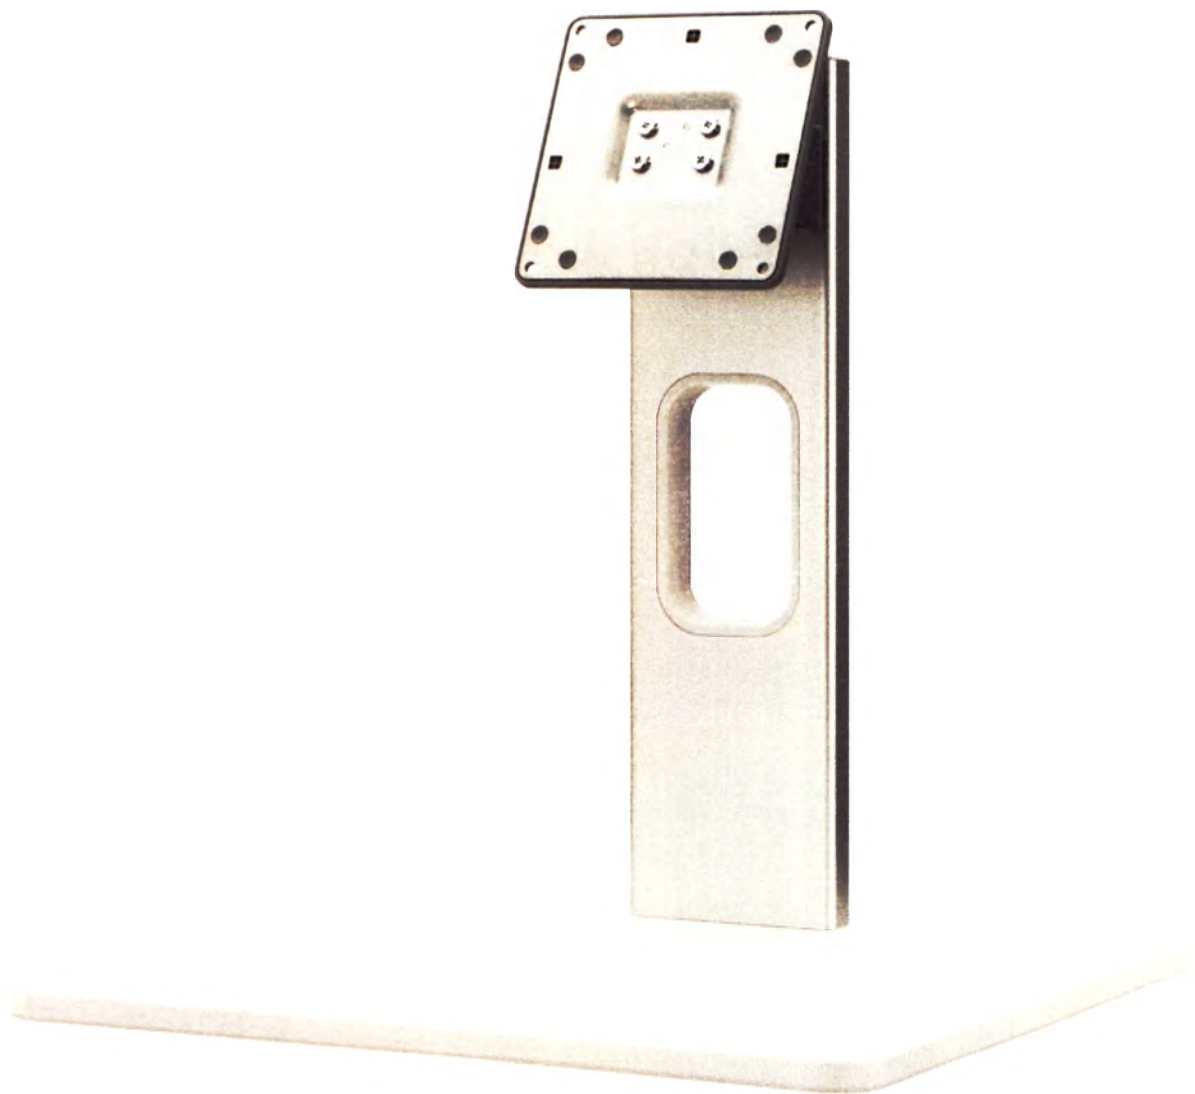

2. Блок питания AC-300MD

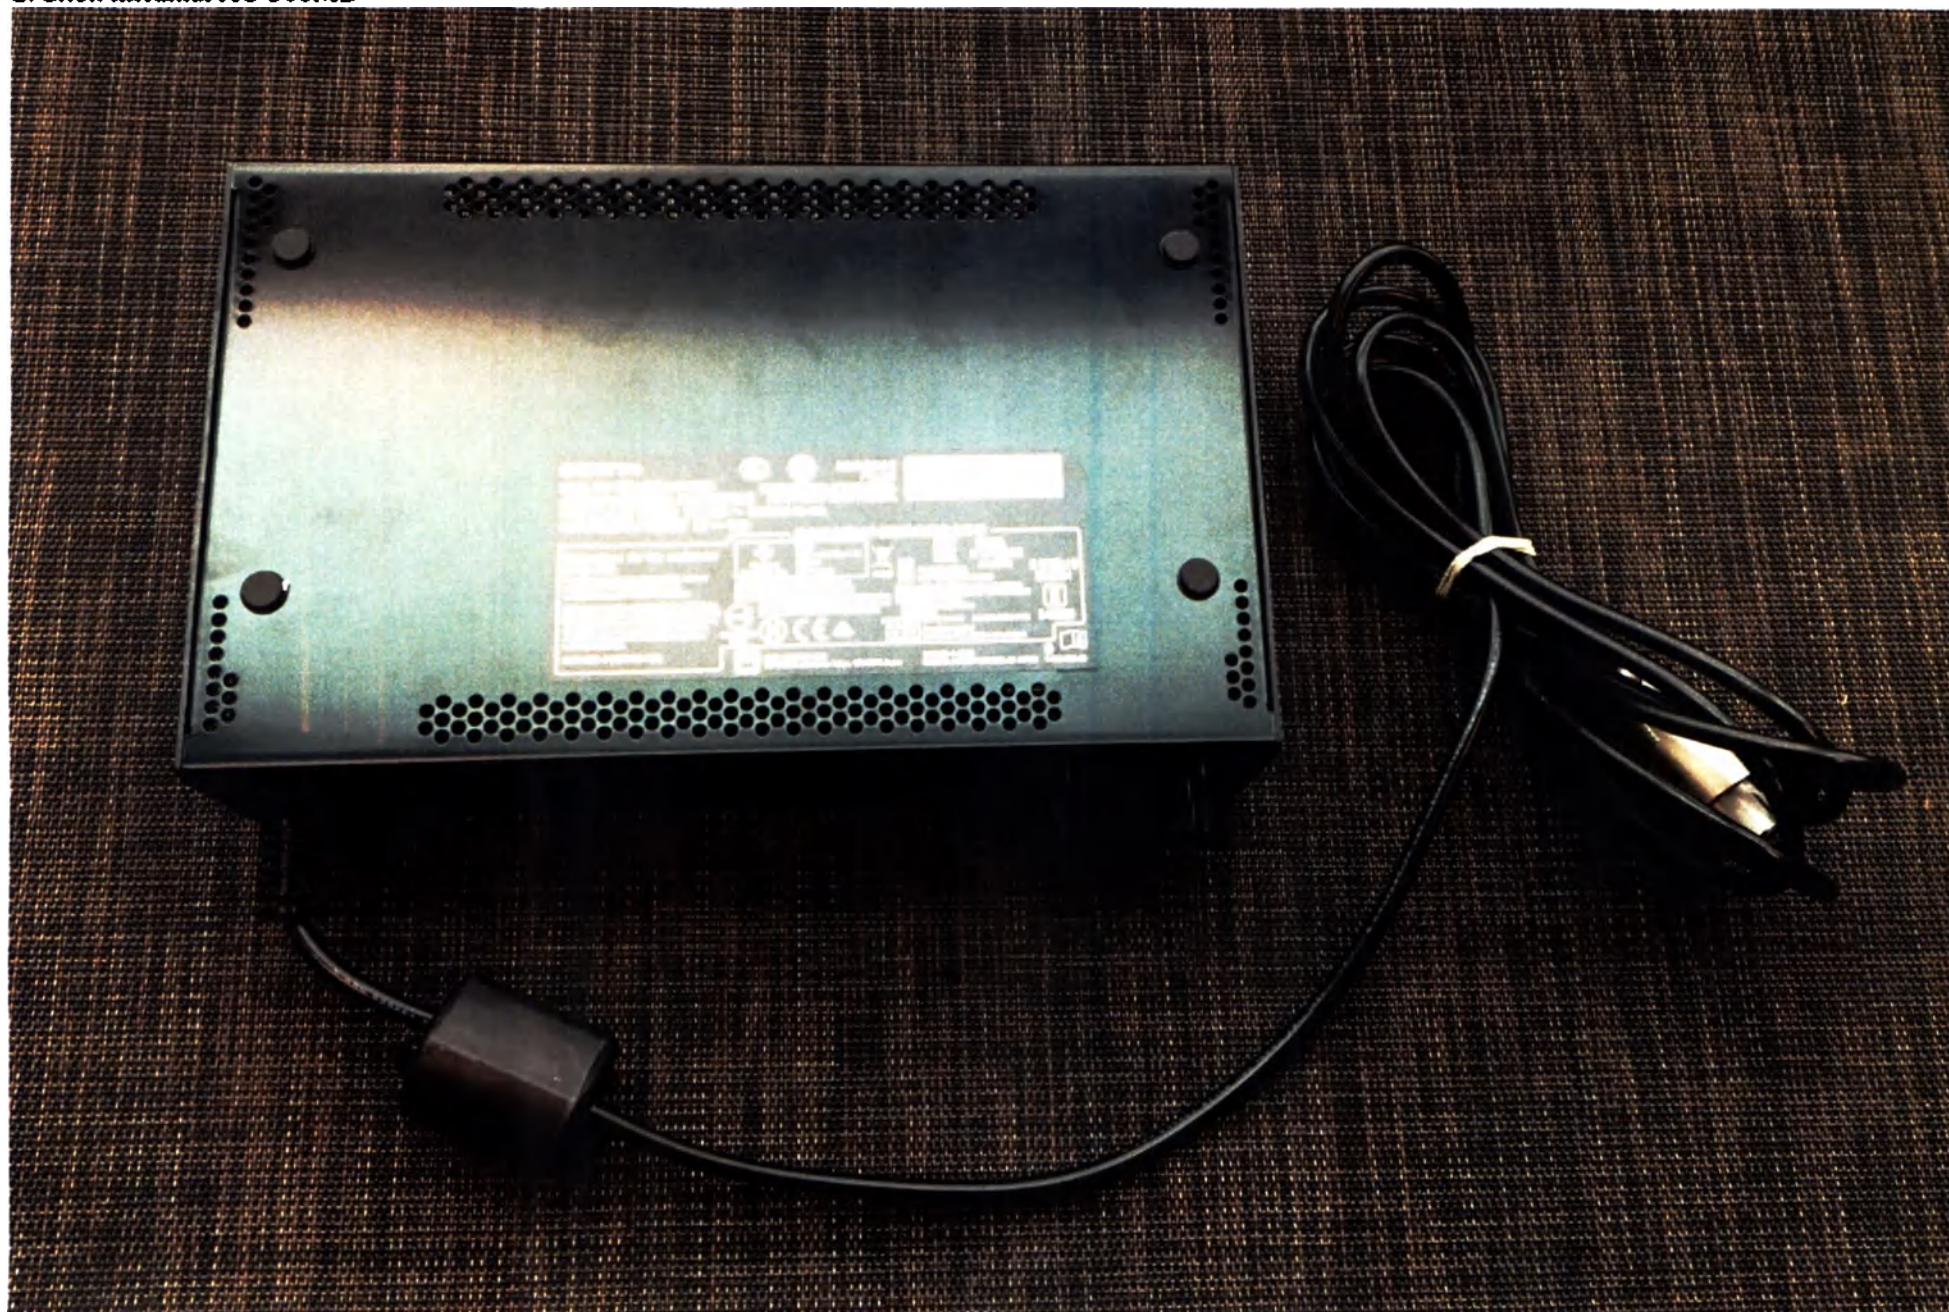

SONY

REF: 4-549 346-03(1)
2012-08

AC Adaptor 电源适配器 交換式電源供應器 БЛОК ПИТАНИЯ ҚУАТ КӨЗІ БЛОГЫ

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

お買い上げいただきありがとうございます。



警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いが示されています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

AC-300MD

CE EAC

© 2014 Sony Corporation

取扱説明書	JP
Instructions for Use	GB
Instructions d'utilisation	FR
Gebrauchsanweisung	DE
Istruzioni per l'uso	IT
Manual de instrucciones	ES
使用说明	CS
操作説明	CT
사용 설명	KR
Руководство по эксплуатации	RU
Пайдалану нұсқаулығы	KZ
Gebruiksaanwijzing	NL
Manual de instruções	PT
Brugervejledning	DK
Käyttöohjeet	FI
Bruksanvisning	NO
Bruksanvisning	SE
Οδηγίες χρήσης	GR
Инструкции за употреба	BG
Uživatelská příručka	CZ
Használati útmutató	HU
Instrukcja obsługi	PL
Instrucțiuni de utilizare	RO
Navodila za uporabo	SI
Návod na obsluhu	SK
Lietošanas instrukcija	LV
Naudojimo instrukcija	LT
Kasutussuunist	EE
Upute za uporabu	HR
Kullanım Talimatları	TR
Uputstvo za upotrebu	SR



4549346030

Примите и скреплено
печатью Н.И.истов

Технический директор
АО «Сони Электроникс»

Итаксаи А.В.

