

5.  
УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМПЛАМАРКЕТ»

Грицай М.А.


06 » августа 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
медицинского изделия

Система дентальных имплантатов ТЗ «Ufit®», в составе

Система дентальных имплантатов ТЗ «Ufit®», в составе  
Имплантат GT2 с винтом-заглушкой

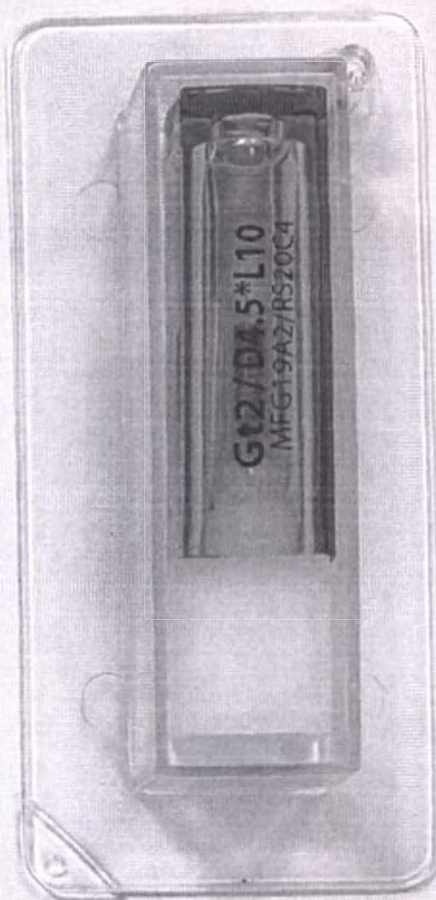

**Gt2/ D4.5\*L10**  
Ufit® Lot:GT24510MT19A2(20C4)

**Gt2/ D4.5\*L10**  
Ufit® Lot:GT24510MT19A2(20C4)

**Gt2/ D4.5\*L10**  
Ufit® Lot:GT24510MT19A2(20C4)

## Ufit® dental implant


주식회사 티스트롱



경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 56, 60870  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 하부구조물

1. 성능 및 사용목적  
단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공  
치근으로 사용되며, 악골에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트  
시술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.

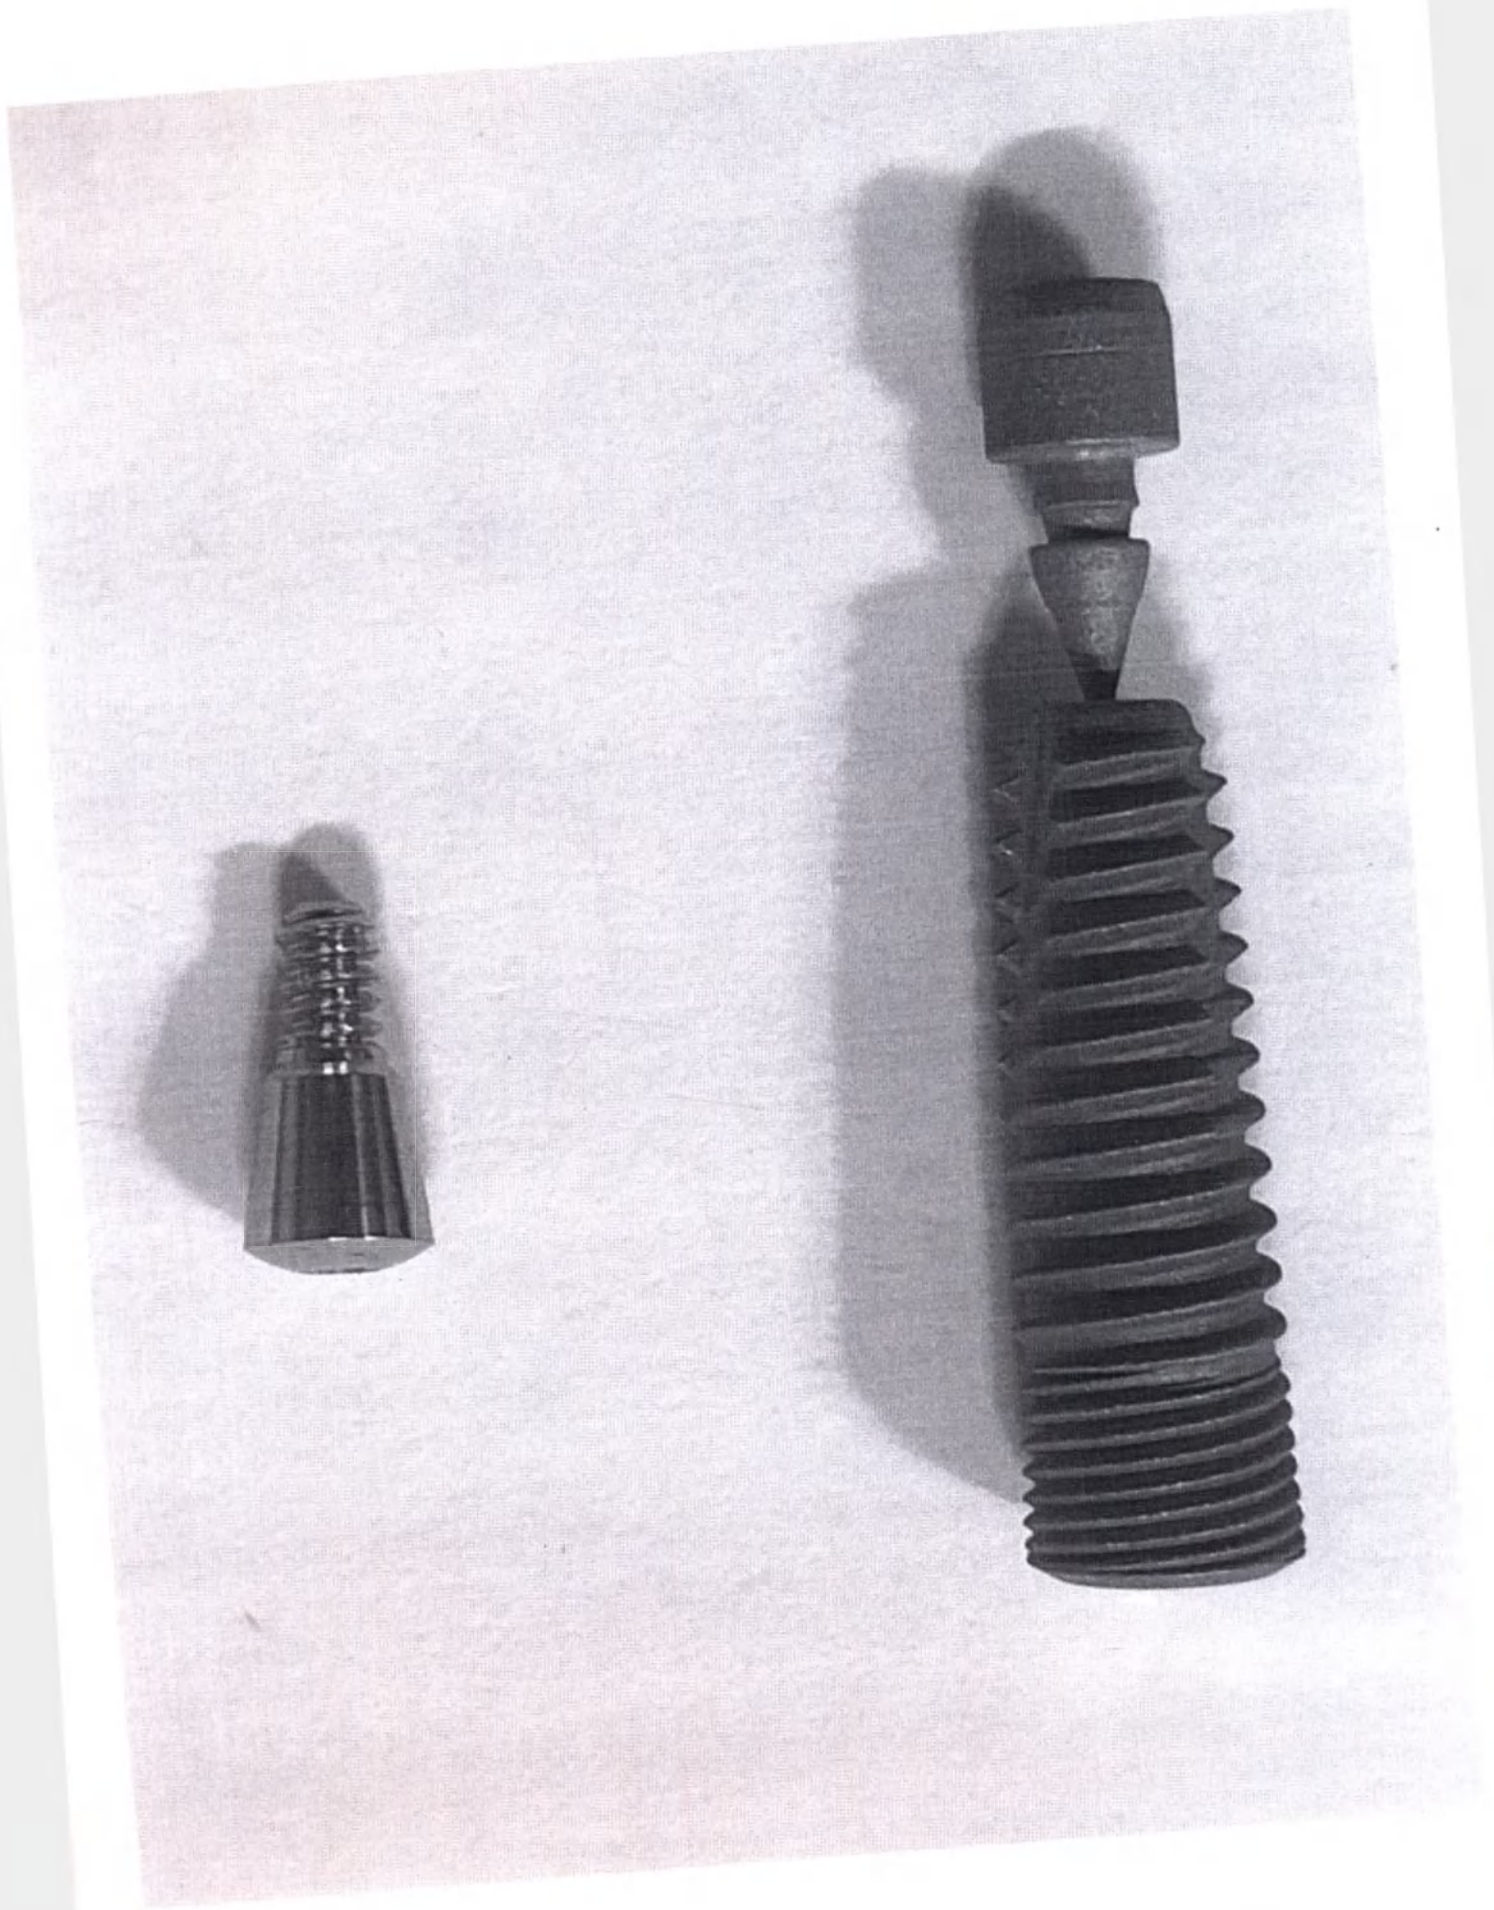

# Имплантат GT2 без винта-заглушки



**Gt2/ D4.0\*L7**  
**Ufit** Lot:GT24007MT18F4(20C5)

**Gt2/ D4.0\*L7**  
**Ufit** Lot:GT24007MT18F4(20C5)

**Gt2/ D4.0\*L7**  
**Ufit** Lot:GT24007MT18F4(20C5)

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱


CE  
0120




경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 56, 50870  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 하부구조물



1. 성능 및 사용목적  
단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공  
치근으로 사용되며, 악궁에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트  
사술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.

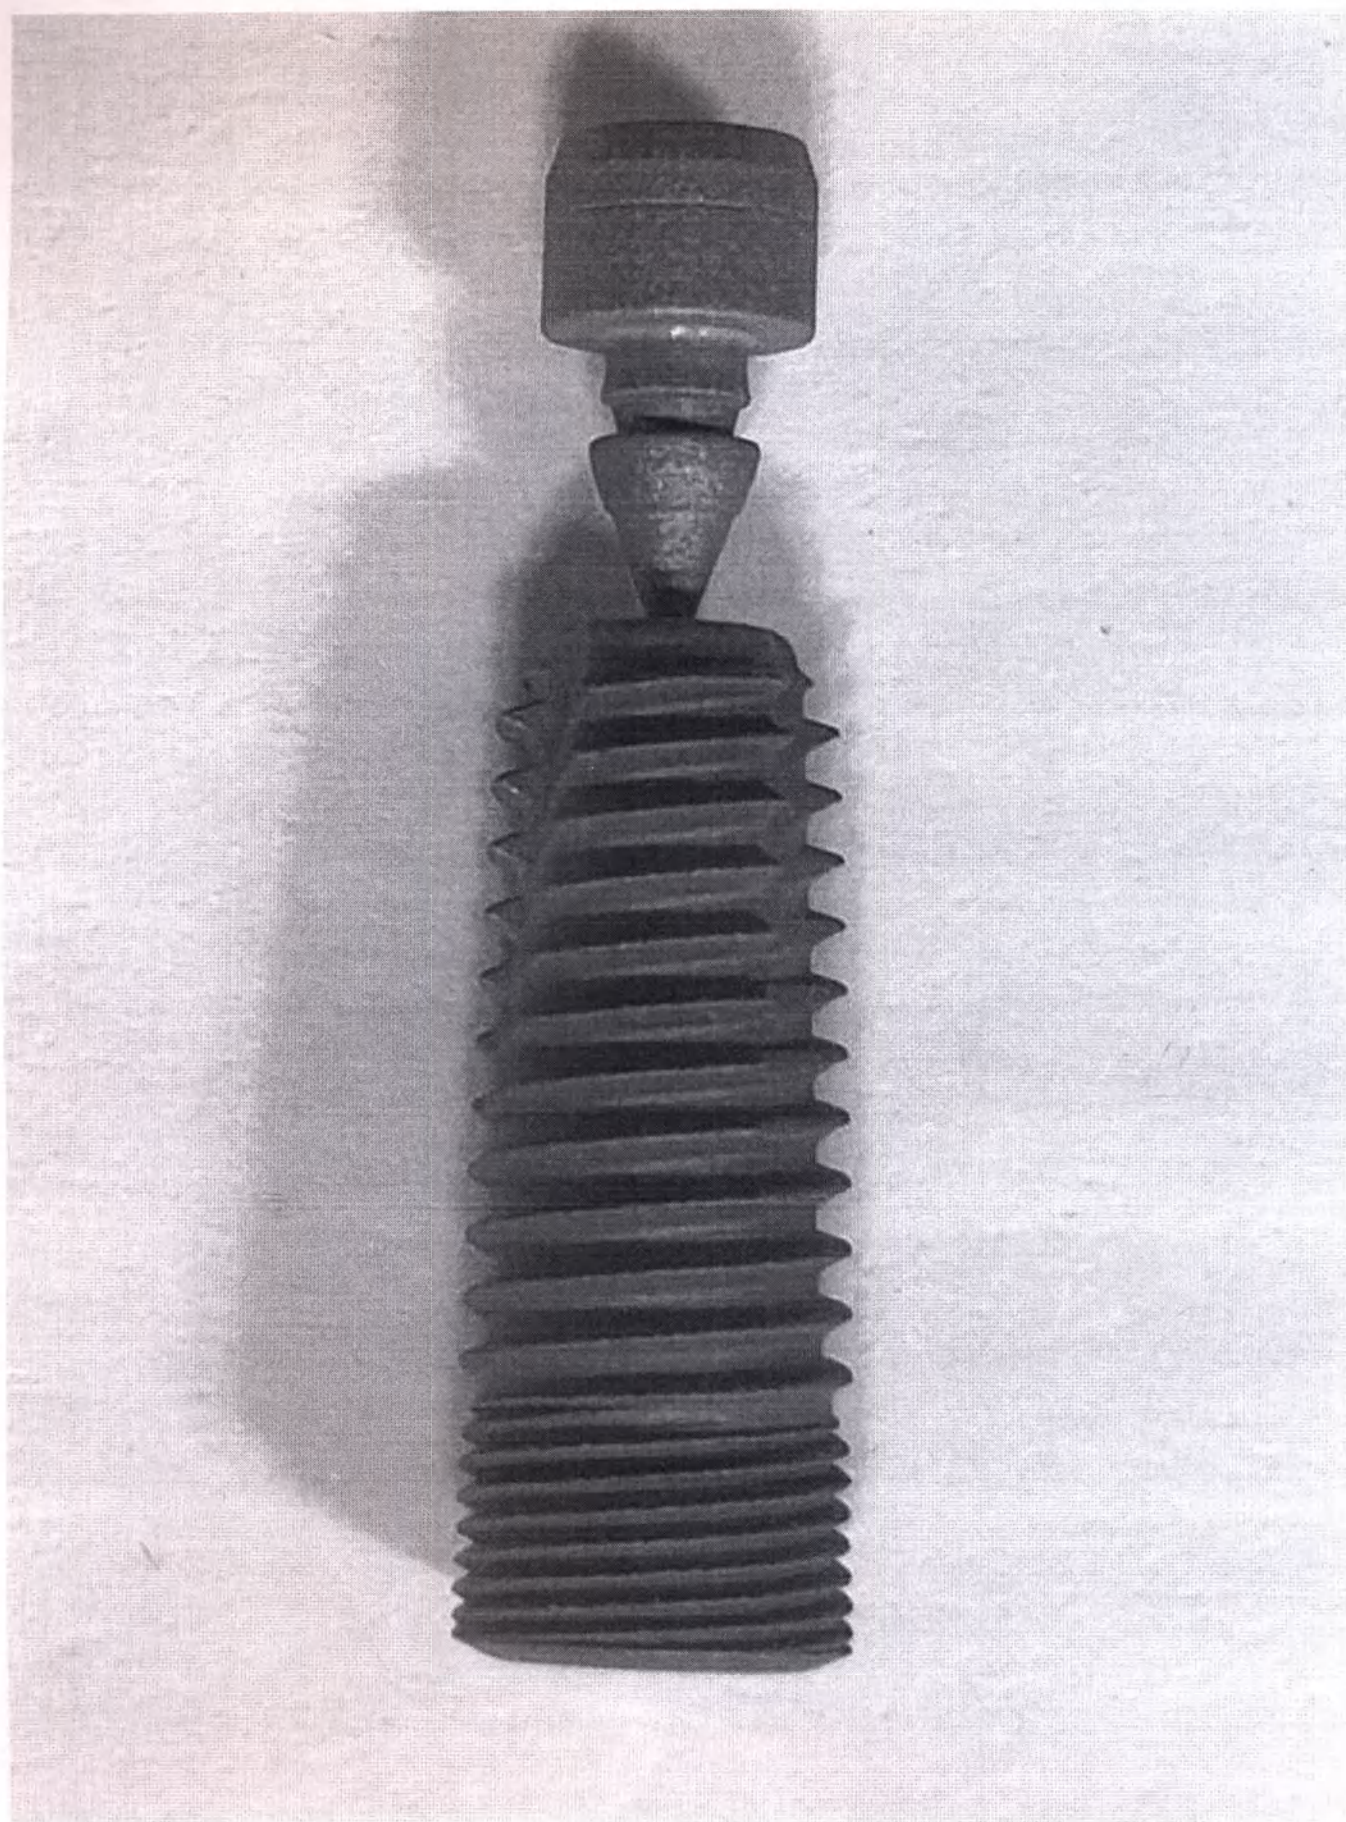

Имплантат GT2 mini без винта-заглушки

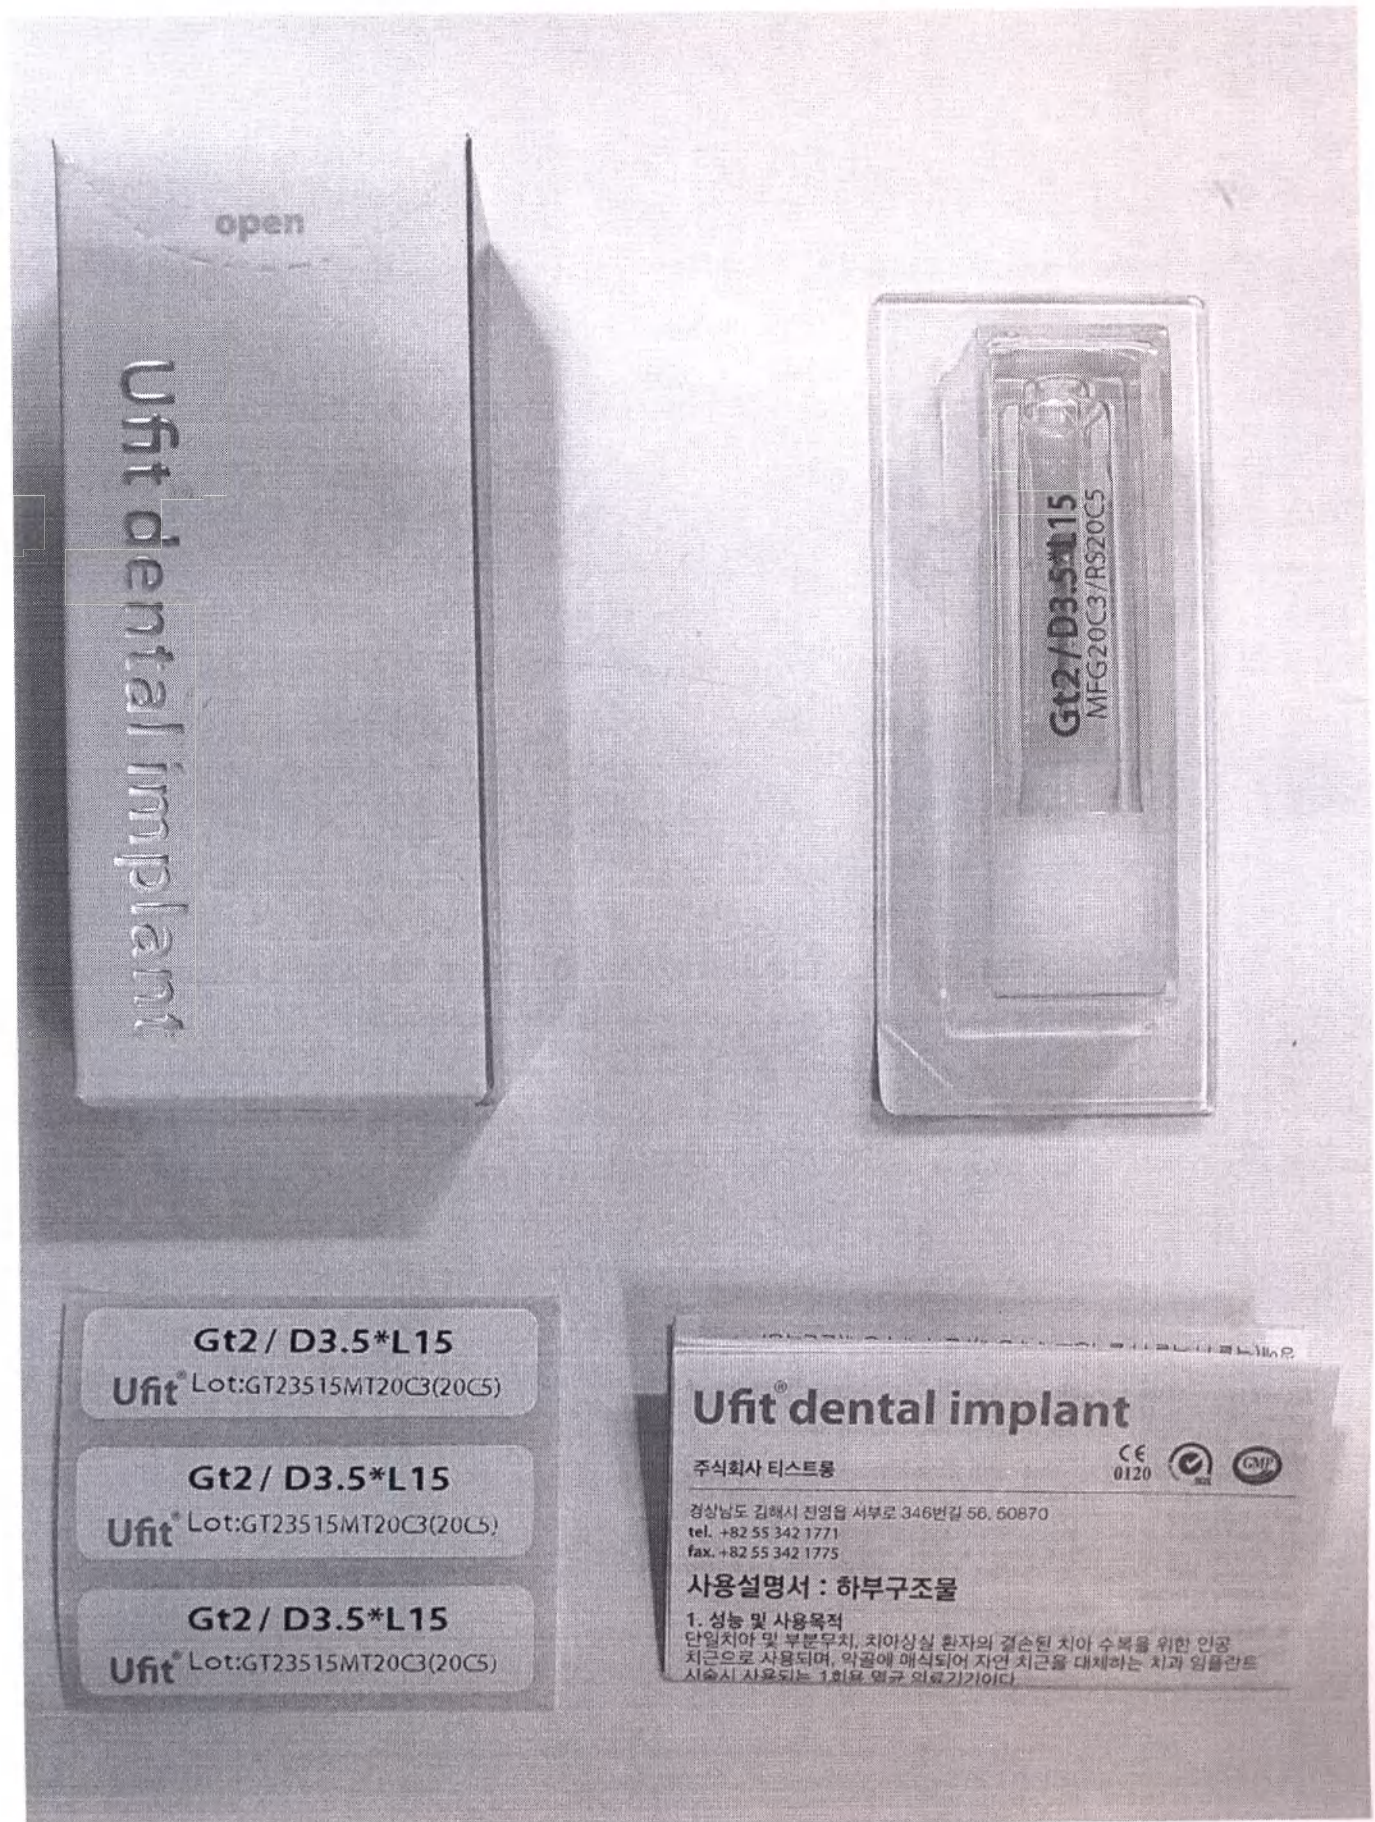

Имплантат GT2 mini с винтом-заглушкой

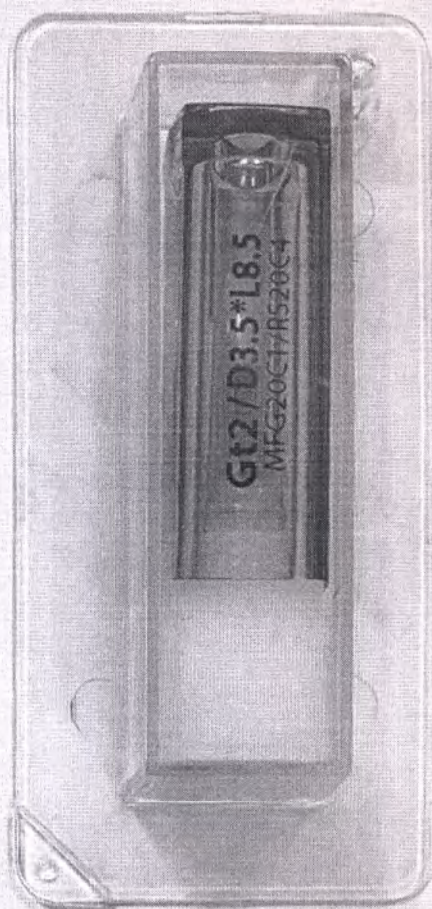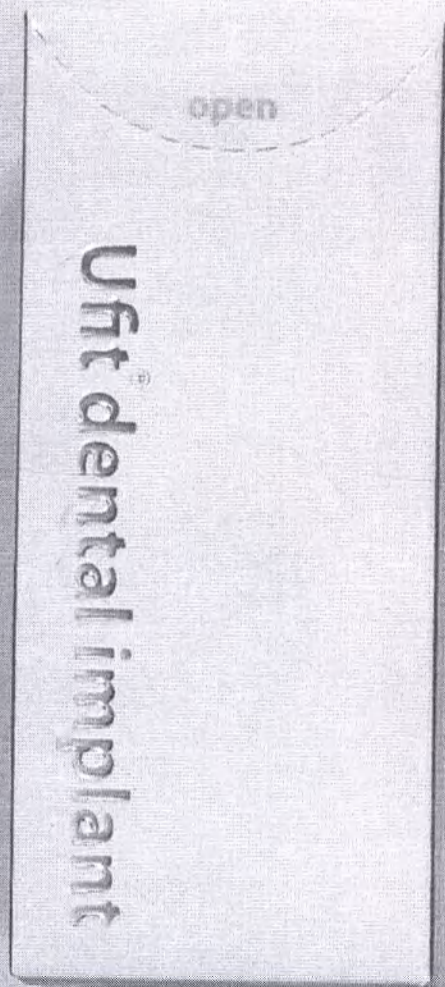

**Gt2/ D3.5\*L8.5**  
**Ufit** Lot:GT235085MT20C1(20C4)

**Gt2/ D3.5\*L8.5**  
**Ufit** Lot:GT235085MT20C1(20C4)

**Gt2/ D3.5\*L8.5**  
**Ufit** Lot:GT235085MT20C1(20C4)

**Ufit<sup>®</sup> dental implant**

주식회사 티스트롱

CE  
0120




경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 56, 60870.  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

**사용설명서 : 하부구조물**

1. 성능 및 사용목적  
단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공  
치근으로 사용되며, 악골에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트  
시술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.

# Имплантат NT2 с винтом-заглушкой

Ufit dental implant

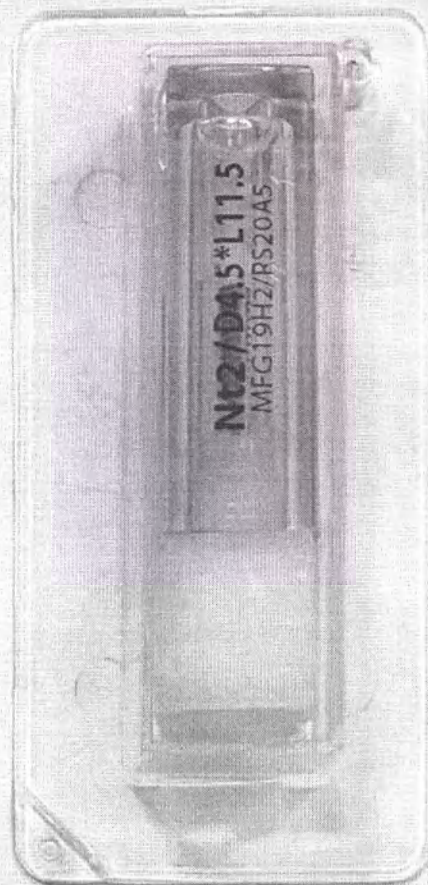

**Ufit® Nt2 / D4.5\*L11.5**  
Lot:NT245115T19H2(20A5)

**Ufit® Nt2 / D4.5\*L11.5**  
Lot:NT245115T19H2(20A5)

**Ufit® Nt2 / D4.5\*L11.5**  
Lot:NT245115T19H2(20A5)

**Ufit® dental implant**

주식회사 티스트롱



경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 56, 50870

tel. +82 55 342 1771

fax. +82 55 342 1775

**사용설명서 : 하부구조물**

**1. 성능 및 사용목적**

단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공 치근으로 사용되며, 악궁에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트 시술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.



Имплантат NT2 без винта-заглушки



**Ufit<sup>®</sup> Nt2/ D7.0\*L10**  
Lot:NT27010T19i2(20C5)

**Ufit<sup>®</sup> Nt2/ D7.0\*L10**  
Lot:NT27010T19i2(20C5)

**Ufit<sup>®</sup> Nt2/ D7.0\*L10**  
Lot:NT27010T19i2(20C5)

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롬



경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 66, 50670


tel. +82 55 342 1771

fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 하부구조물

#### 1. 성능 및 사용목적

단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공 치근으로 사용되며, 악궁에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트 수술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.

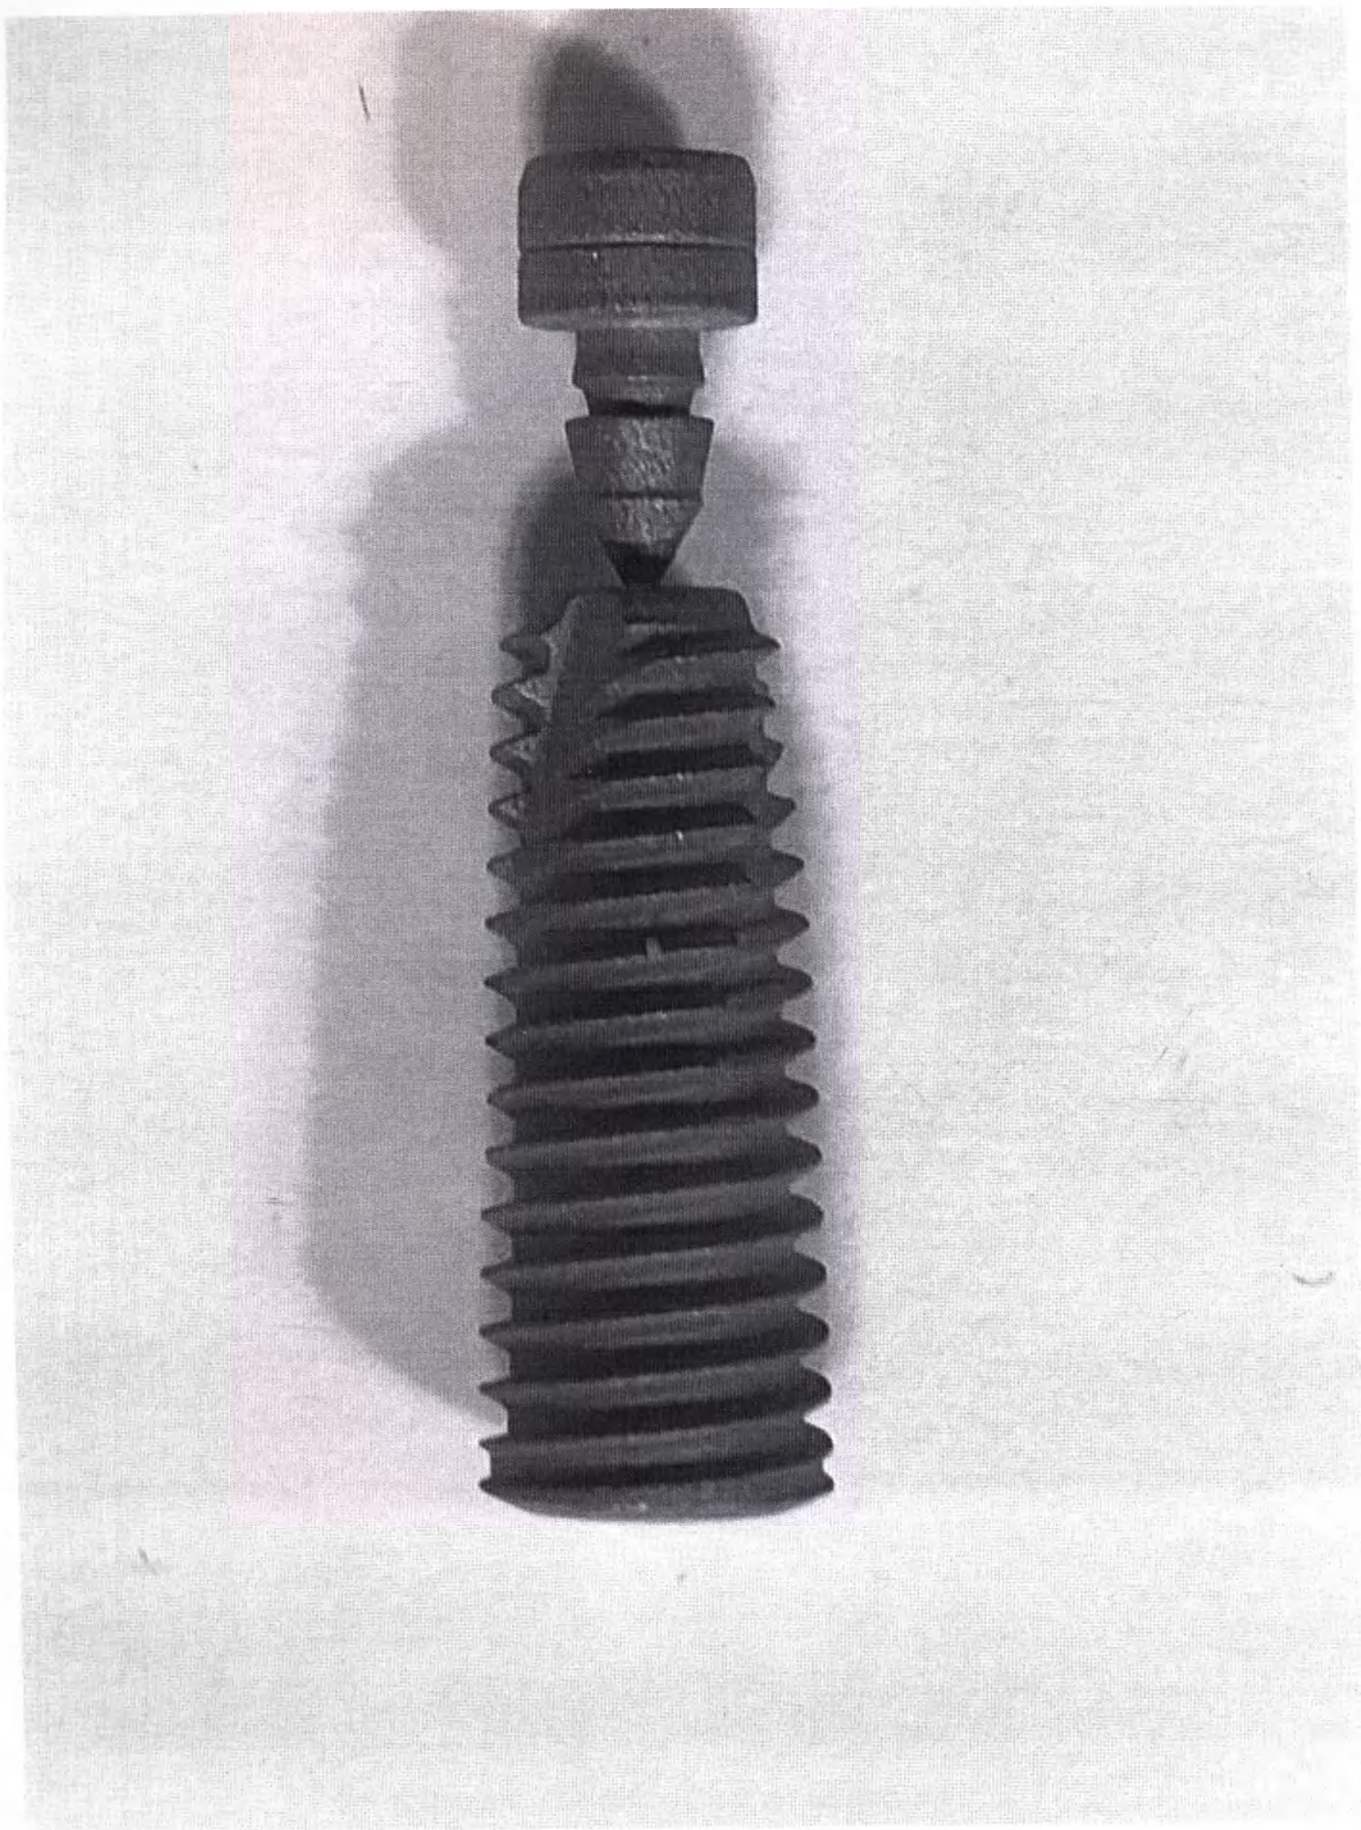

# Имплантат NT2 mini с винтом-заглушкой



**Ufit® Nt2 / D3.5\*L8.5**  
Lot:NT235085T17D5(20B2)

**Ufit® Nt2 / D3.5\*L8.5**  
Lot:NT235085T17D5(20B2)

**Ufit® Nt2 / D3.5\*L8.5**  
Lot:NT235085T17D5(20B2)

## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱



경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 56, 50870  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 하부구조물

**1. 성능 및 사용목적**  
단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공 치근으로 사용되며, 악골에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트 시술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.

Имплантат NT2 mini без винта-заглушки



**Ufit® Nt2 / D3.5\*L11.5**  
Lot:NT235115T19B3(20B2)

**Ufit® Nt2 / D3.5\*L11.5**  
Lot:NT235115T19B3(20B2)

**Ufit® Nt2 / D3.5\*L11.5**  
Lot:NT235115T19B3(20B2)

## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱



경상남도 김해시 진영읍 서부로 346번길 56, 50870  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 하부구조물

1. 성능 및 사용목적  
단일치아 및 부분무치, 치아상실 환자의 결손된 치아 수복을 위한 인공  
치근으로 사용되며, 악궁에 매식되어 자연 치근을 대체하는 치과 임플란트  
시술시 사용되는 1회용 멸균 의료기기이다.

Дентальный имплантат

Номер лицензии на производство : № 10-53

**REF** GT2 5010MT

**LOT** GT25010MT16G4



РУ № XXXXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ.



2021.04.29



2028.04.29



Т.СТРОНГ ИНК, Корея  
упаковочная единица : 1 шт.  
Сделано в Корее

Уполномоченный представитель ООО  
"ИМПЛАМАРКЕТ"  
Россия, 350065, г. Краснодар,  
ул. им. Василия Гассия, 10/51-1  
[+79181408266]


### (주)티스트롱

경상남도 김해시 진영읍  
서부로 346번길 56

tel. 055 342 1771

fax. 055 342 1775

치과용 임플란트 고정체  
본 제품은 1회용 멸균의료기기임  
제조업 허가번호 : 제1358호

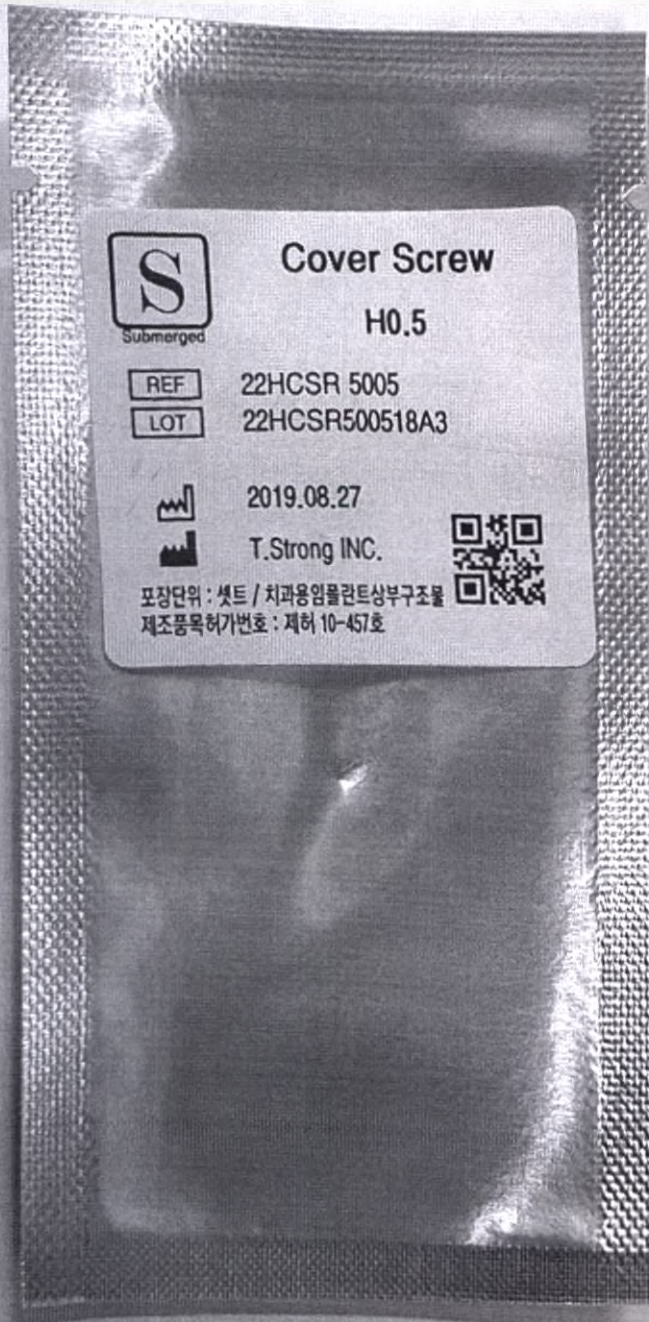

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 걸손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Transfer Abutment

D5.5\*GH3\*H5.5

REF

STA 553055H

LOT

STA553055H19G2

CSR27H19D4




2020.02.10



T.Strong INC.



포장단위 : 셋트 / 치과용임플란트상부구조물  
제조품목허가번호 : 제허10-557호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로348번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ㉠. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Milling Abutment

D5.0\*GH2\*H9

REF

SMA 5029H

LOT

SMA5029H17F5

CSR27H19D4




2020.02.19



T.Strong INC.



포장단위 : 세트 / 치과용임플란트상부구조물  
제조품목허가번호 : 제허12-635호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적


본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ㉠. 일반적인 주의사항

① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.

② 포장상태를 확인한다.

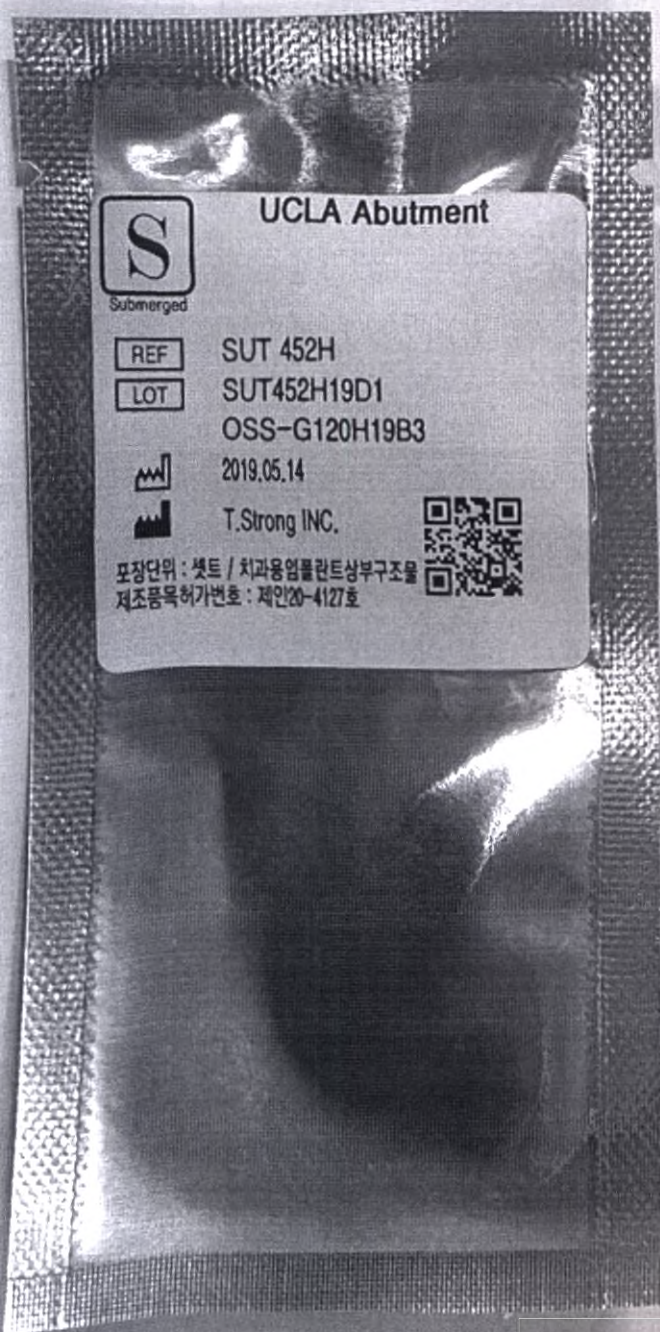

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —, 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



Plastic Cylinder

D4.5

REF

S-PSC 45H

LOT

S-PSC45H18F5

CSR27H19A1




2019.09.24



T.Strong INC.



포장단위 : 셋트 / 치과용임플란트사출기구  
제조품목허가번호 : 제신11-46호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —, 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



**Conical Multi  
Abutment-Mini  
P4.8°GH1**

REF

MCMA 4810

LOT

MCMA481017C2



2019.02.24

T.Strong INC.

포장단위 : 세트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제인02-447호



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



Конический мульти-  
юнит абатмент  
P4,8\*GH1

REF

MCMA 4810

LOT

MCMA481017C2



2021.04.29



Т.СТРОНГ ИНК, Корея



Единица упаковки: комплект

Верхняя структура зубного имплантата

Номер лицензии на производство: № 02-447

Уполномоченный представитель ООО "ИМПЛАМАРКЕТ"  
Росси́я, 350065, г. Краснодар,  
ул. им. Басматия Гассыя, 10/51-1 (+79181408266)



**Conical Multi Angled  
Abutment-Mini  
P4.8\*GH1.5\*A15**

REF

MCMAA 481515H

LOT

MCMAA481515H19D1

MCSN02H17E3

2019.02.24



T.Strong INC.



포장단위 : 세트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제허02-447호



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



Conical abutment  
healing cap  
P4.8\*H6

REF

CAHC 600

LOT

CAHC60017C4



2019.03.22

T.Strong INC.

포장단위 : 세트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제허02-447호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



**Conical Temporary  
Abutment  
P4.8**

REF

CTPA 48H

LOT

CTPA48H17C2


NTS00H13L1



2018.08.16

T.Strong INC.

포장단위 : 세트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제허02-447호



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물


#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ㉠. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

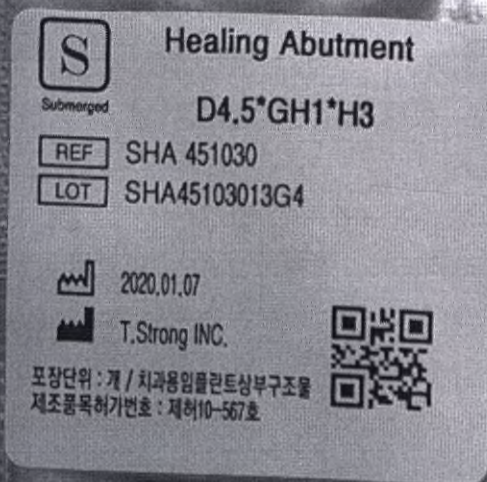

## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ①. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.





## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ㉠. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Fixture Lab Analog

REF

S-FLA 45

LOT

S-FLA4519A2



2019.09.27



T.Strong INC.



포장단위 : 개 / 치과용임플란트가공재료  
제조품목허가번호 : 제신 11-47호



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물


#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ㉠. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

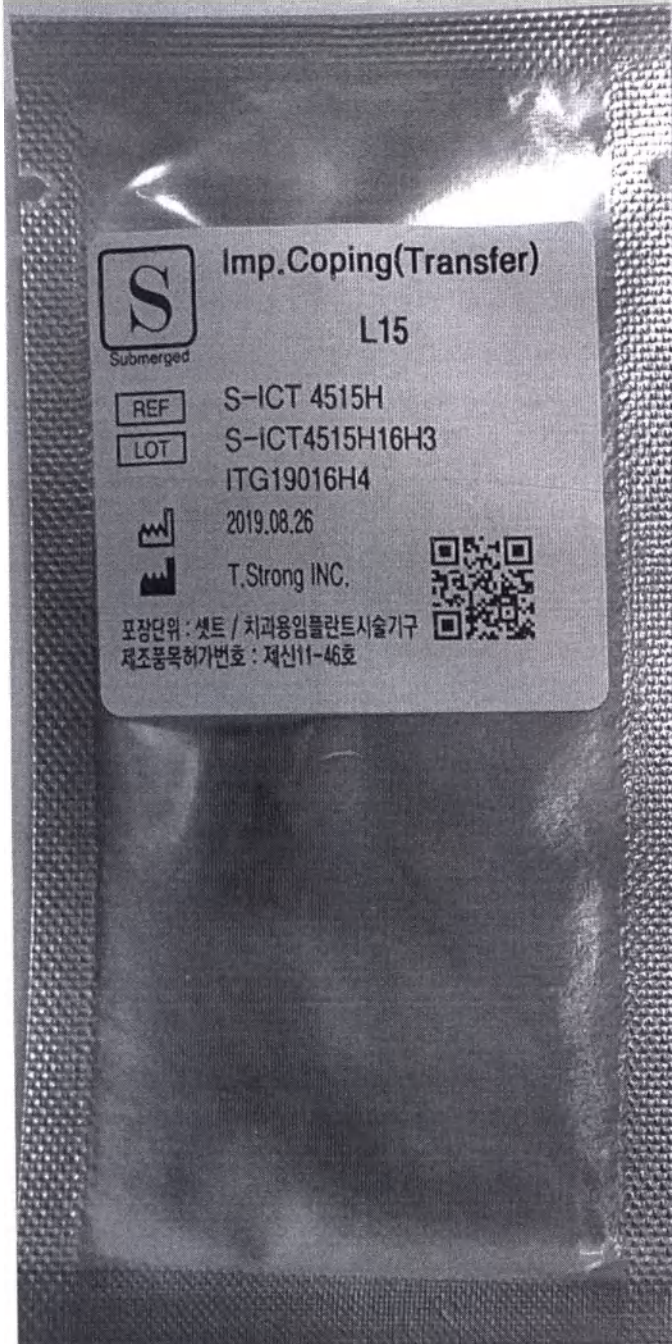

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물


#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

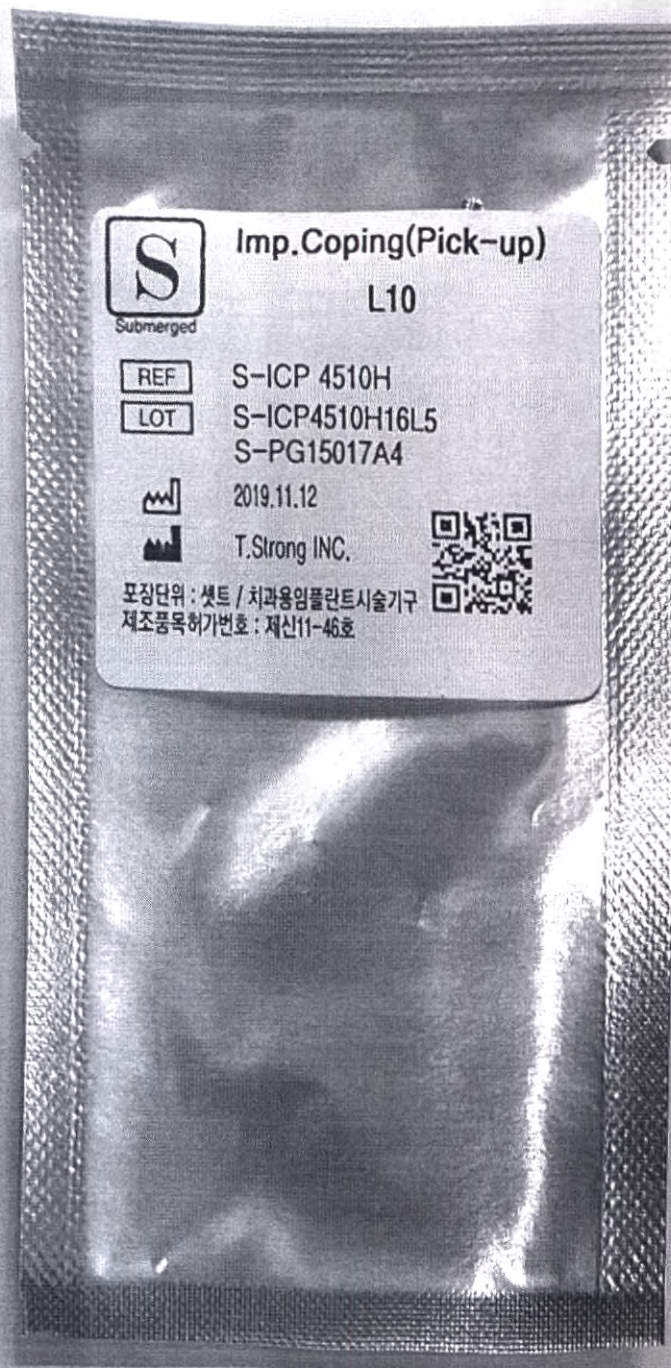

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



Guide Pin  
(Pick-up)  
L15

REF

S-PG 150

LOT

S-PG15014D1



2014.08.20

T.Strong INC.



포장단위 : 개 / 치과용임플란트기술기구  
제조품목허가번호 : 제신 11-46호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



Conical Lab Analog

P4.8

REF

CLA 48

LOT

CLA4817C4



2019.03.22

T.Strong INC.

포장단위 : 세트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제허02-447호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



Conical Plastic  
Cylinder  
P4.8

REF

CPSC 48H

LOT

CPSC48H17D4

NTS00H13L1



2017.11.14

T.Strong INC.



포장단위 : 셋트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제허02-446호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적


본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

Транссер для конического абатмента (для закрытой ложки)

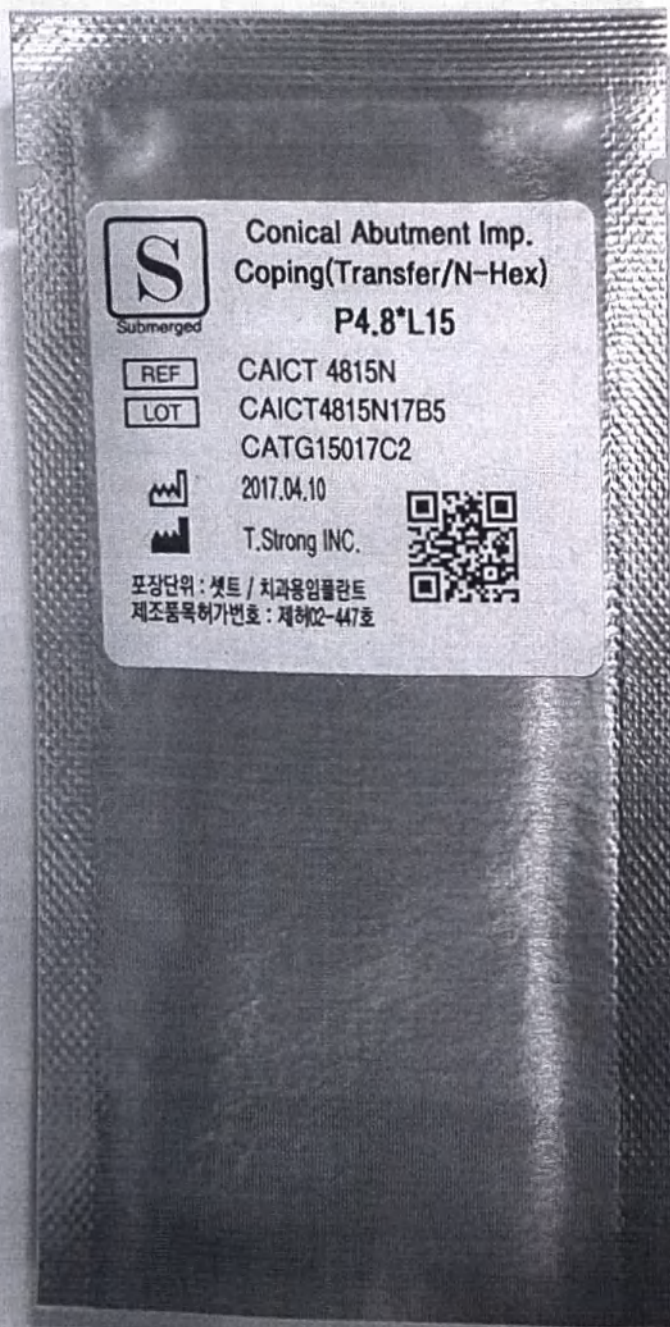

## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

Трансфер для конического абатмента (для открытой ложки)



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### —. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

Направляющий пин трансфера для конического абатмента  
- для закрытой ложки



**Conical Abutment  
Guide Pin(Transfer)**  
L 15

REF CATG 150  
LOT CATG15017C2

2020.08.03  
T.Strong INC.

포장단위 : 셋트 / 치과용임플란트  
제조등록허가번호 : 제허02-447호





## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### 一. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

Направляющий пин трансфера для конического абатмента  
- для открытой ложки



Conical Abutment  
Guide Pin(Pick-up )  
L 20

REF

CAPG 200

LOT

CAPG20017B5



2020.08.03



T.Strong INC.

포장단위 : 셋트 / 치과용임플란트  
제조등록허가번호 : 제허02-447호



## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uljeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물


#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### ①. 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

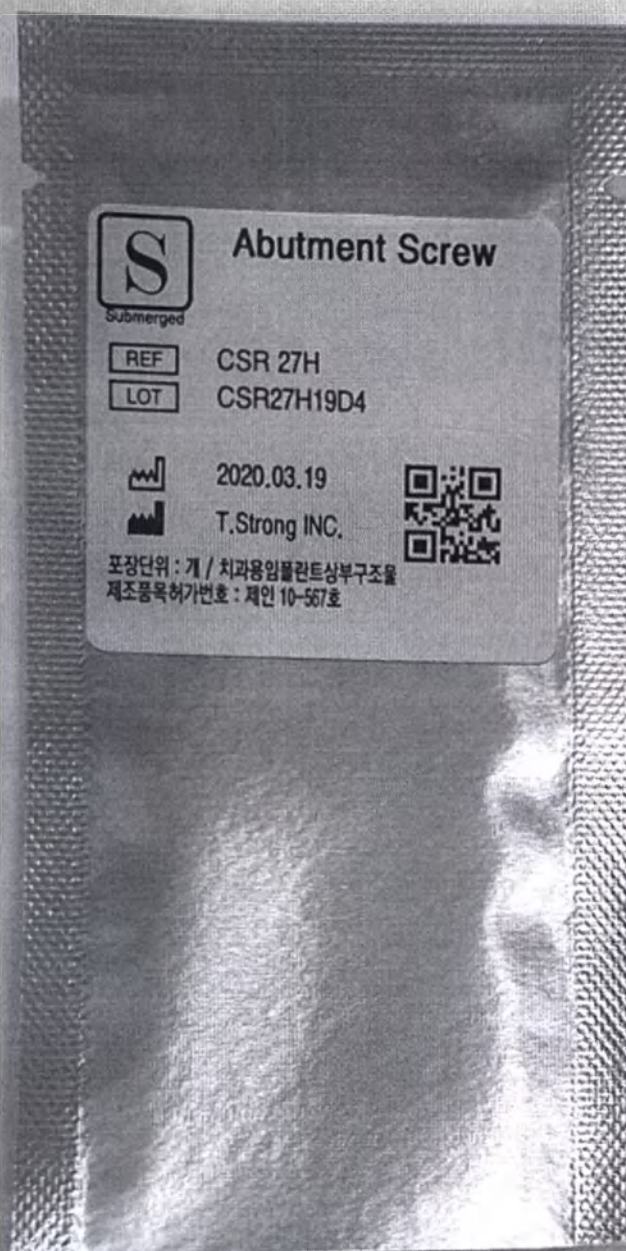

## Ufit® dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong, Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.



## Multi Abutment Screw

REF

NTS 00H

LOT

NTS00H13L1



2017.04.18



T.Strong INC.

포장단위 : 셋트 / 치과용임플란트  
제조품목허가번호 : 제허02-447호



## Ufit<sup>®</sup> dental implant

주식회사 티스트롱 / T.Strong.Inc

경상남도 김해시 진영읍 의전리 181-4  
(서부로346번길 56) 621-801  
181-4, Uijeon-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si,  
Gyeongsangnam-do, 621-801, Republic of Korea  
tel. +82 55 342 1771  
fax. +82 55 342 1775

### 사용설명서 : 상부구조물

#### 1. 사용목적

본 제품은 치과용임플란트고정체와 체결되어 인공치아를 지지하기 위한 치과용임플란트상부구조물로서, 결손된 치아의 저작기능 회복, 심미 회복을 위해 사용되는 일회용 의료기기이다

#### 2. 주의사항

##### — 일반적인 주의사항

- ① 숙련된 의사 및 허가 받은 자 이외에는 절대 사용해서는 안 되며, 구강 내 사용하는 제품으로 1회용이므로 재사용하지 않아야 한다.
- ② 포장상태를 확인한다.

«Верно, всего пронумеровано, прошнуровано,  
скреплено печатью

(Сорок две) 42 листов»

Директор

(М.А. Грицай)

.2021г

