

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Медтроник»

Генеральный директор

Е.В.Плясунова

«13» декабря 2018 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™

с технологией DST Series™


1. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Seture™ с технологией DST Series 60 мм – 2,5 мм

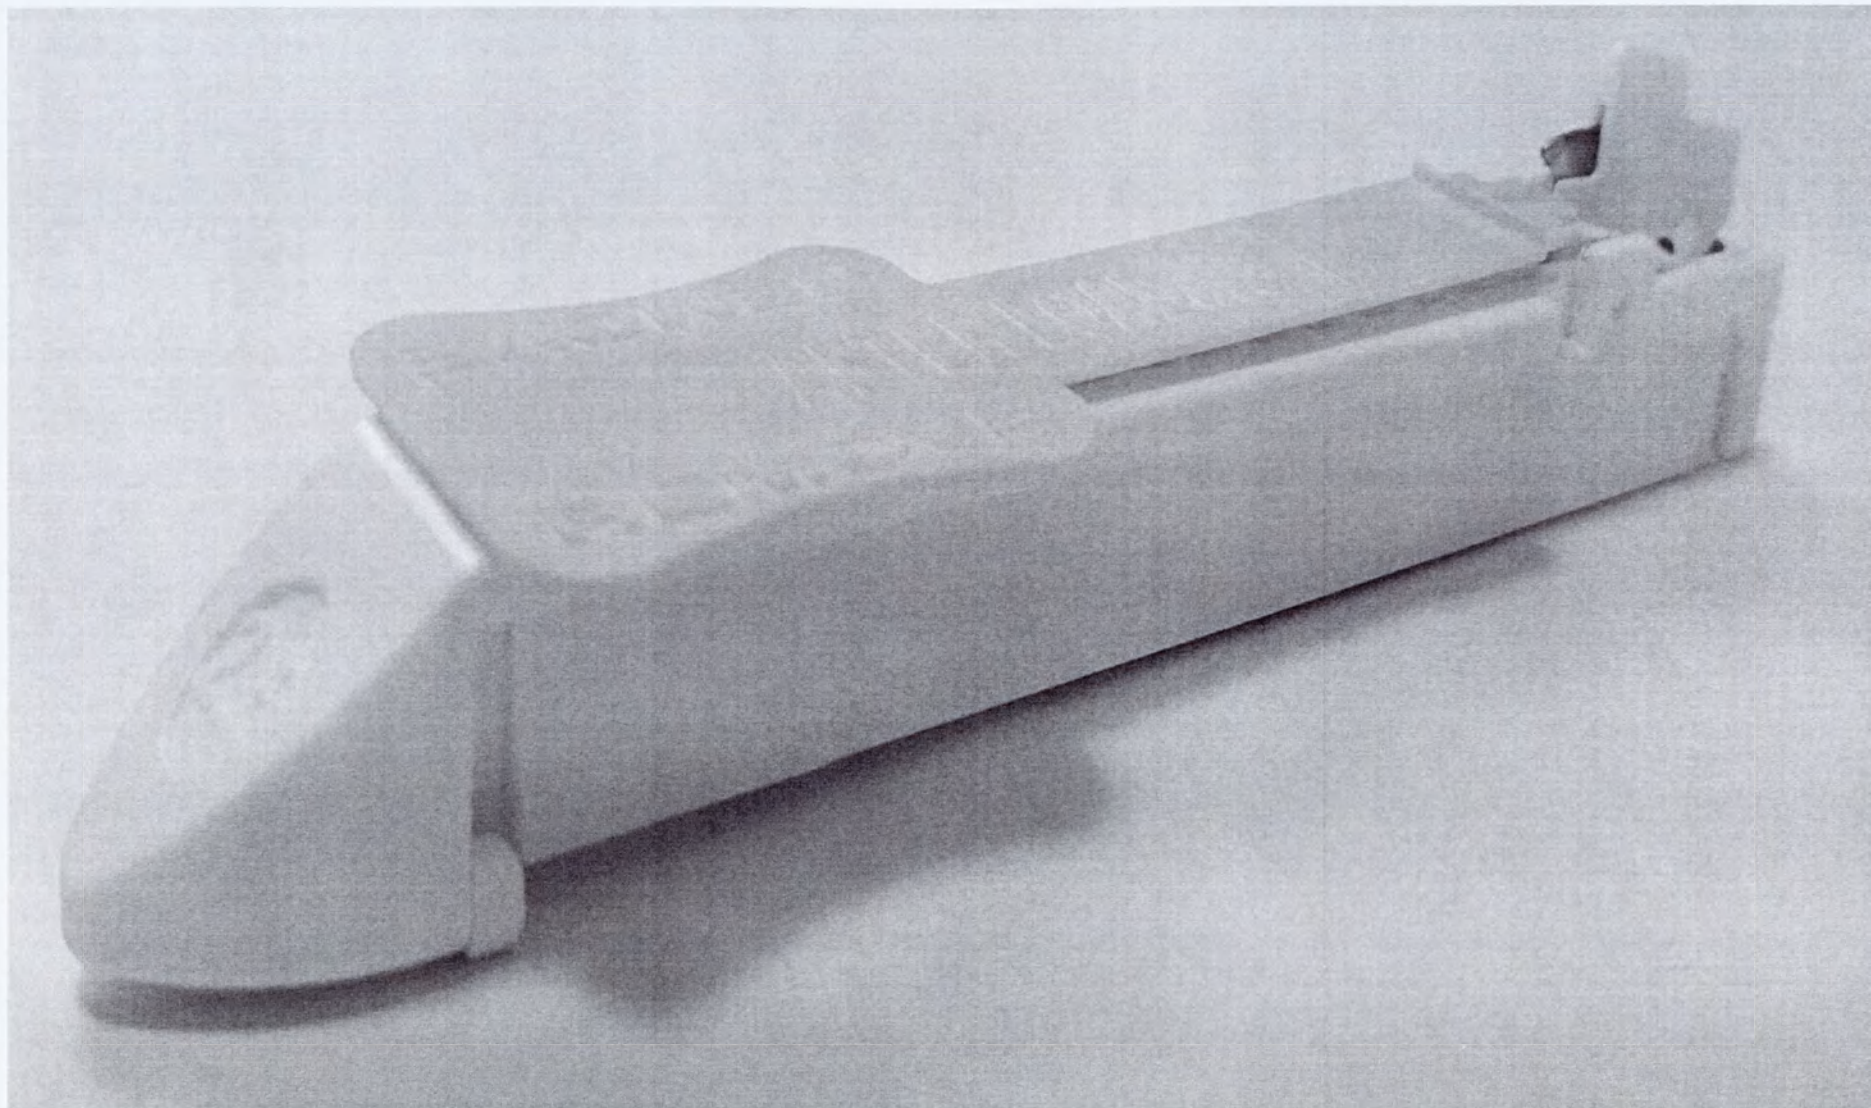


2. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™ 60 мм – 3,8 мм

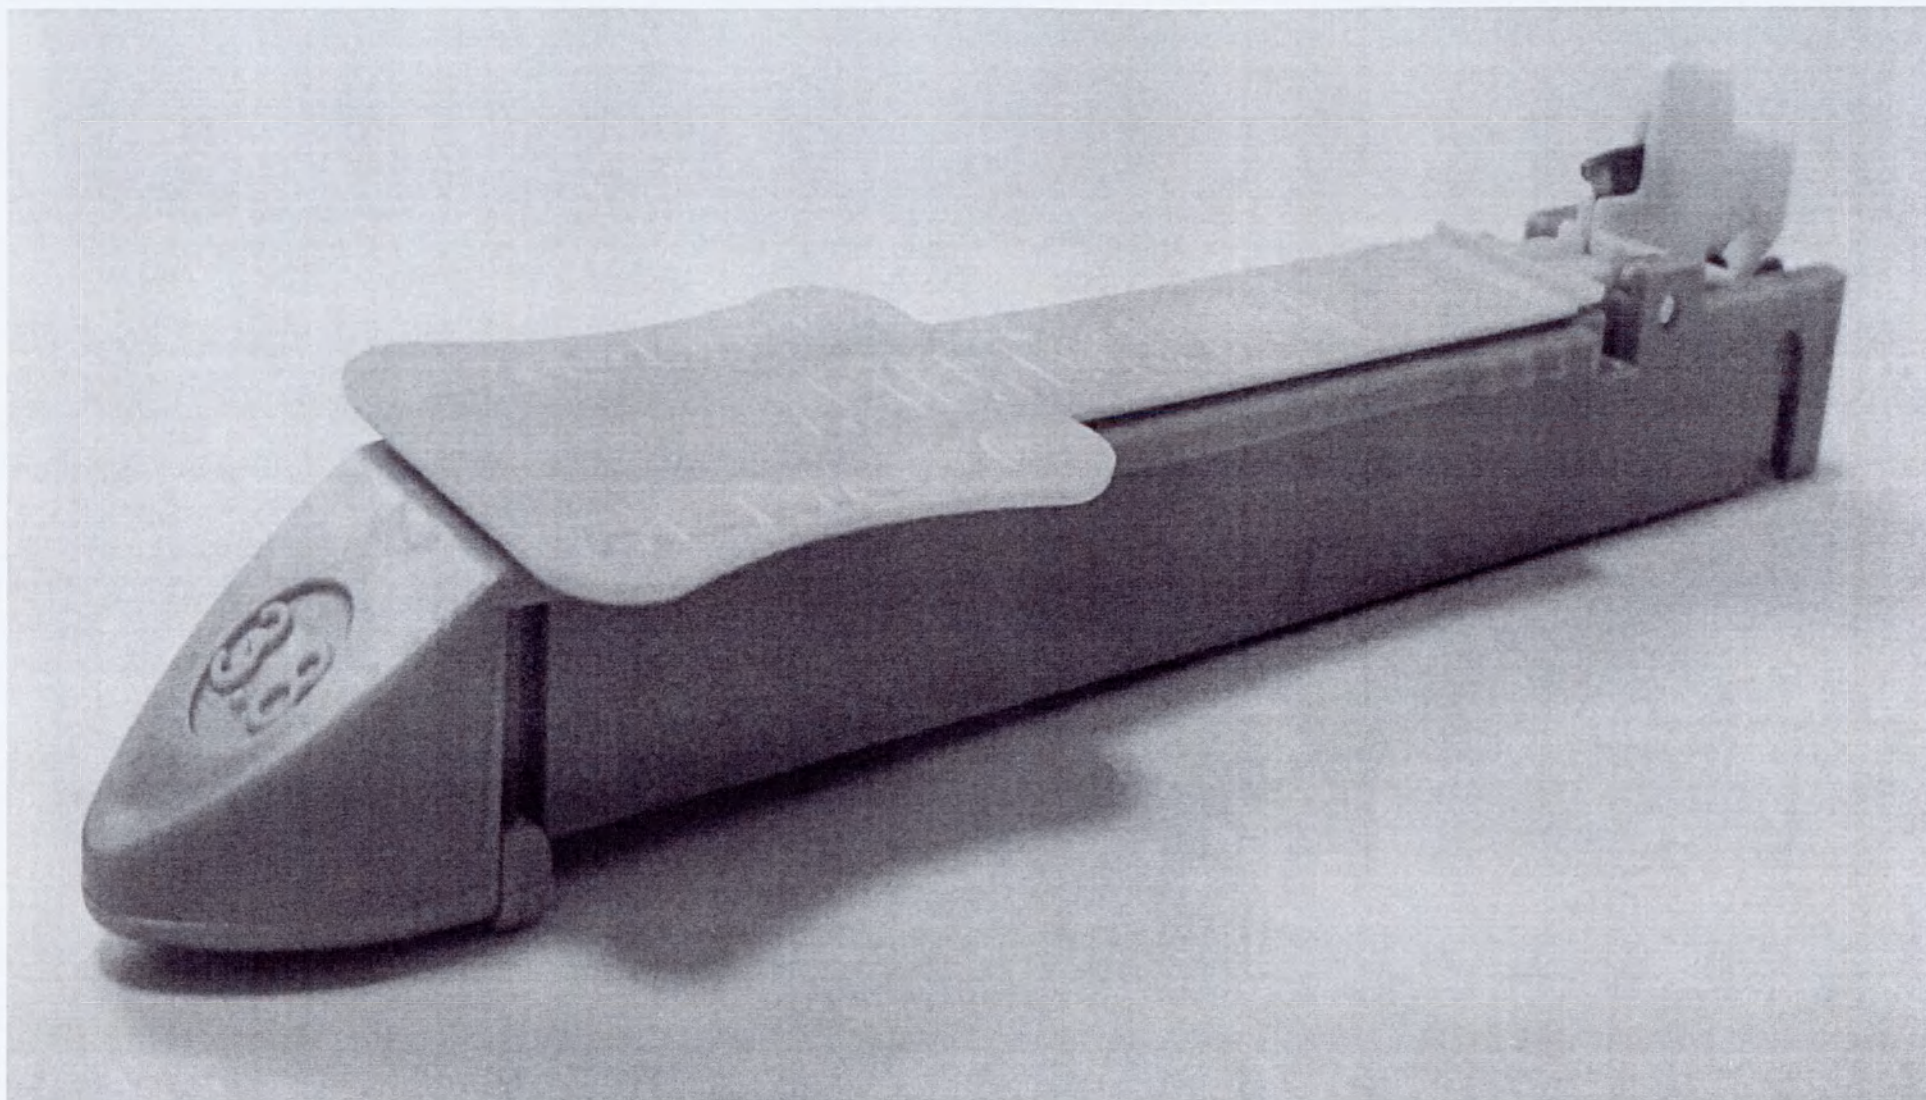


3. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™ 60 мм – 4,8 мм

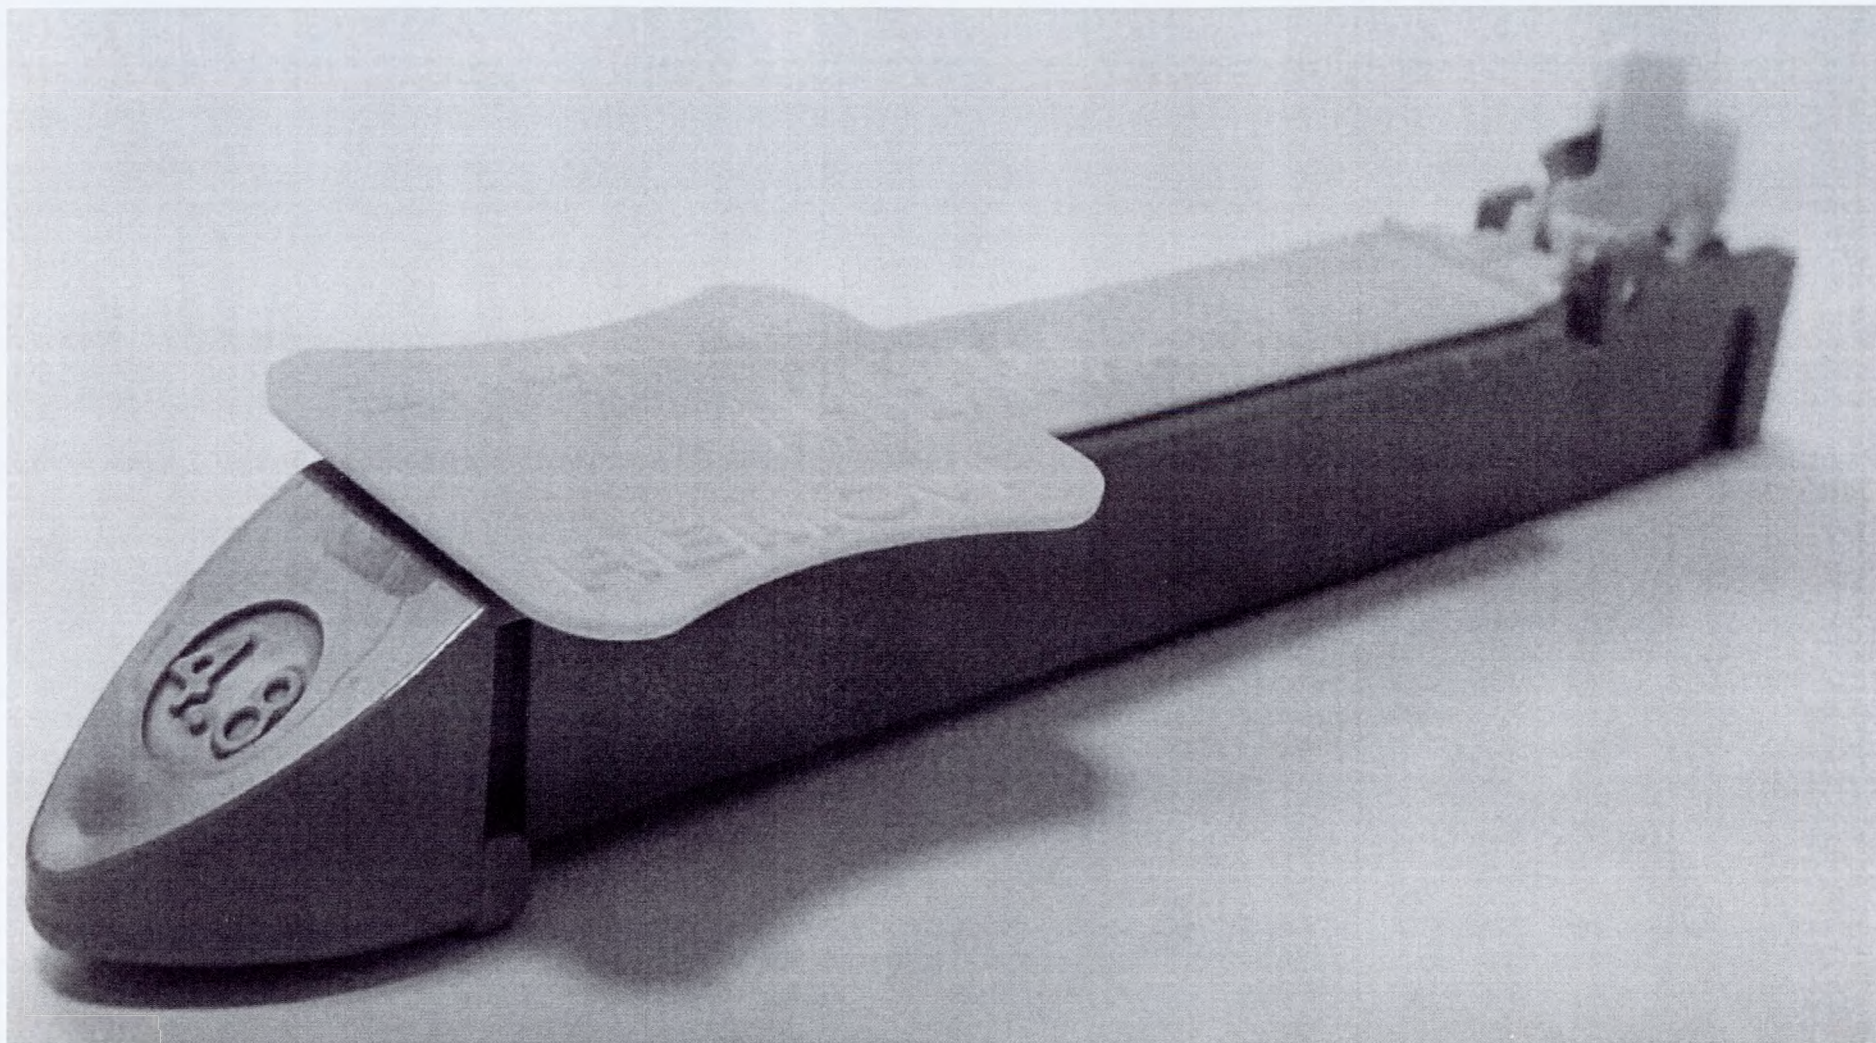


4. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™ 80 мм – 3,8 мм

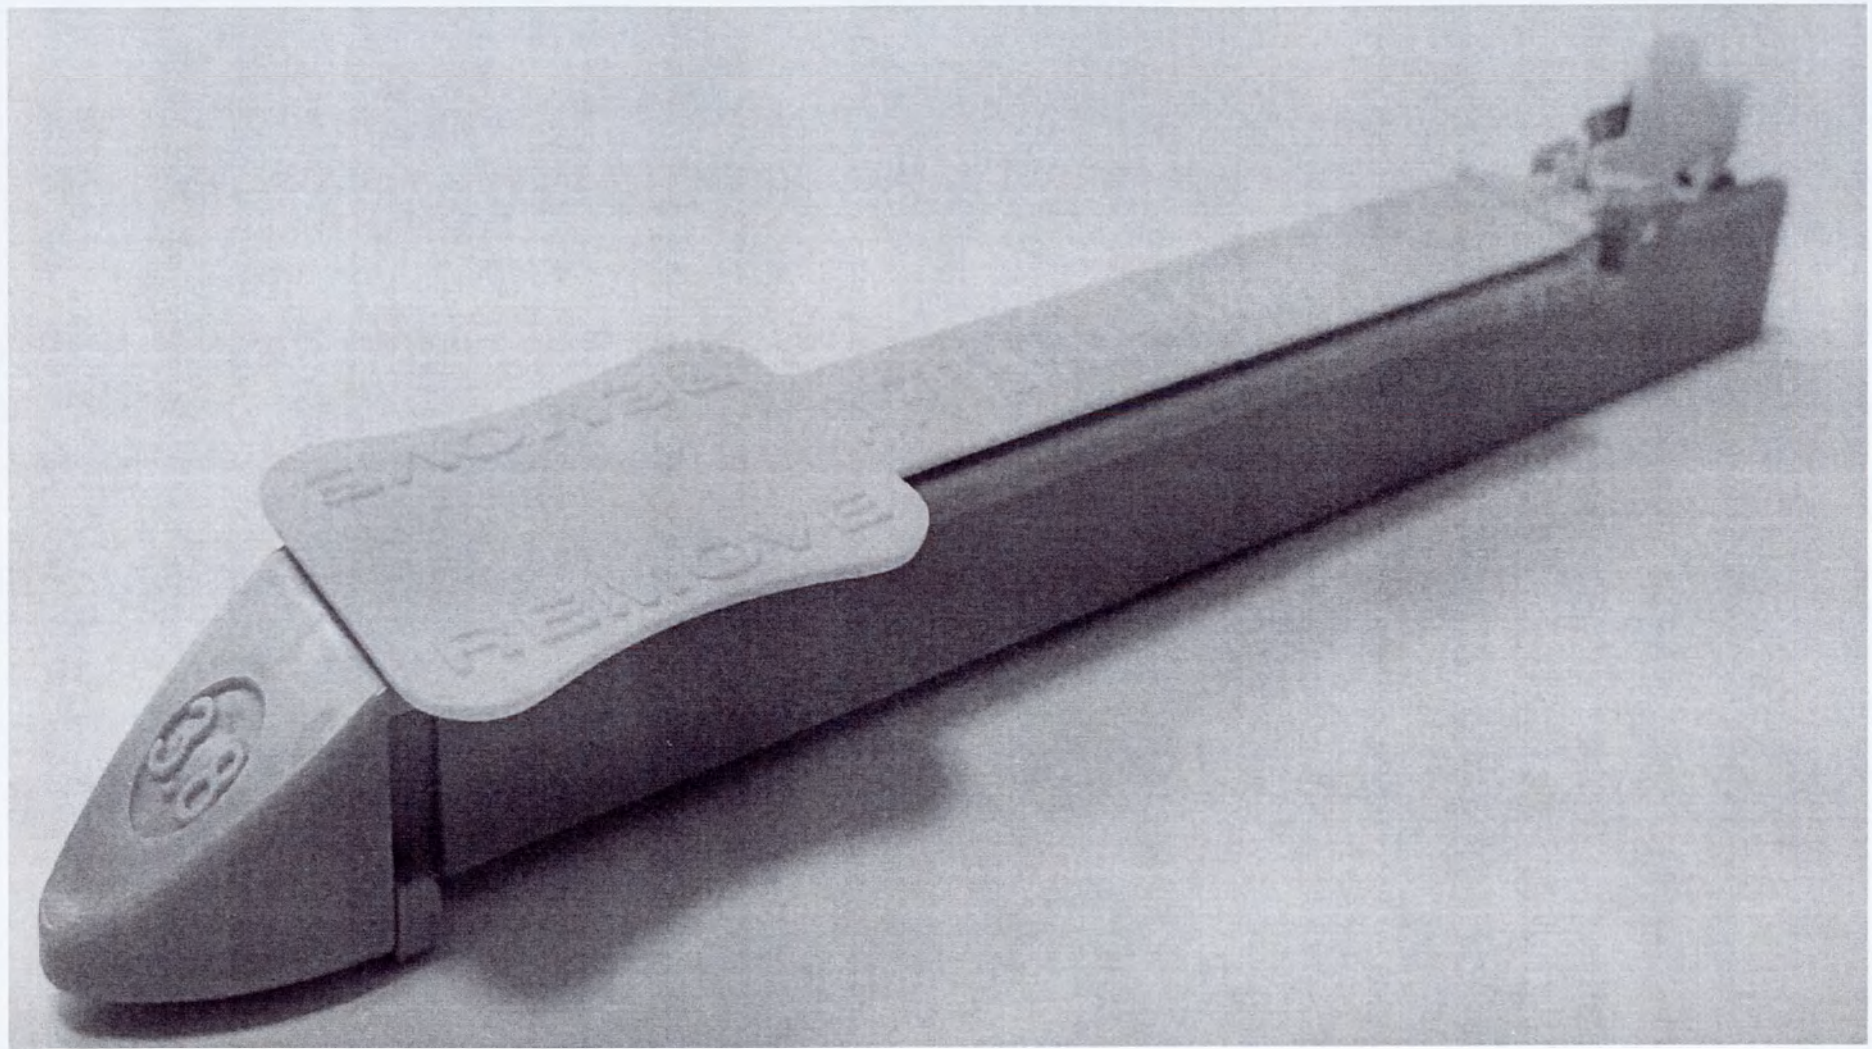


5. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™ 80 мм – 4,8 мм

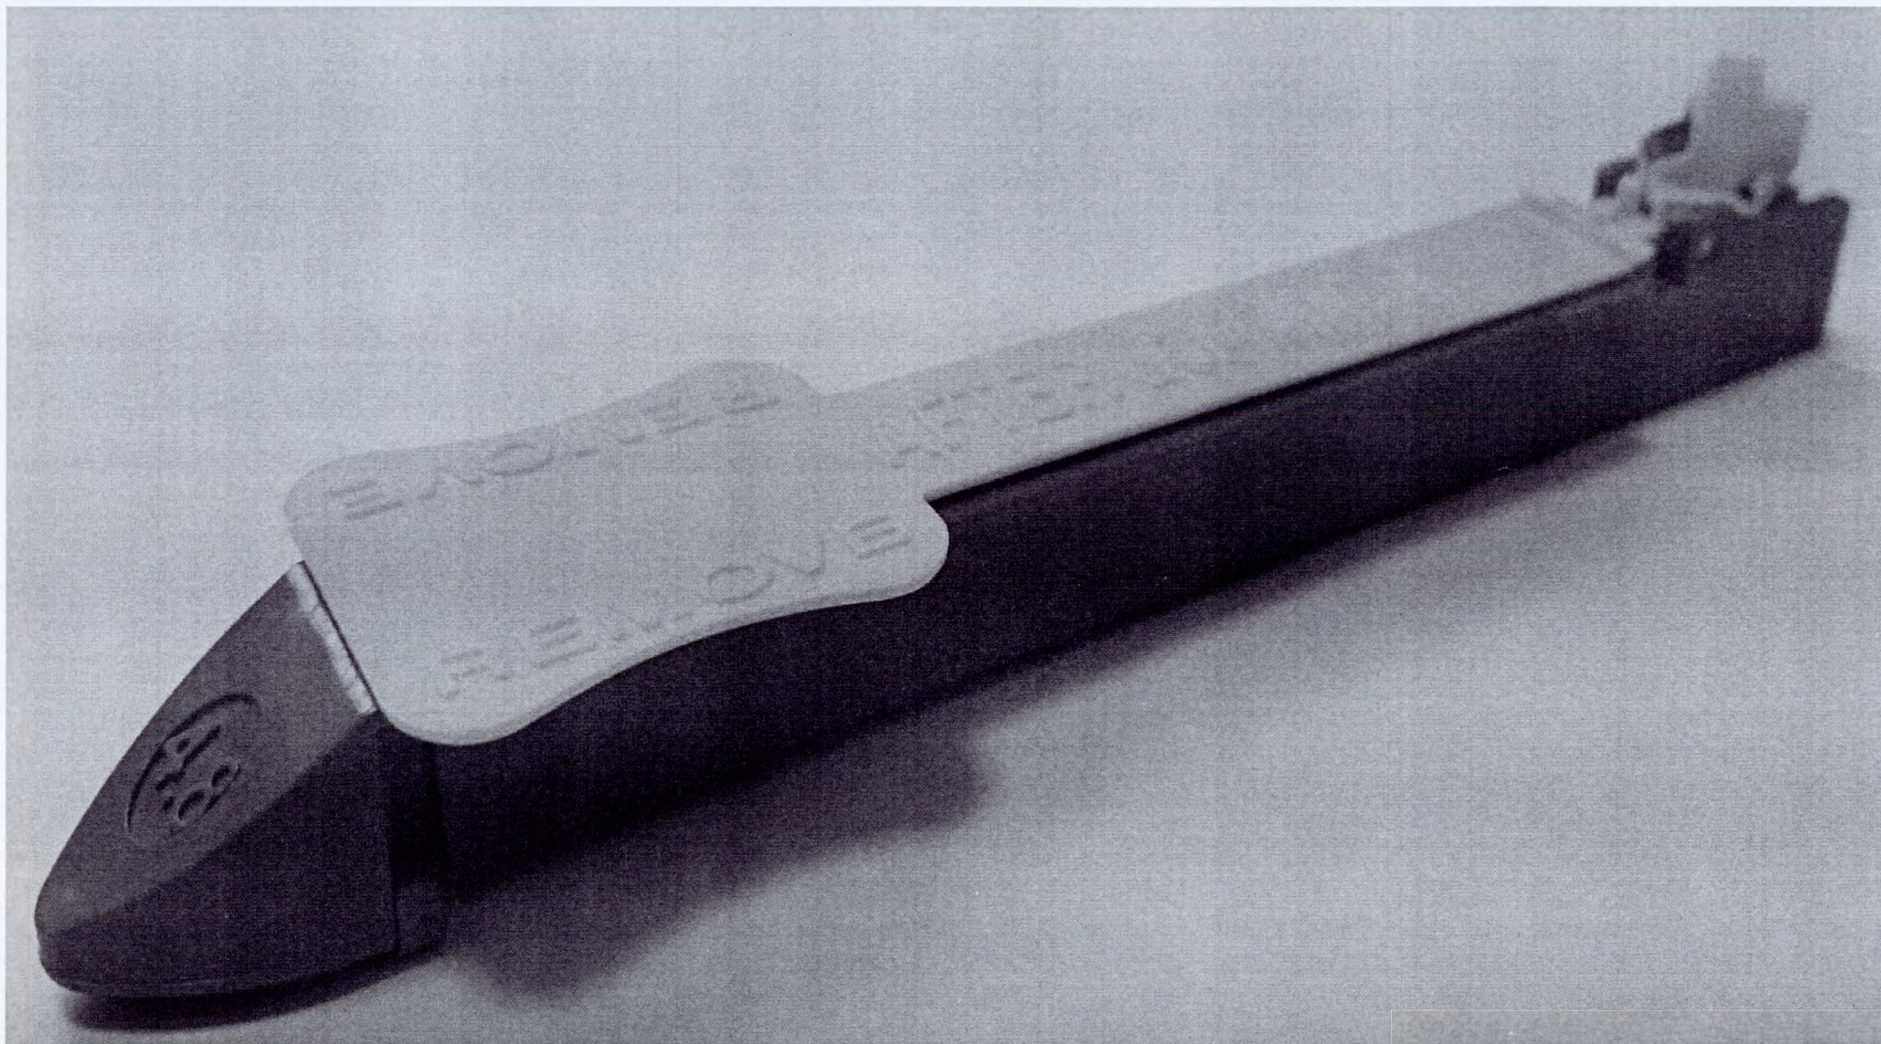

6. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™ 100 мм – 3,8 мм

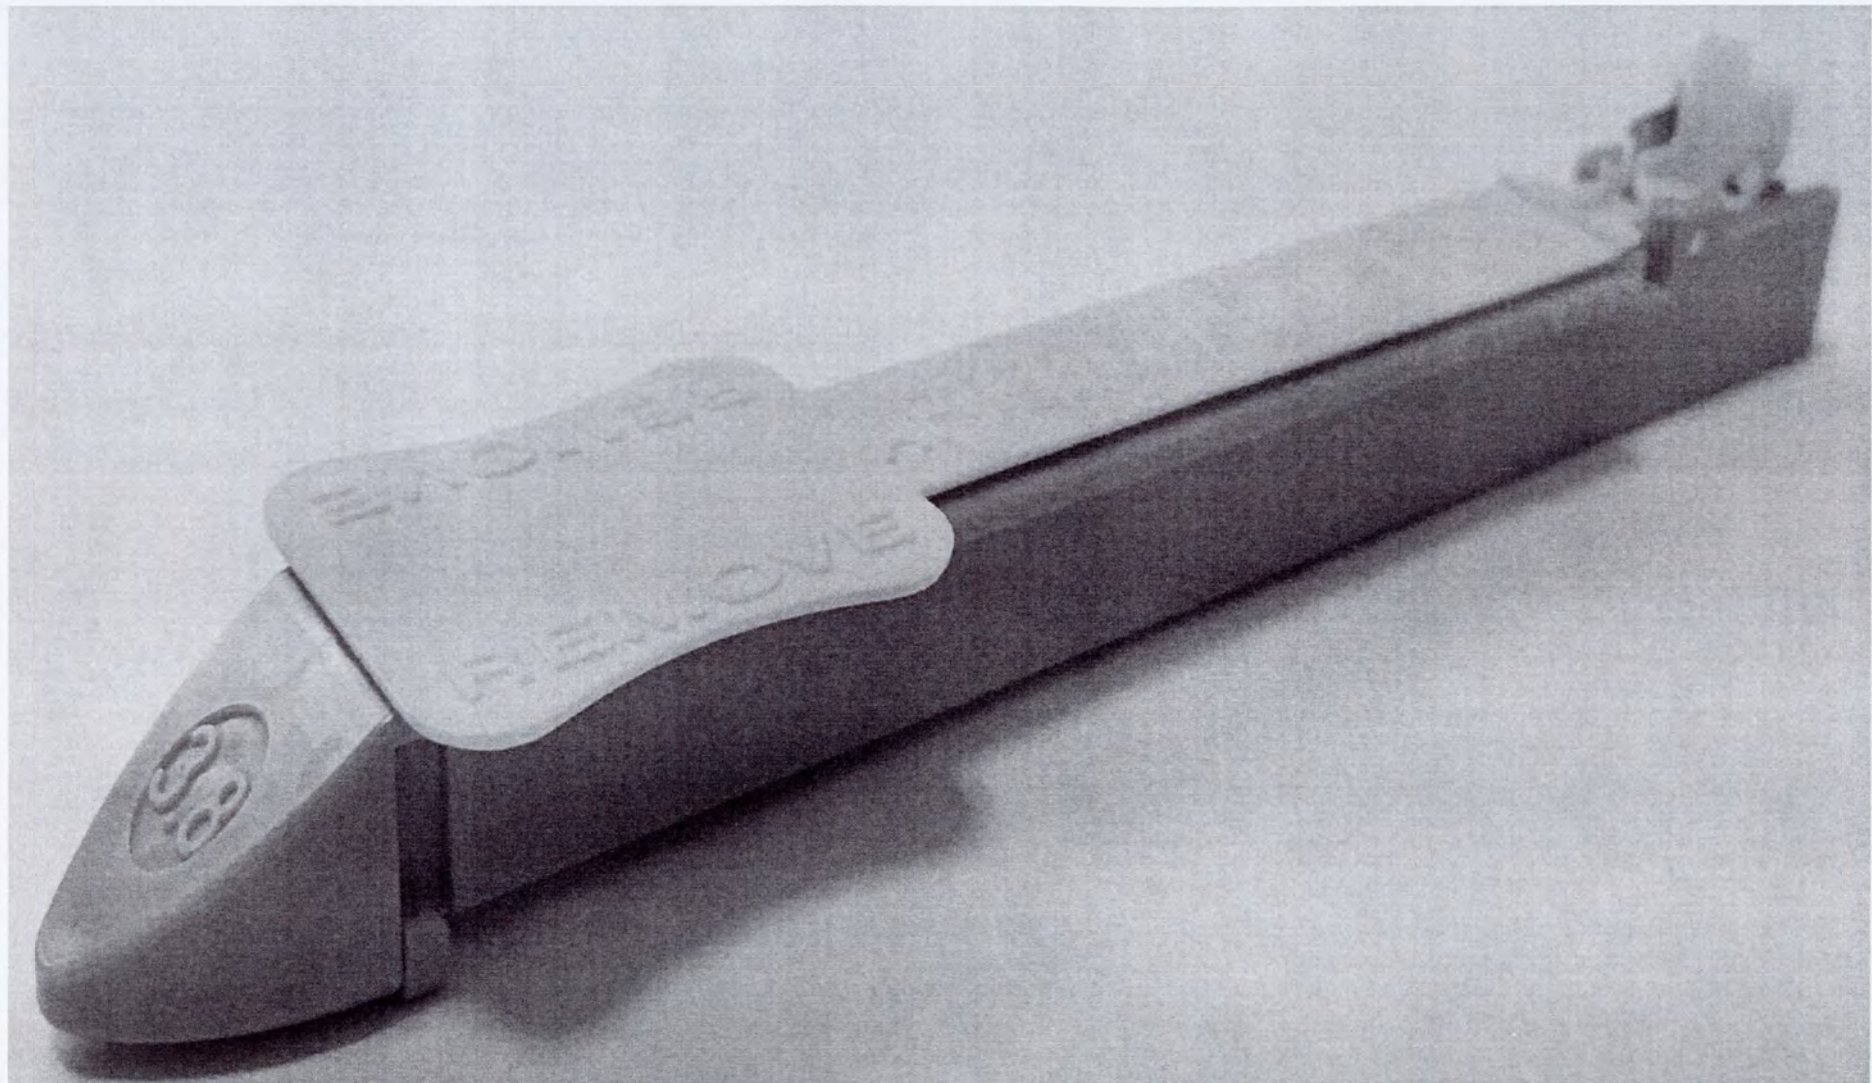

7. Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™ 100 мм – 4,8 мм

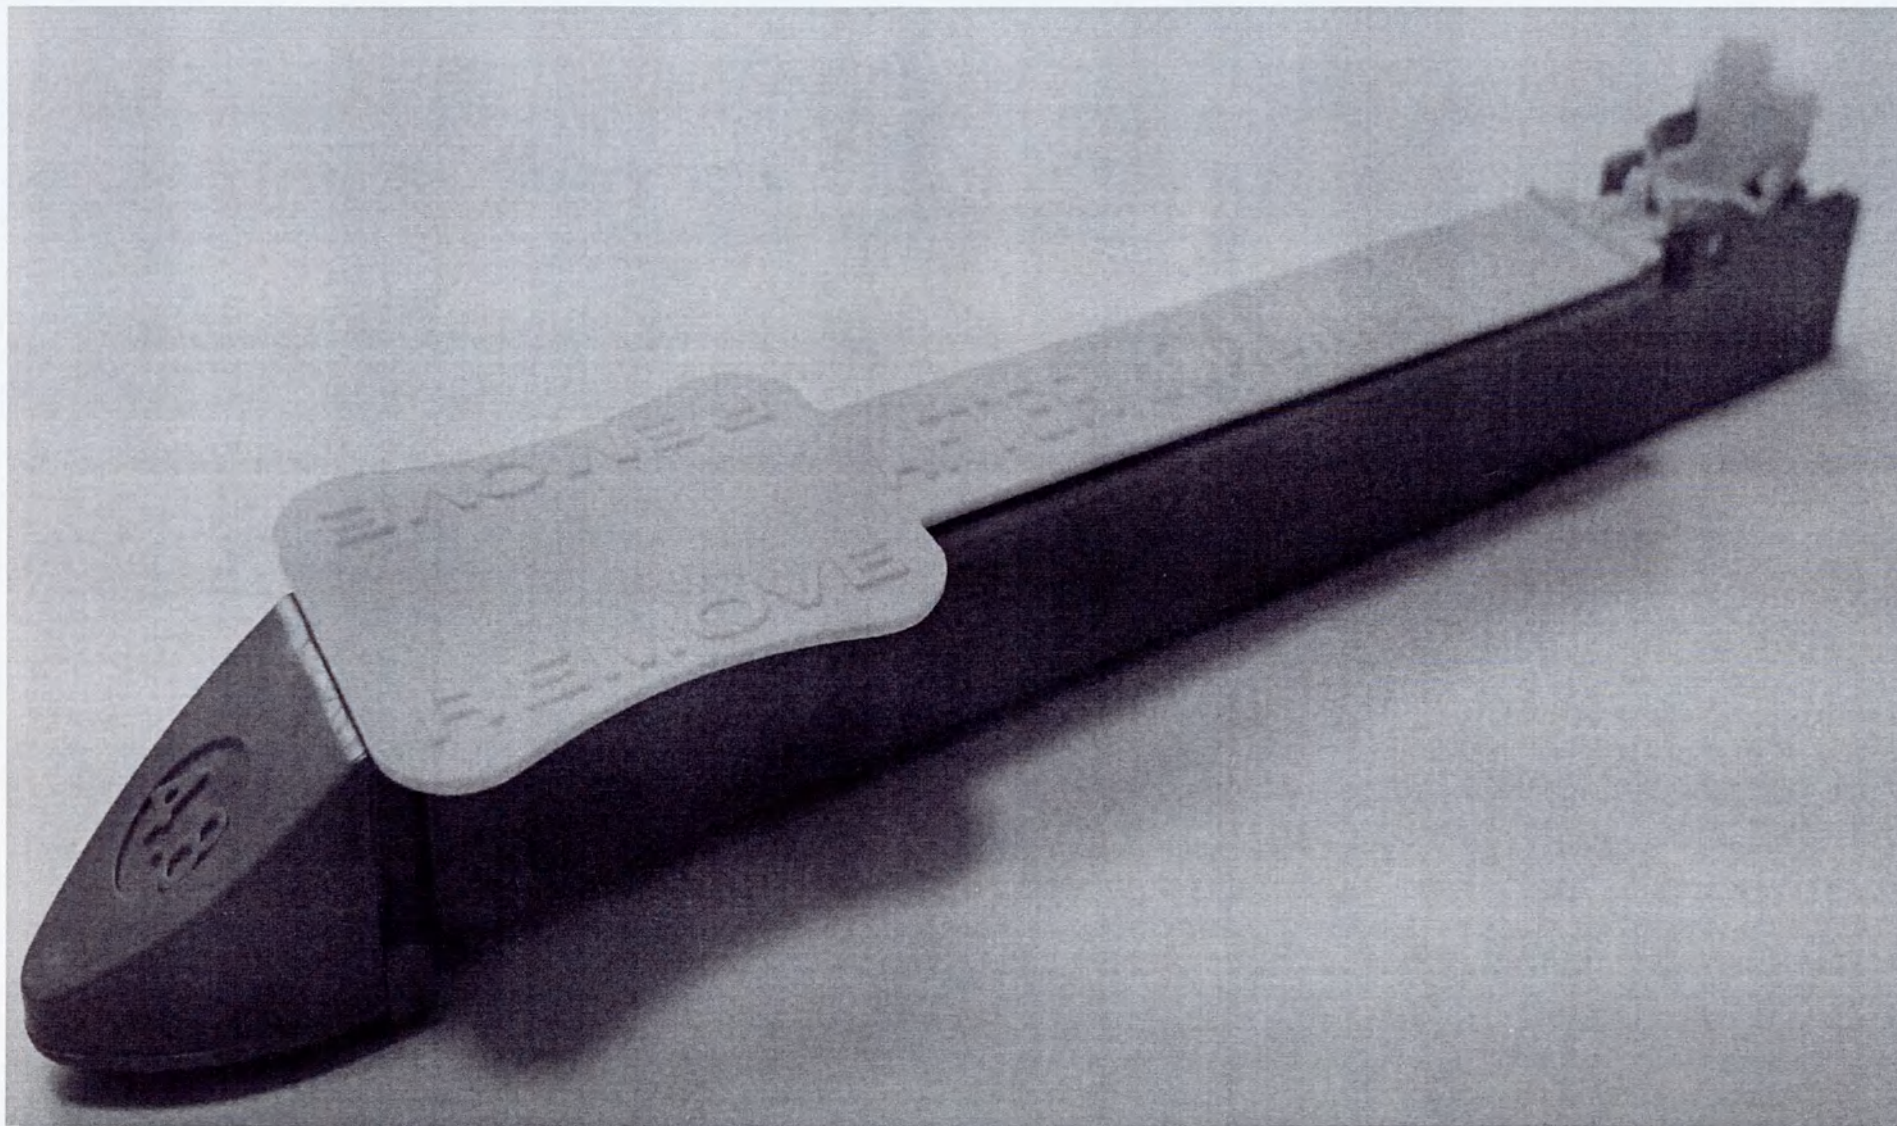



Прошито и пронумеровано
228 8 лист ax
Ген. директор

Ген.