
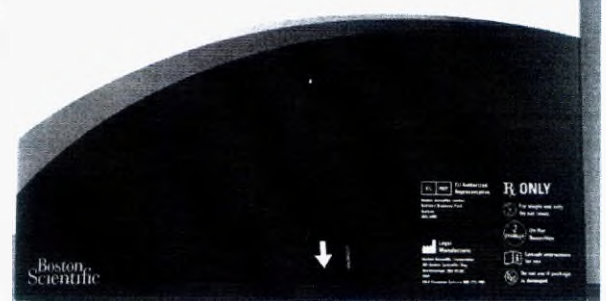
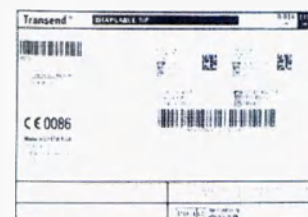
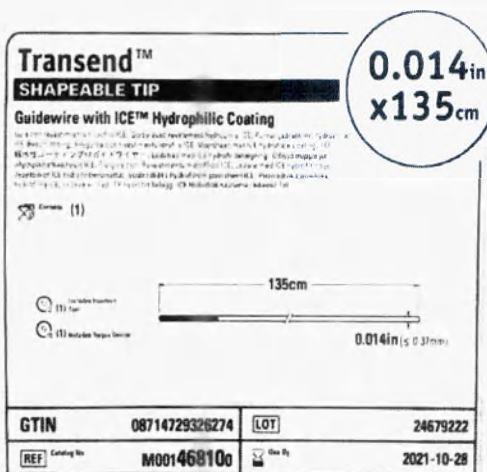


Результат АУ, В. Родина
27-го апреля 2020 г.

- 1. Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием (СТ, номинальным диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм), длиной 135 см в составе:
 - проводник — 1 шт.
 - устройство для вращаения — 1 шт.
 - инструмент для введения — 1 шт.
 - инструкция по применению — 1 шт.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам,
в вариантах исполнения

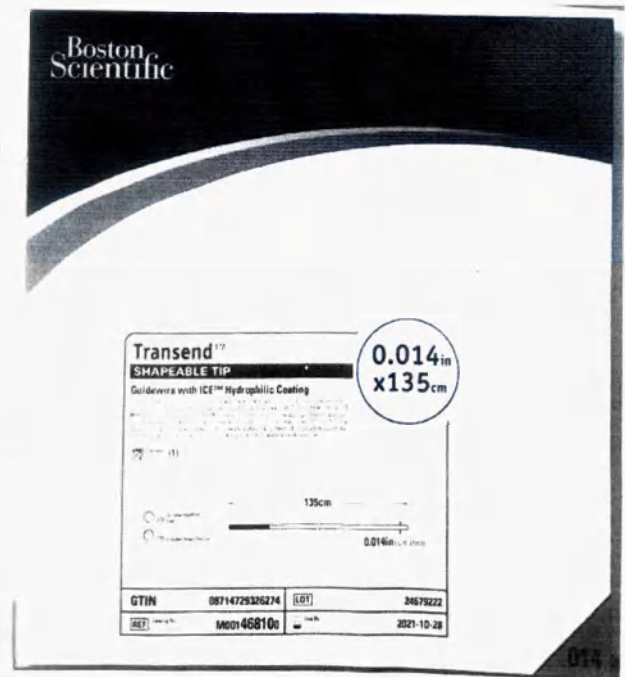




2. Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием ICE, номинальным диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм), длиной 190 см в составе:

- проводник - 1 шт.
- устройство для вращения - 1 шт.
- инструмент для введения - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.



13

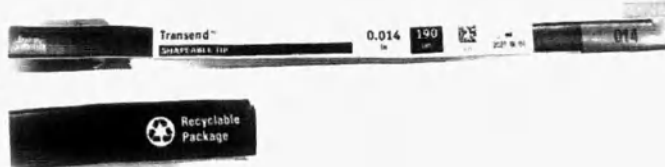

14

51



16



17




This product may be protected by one or more patents. Patent information can be found at www.boston-scientific.com.



19



инструмент для измерения 1 шт.
инструмент для измерения 1 шт.
инструмент для измерения 1 шт.


инструмент для измерения 1 шт.
инструмент для измерения 1 шт.
инструмент для измерения 1 шт.

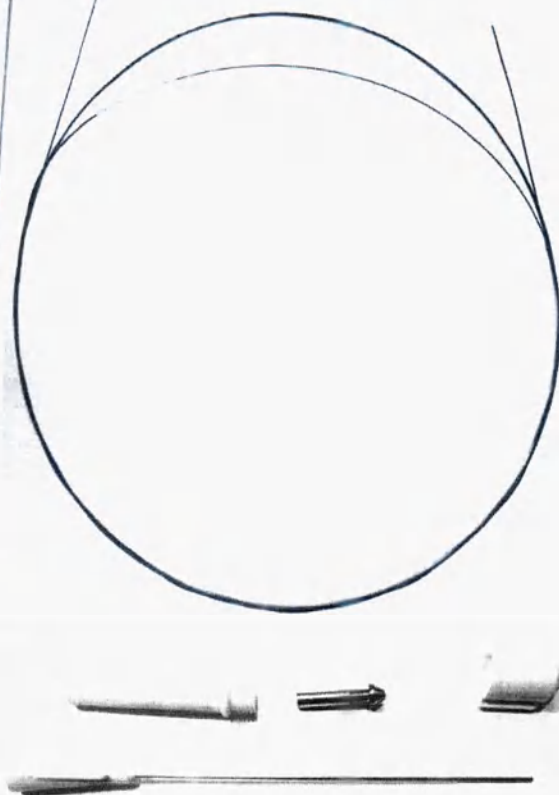

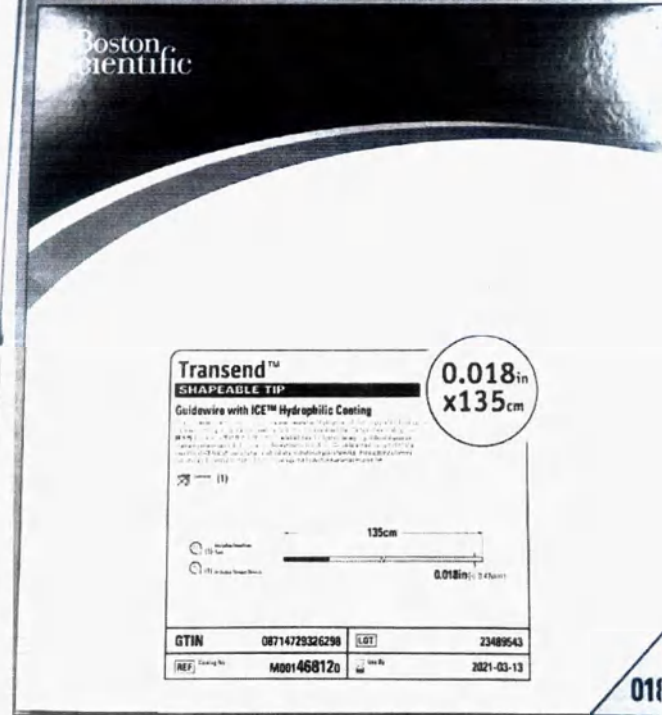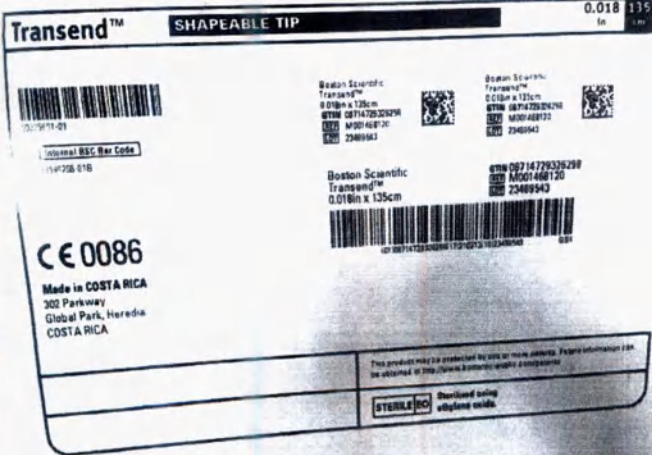

25



26

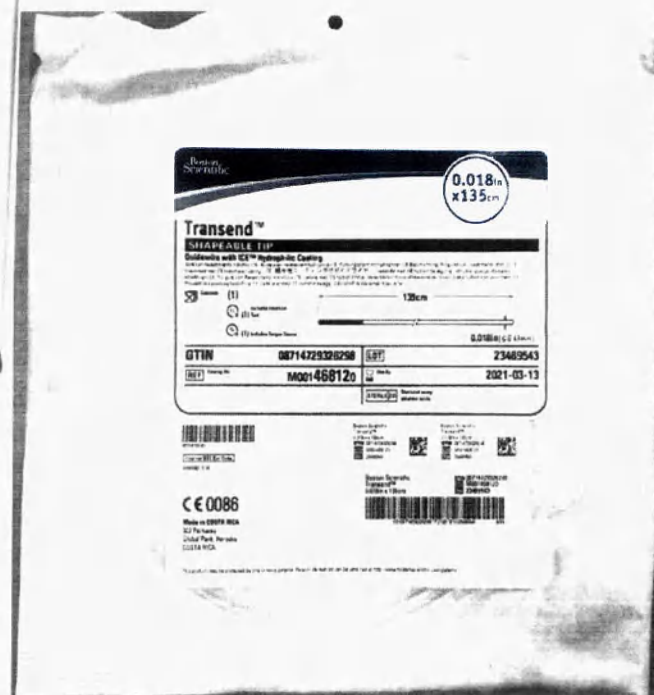


27

28


- 4 Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием ICE, доминирующим диаметром 0.018 дюйма (0,46 мм), длиной 165 см в составе:
- проводник - 1 шт.
 - устройство для вращения - 1 шт.
 - инструмент для введения - 1 шт.
 - инструкция по применению - 1 шт.

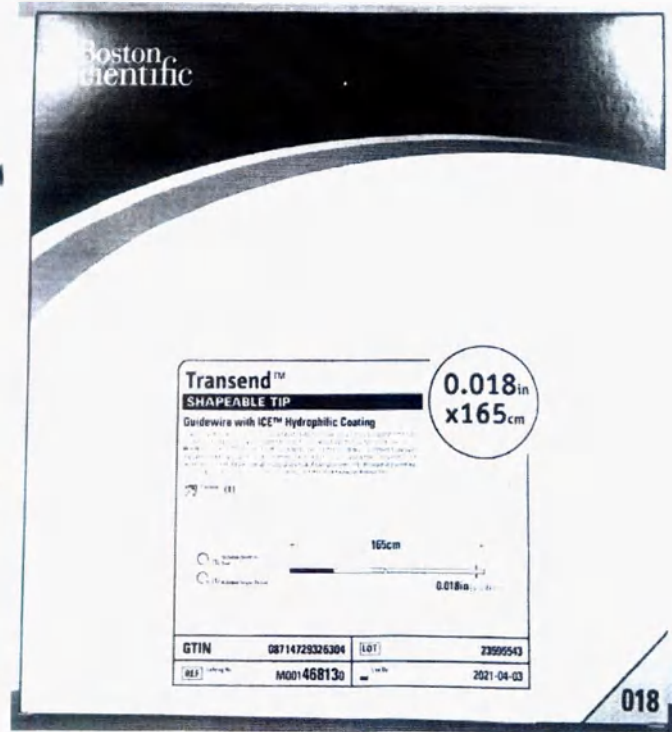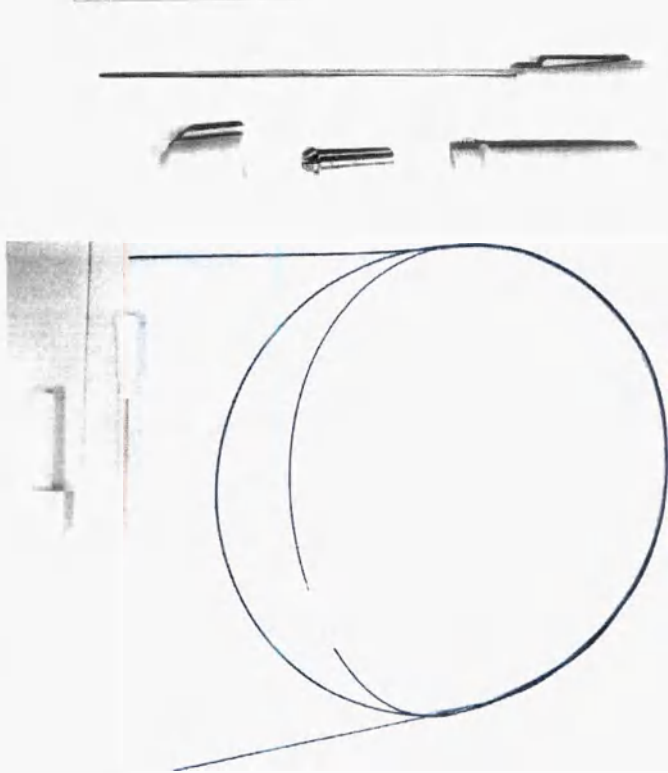

34

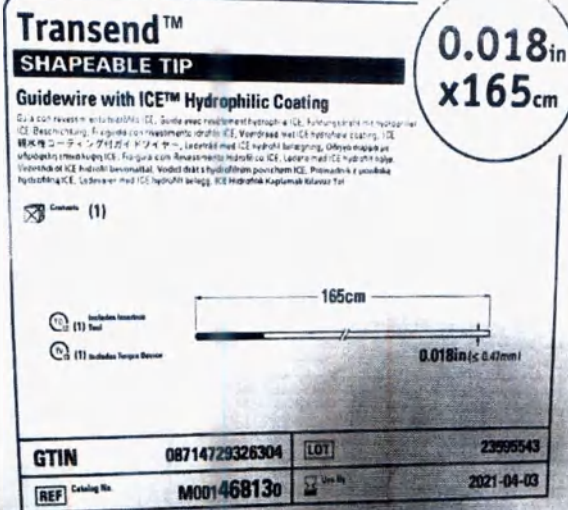


35

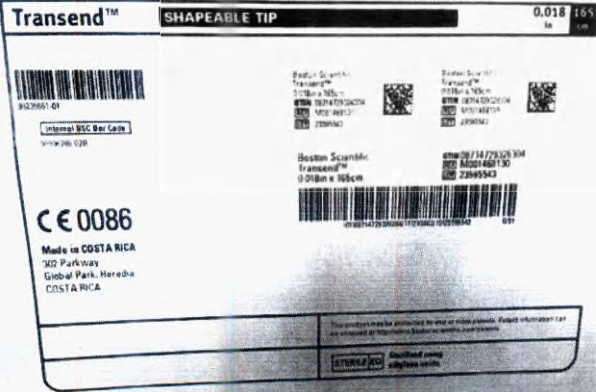

37

38

39


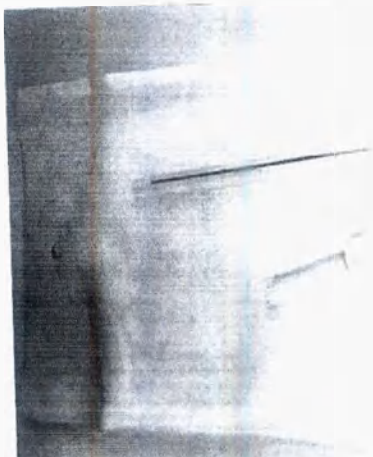


40



二

35

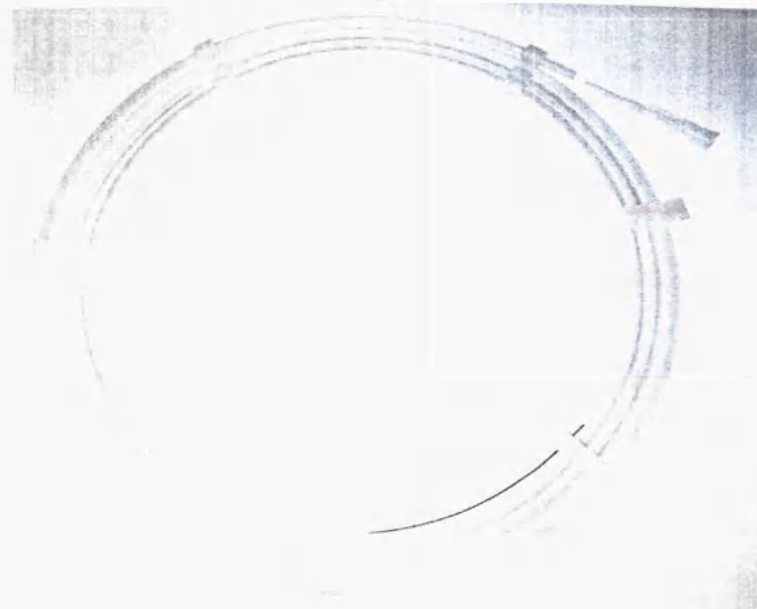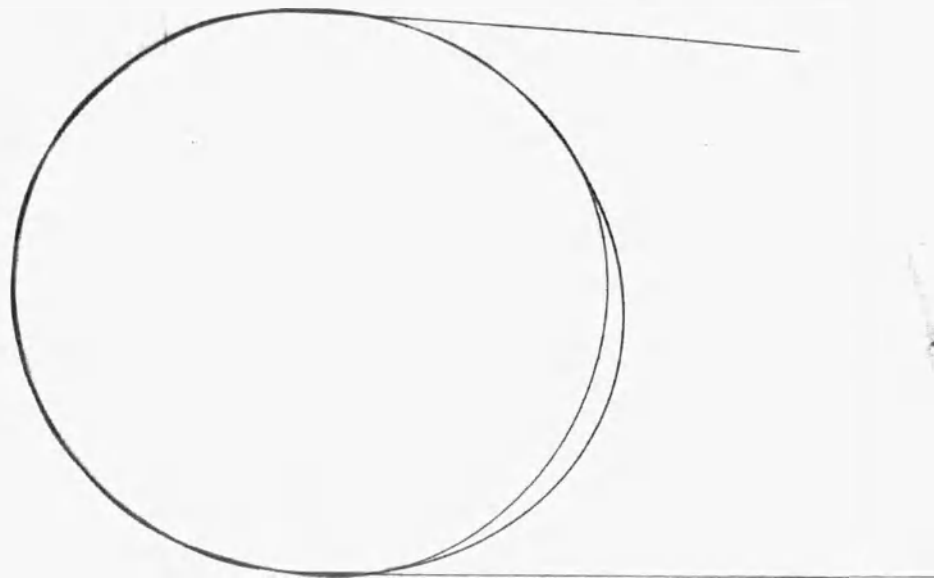

Макеты русскоязычных лейблов для медицинского изделия Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам, в вариантах исполнения

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам, в вариантах исполнения

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием ICE, номинальным диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм), длиной 135 см в составе:

- проводник - 1 шт.
- устройство для вращения - 1 шт.
- инструмент для введения - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение От:

№
Только для одноразового использования
Стерильно

Апирогенно
Не токсично

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.
Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по

45

применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.
Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.
Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам, в вариантах исполнения

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием ICE, номинальным диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм), длиной 165 см в составе:

- проводник - 1 шт.
- устройство для вращения - 1 шт.
- инструмент для введения - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение От:

№
Только для одноразового использования
Стерильно

Апирогенно
Не токсично

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.
Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам, в вариантах исполнения

46

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием ICE, номинальным диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм), длиной 190 см в составе:

- проводник - 1 шт.
- устройство для вращения - 1 шт.
- инструмент для введения - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение От:

№
Только для одноразового использования
Стерильно

Апирогенно
Не токсично

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.
Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

47

Регистрационное удостоверение От:

№
Только для одноразового использования
Стерильно

Апирогенно
Не токсично

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.
Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам, в вариантах исполнения

Проводник Transend для доступа к периферическим сосудам с гидрофильным покрытием ICE, номинальным диаметром 0,018 дюйма (0,46 мм), длиной 165 см в составе:

- проводник - 1 шт.
- устройство для вращения - 1 шт.
- инструмент для введения - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение От:

№
Только для одноразового использования
Стерильно

Апирогенно
Не токсично

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

48

40

1. 1. 2023 г.
1. 1. 2023 г.
1. 1. 2023 г.
1. 1. 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

Инструкция по исполнению для всех работников в соответствии с требованиями законодательства.

Перед тем как приступить к выполнению работы, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться, что вы понимаете все требования и правила.

Работать необходимо в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты.

Если вы обнаружили нарушение правил или безопасности, немедленно сообщите об этом своему руководителю.

Инструкция разработана в соответствии с требованиями законодательства и является обязательной для всех работников.

Информация о безопасности и охране труда доступна на сайте компании.

Информация о безопасности и охране труда доступна на сайте компании.