

Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Sirolimus CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru


Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld. 3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

бор калибраторов для количественного определения сиролимуса
иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Sirolimus CalSet Elecsys and
cobas e analyzers) (общий вид)

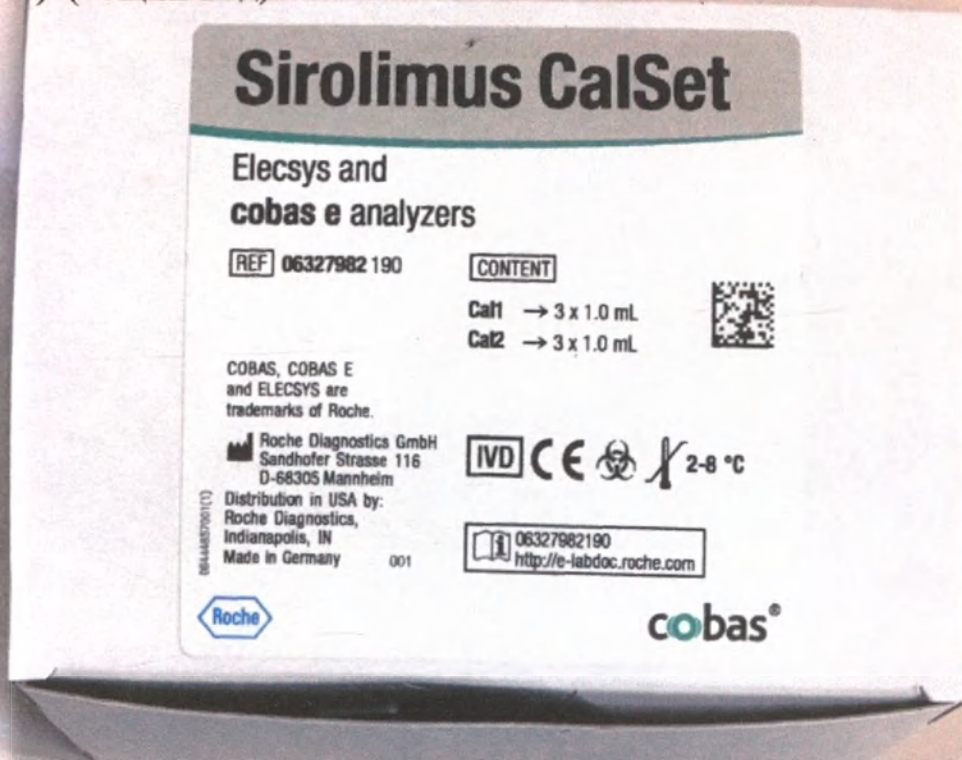

Набор калибраторов для количественного определения сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Sirolimus CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

«Набор калибраторов для количественного определения сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Sirolimus CalSet Elecsys and cobas e analyzers) Состав:

1. Калибратор 1 (SRL Cal1), низкий уровень концентрации, флакон объем 1,0 мл (3 шт.)
2. Калибратор 2 (SRL Cal2), высокий уровень концентрации, флакон объем 1,0 мл (3 шт.)
3. Этикетка со штрих-кодом (20 шт.)
4. Карта со штрих-кодом
5. Лист со штрих-кодом
6. Инструкция по применению»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке
Дату производства см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке .

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"),

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64


E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат. номер 06327982190

Набор калибраторов для количественного определения сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Sirolimus CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

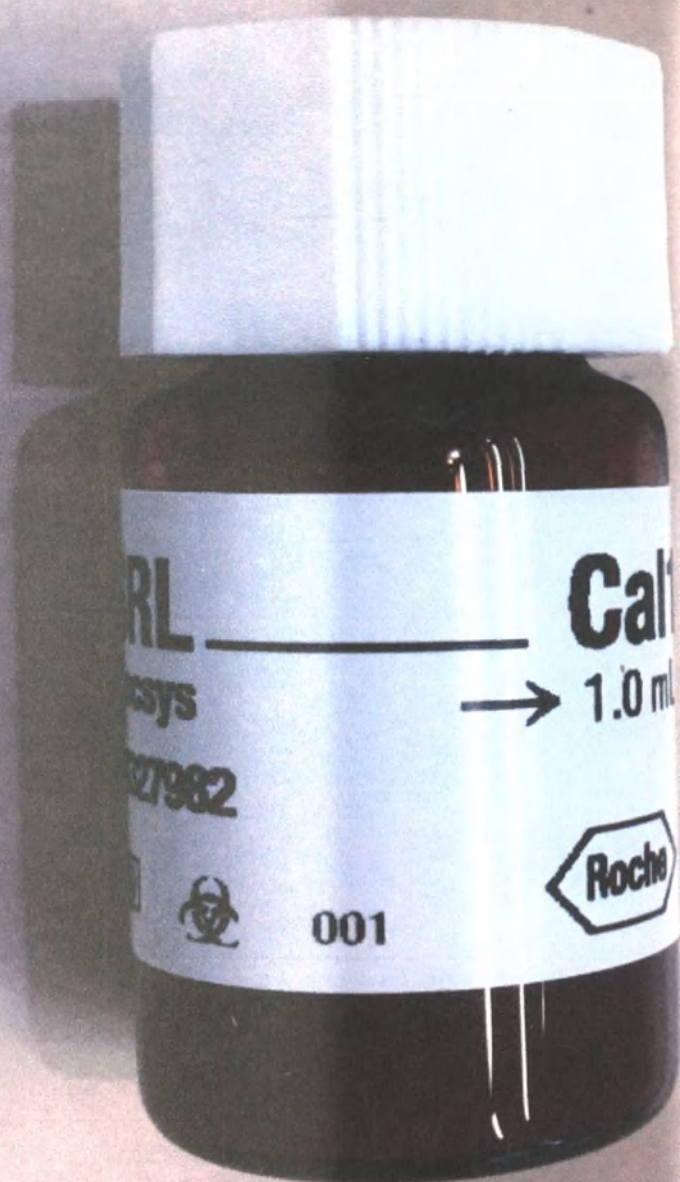

Набор калибраторов для количественного определения сиролимуса
иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Sirolimus CalSet Elecsys
and cobas e analyzers)

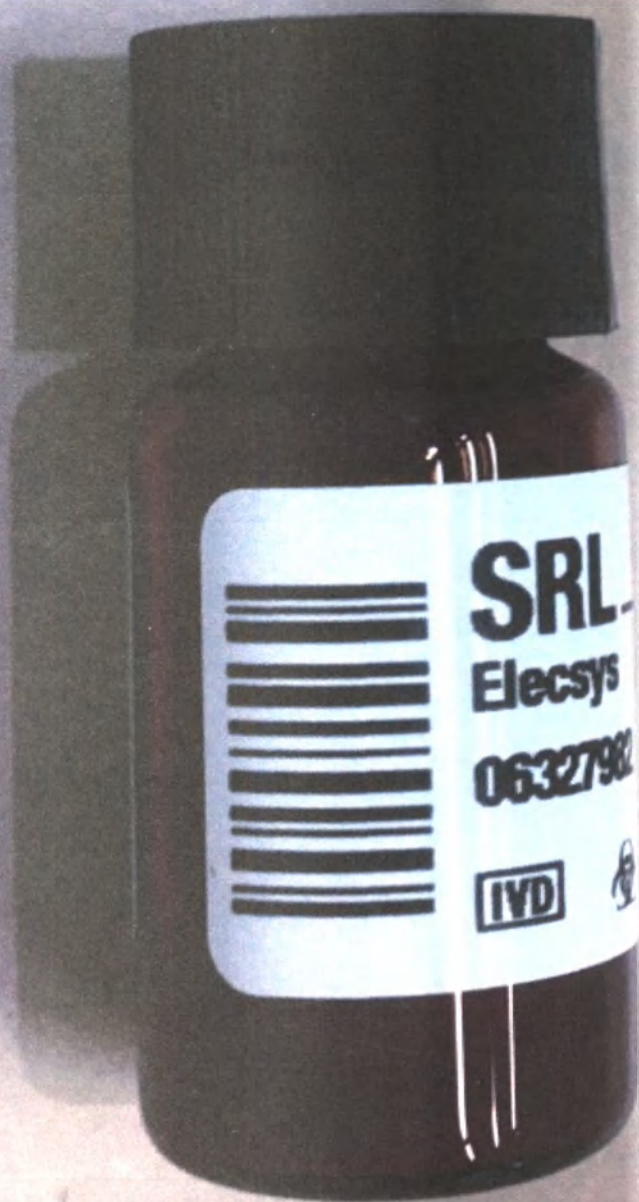

Пучина М. А.
Руководитель отдела
и качества по доверенности
02 июля 2018



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
5 листа (ов)