




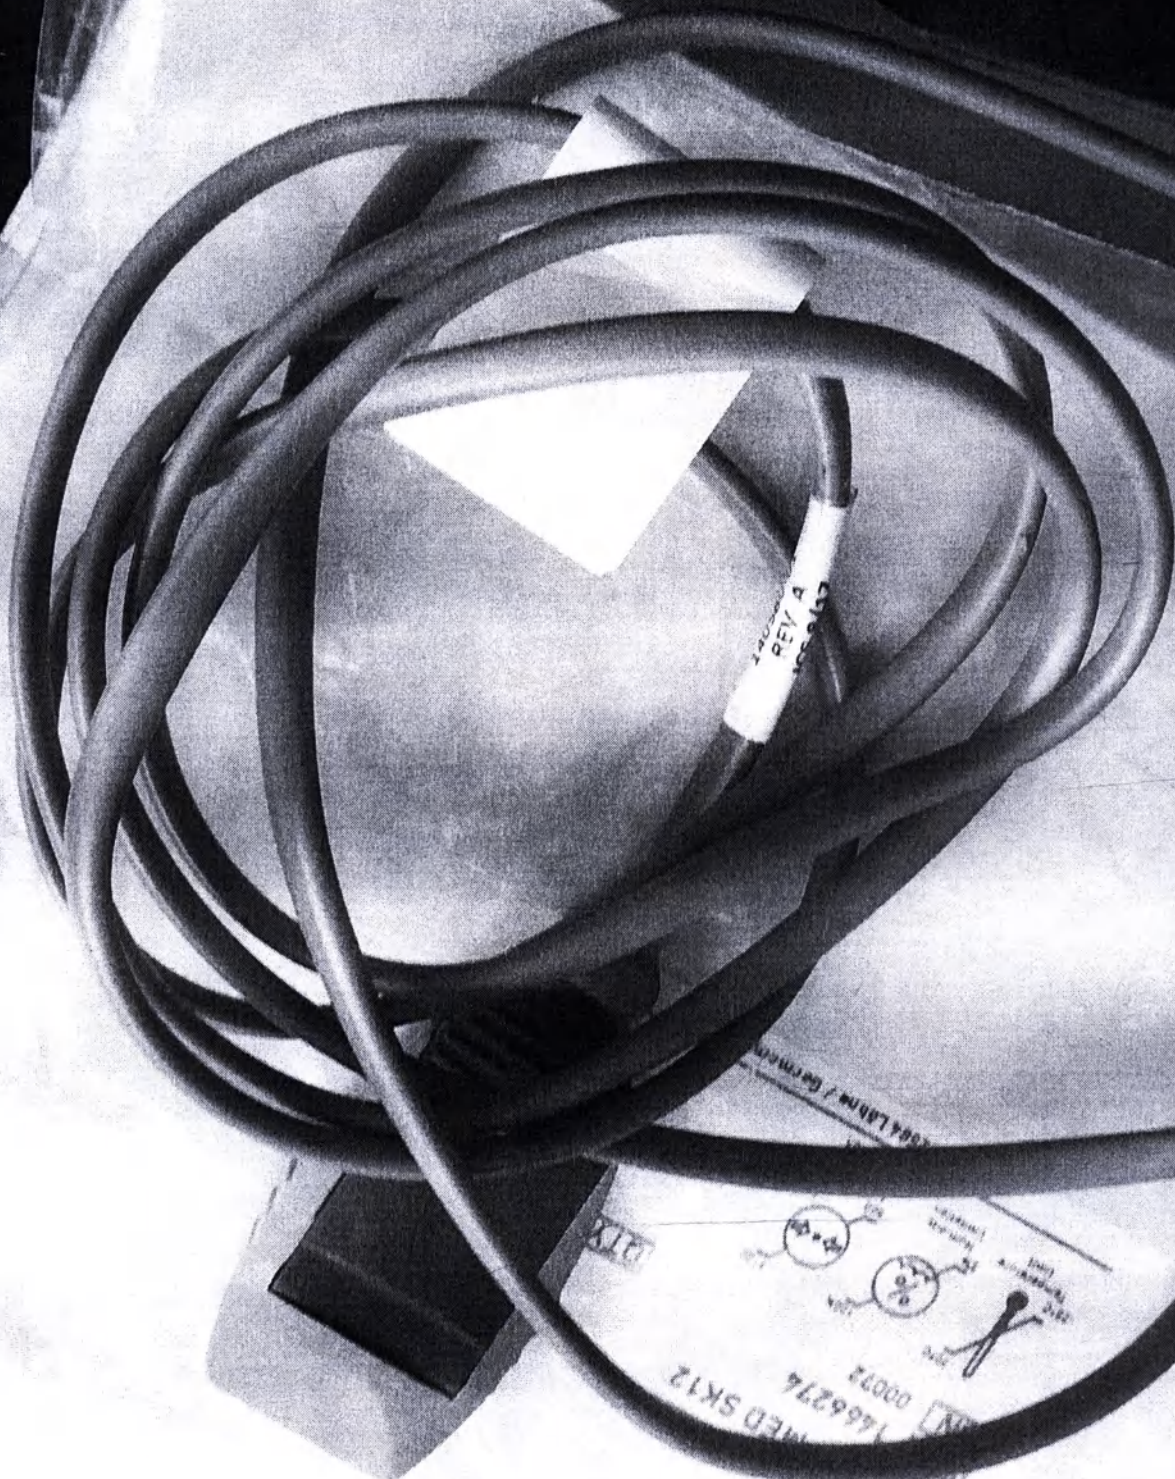

Терапевтический наконечник Viveve, 8см модель VIVTT09

для Аппарата терапевтического - генератора VIVEVE 2.0

PY №

Производитель: «Вивив Инк.» («Viveve Inc.»)

345, Инвернесс Драйв Юг, Здание Б, оф.250, г. Энглвуд, 80112 США(345, Inverness Drive South Building B, South 250 Englewood 80112 USA)

Партия № WJ00001330.

Количество в упаковке: 6 шт.

Дата производства – 09.2018

Использовать до – 09.2021

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 20%-80%

Транспортировать при температуре от 0 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха 20%-80%

REF

VIVTT09



viveve 2.0

Treatment Tip

Терапевтический наконечник Viveve, 5см модель VIVTT08

для Аппарата терапевтического - генератора VIVEVE 2.0

STERILE EO



РУ № _____

Производитель: «Вивив Инк.» («Viveve Inc.»)

345, Инвернесс Драйв Юг, Здание Б, оф.250, г. Энглвуд, 80112 США (345, Inverness Drive South Building B, South 250 Englewood 80112 USA)

Партия № WJ00001231,

Количество в упаковке: 6 шт.


Дата производства – 06.2018

Использовать до – 06.2021

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 20%-80%
Транспортировать при температуре от 0 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха 20%-80%

REF

VIVTT08






M



30



Терапевтический наконечник Viveve, 8см модель VIVTT09

для Аппарата терапевтического - генератора VIVEVE 2.0

REF

VIVTT09,

Партия № WJ00001330

Дата производства -- 09.2018

Использовать до -- 09.2021


STERILE

EO



Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

Гавриленко А.В.

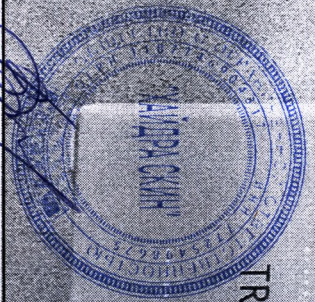

Терапевтический наконечник Viveve, 5см модель VIVTT08

для Аппарата терапевтического - генератора VIVEVE 2.0

STERILE EO 2 

ПУ № _____


Производитель: «Вивив Инк.» («Viveve Inc.»)
345, Инвернесс Драйв Юг, Здание Б, оф.250, г. Энглвуд, 80112 США(345, Inverness Drive South Building B, South 250 Englewood 80112 USA)

Партия № WJ00001231, Количество в упаковке: 6 шт.

Дата производства – 06.2018, Использовать до – 06.2021

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 20%-80%
Транспортировать при температуре от 0 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха 20%-80%

REF VIVTT08



VIVEVE.

TREATMENT TIP

5 cm

Контактная жидкость Viveve, модель VIVCF01, 30 мл

для Аппарата терапевтического - генератора VIVEVE 2.0

REF

VIVCF01,

Партия № _____

Дата производства -- мес, год


Использовать до -- мес, год



viveve®
COUPLING FLUID


30 ml / LBL-154 D



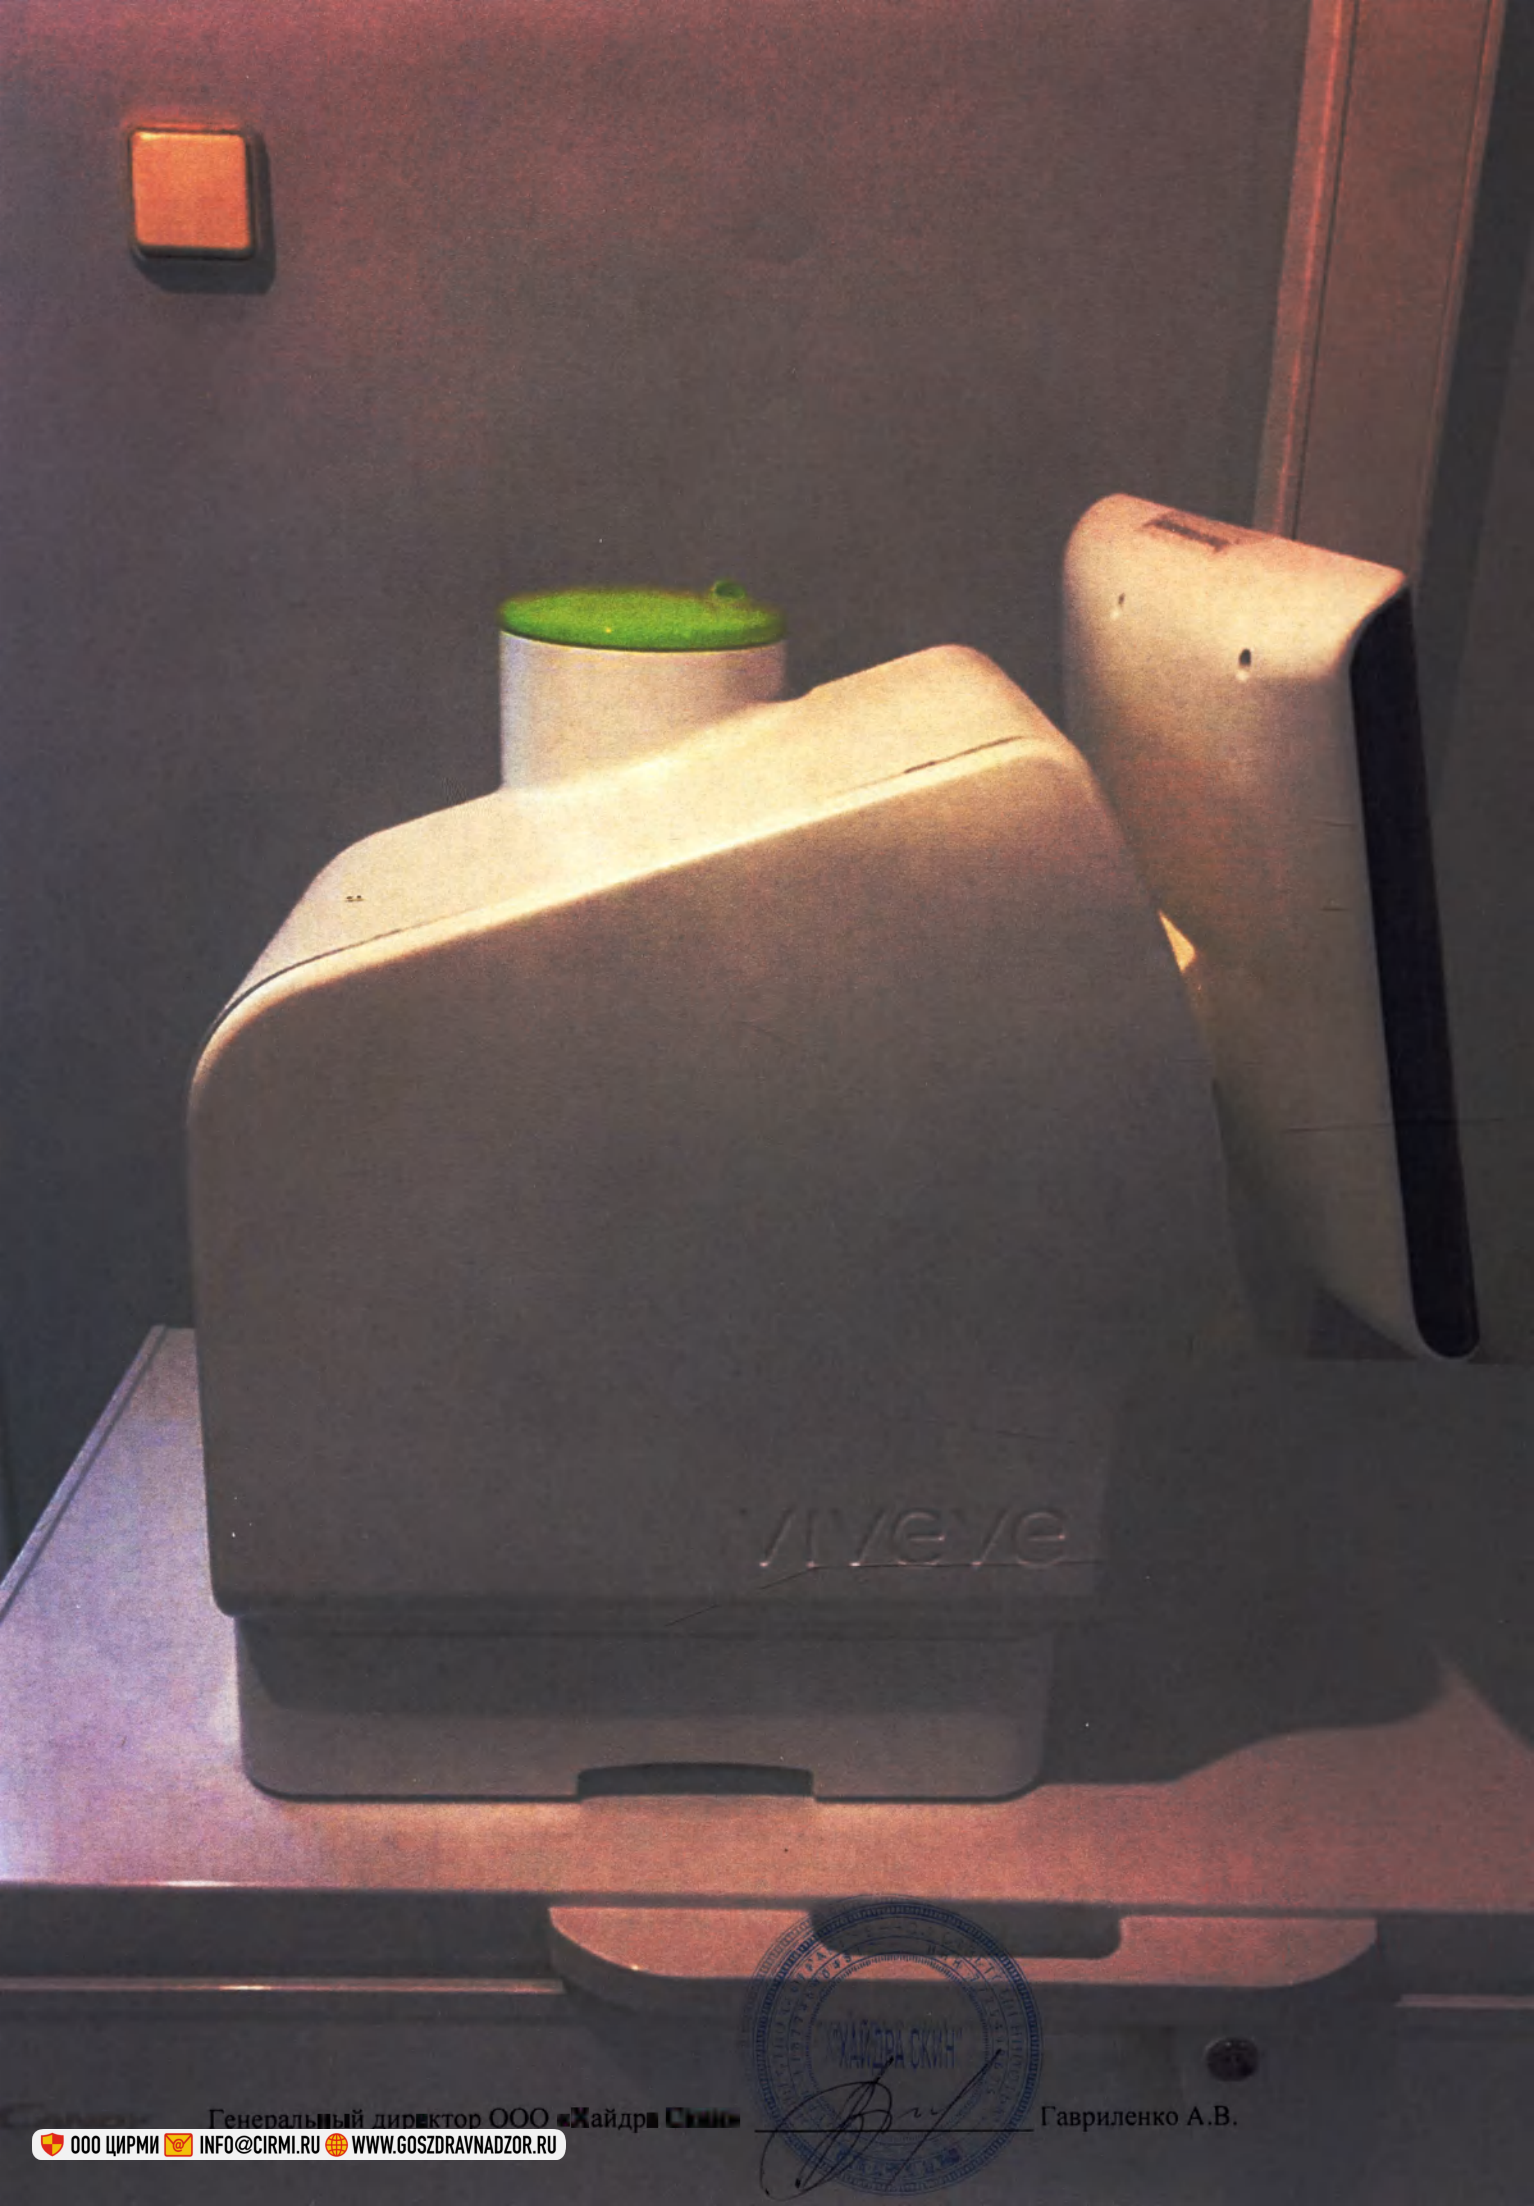

Генеральный директор ООО «Хайдр» 

Гавриленко А.В.


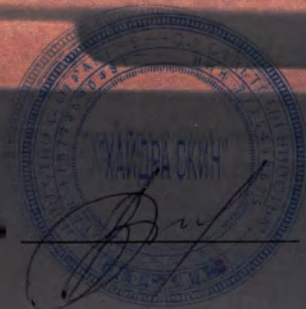





Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

Гавриленко А.В.



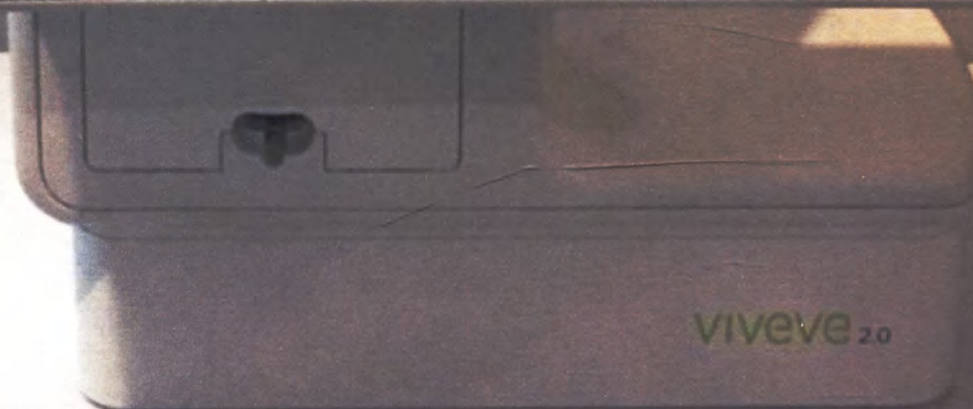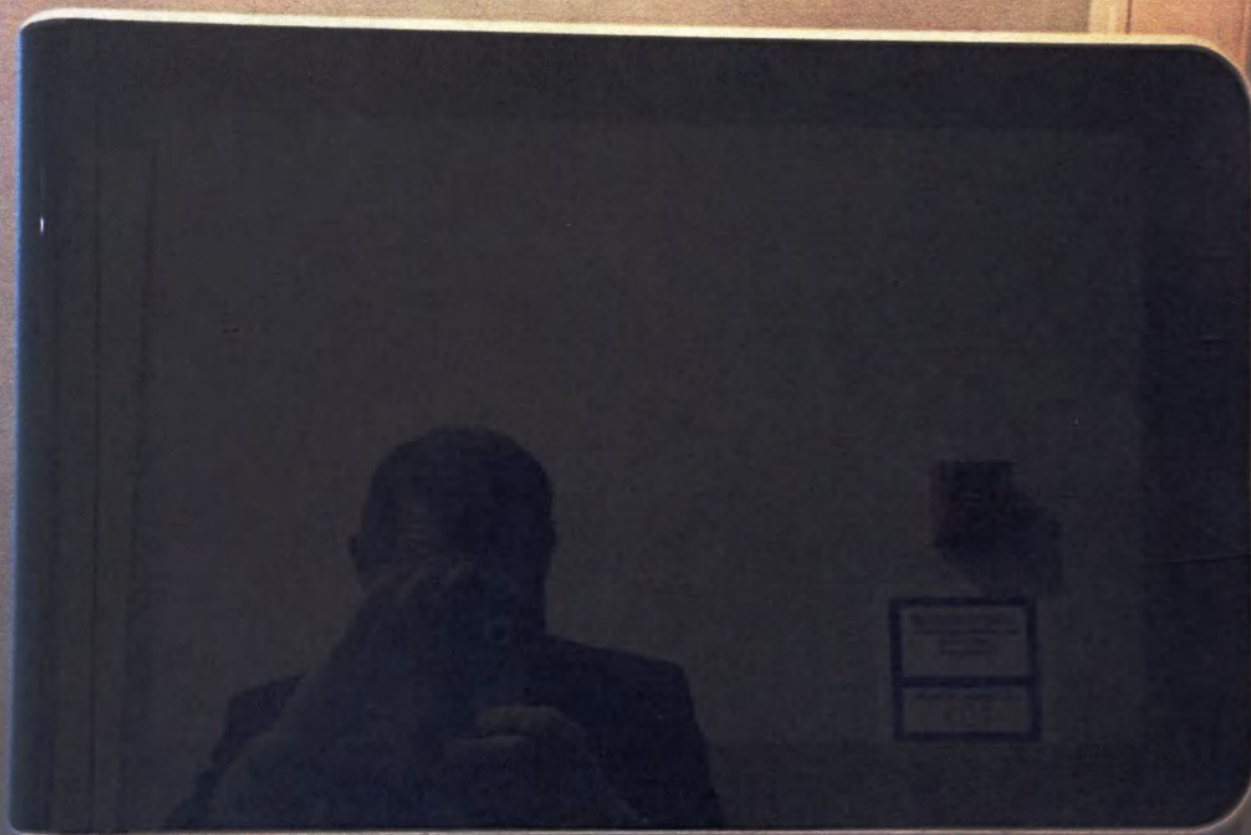

viveve 2.0

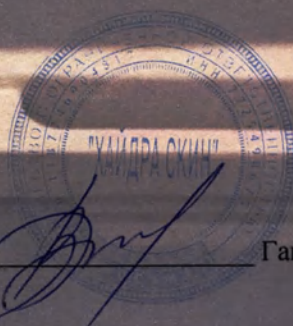

Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

Гавриленко А.В.



Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»





Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

Handwritten signature of A.V. Gavrilenko


Гавриленко А.В.



Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

ООО ЦРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

Гавриленко А.В.

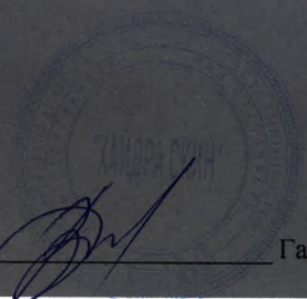


Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

Гавриленко А.В.



Генеральный директор ООО «Хайдра Скин»

Гавриленко А.В.

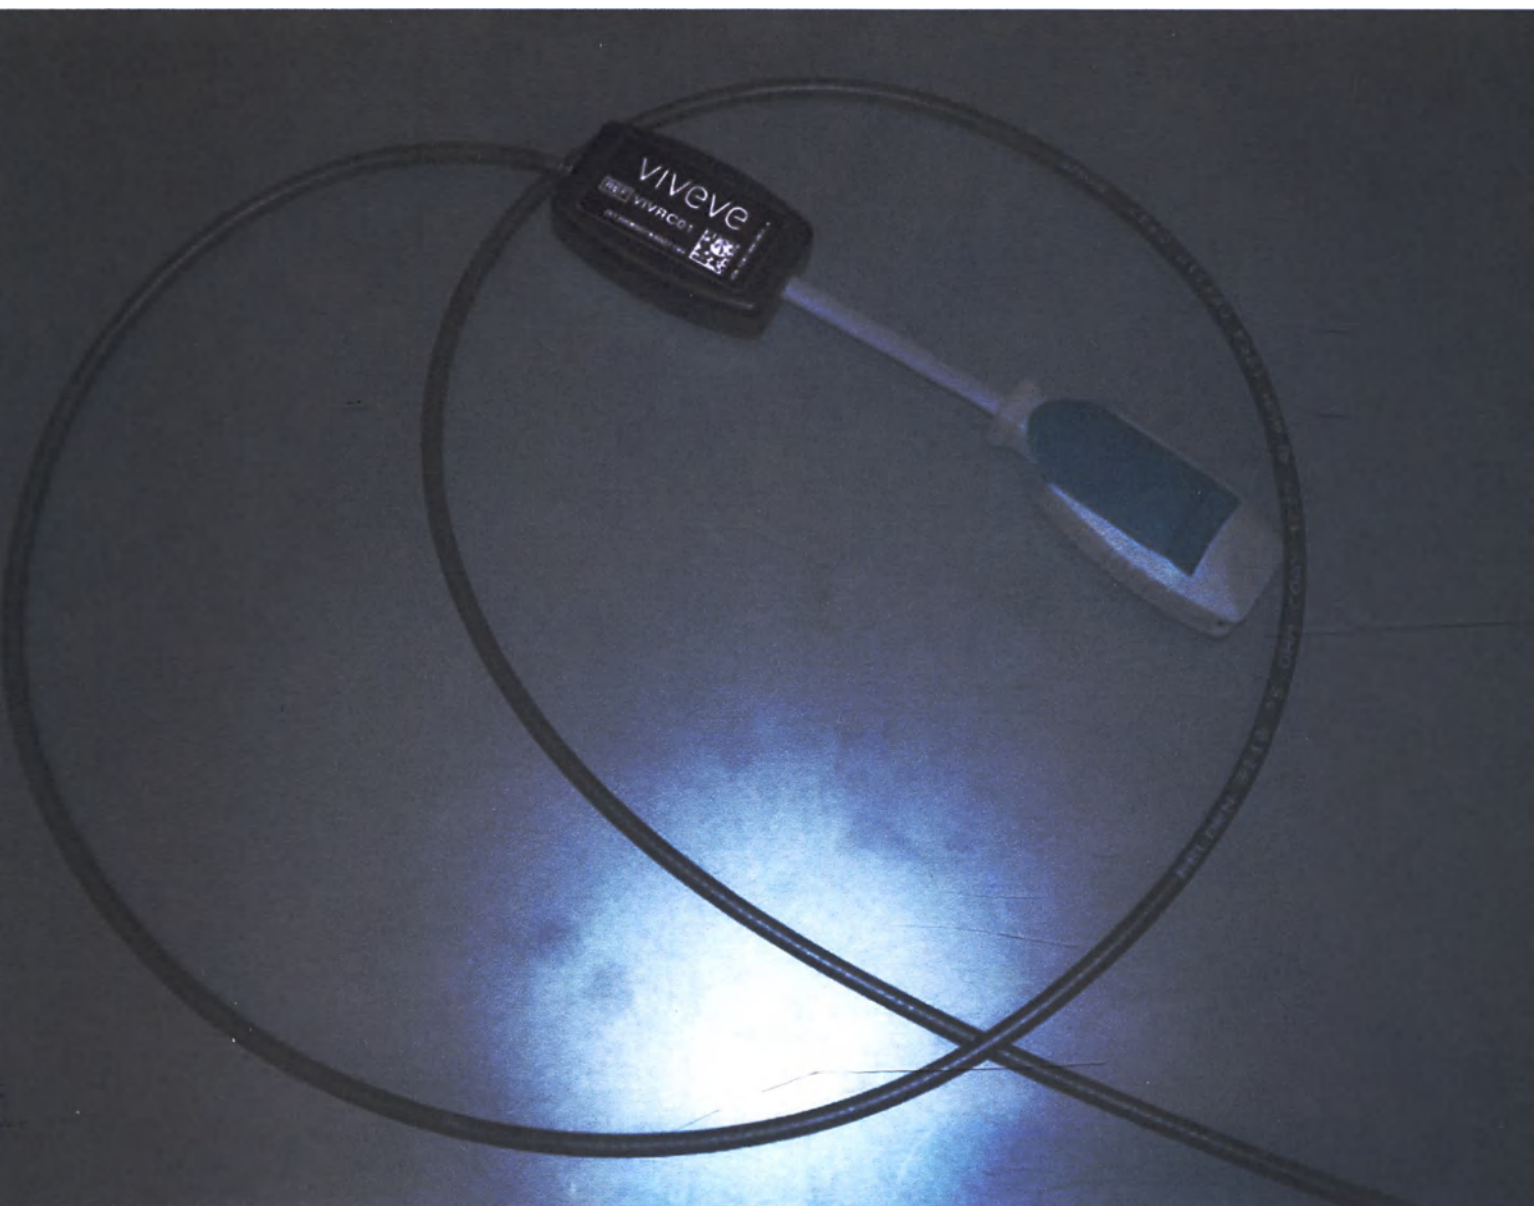







Контактная жидкость для ультразвуковой терапии VIVCF01, 30 мл

для Аппарата терапевтического - генератора VIVEVE

РУ

Производитель: «Виве Инк.» («Viveve Inc.»)

345, Inverness Drive Юг, Здание В, оф 250, г. Энглевуд, 80112 США (345, Inverness Drive South Building B, South 250 Englewood 80112 USA)

Дата производства — мес, год

Использовать до — мес, год

Объем: 30 мл.

Количество в упаковке: 6 шт.

Хранить при температуре от +5 °C до +40 °C, относительной влажности воздуха 20%-80%

Транспортировать при температуре от 0 °C до +50 °C, относительной влажности воздуха 20%-80%

REF

VIVCF01,

Партия №





viveve

COUPLING FLUID

6 30 ml

REF

VIVCF01



viveve®

Made in the U.S.A.

