



Электрокардиостимулятор имплантируемый
частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
и отвёртка тарированная.



Электрокардиостимулятор имплантируемый
частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.



Отвёртка тарированная
в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.

ЭКС-560А-SR

SN 00222

06.03.2018

06.03.2020

IS-1 BI

БНПК.941514.001ТУ IPX7

5°C - 40°C

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ
ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR
ПО БНПК.941514.001ТУ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ: электрокардиостимулятор,
отвертка тарированная

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ

VI (R)

ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ

60 имп/мин

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

P

1,5 мВ

R

4,2 мВ


АМПЛИТУДА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СТИМУЛЯЦИИ

3,0 В; 0,4 мс


Открытие стерильной упаковки



1. Вскрыть контейнер.
2. Вынуть пакет с электрокардиостимулятором и отверткой.



3. Вскрыть наружный пакет с электрокардиостимулятором, не касаясь при этом поверхности внутренних пакетов.



5. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренние стерильные пакеты, извлечь из них электрокардиостимулятор и отвертку.

ВНИМАНИЕ! Внутренние стерильные пакеты вскрывать в условиях операционной с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Внутри

Нетоксично

STERILE EO



РУ № ФСР

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

Место производства
117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а

ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО" Россия,
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: info@elestim-cardio.ru
ООО "Биоточка" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 795-36-78 E-mail: biotochka@mail.ru
ООО "НП "Кардиоспектр" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: cardiospectr@mail.ru

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
и отвертка тарированная в общем пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.

ЭКС-560А-SR

SN 00222

06.03.2018

06.03.2020



IS-1 BI

БНПК.941514.001ТУ IPX7

5°C — 40°C

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR ПО БНПК.941514.001ТУ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ: электрокардиостимулятор,
отвертка тарированная

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ


WI (R)

ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ




60 имп/мин

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



P


1,5 мВ



R

4,2 мВ

АМПЛИТУДА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СТИМУЛЯЦИИ



3,0 В; 0,4 мс

Открытие стерильной упаковки



1. Вскрыть контейнер.

2. Вынуть пакет с электрокардиостимулятором и отверткой.



3. Вскрыть наружный пакет с электрокардиостимулятором, не касаясь при этом поверхности внутренних пакетов.

4. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренние стерильные пакеты.



5. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренние стерильные пакеты, извлечь из них электрокардиостимулятор и отвертку.

ВНИМАНИЕ! Внутренние стерильные пакеты вскрывать в условиях операционной с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Внутри

Нетоксично



STERILE

EO

РУ № ФСР



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

Место производства: Днепропетровский пр., д. 4а стр 1а

117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а стр 1а

info@elestim-cardio.ru

117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а стр 1а

biochimash@mail.ru

117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а стр 1а

cardiospt@mail.ru

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR и отвертка тарированная. Этикетка на стерильной упаковке.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560A-SR и отвёртка тарированная в стерильной упаковке в контейнере. Контейнер закрыт.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560A-SR по ДНКБ.941514.005 ТУ и эксплуатационная документация в упаковке для хранения

**ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ
ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR ПО БНПК.941514.001ТУ**

Назначение изделия: ресинхронизирующая терапия и лечение других нарушений ритма сердца путём его электрической стимуляции.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ VVI (R)	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  P 1,5 мВ	ТИП СТИМУЛЯЦИИ/ВОСПРИЯТИЯ МОН/МОН
ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ  60 имп/мин	 R 4,2 мВ	ПОИСК СОБСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ВЫКЛ
АМПЛИТУДА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ  3,0 В; 0,4 мс	РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД 300 мс	ПОВТОРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС ВЫКЛ
	ГИСТЕРЕЗИС 0 мс	СЕНСОР ВЫКЛ

Место производства:

ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

ООО "Биоточмаш"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 785-36-78
E-mail: biotochmash@mail.ru

ООО "НПП "Кардиоспектр"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: cardiosptr@mail.ru

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа ЭКС-560А-SR
по БНПК.941514.001ТУ и эксплуатационная документация.
Этикетка на задней стороне упаковки для хранения (коробки).

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ
ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR ПО БНПК.941514.001 ТУ

Количество 3 шт. Серийные номера: 00222, 00447,
00700


Изготовитель: ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО», Россия, 125363, г. Москва, ул. Аэродромная, д. 16,
тел./факс: (495) 649-15-49, E-mail: info@elestim-cardio.ru

Место производства:


☒ ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: info@elestim-cardio.ru

☒ ООО «Биоточмаш» Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 785-36-78 E-mail: biotochmash@mail.ru

☒ ООО «НПП «Кардиоспектр» Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: cardiosptetr@mail.ru



Транспортирование



Хранение

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
по ДНКБ.941514.005 ТУ и эксплуатационная документация в транспортной упаковке.



Электрокардиостимулятор имплантируемый
частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
и отвёртка тарированная.



Электрокардиостимулятор имплантируемый
частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.



Отвёртка тарированная
в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.

ЭКС-560А-SR



SN 00447

06.03.2011

06.03.2020




IS-1 BI



БНПК.941514.001ТУ IPX7

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ
ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR
ПО БНПК.941514.001ТУ

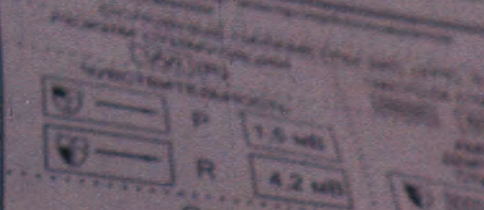

- Открытие стерильной упаковки
1. Вскрыть контейнер.
 2. Вынуть пакет с электрокардиостимулятором и отверткой.
 3. Вскрыть наружный пакет с электрокардиостимулятором, не касаясь при этом содержимого внутреннего пакета.
 4. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет.
 5. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний стерильный пакет, извлечь из него электрокардиостимулятор и отвертку.

ВНИМАНИЕ! Внутренние стерильные пакеты вскрывать в условиях операционной с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Внутри Нетоксично
~~XXXX~~
STERILE EO
PU № ФCP

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва
ул. Аэродромная, д. 19
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR и отвёртка тарированная в общем пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.

ЭКС-560А-SR

SN 00447

06.03.2018

06.03.2020

IS-1 BI

IPX7

БНПК.941514.001ТУ

5°C 40°C

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ
ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR
ПО БНПК.941514.001ТУ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ: электрокардиостимулятор,
отвертка тарированная

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ

WI (R)

ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ

60 имп/мин

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



P


1,5 мВ



R

4,2 мВ

АМПЛИТУДА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СТИМУЛЯЦИИ



3,0 В; 0,4 мс

Открытие стерильной упаковки




1. Вскрыть контейнер.

2. Вынуть пакет с электрокардиостимулятором и отверткой.



3. Вскрыть наружный пакет с электрокардиостимулятором, не касаясь при этом поверхности внутренних пакетов.

4. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренние стерильные пакеты.



5. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренние стерильные пакеты, извлечь из них электрокардиостимулятор и отвертку.

ВНИМАНИЕ! Внутренние стерильные пакеты вскрывать в условиях операционной с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Внутри

Нетоксично

STERILE EO

РУ № ФСР



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

Место производства:

000 "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: info@elestim-cardio.ru
000 "Биоточмаш" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр 1а
тел./факс: (495) 785-36-78 E-mail: biotochmash@mail.ru
000 "НПГ" Кардиоспектр" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: cardiospctr@mail.ru

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
и отвертка тарированная. Этикетка на стерильной упаковке.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
и отвёртка тарированная в стерильной упаковке в контейнере. Контейнер закрыт.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR по ДНКБ.941514.005 ТУ и эксплуатационная документация в упаковке для хранения

**ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ
ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR ПО БНПК.941514.001ТУ**

Назначение изделия: ресинхронизирующая терапия и лечение других нарушений ритма сердца путём его электрической стимуляции.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ ☐ VVI (R)	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  P 1,5 мВ	ТИП СТИМУЛЯЦИИ/ВОСПРИЯТИЯ ☐ МОН/МОН
ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ  60 имп/мин	 R 4,2 мВ	ПОИСК СОБСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ☐ ВЫКЛ
АМПЛИТУДА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ  3,0 В; 0,4 мс	РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД 300 мс	ПОВТОРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС ☐ ВЫКЛ
	ГИСТЕРЕЗИС 0 мс	СЕНСОР ☐ ВЫКЛ


Место производства:

ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

ООО "Биоточмаш"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 785-36-78
E-mail: biotochmash@mail.ru

ООО "НПП "Кардиоспектр"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: cardiosptcr@mail.ru

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа ЭКС-560А-SR по БНПК.941514.001ТУ и эксплуатационная документация.
Этикетка на задней стороне упаковки для хранения (коробки).



Электрокардиостимулятор имплантируемый
частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
и отвёртка тарированная.



Электрокардиостимулятор имплантируемый
частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR
в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.



Отвёртка тарированная
в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.




Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR и отвёртка тарированная в общем пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.

SN 00700
06.03.2018
06.03.2020

5°C - 40°C

ЭКС-560А-SR



IS-1 BI

IPX7

БНПК.941514.001ТУ

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR ПО БНПК.941514.001ТУ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ: электрокардиостимулятор,
отвертка тарированная

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ


WI (R)

ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ




60 имп/мин

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



P

1,5 мВ



R

4,2 мВ

АМПЛИТУДА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СТИМУЛЯЦИИ



3,0 В; 0,4 мс

Открытие стерильной упаковки




1. Вскрыть контейнер.

2. Вынуть пакет с электрокардиостимулятором и отверткой.



3. Вскрыть наружный пакет с электрокардиостимулятором, не касаясь при этом поверхности внутренних пакетов.

4. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренние стерильные пакеты.



5. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренние стерильные пакеты, извлечь из них электрокардиостимулятор и отвертку.

ВНИМАНИЕ! Внутренние стерильные пакеты вскрывать в условиях операционной с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Внутри Нетоксично

STERILE EO

РУ № ФСР



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

Место производства:

ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: info@elestim-cardio.ru
ООО "Биоточмаш" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр 1а
тел./факс: (495) 785-36-78 E-mail: biotochmash@mail.ru
ООО "НПП "Кардиоспектр" Россия, 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4а, стр 1а
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: cardiosptctr@mail.ru

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR и отвертка тарированная. Этикетка на стерильной упаковке.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR и отвёртка тарированная в стерильной упаковке в контейнере. Контейнер закрыт.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560А-SR по ДНКБ.941514.005 ТУ и эксплуатационная документация в упаковке для хранения

**ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ
ТИПА SSIR ЭКС-560А-SR ПО БНПК.941514.001ТУ**

Назначение изделия: ресинхронизирующая терапия и лечение других нарушений ритма сердца путём его электрической стимуляции.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ VVI (R)	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  P 1,5 мВ	ТИП СТИМУЛЯЦИИ/ВОСПРИЯТИЯ МОН/МОН
ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ  60 имп/мин	 R 4,2 мВ	ПОИСК СОБСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ВЫКЛ
АМПЛИТУДА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ  3,0 В; 0,4 мс	РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД 300 мс	ПОВТОРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС ВЫКЛ
	ГИСТЕРЕЗИС 0 мс	СЕНСОР ВЫКЛ



Место производства:

ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru

ООО "Биотечмаш"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 785-36-78
E-mail: biotchemash@mail.ru

ООО "НПП "Кардиоспектр"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский пр.,
д. 4а, стр. 1а
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: cardiosptctr@mail.ru

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



РУ № ФСР



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа ЭКС-560А-SR по БНПК.941514.001ТУ и эксплуатационная документация.
Этикетка на задней стороне упаковки для хранения (коробки).

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

25 (двадцать пять) листов

Генеральный директор

ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"

А.В. Войцеховский

