

«Утверждаю»



Генеральный директор
ООО «Дельрус»

Федотов И.В.

19.12.2019
РУКОВОДИТЕЛЬ
М В КУЛАС

«12» августа 2020 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Boaray 5000D, серии: с 020120052001 по 020120052500, с 020120062001 по 020120063000, с 020120072001 по 020120073000», производства Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd. (Шэньчжэнь Прунус Медикал Ко., Лтд.), КНР

Аппарат искусственной вентиляции легких Boaray 5000D, серии: с 020120052001 по 020120052500, с 020120062001 по 020120063000, с 020120072001 по 020120073000


1. Основной блок аппарата искусственной вентиляции легких Boaray 5000D: вид спереди



2. Основной блок аппарата искусственной вентиляции легких Воагау 5000D: вид сзади



3. Основной блок аппарата искусственной вентиляции легких Boaray 5000D: маркировка

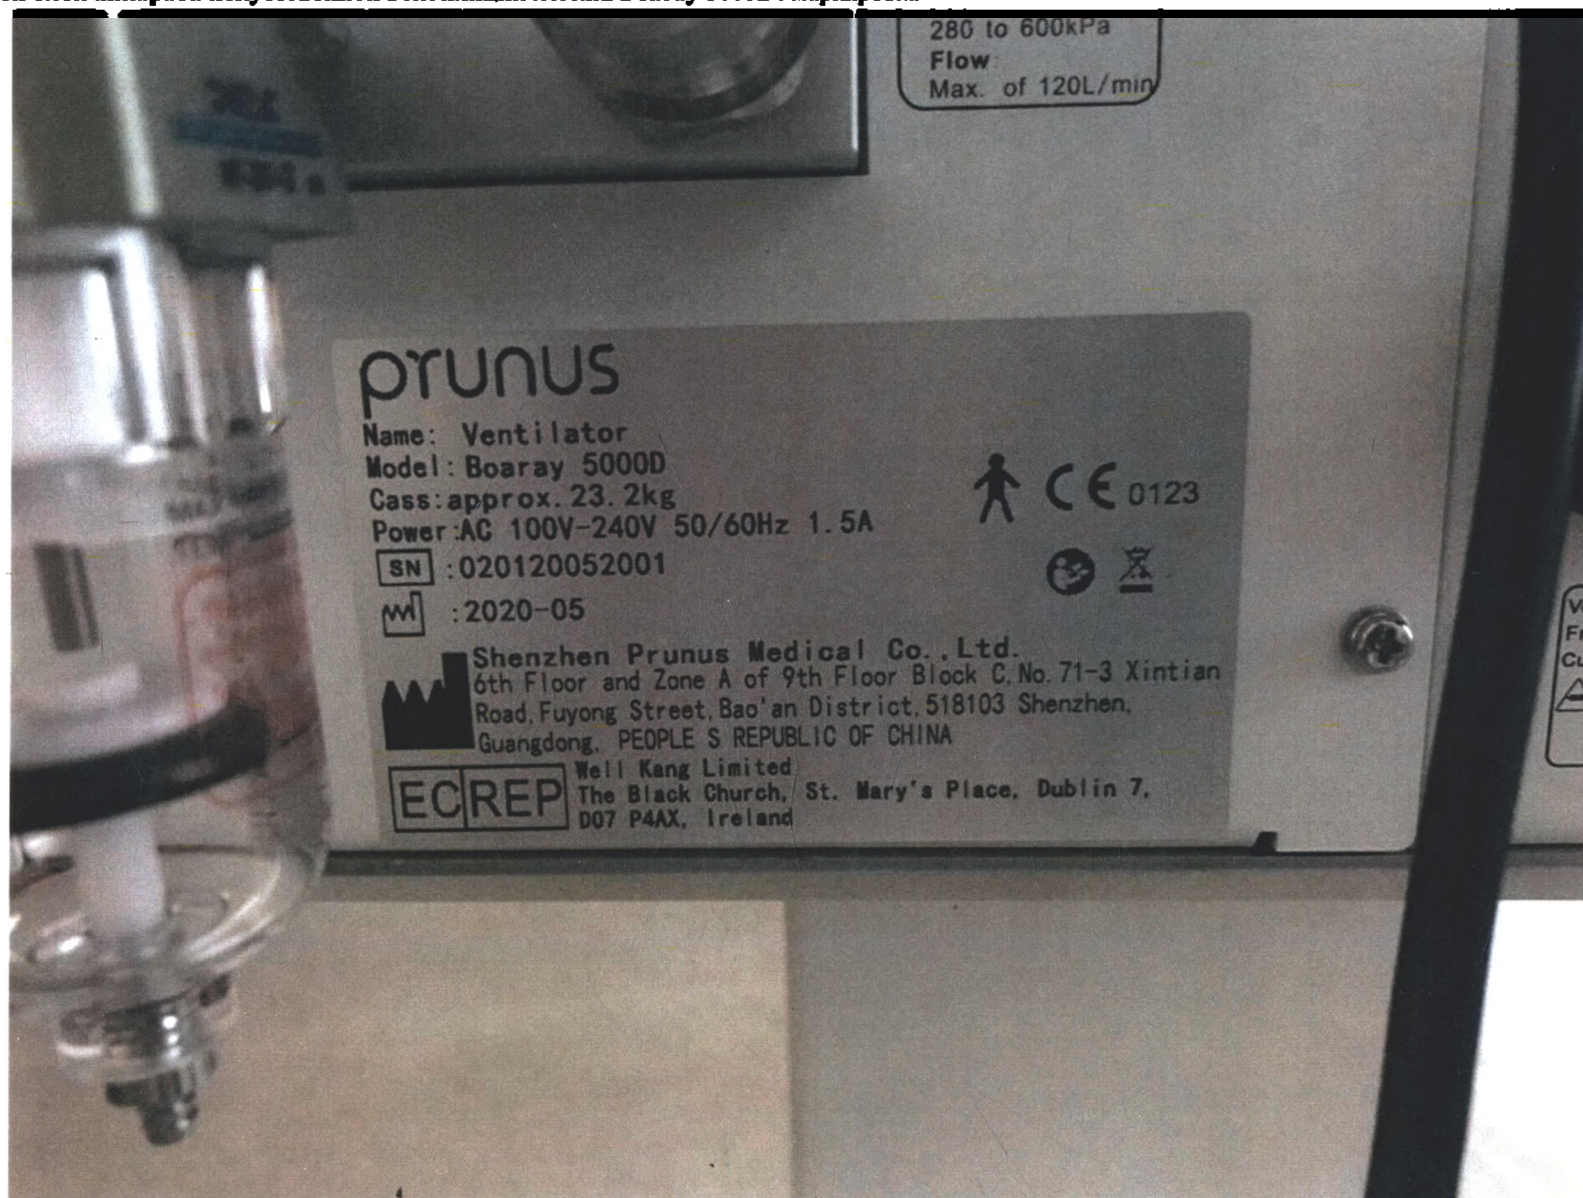

4. TFT-дисплей со встроенным программным обеспечением



5. Шланг высокого давления кислорода




6. Шланг высокого давления воздуха



7. Тележка



8. Держатель контура пациента

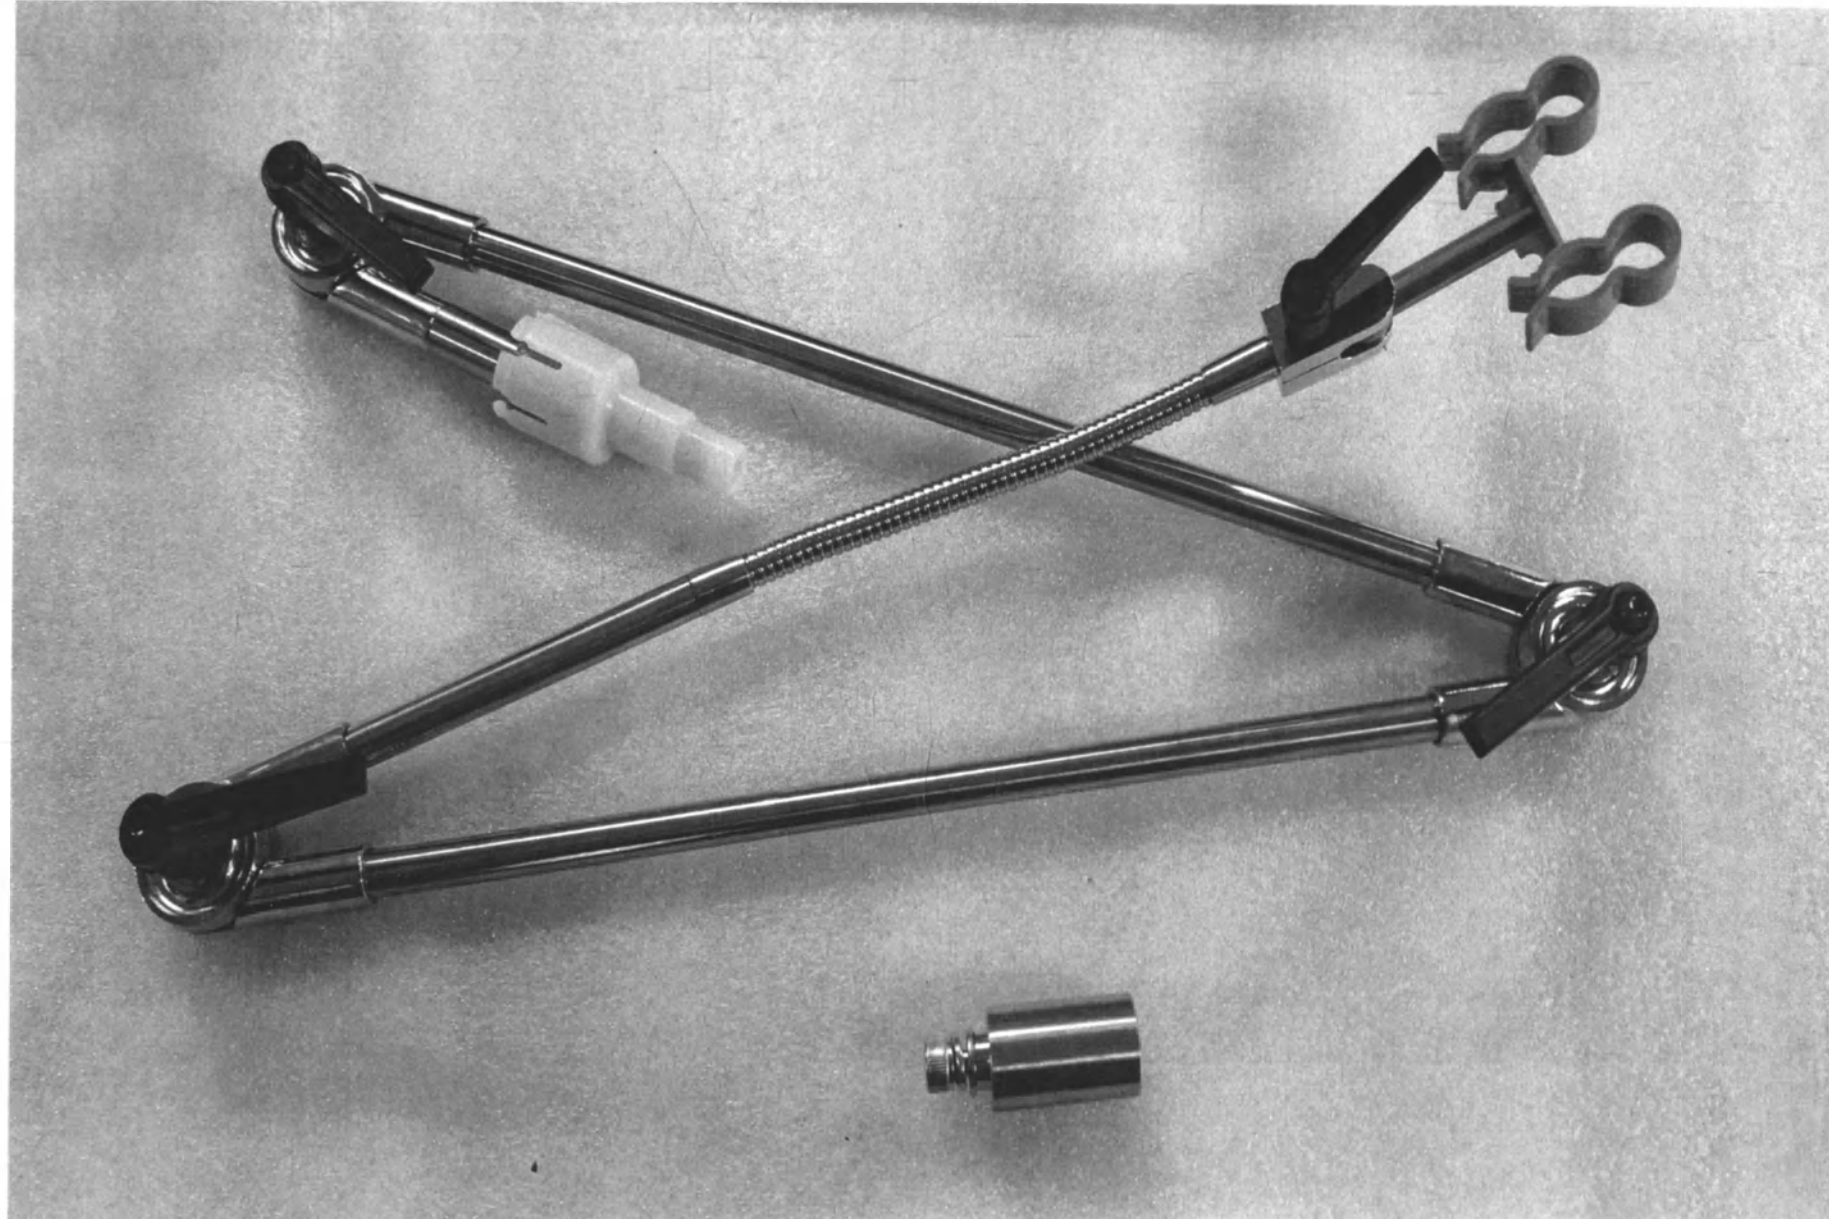

9. Взрослый дыхательный контур без обогрева с линией давления, одноразового использования, REF RT134, производитель Fisher & Paykel Healthcare Ltd., New Zealand («Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.», Новая Зеландия)



10. Взрослый дыхательный контур без обогрева с линией давления, одноразового использования, REF RT134, производитель Fisher & Paykel Healthcare Ltd., New Zealand («Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.», Новая Зеландия): маркировка

REF RT134

Взрослый дыхательный контур без обогрева с линией давления

Производитель: Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland, New Zealand


Получатель: ООО "Фишер энд Пэйкел Хелскэр"
109428, г. Москва,
Рязанский проспект, дом 10
строение 18, 3 этаж, офис 3.9
Тел. +7 495 782 21 50

Свидетельство о регистрации: ФСЗ 2011/09111 25.02.2011
ФСЗ 2007/00742 07.12.2007


Спецификация: Одноразового использования

Срок годности до: 07-06-2024


Обратитесь к инструкции по применению
Сделано в Новой Зеландии



11. Клапан выдоха

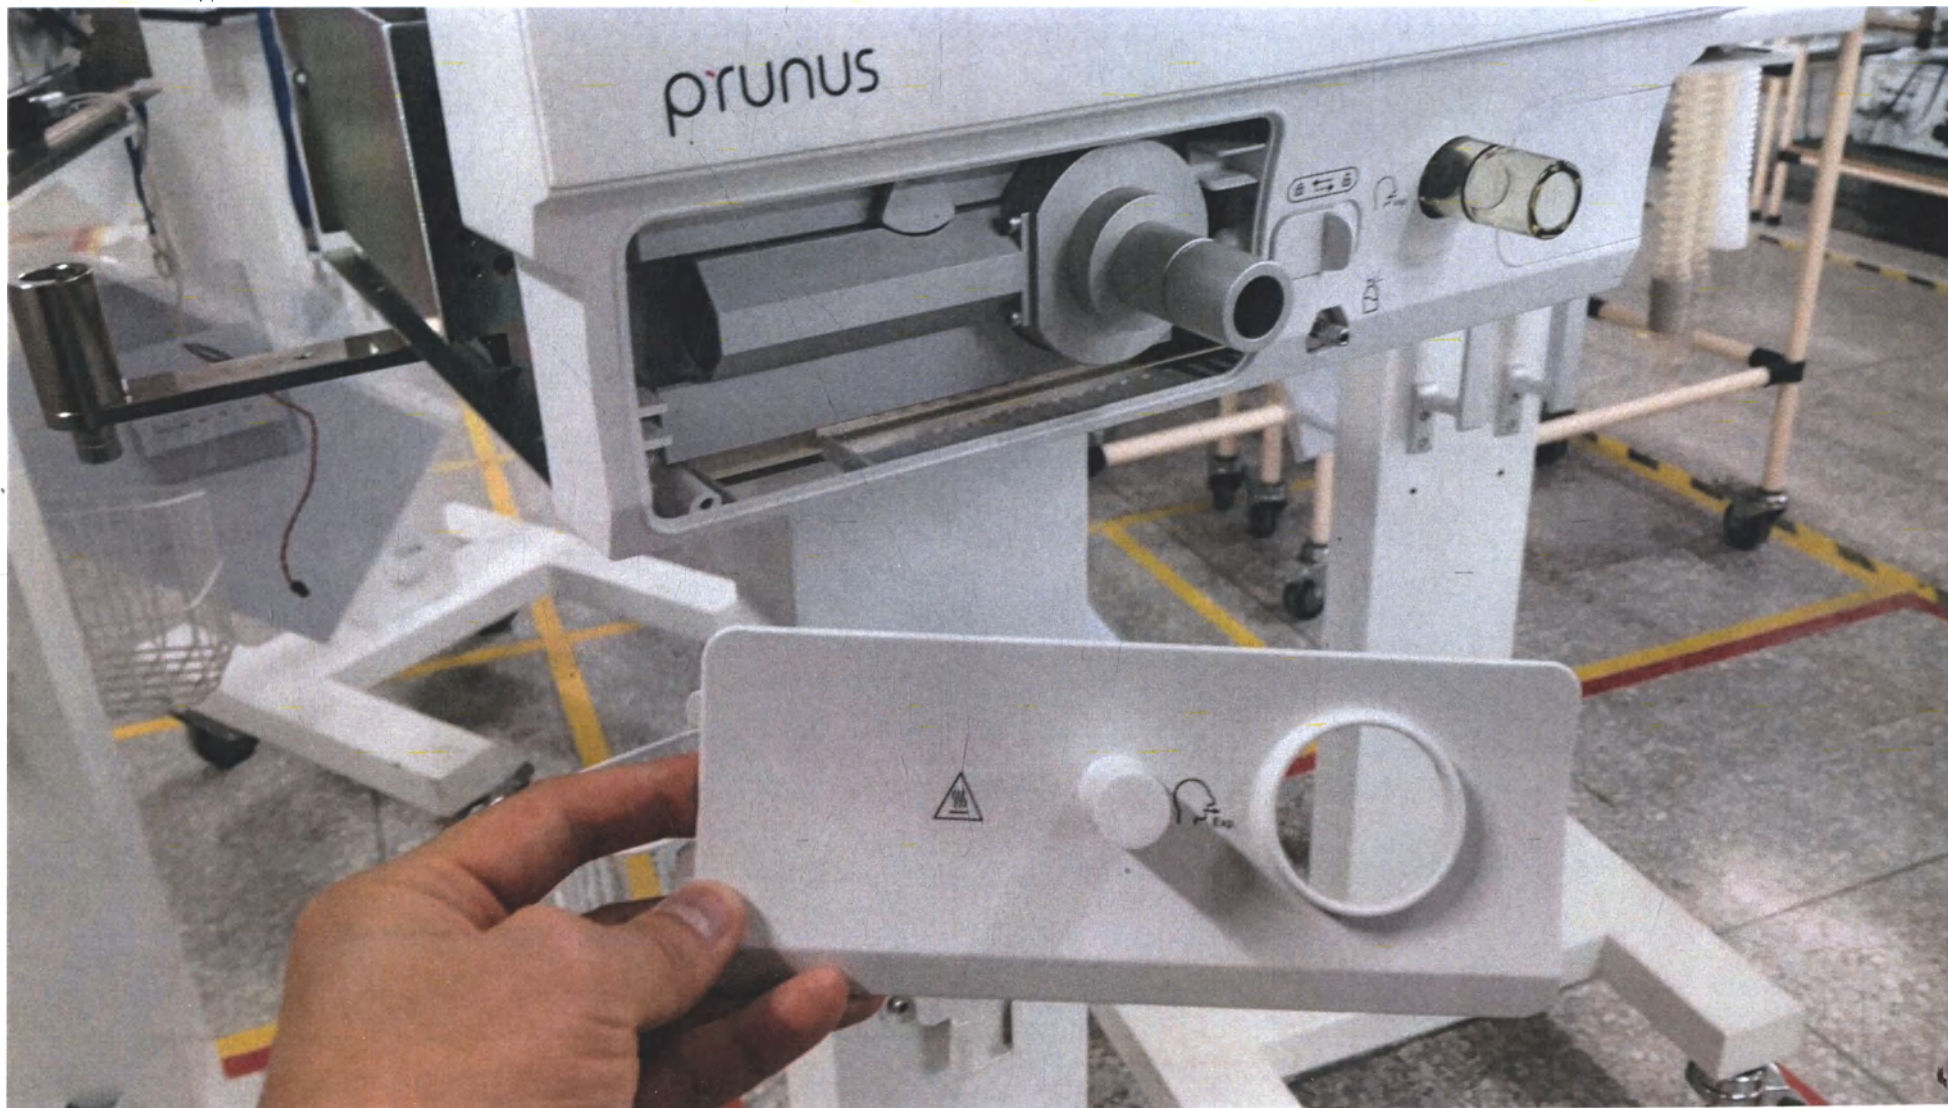

12. Датчик потока

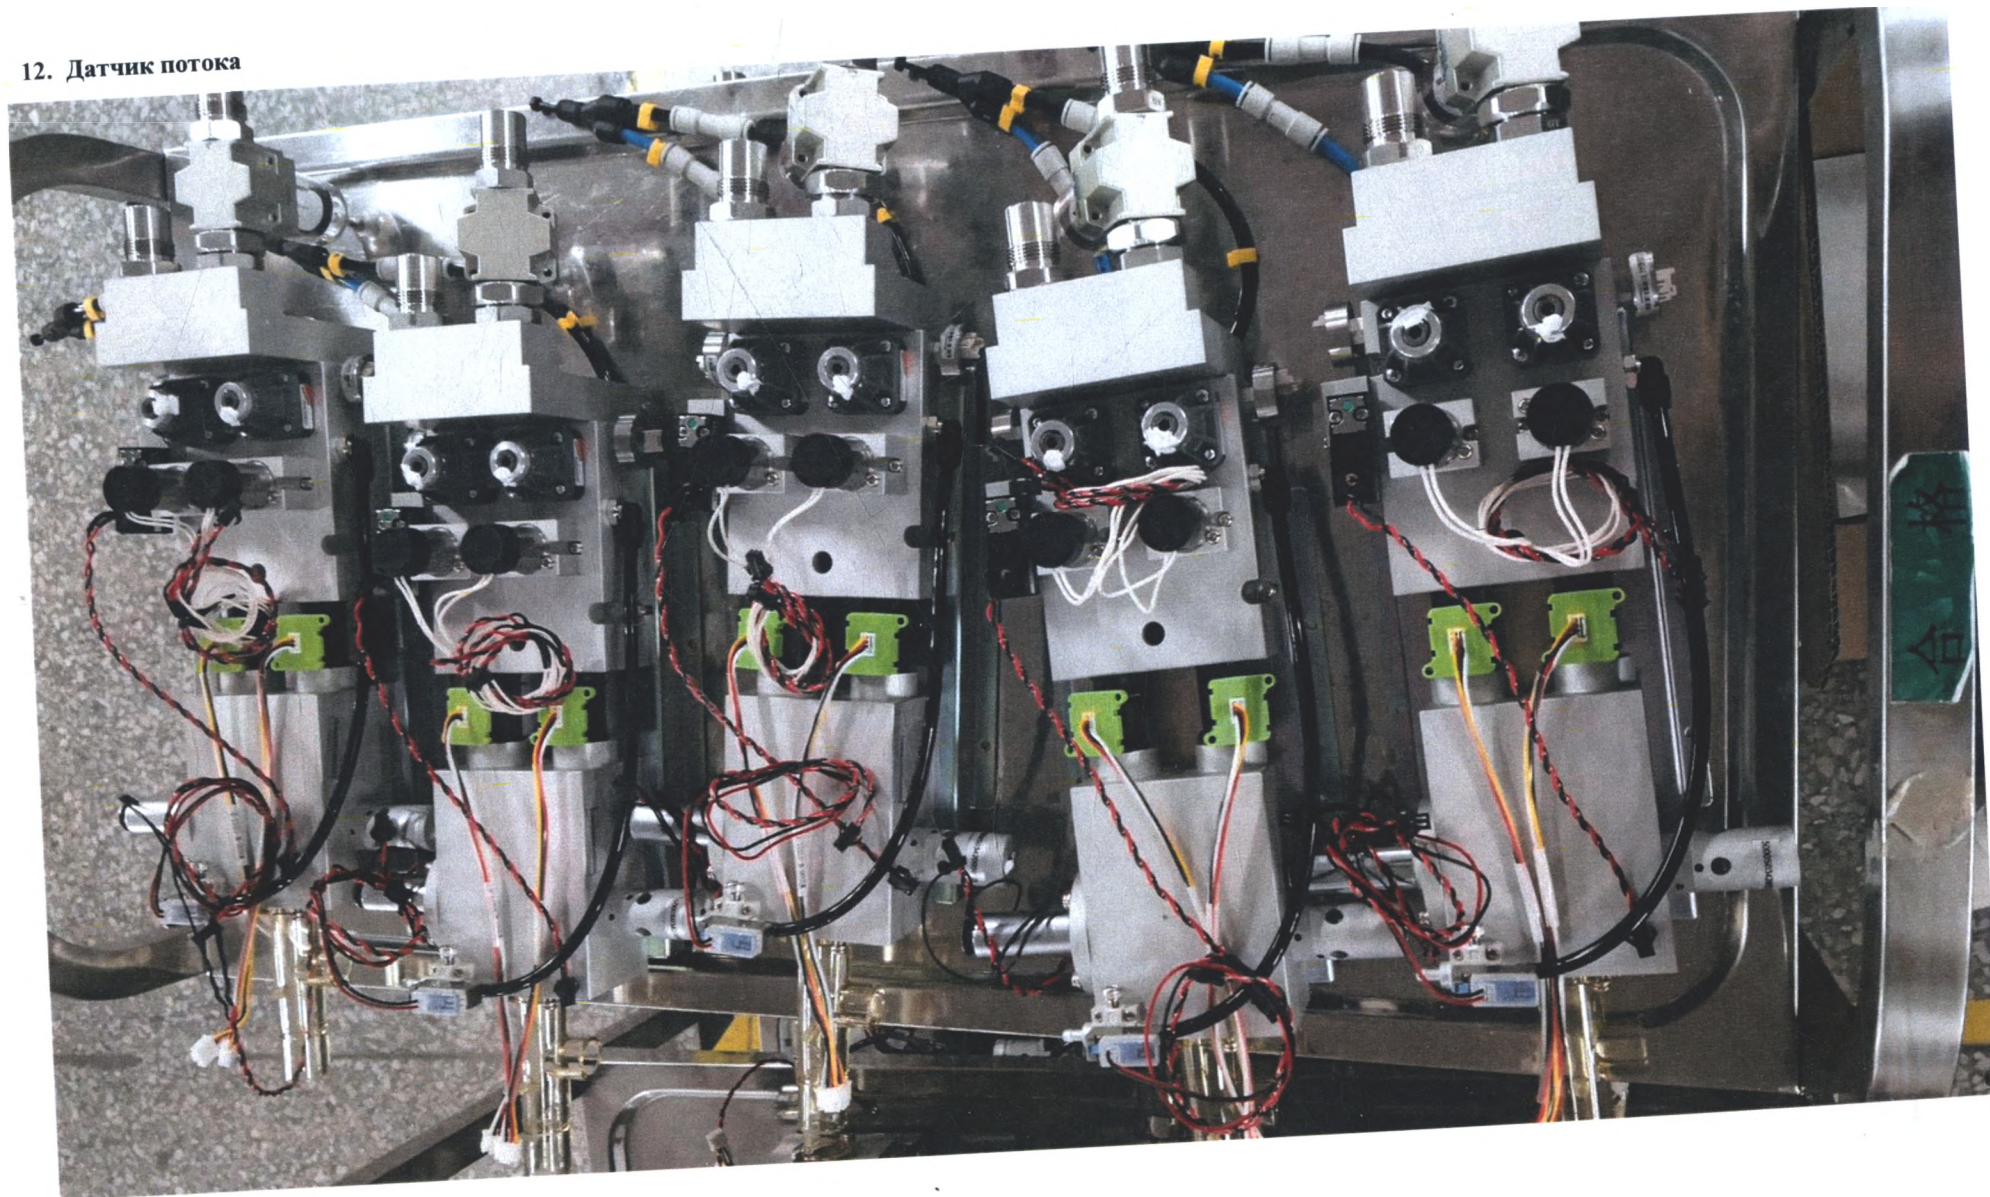

13. Тестовое легкое




14. Компрессор




15. Увлажнитель



16. Камера увлажнителя универсальная MR290, производитель Fisher & Paykel Healthcare Ltd., New Zealand («Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.», Новая Зеландия)

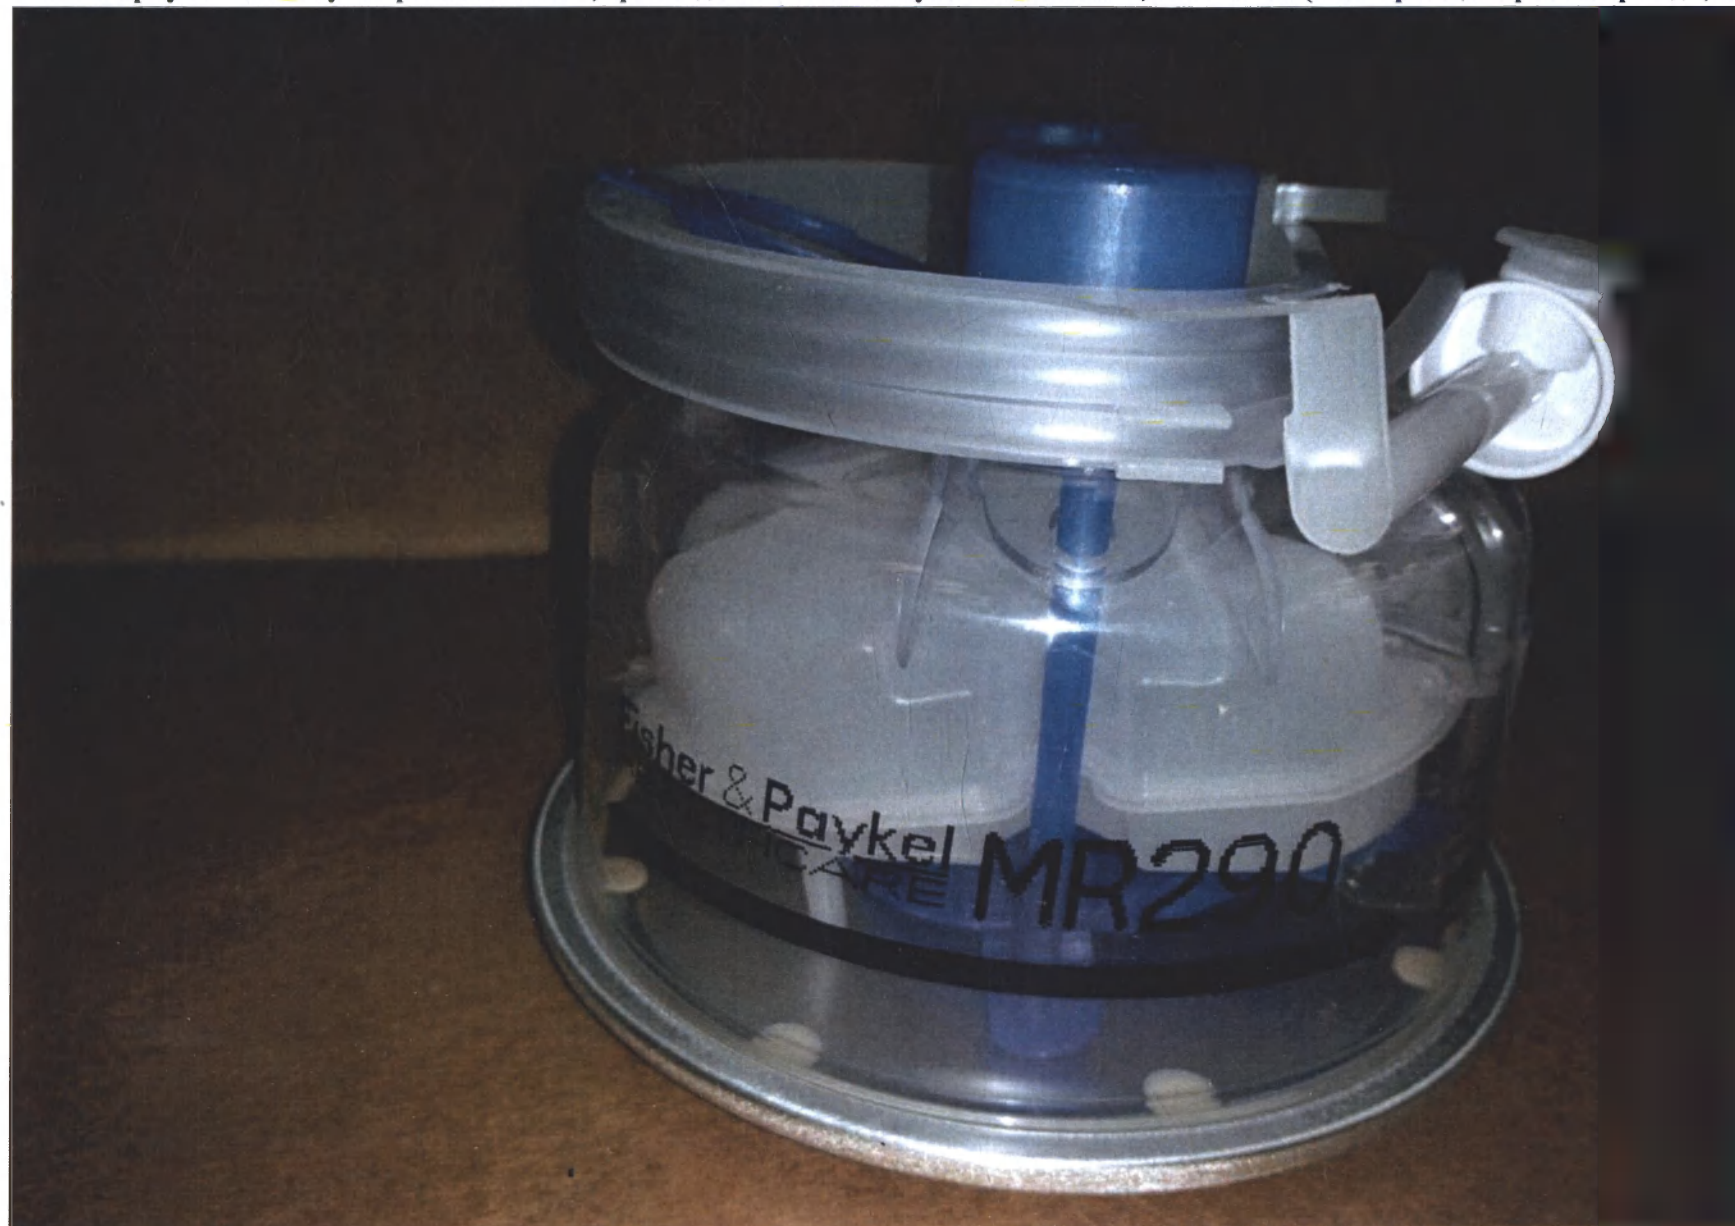

17. Температурный датчик увлажнителя

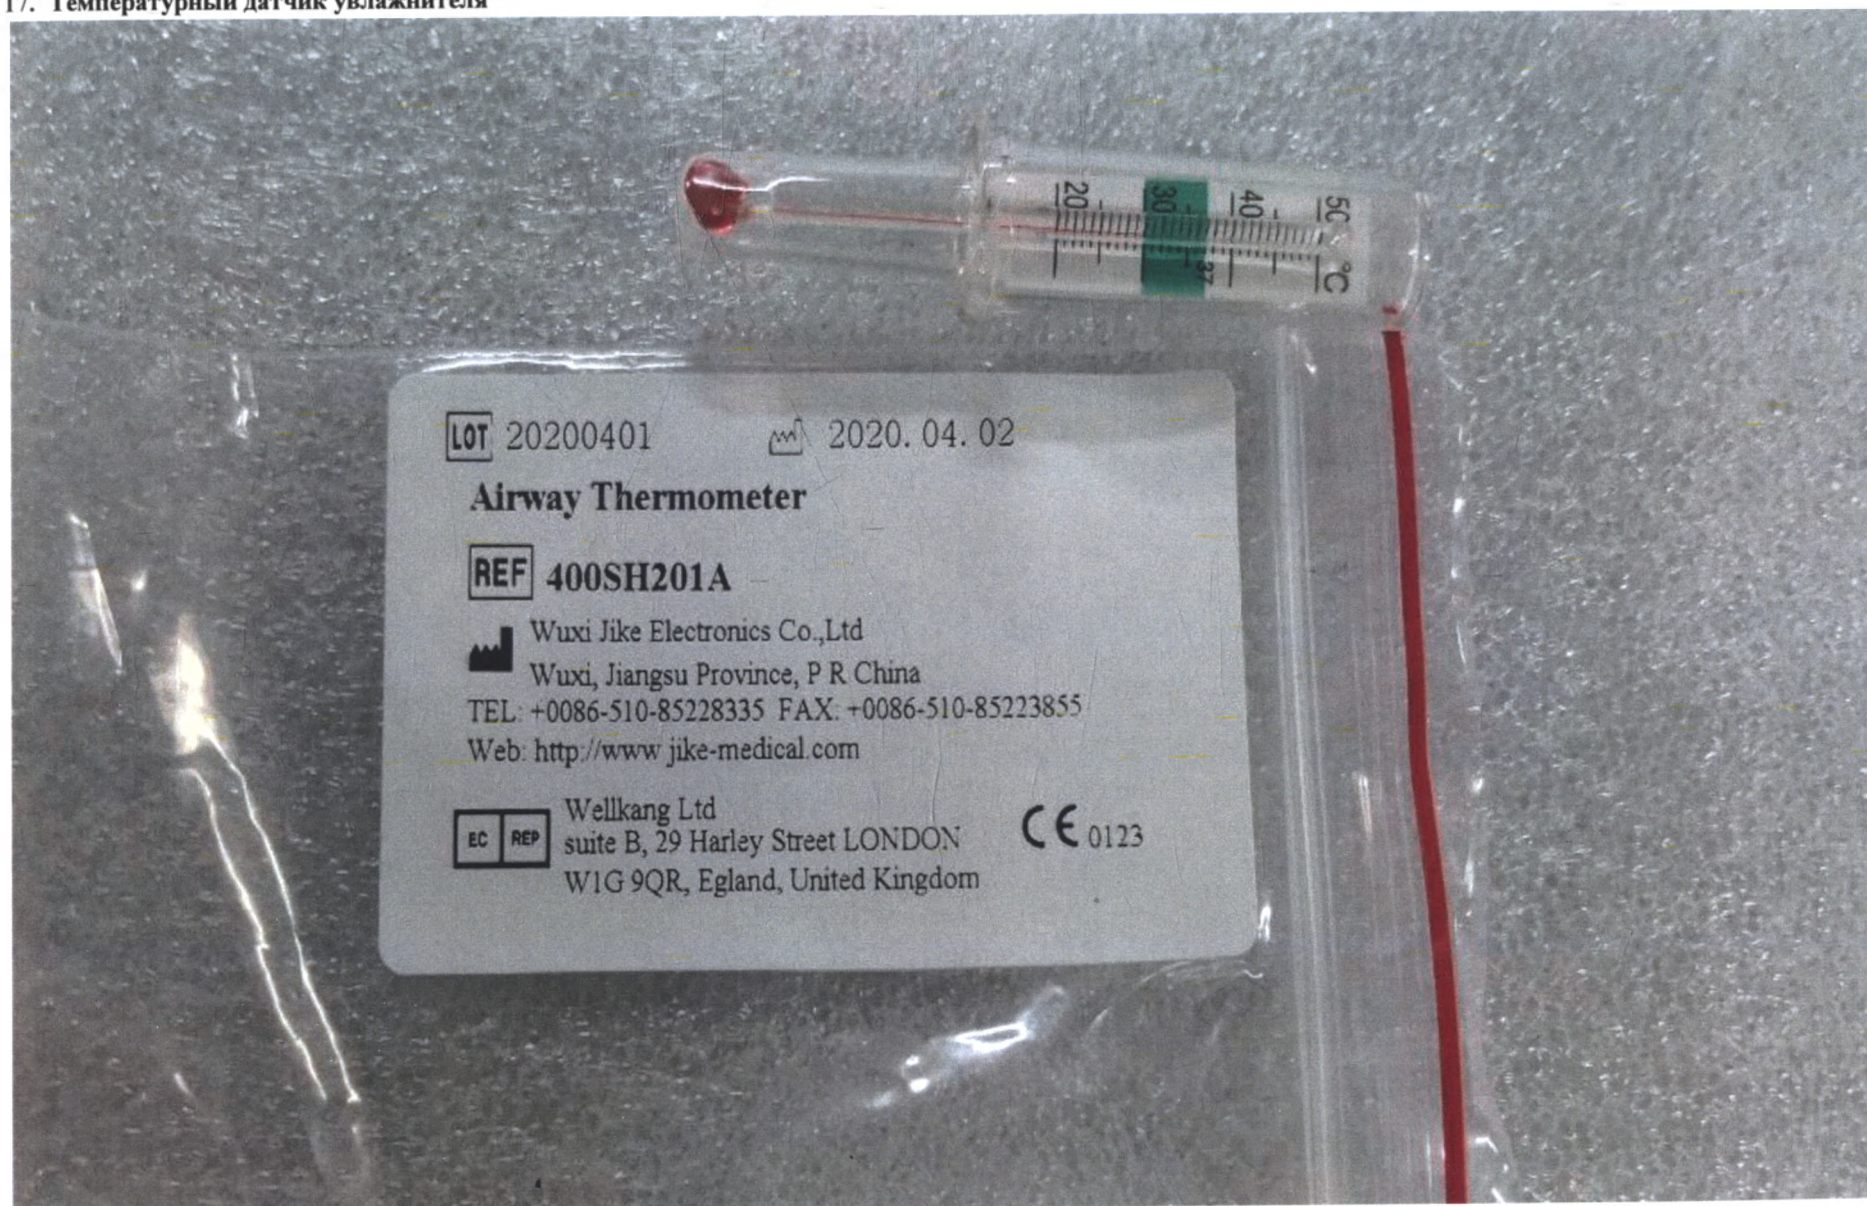


18. Датчик нуль-соосимметричный SpO2



19. Датчик кислорода




20. Датчик капнометрии CO_2 в прямом потоке

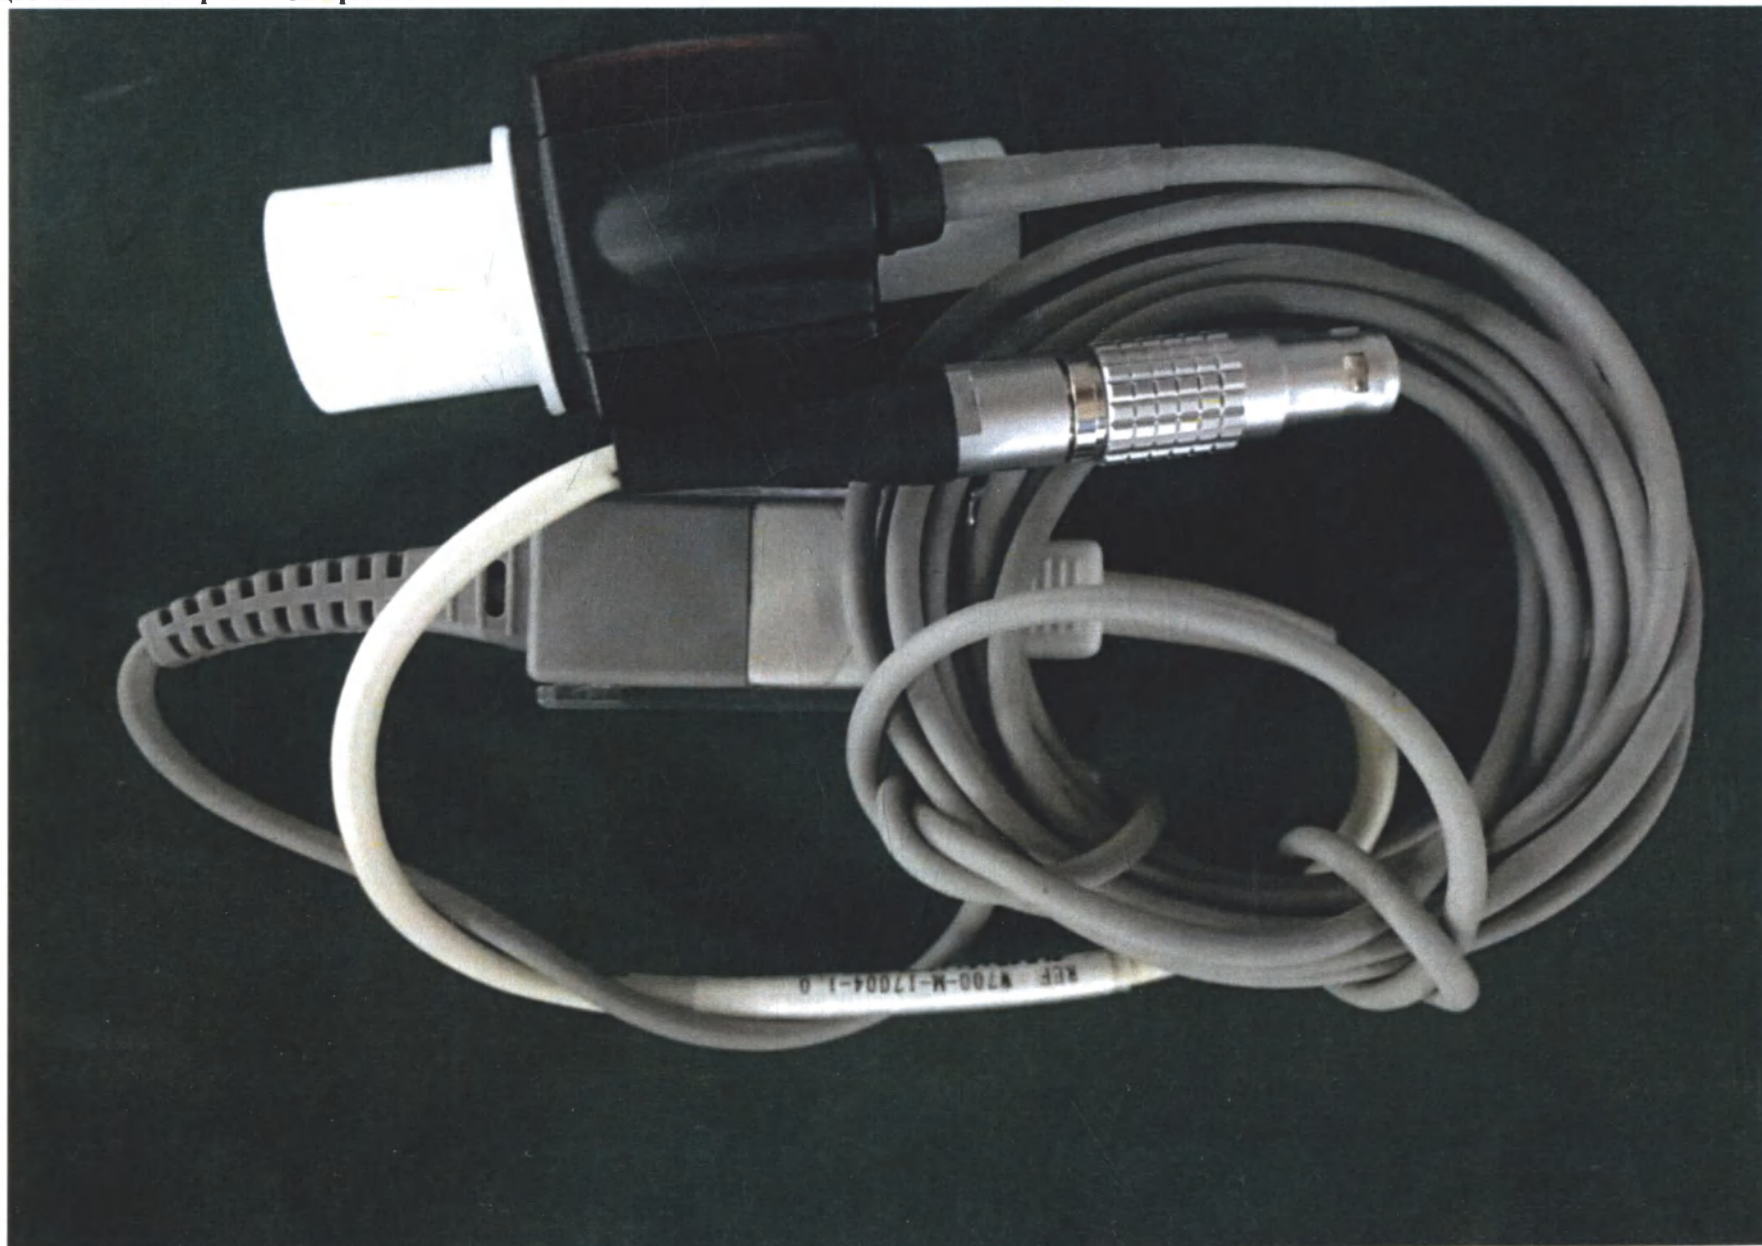

21. Батарея Li-ion



22. Сетевой кабель

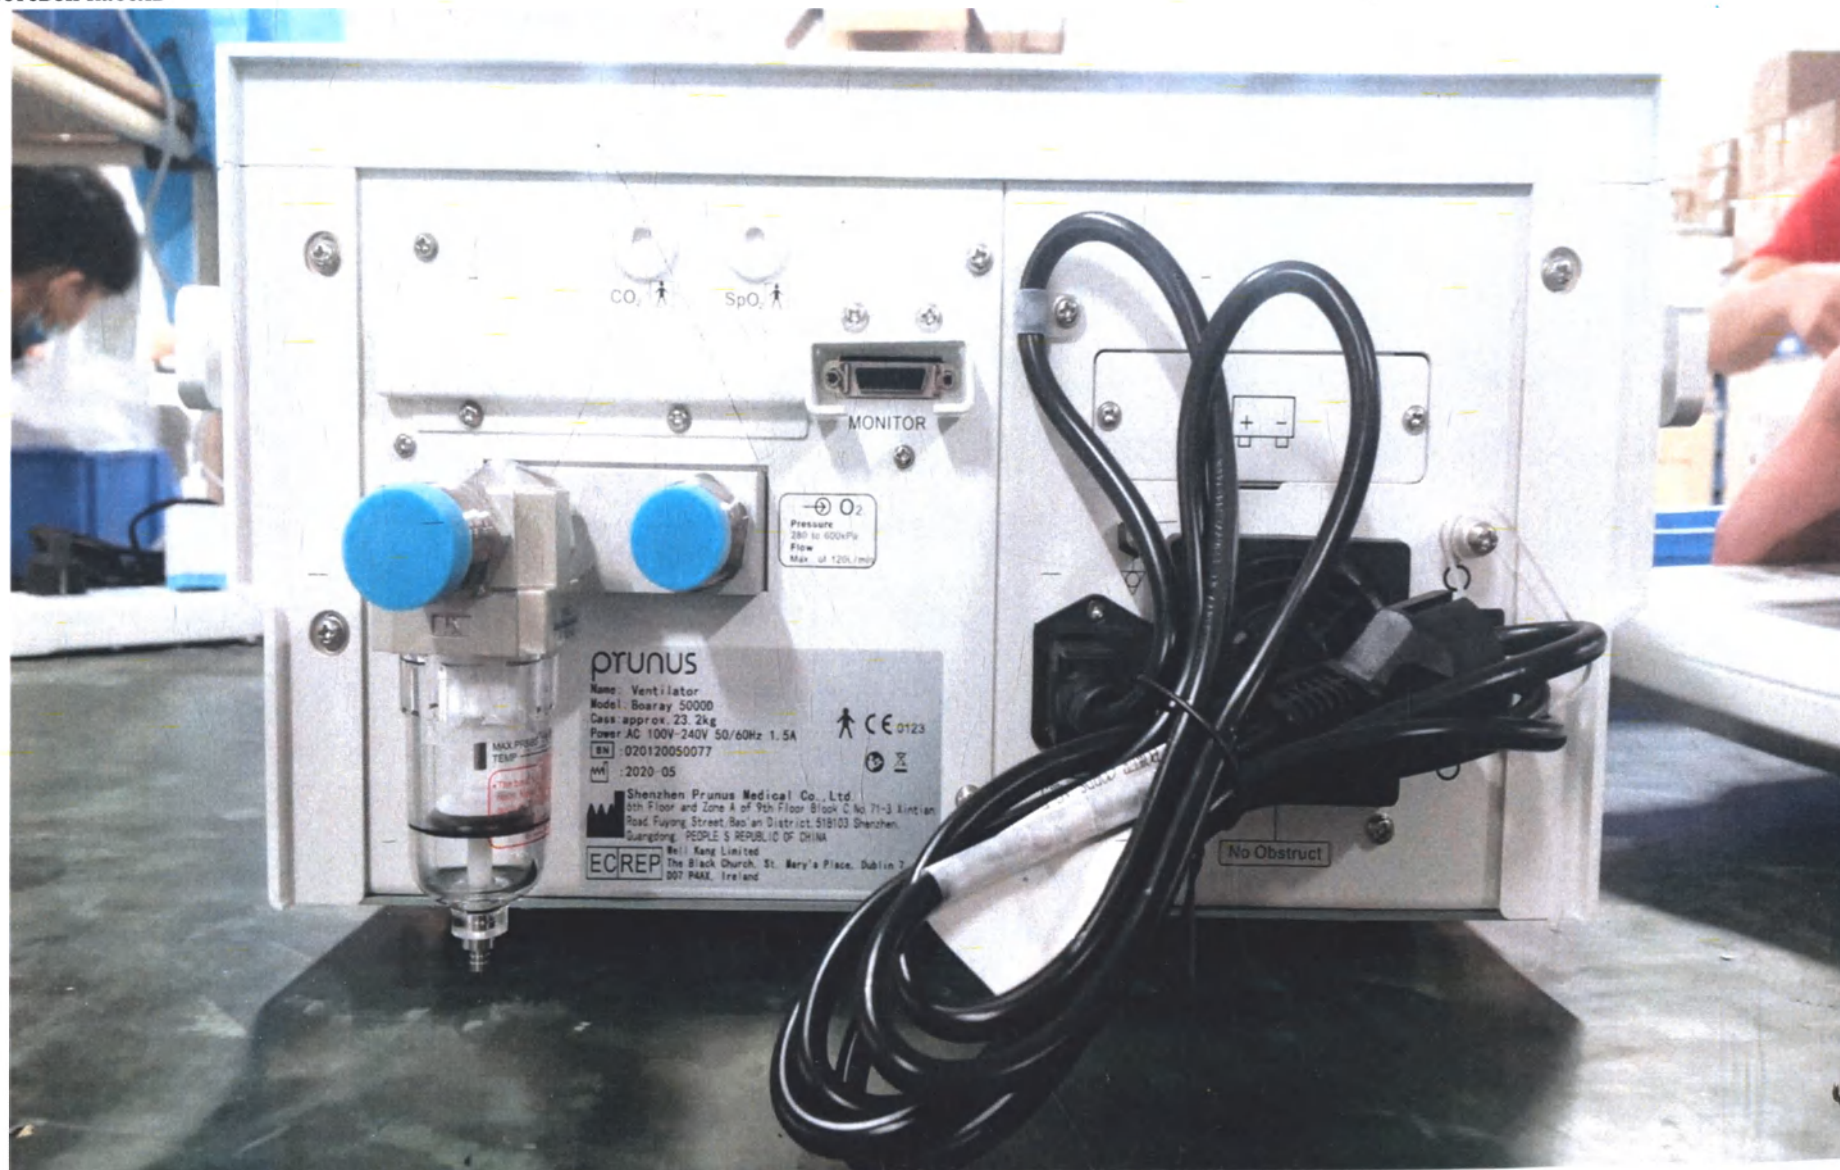

Boaray 5000D/C Ventilator User Manual



prunus

24 (двадцать четыре) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус» _____

И. В. Федотов

НО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 259 от 12.02.2019
РУКОВОДИТЕЛЬ НОРМИ
М В ДП «Дельта»

