

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»



Н.В. Макарова

«04» августа 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАБОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕМА ГЛАЗА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
SMARTCOAT

- I. Набор офтальмологический для сохранения объема глаза при проведении офтальмологических операций SmartCoat



Рисунок 1 – Потребительская упаковка, вид спереди

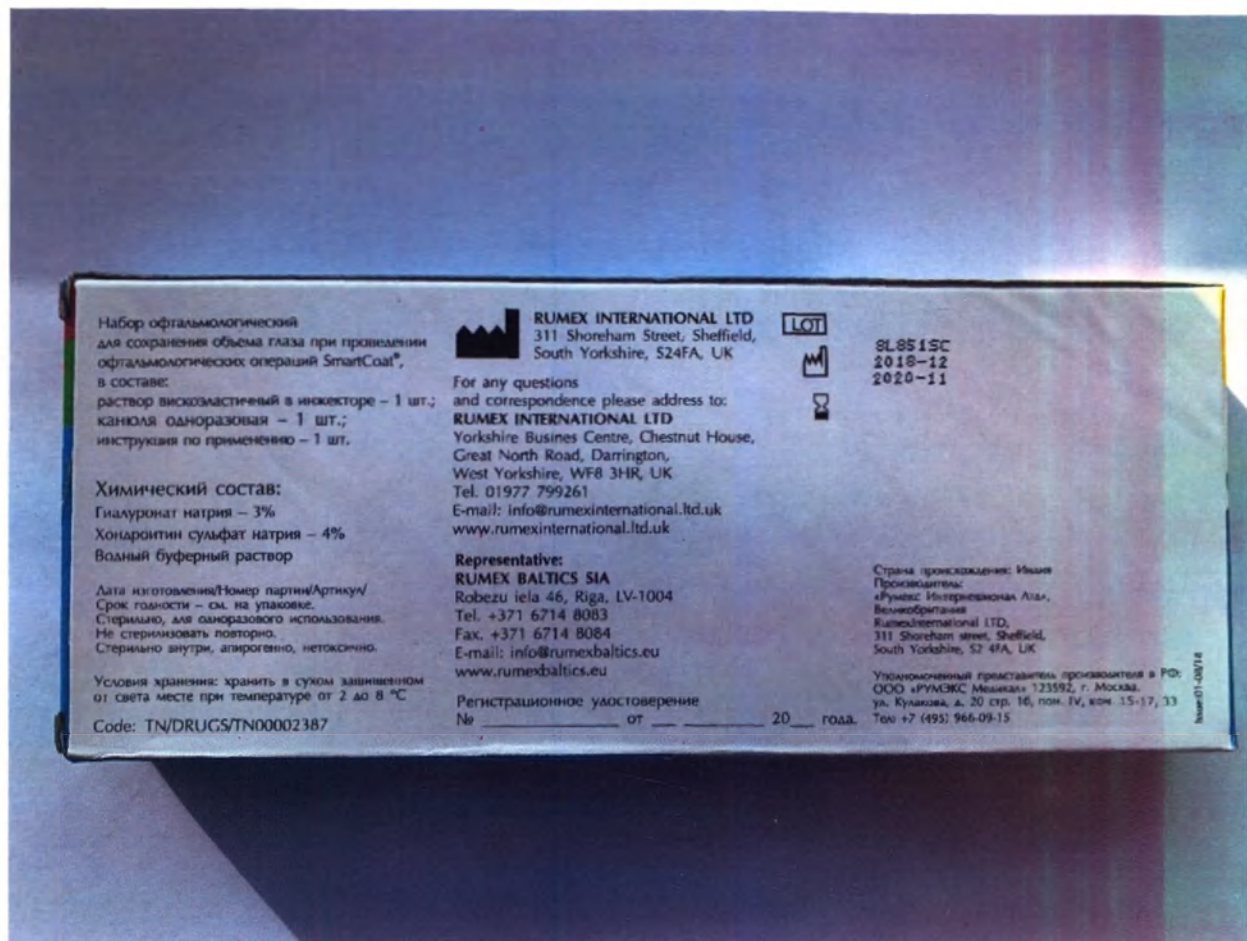


Рисунок 2 – Потребительская упаковка, вид сзади

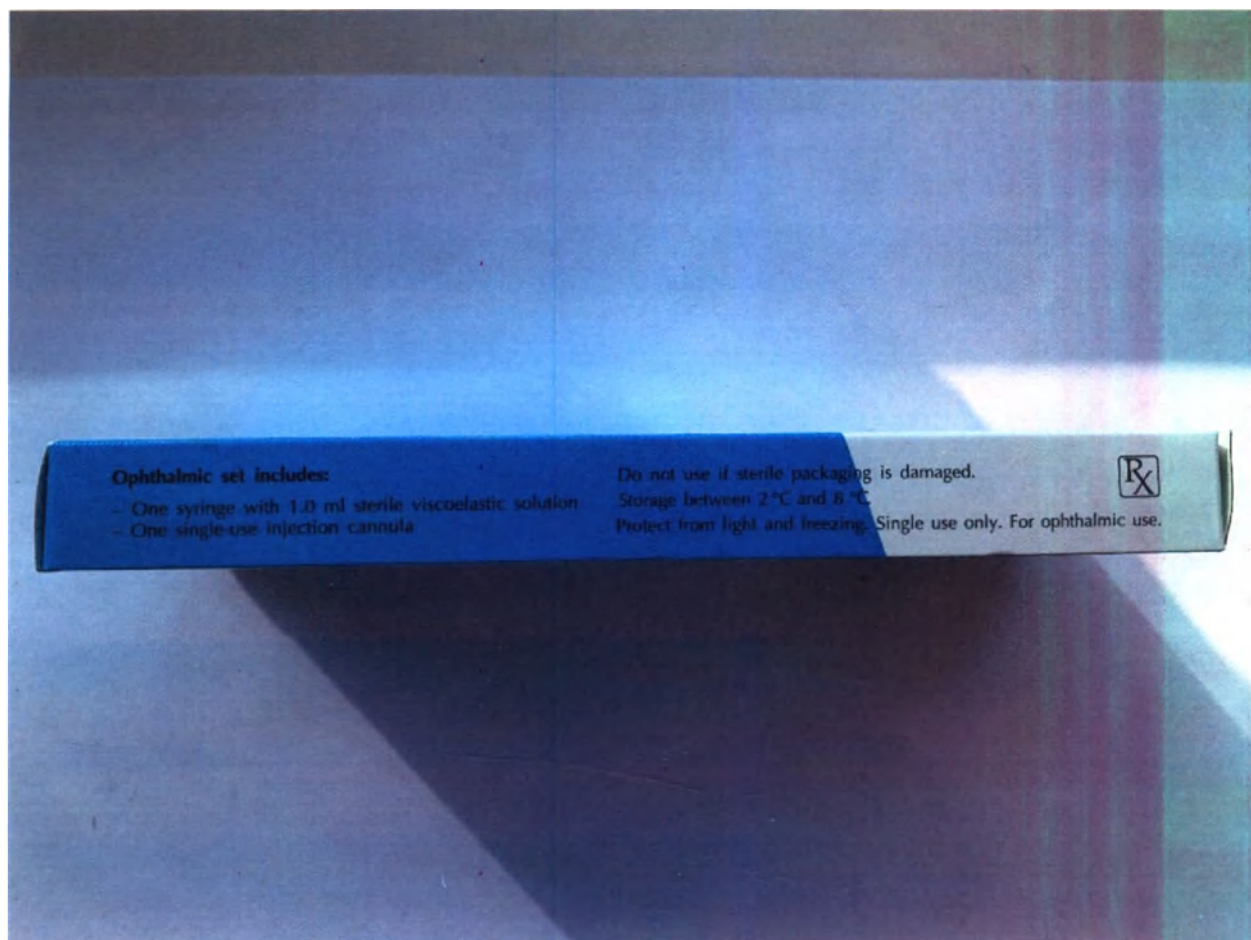


Рисунок 3 – Потребительская упаковка, вид сбоку 1



Рисунок 4 – Потребительская упаковка, вид сбоку 2

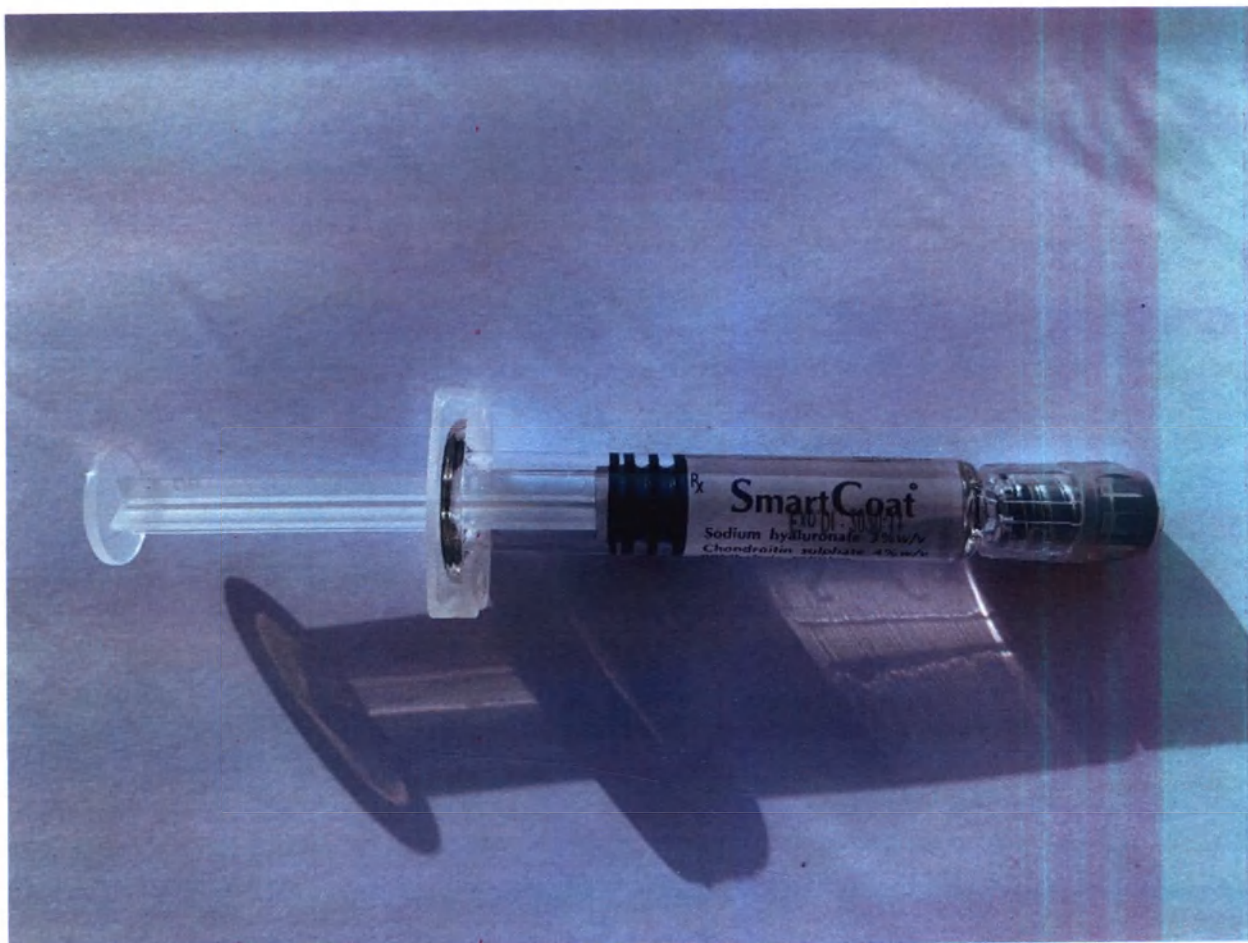


Рисунок 5 – Раствор вязкоэластичный в инжекторе (вид 1)

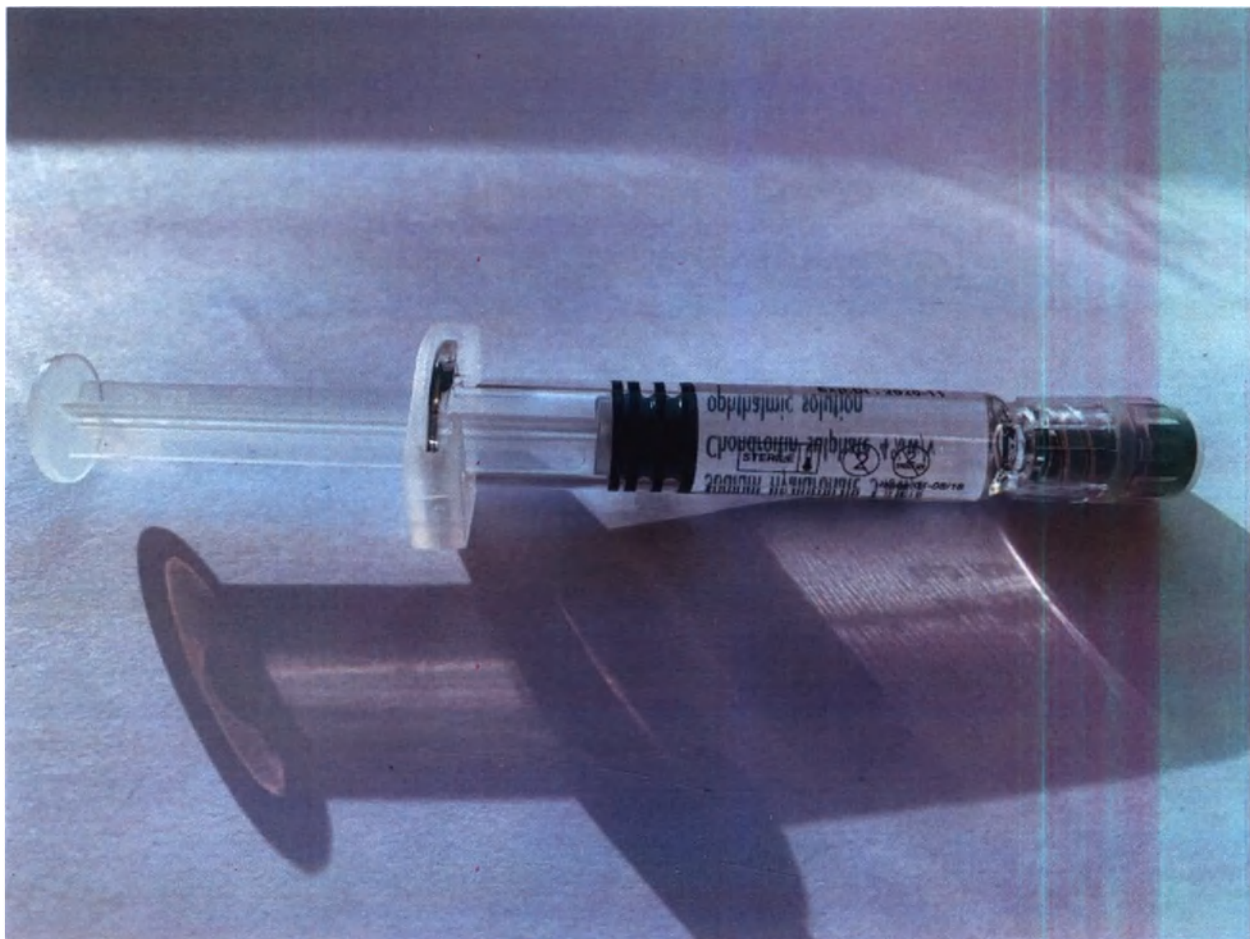


Рисунок 6 – Раствор вязкоэластичный в инжекторе (вид 2)

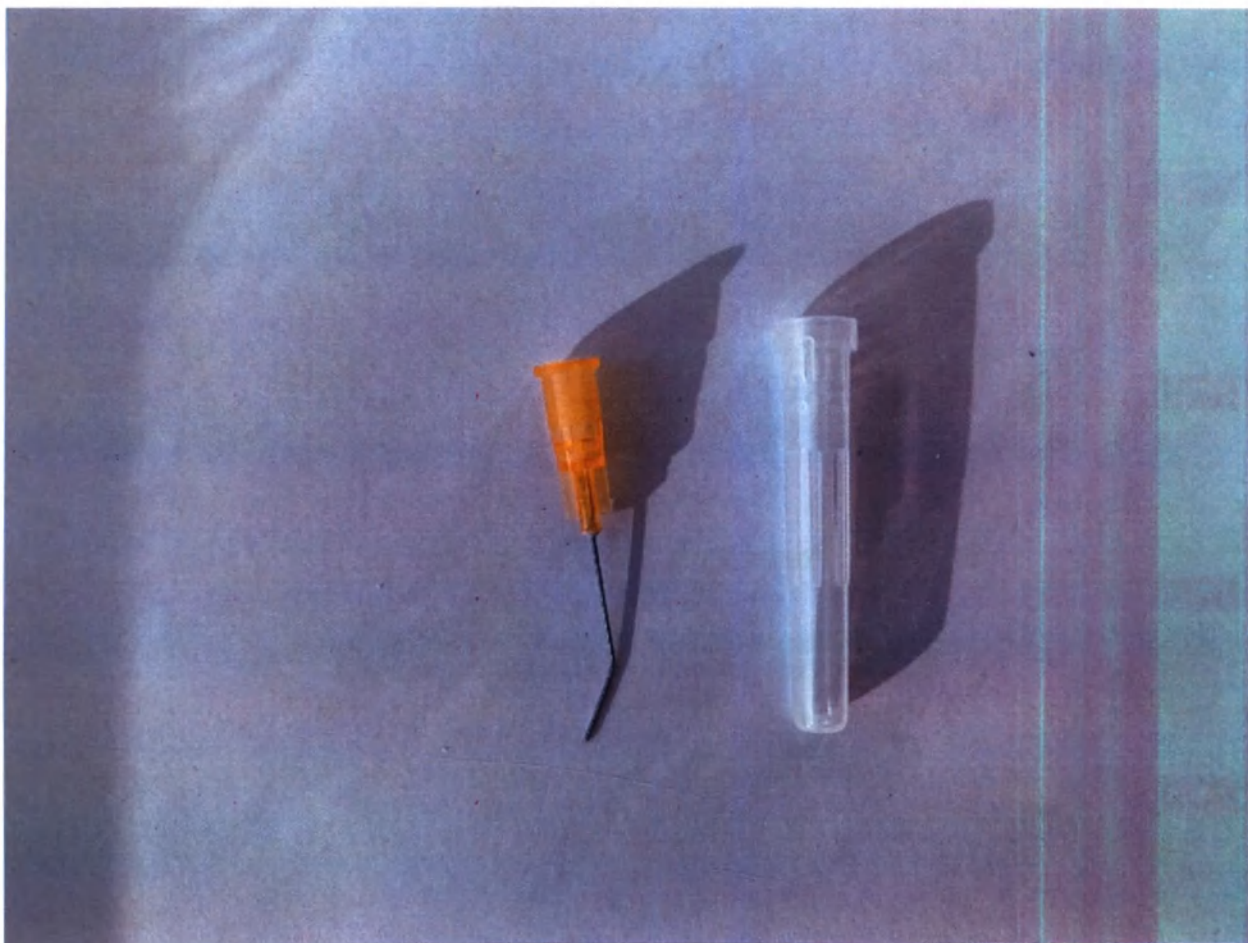


Рисунок 7 – Канюля одноразовая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАБОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕМА ГЛАЗА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
SMARTCOAT

1

Рисунок 8 – Инструкция по применению

II. Набор офтальмологический для сохранения объема глаза при проведении офтальмологических операций SmartCoat Dual



Рисунок 9 – Потребительская упаковка, вид спереди

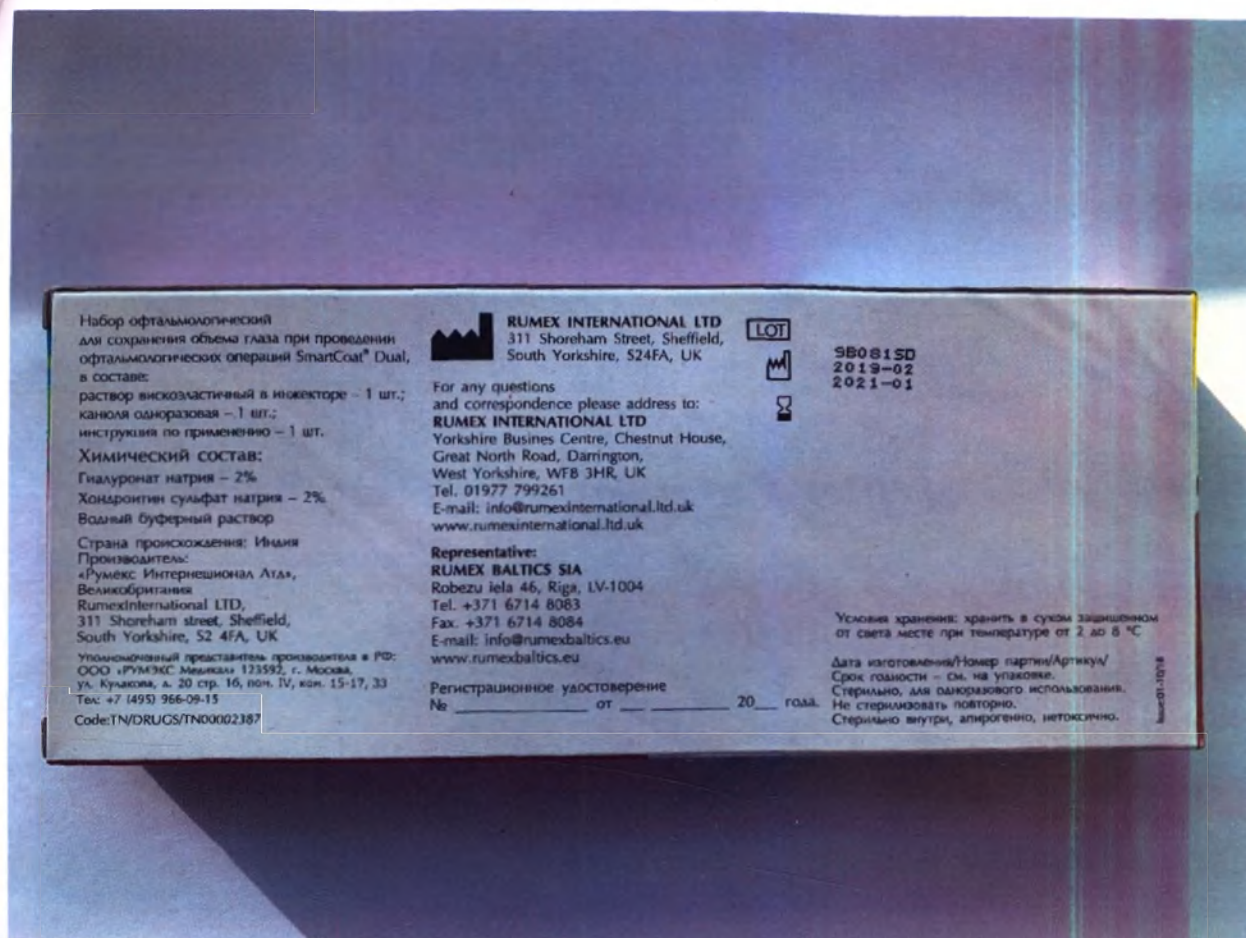


Рисунок 10 – Потребительская упаковка, вид сзади

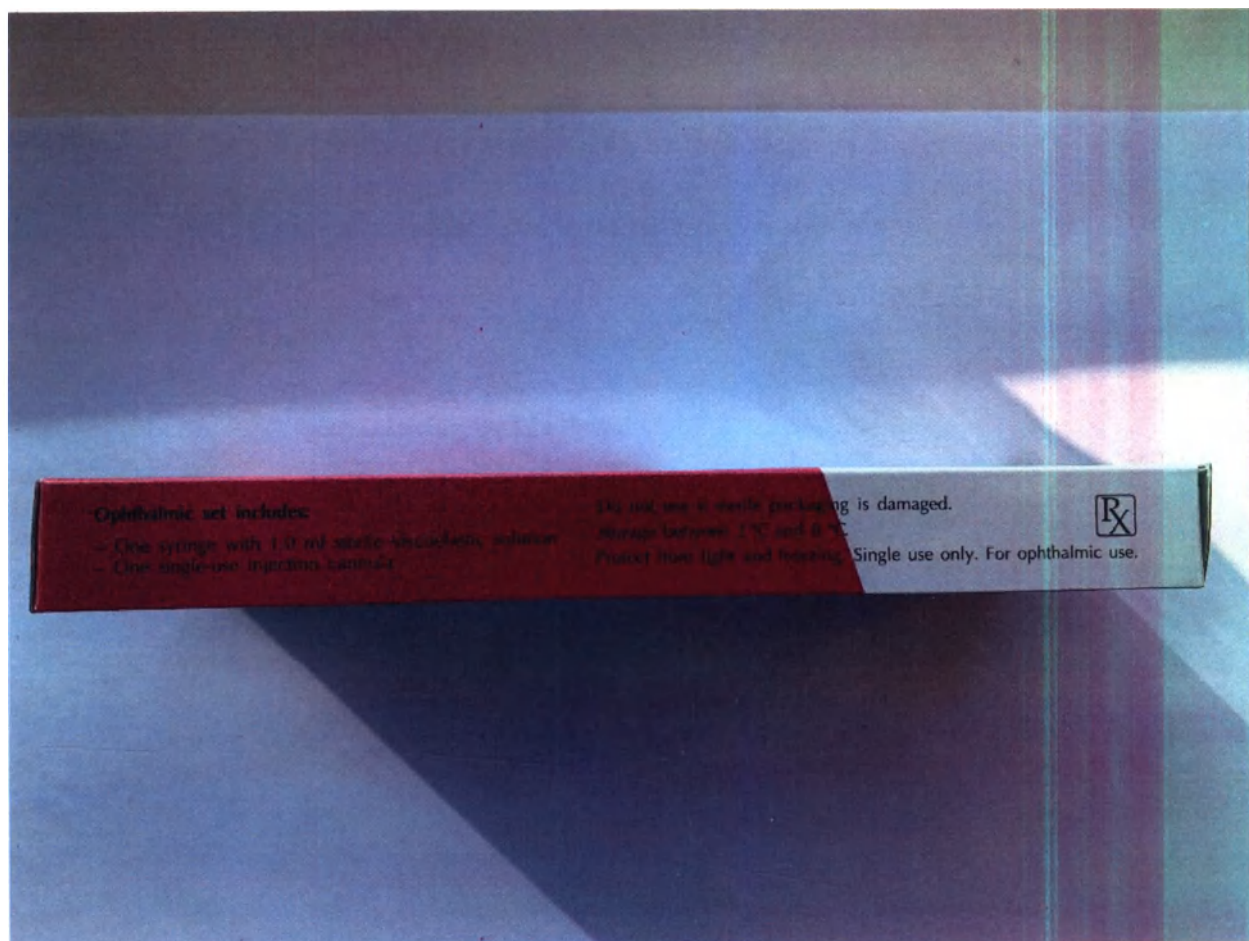


Рисунок 11 – Потребительская упаковка, вид сбоку 1



Рисунок 12 – Потребительская упаковка, вид сбоку 2

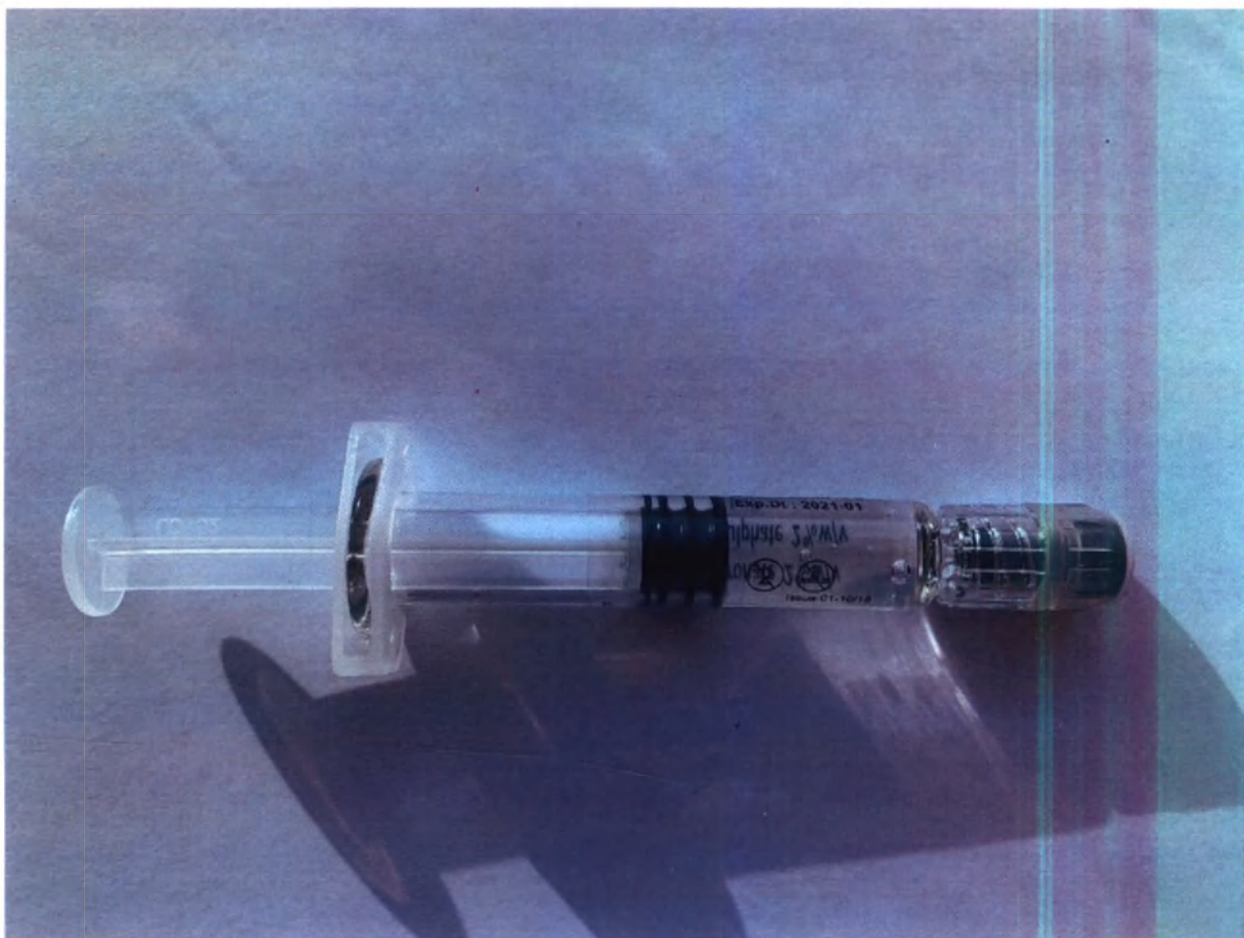


Рисунок 13 – Раствор вискоэластичный в инжекторе (вид 1)

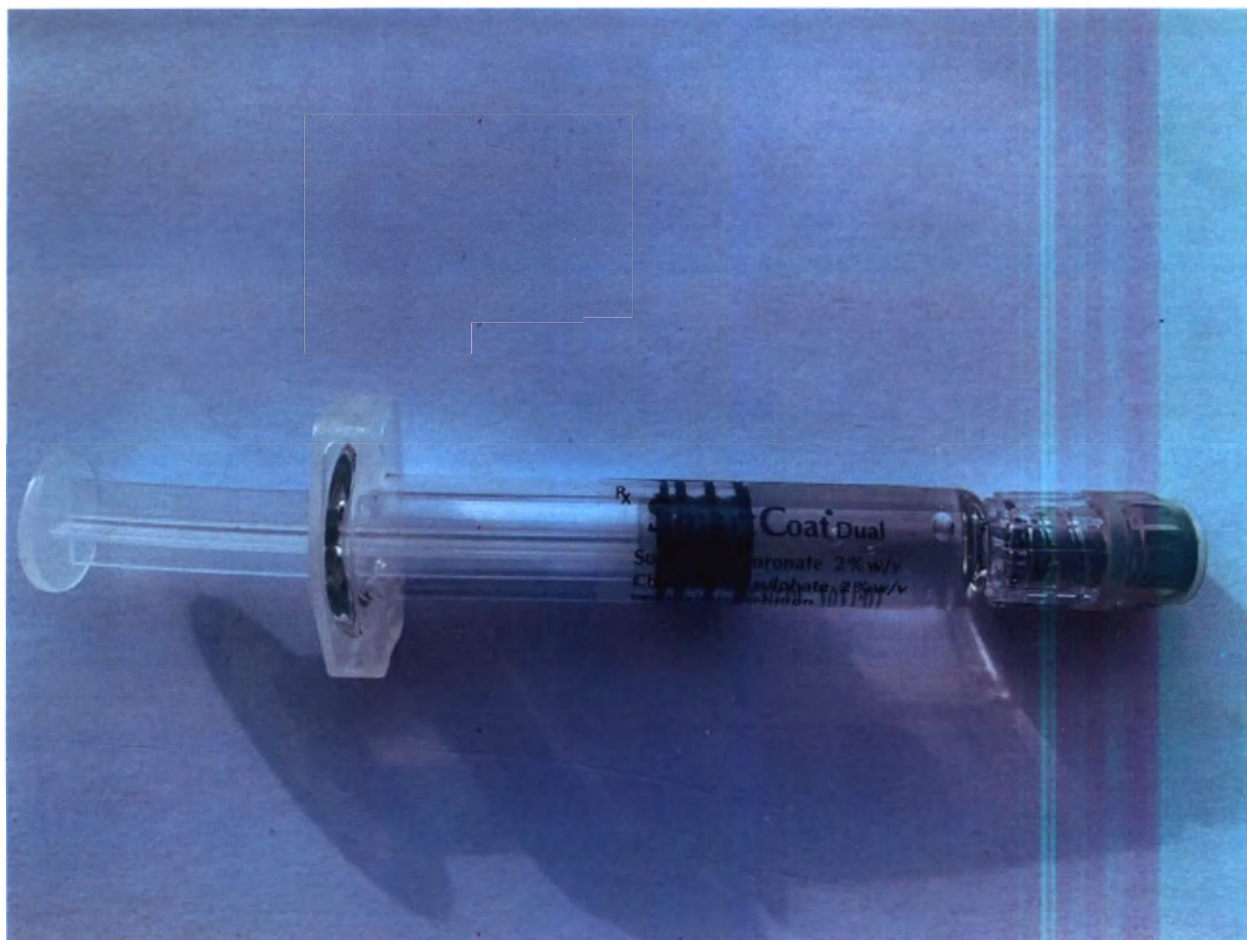


Рисунок 14 – Раствор вязкоэластичный в иньекторе (вид 2)

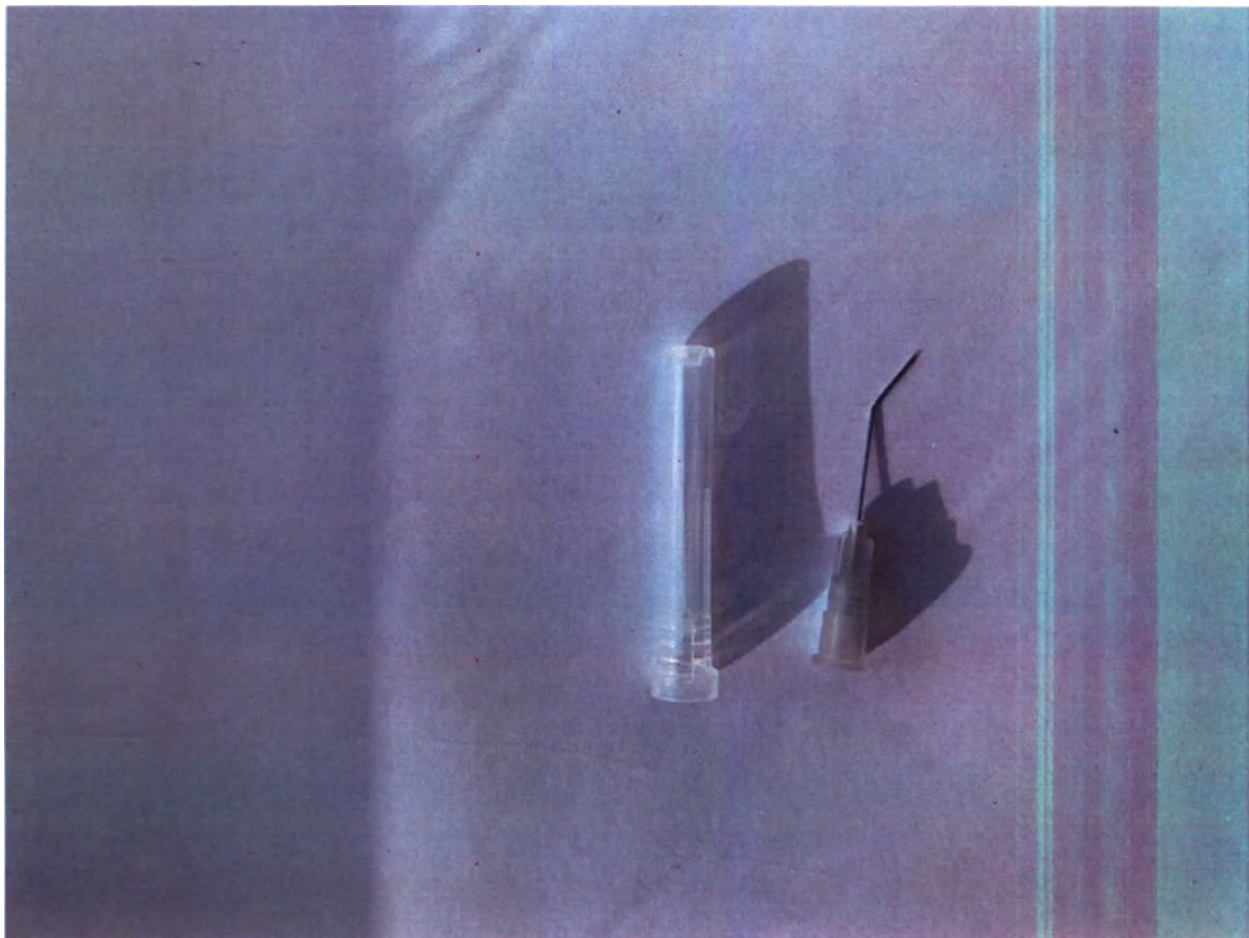


Рисунок 15 – Канюля одноразовая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**НАБОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕМА ГЛАЗА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
SMARTCOAT**

1

Рисунок 16 – Инструкция по применению

Прошито, пронумеровано

17.11.2019 лист (а/ов)
Скреплено печатью.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
МАКАРОВА Н.В.

