

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»



М.В. Кротенко

"17" февраля 2014 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сканер для моделей и слепков зубов inEos X5, с принадлежностями, производства SIRONA
Dental Systems GmbH (СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сканер для моделей и слепков зубов inEos X5
2. Блок обработки данных специальный, в составе: системный блок, клавиатура, мышь.
3. Монитор специальный.
4. Блок питания.
5. Педаль для управления сканером.
6. Держатели модели шаровые – не более 3 шт.
7. Платформы для моделей зубов – не более 8 шт.
8. Зажим специальный для слепков и моделей зубов – не более 3 шт.
9. Стаканы для сканирования гипсовой модели (30 мм) – не более 16 шт.
10. Стаканы для сканирования гипсовой модели (50 мм) – не более 4 шт.
11. Держатели для артикулятора – не более 3 шт.
12. Кабели питания – не более 4 шт.
13. Кабели соединительные – не более 5 шт.
14. Материалы пластичные для фиксации штампа или гипсовой модели – не более 5 уп.
15. Гипс для изготовления моделей зубов CEREC Stone BC, объемом от 50 до 2000 гр.– не более 4 упаковок.
16. Модель челюсти фантомная.
17. Носители электронные с ПО и технической документацией – не более 10 шт.
18. Накопители USB– не более 10 шт.
19. Конверты с защитным кодом License Voucher – не более 15 шт.
20. Техническая документация.

Сканер для моделей и слепков зубов
inEosX5.




Блок обработки данных специальный, в составе: системный блок, клавиатура, мышь.



Монитор специальный.



Блок питания.

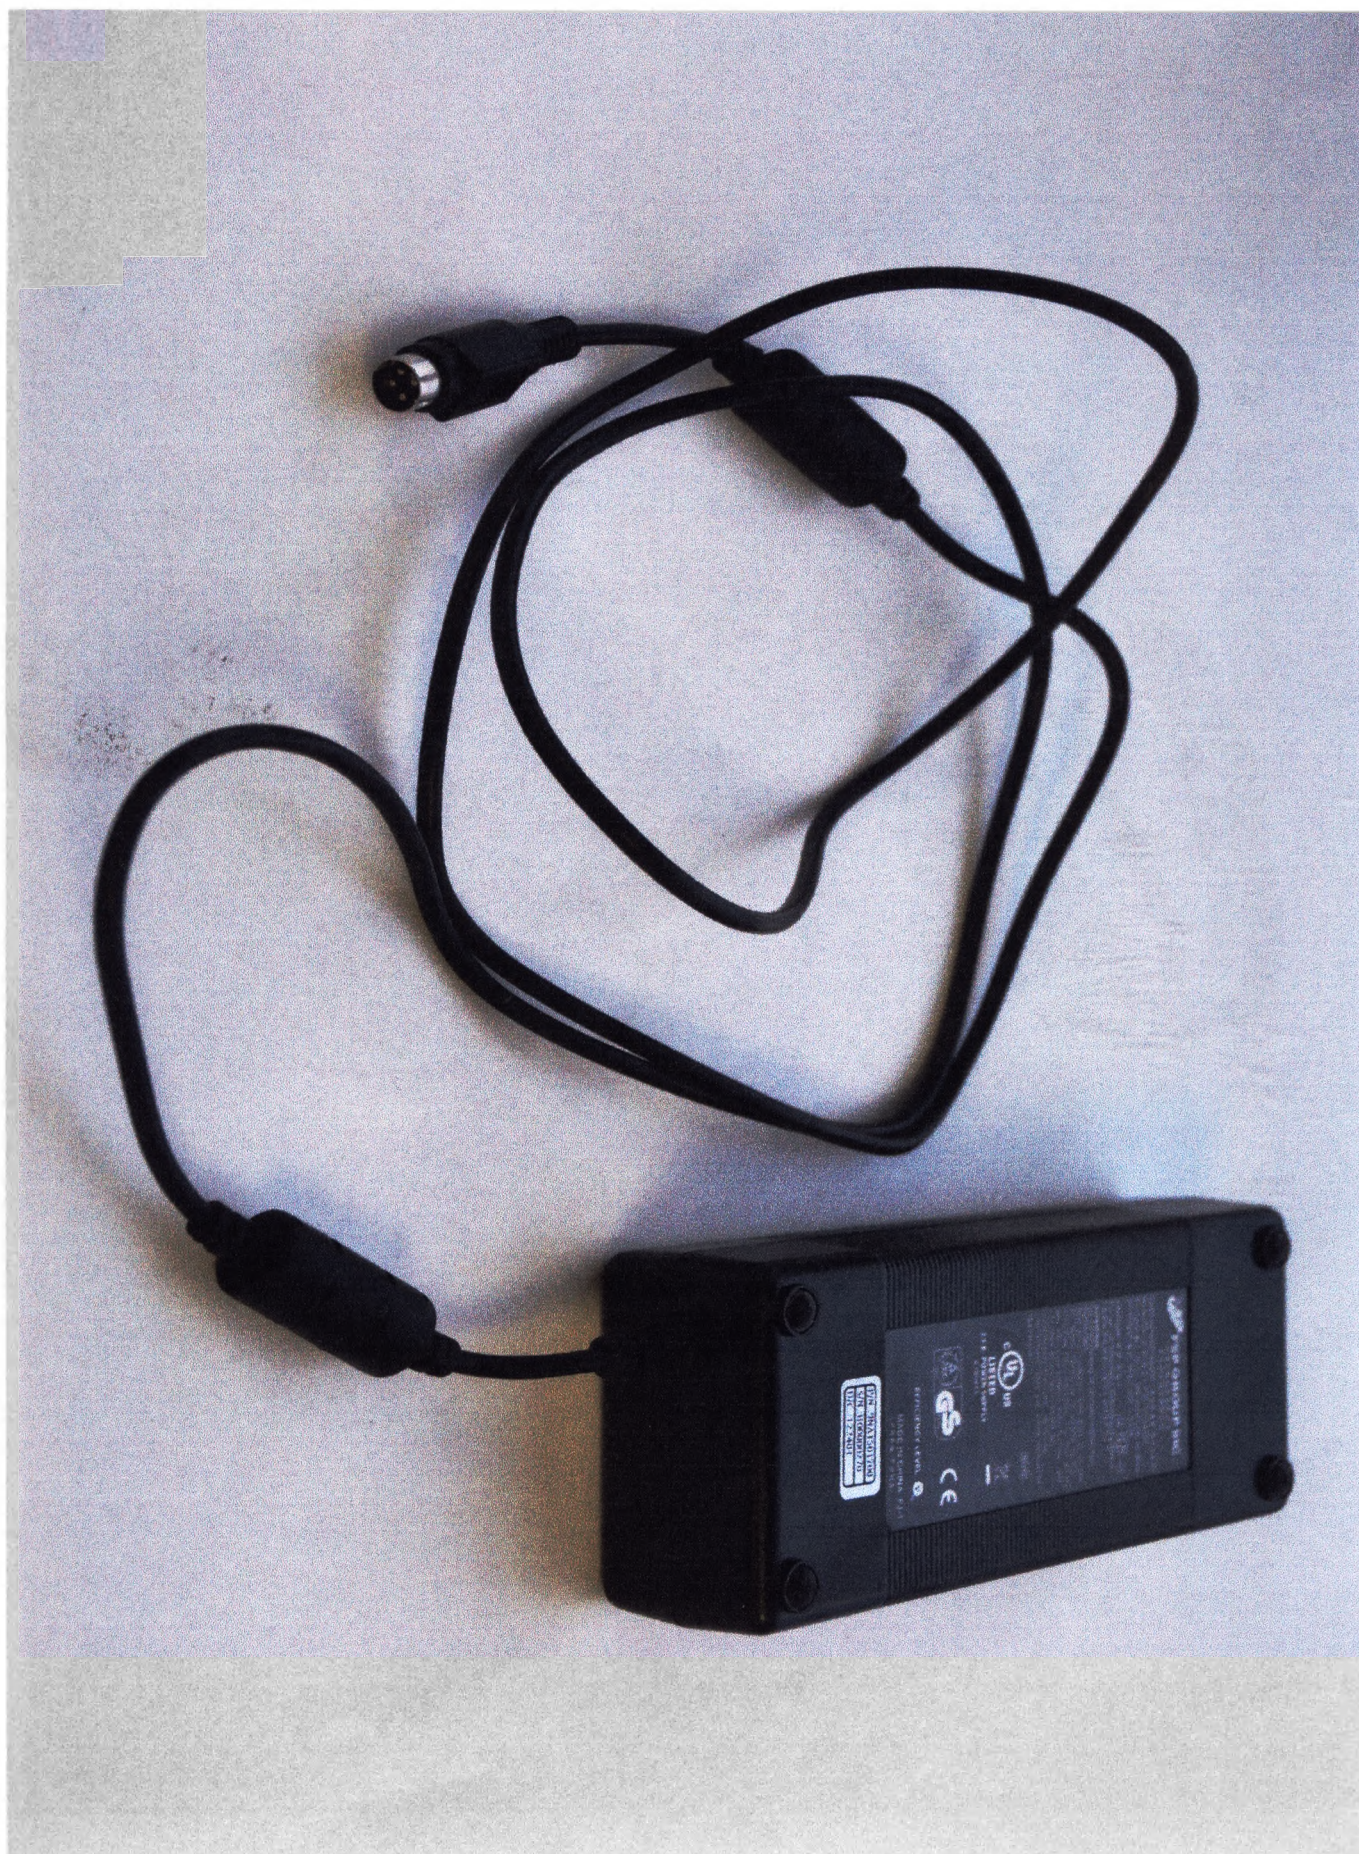


Педаль для управления сканером.




Держатели модели шаровые – не более 3 шт.



Платформы для моделей зубов – не более 8 шт.

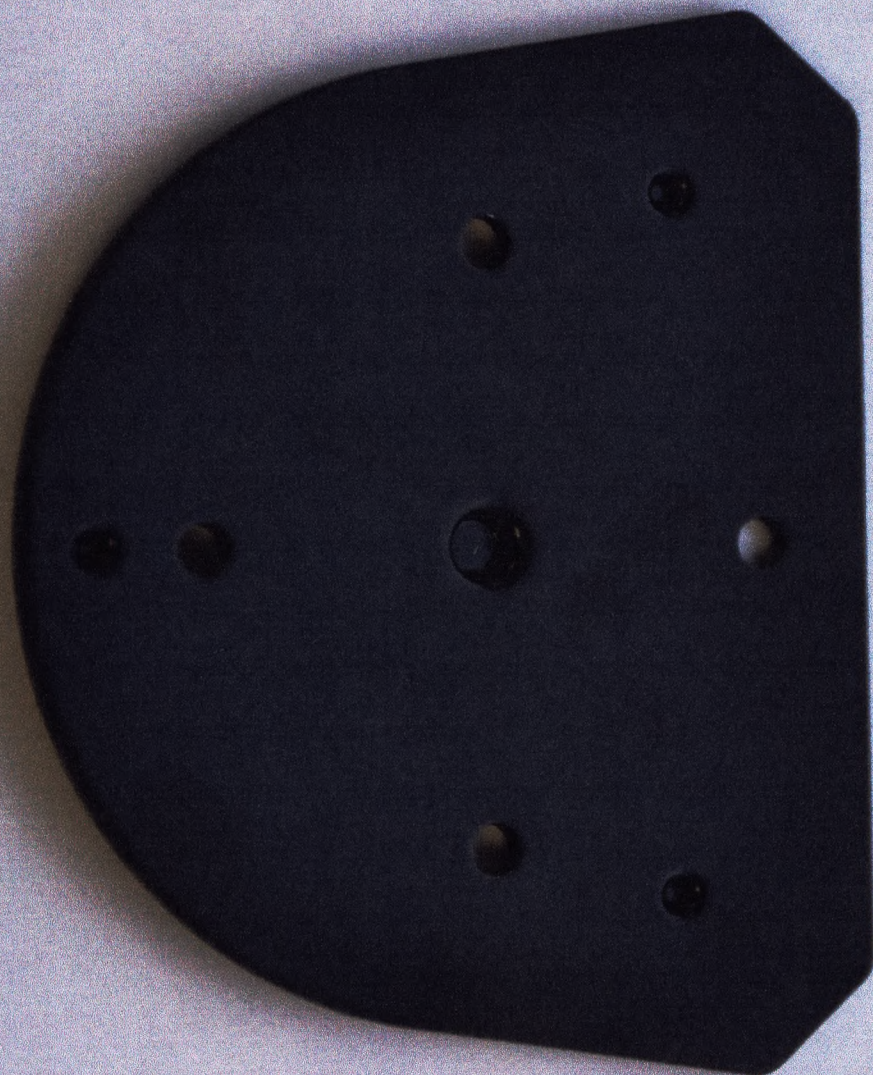


зажим специальный для слепков и моделей зубов – не более 3 шт.

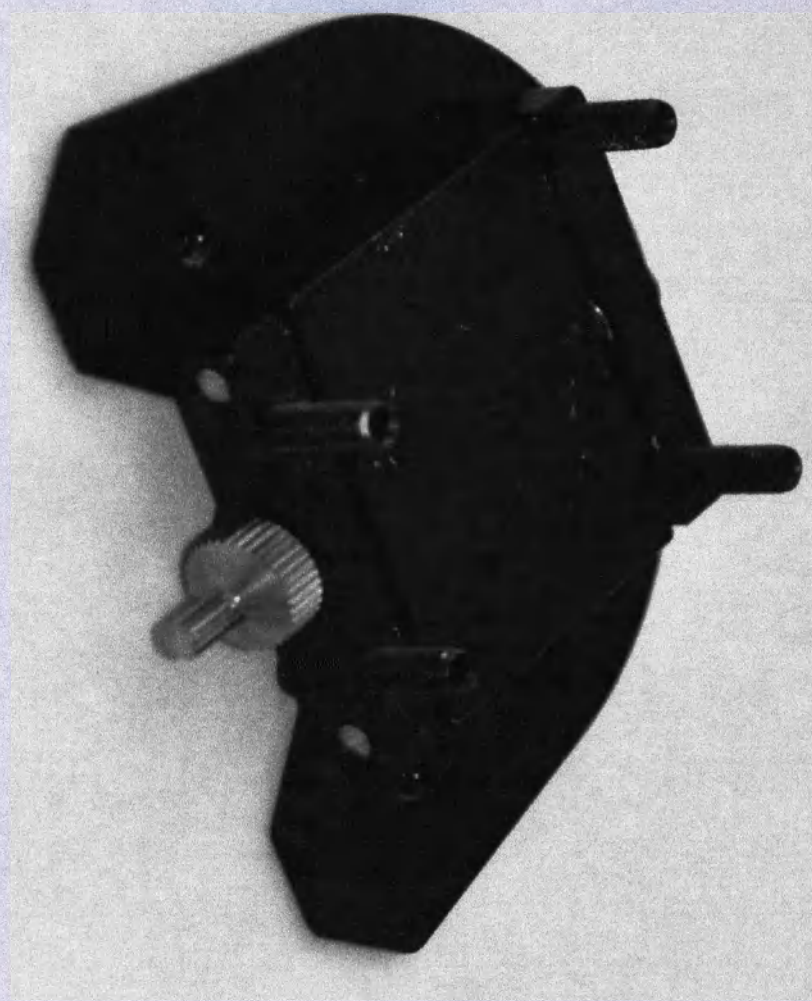

таканы для сканирования гипсовой модели (30 мм), (50 мм).




держатели для артикулятора – не более 3 шт.

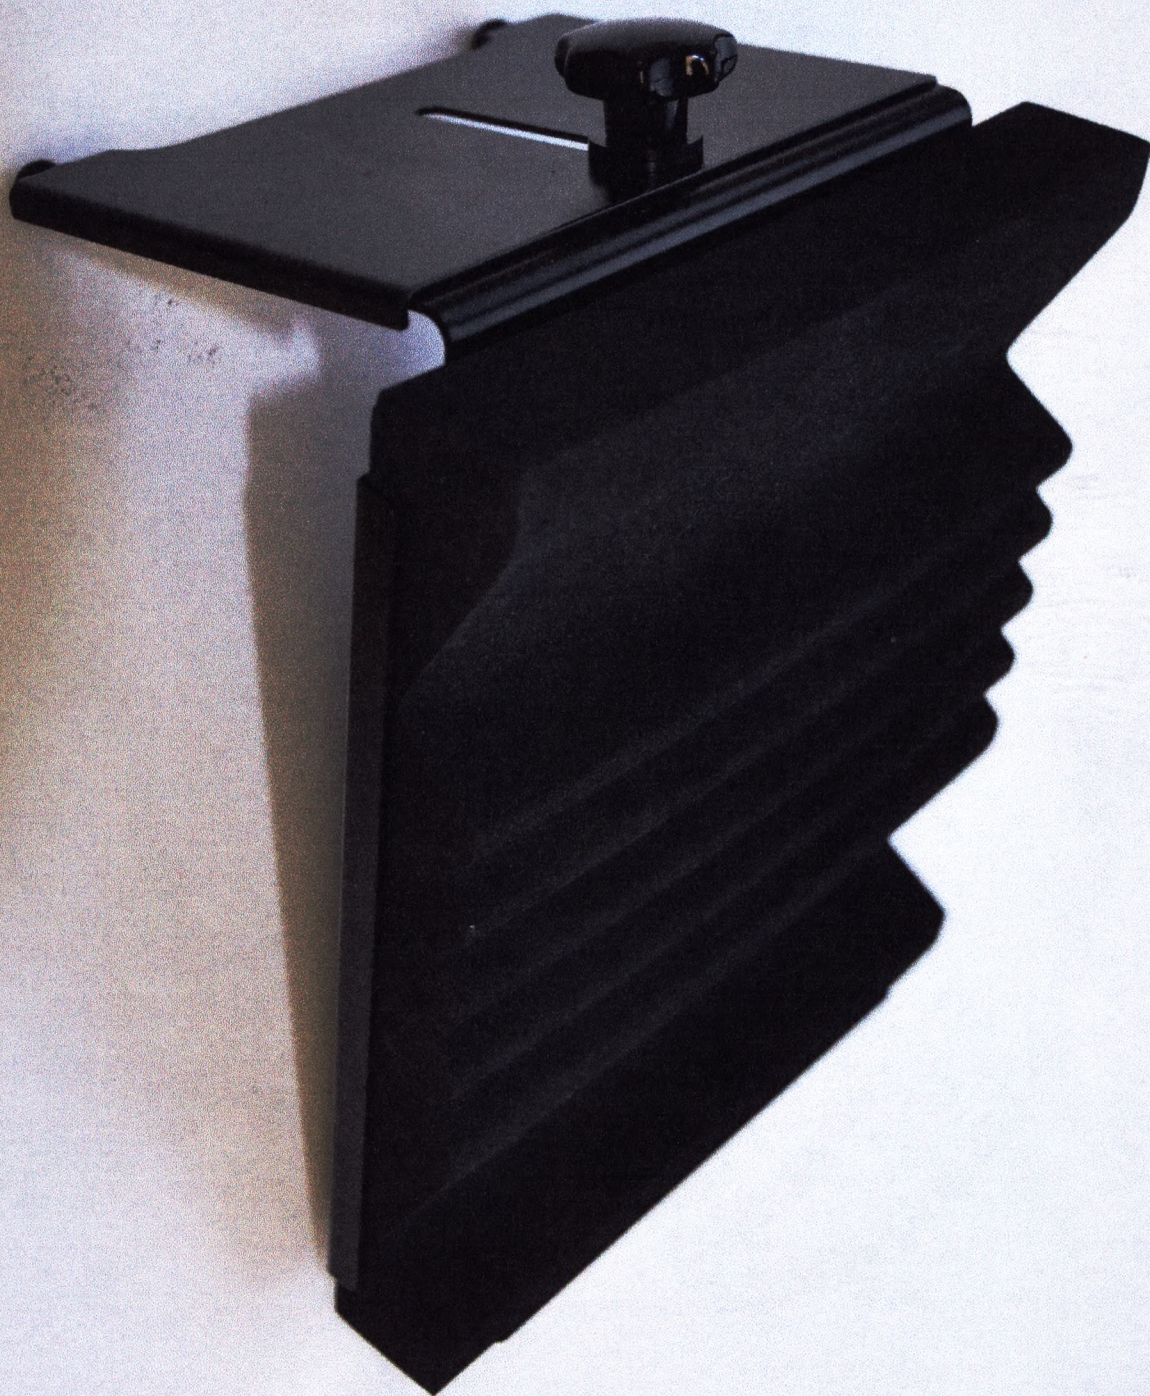

кабели питания – не более 4 шт.





Кабели соединительные – не более 5 шт.

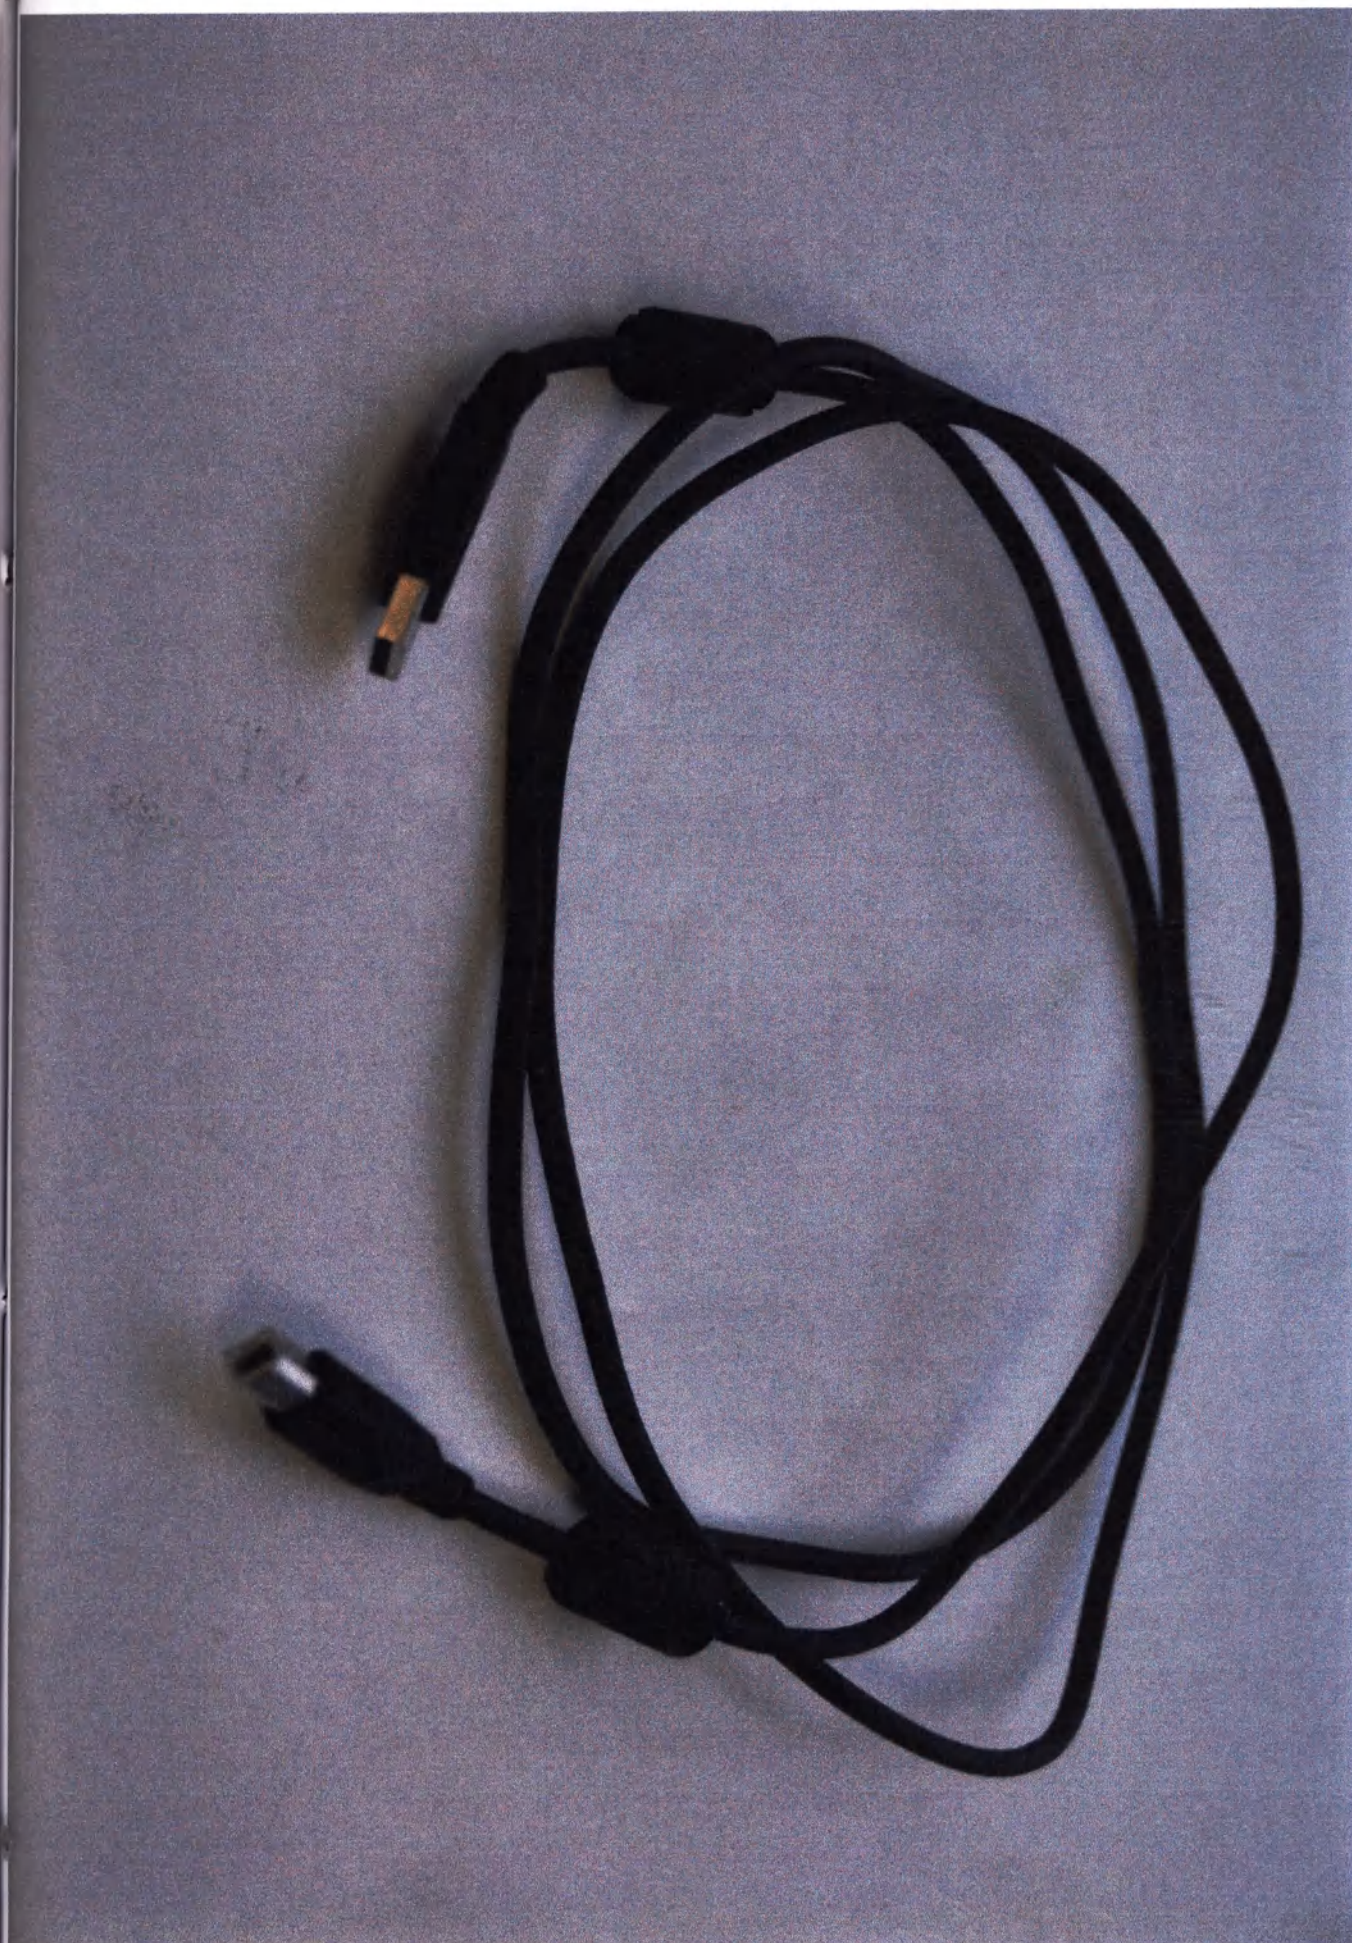


материалы пластичные для фиксации штампа или гипсовой модели – не более 5 уп.



ипс для изготовления моделей зубов CEREC Stone BC, объемом от 50 до 2000 гр.– не более 4 паковок.

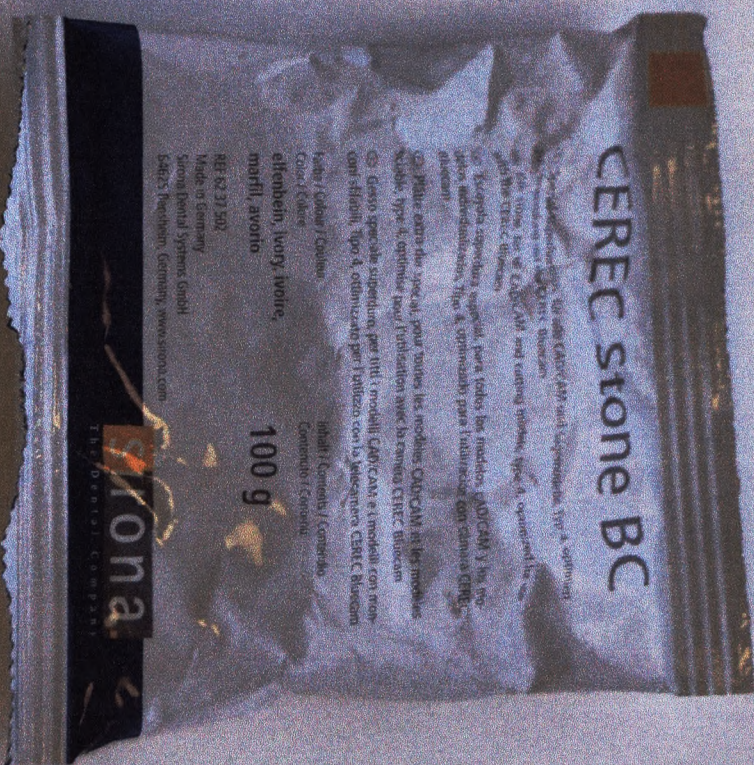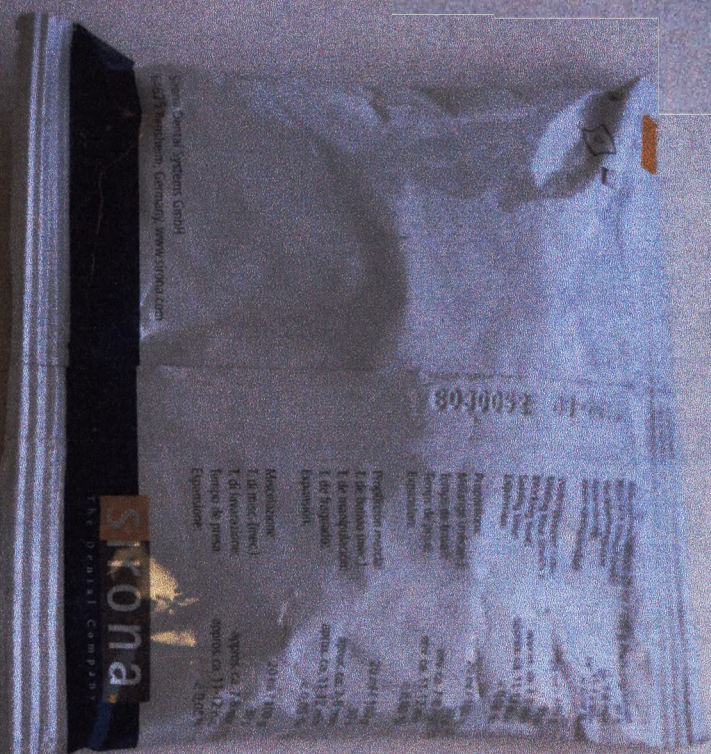



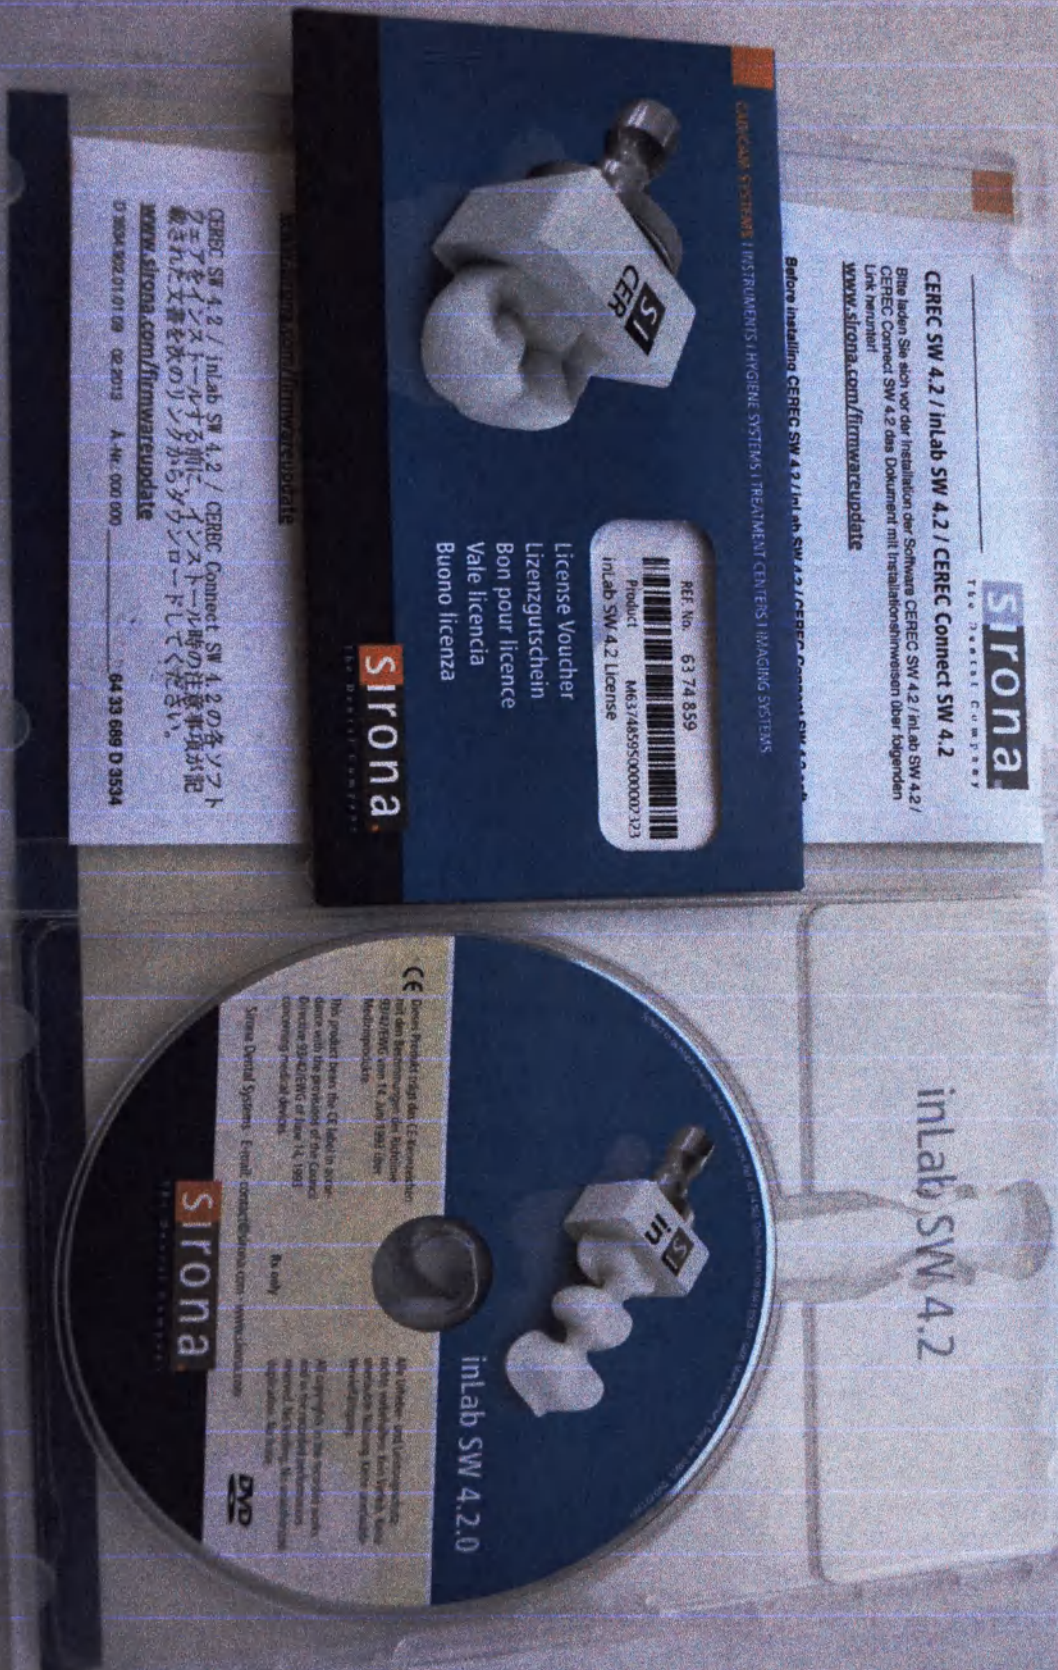

Накопители USB— не более 10 шт.



CAD/CAM SYSTEMS | INSTRUMENTS | HYGIENE SYSTEMS | TREATMENT CENTERS | IMAGING SYSTEMS



REF. No. 63 74 859



Product M6374859S0000002323
inLab SW 4.2 License

License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

sirona.
The Dental Company

[illegible]


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

I. Сканер для моделей и слепков зубов inEos X5.

II. Принадлежности:

1. Блок обработки данных специальный, в составе: системный блок, клавиатура, мышь.
2. Монитор специальный.
3. Блок питания.
4. Педаль для управления сканером.
5. Держатели модели шаровые – не более 3 шт.
6. Платформы для моделей зубов – не более 8 шт.
7. Зажим специальный для слепков и моделей зубов – не более 3 шт.
8. Стаканы для сканирования гипсовой модели (30 мм) – не более 16 шт.
9. Стаканы для сканирования гипсовой модели (50 мм) – не более 4 шт.
10. Держатели для артикулятора – не более 3 шт.
11. Кабели питания – не более 4 шт.
12. Кабели соединительные – не более 5 шт.
13. Материалы пластичные для фиксации штампа или гипсовой модели – не более 5 уп.
14. Гипс для изготовления моделей зубов CEREC Stone BC, объемом от 50 до 2000 гр. – не более 4 упаковок.
15. Модель челюсти фантомная.
16. Носители электронные с ПО и технической документацией – не более 10 шт.
17. Накопители USB – не более 10 шт.
18. Конверты с защитным кодом License Voucher – не более 15 шт.
19. Техническая документация.

Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»



М. В. Кротенко

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 22 лист (ов)

М.В. Кротенко

