

ООО «Медтроник»
Башня на Набережной
ММДЦ «Москва-Сити»
123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10,
эт.9, пом. III, ком. 41

tel (+7 495) 580 73 77
fax (+7 495) 580 73 78
www.medtronic.ru




УТВЕРЖДАЮ
ООО «Медтроник»
Генеральный директор
Е.В. Плясунова
28 декабря 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Одноразовая кассета Endo GIA с технологией Tri-Staple,
производства Covidien Llc, USA (Ковидиен Ллс, США)

Одноразовая кассета Endo GIA с технологией Tri-Staple, варианты исполнения:

1. Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple

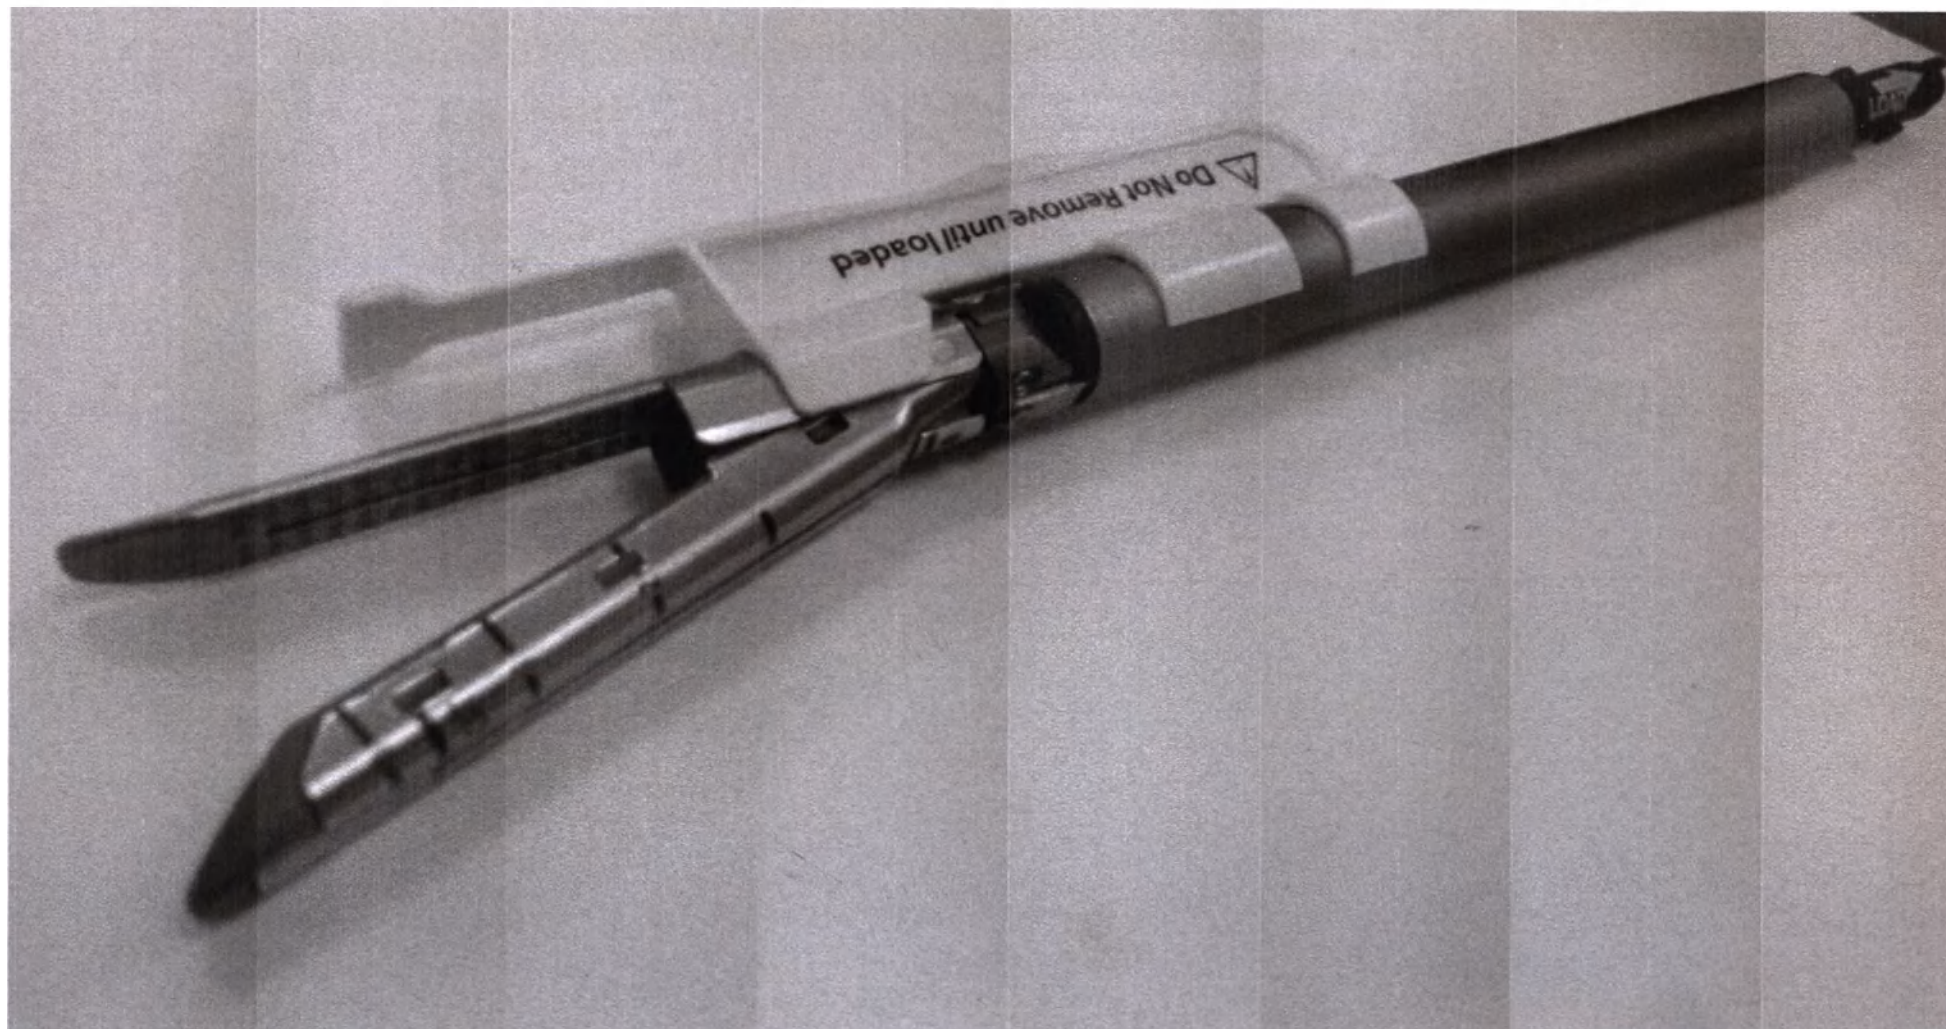


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple»

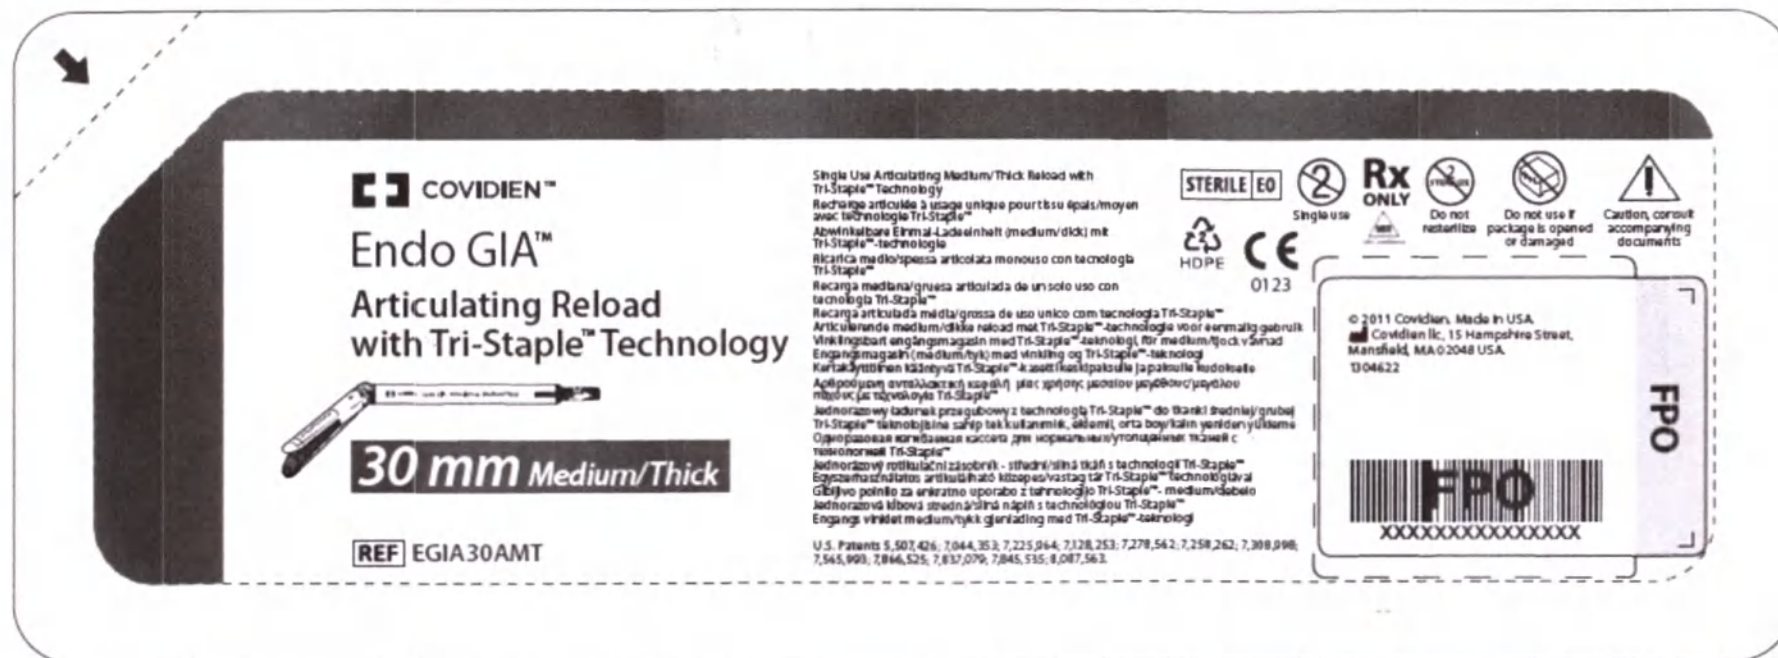


Пример русскоязычного стикера МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple»

	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение №__ от__	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		

2. Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple

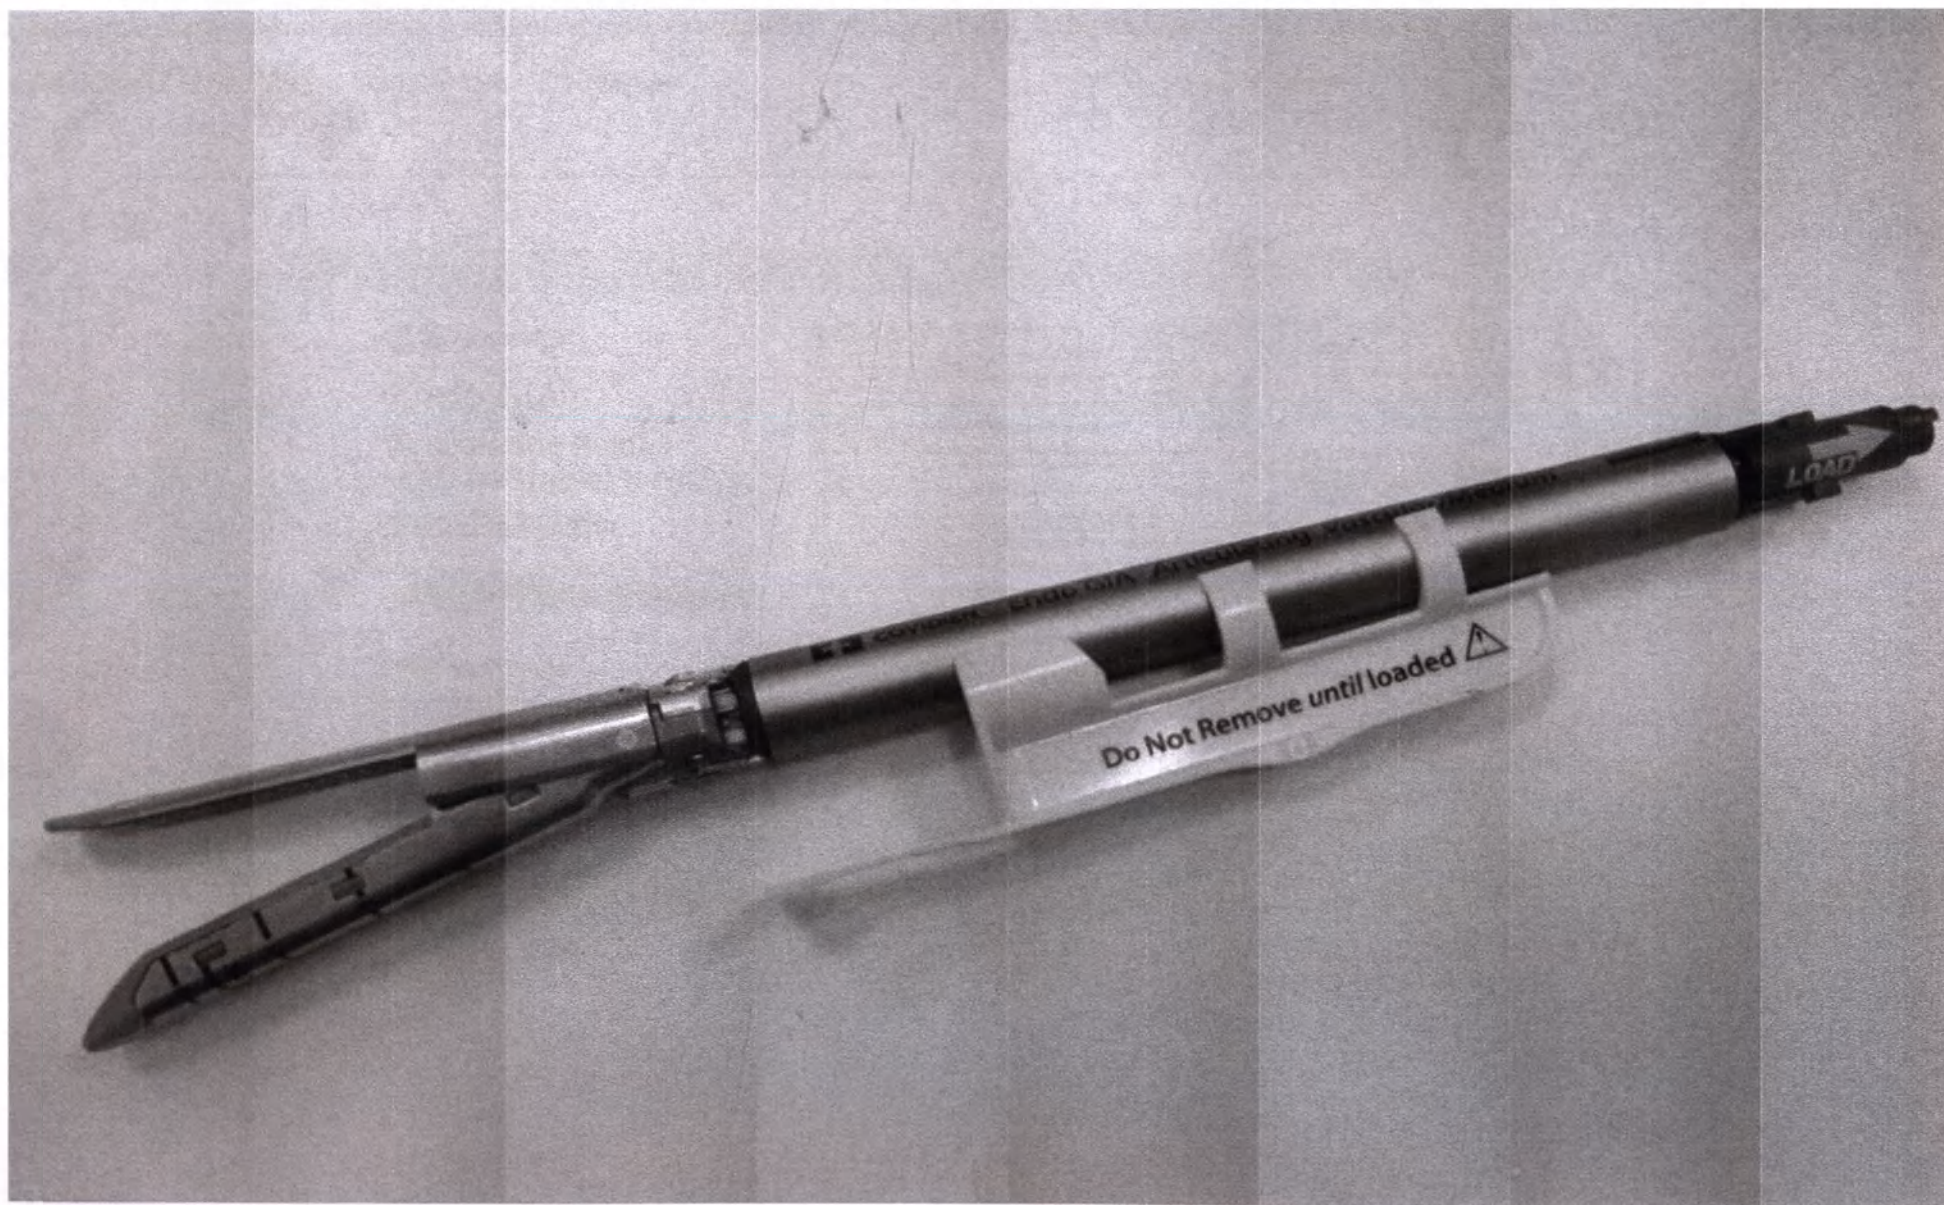


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple»

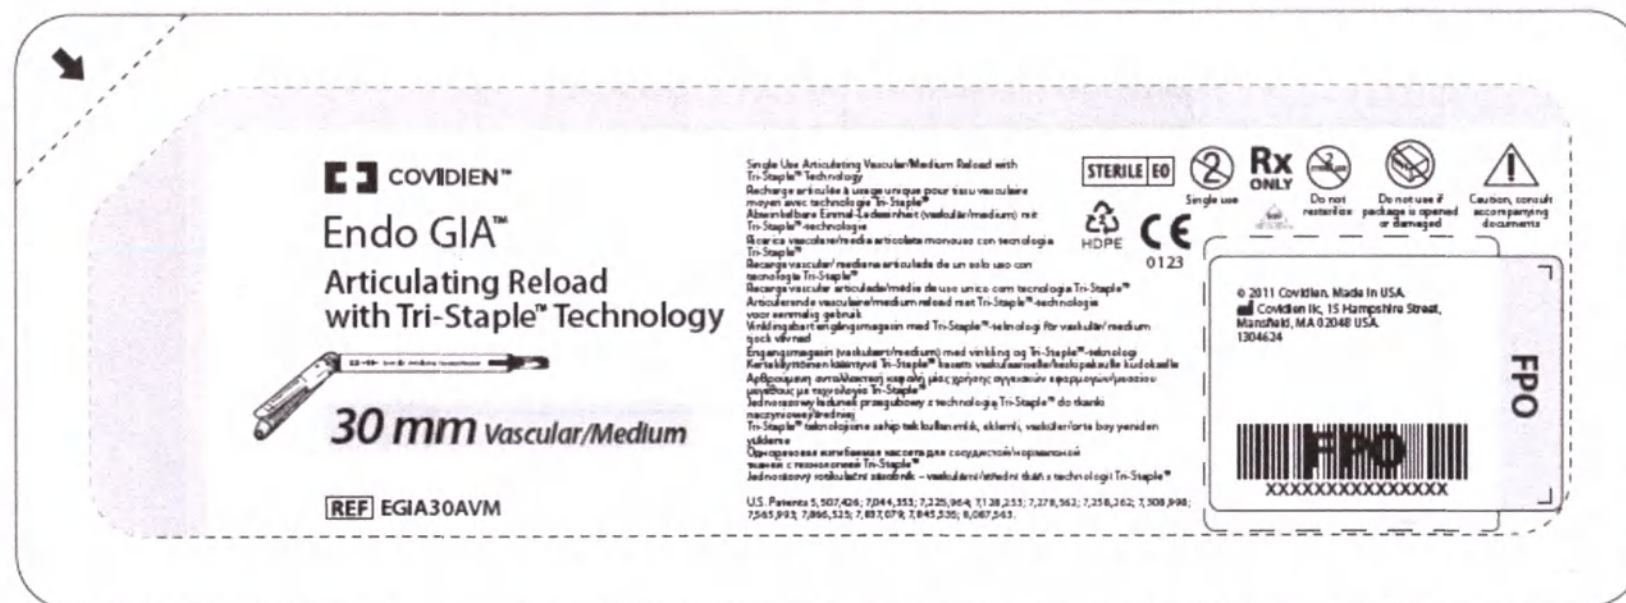


Пример русскоязычного стикера МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple»

	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 30 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение №____ от____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		

3. Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple

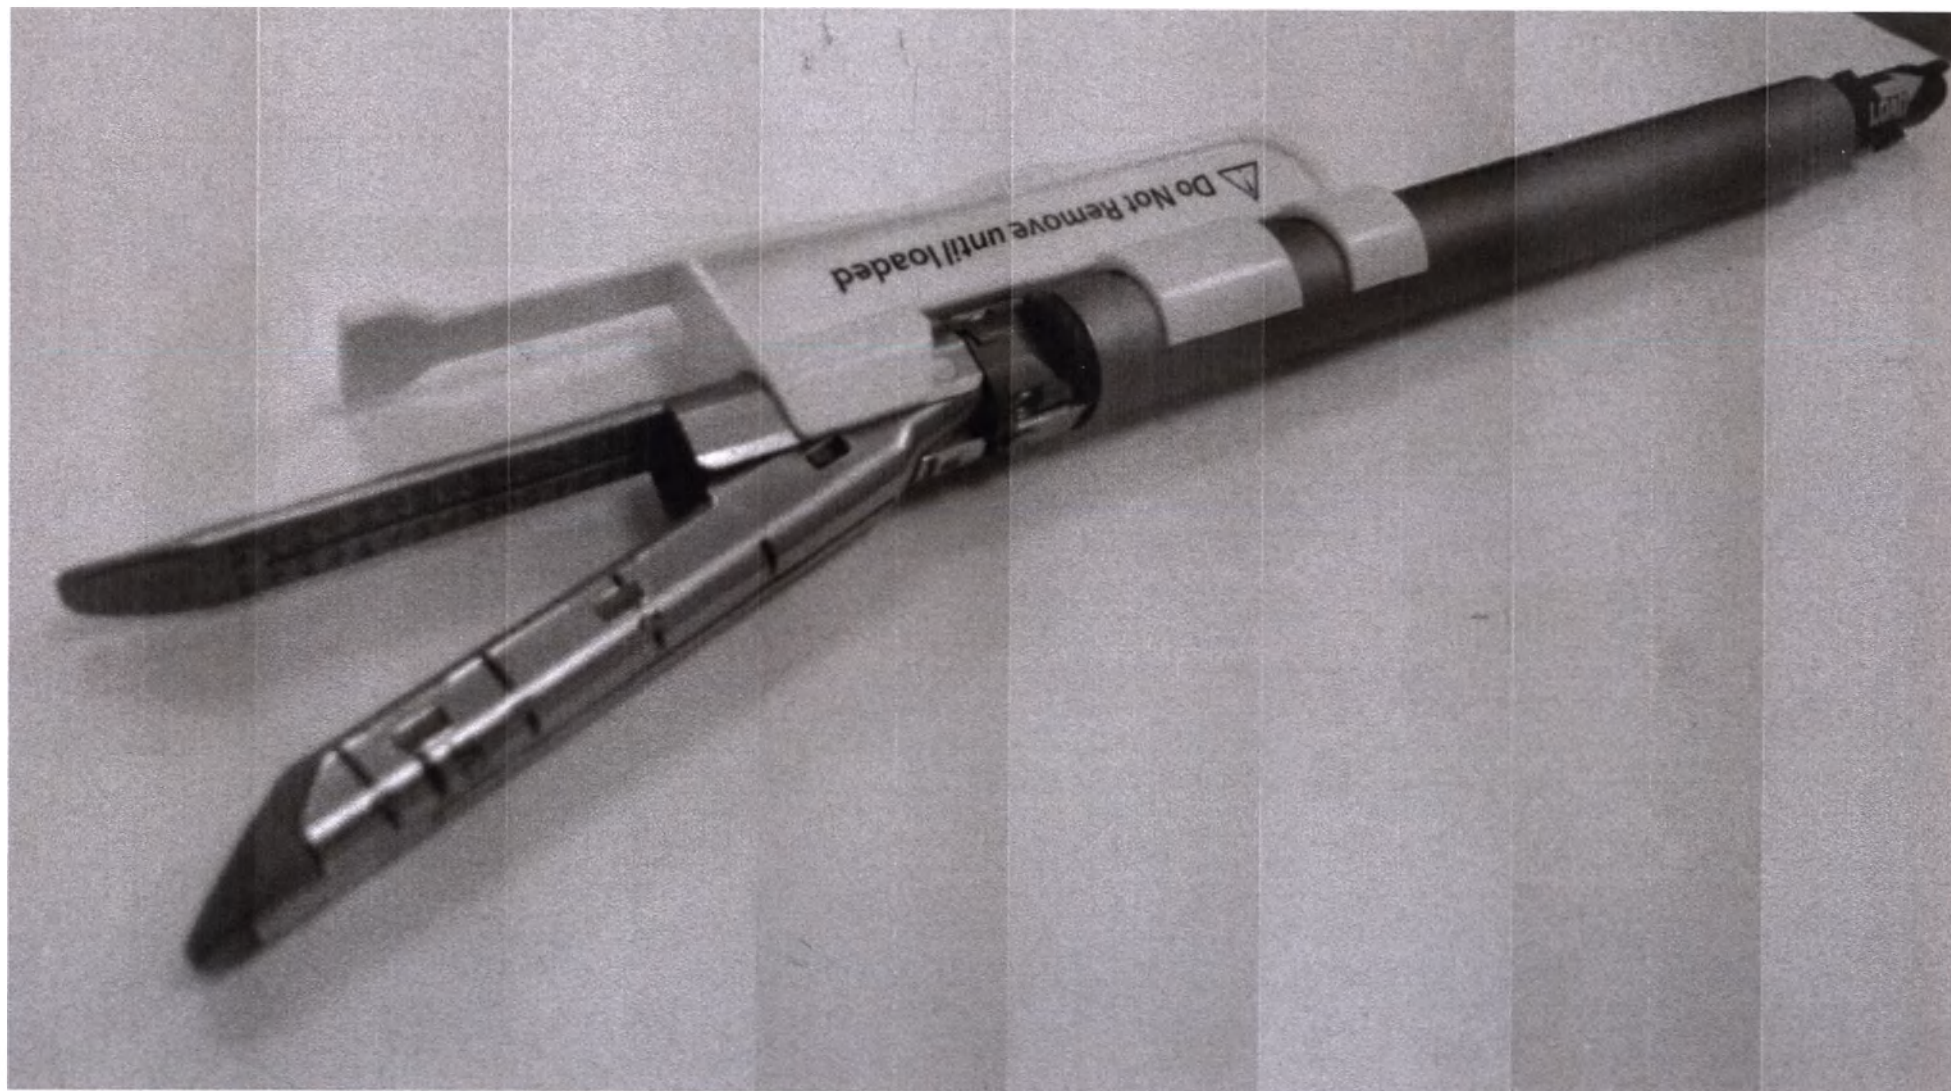


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple»

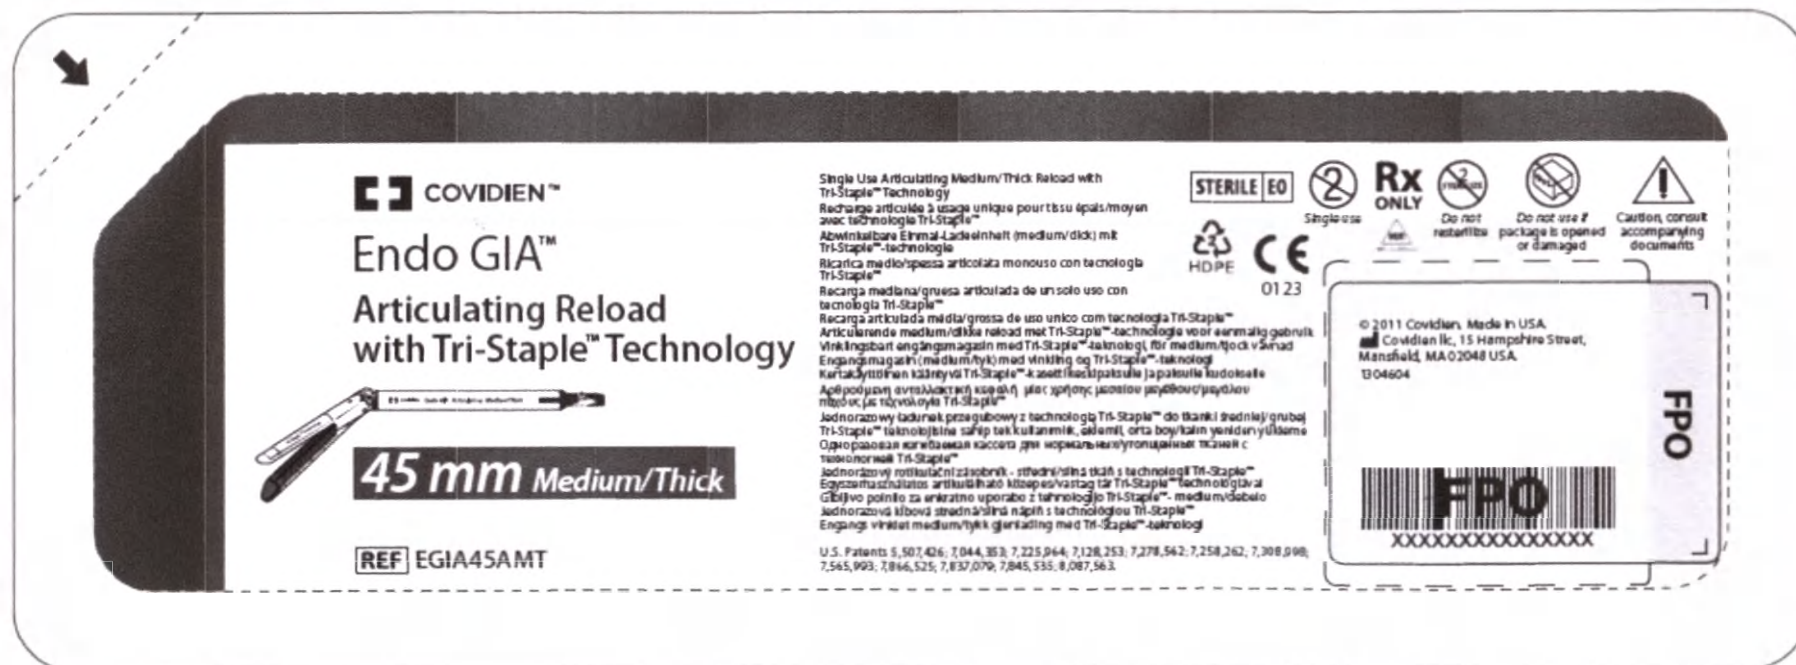


Пример русскоязычного стикера МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple»

	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		


4. Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple

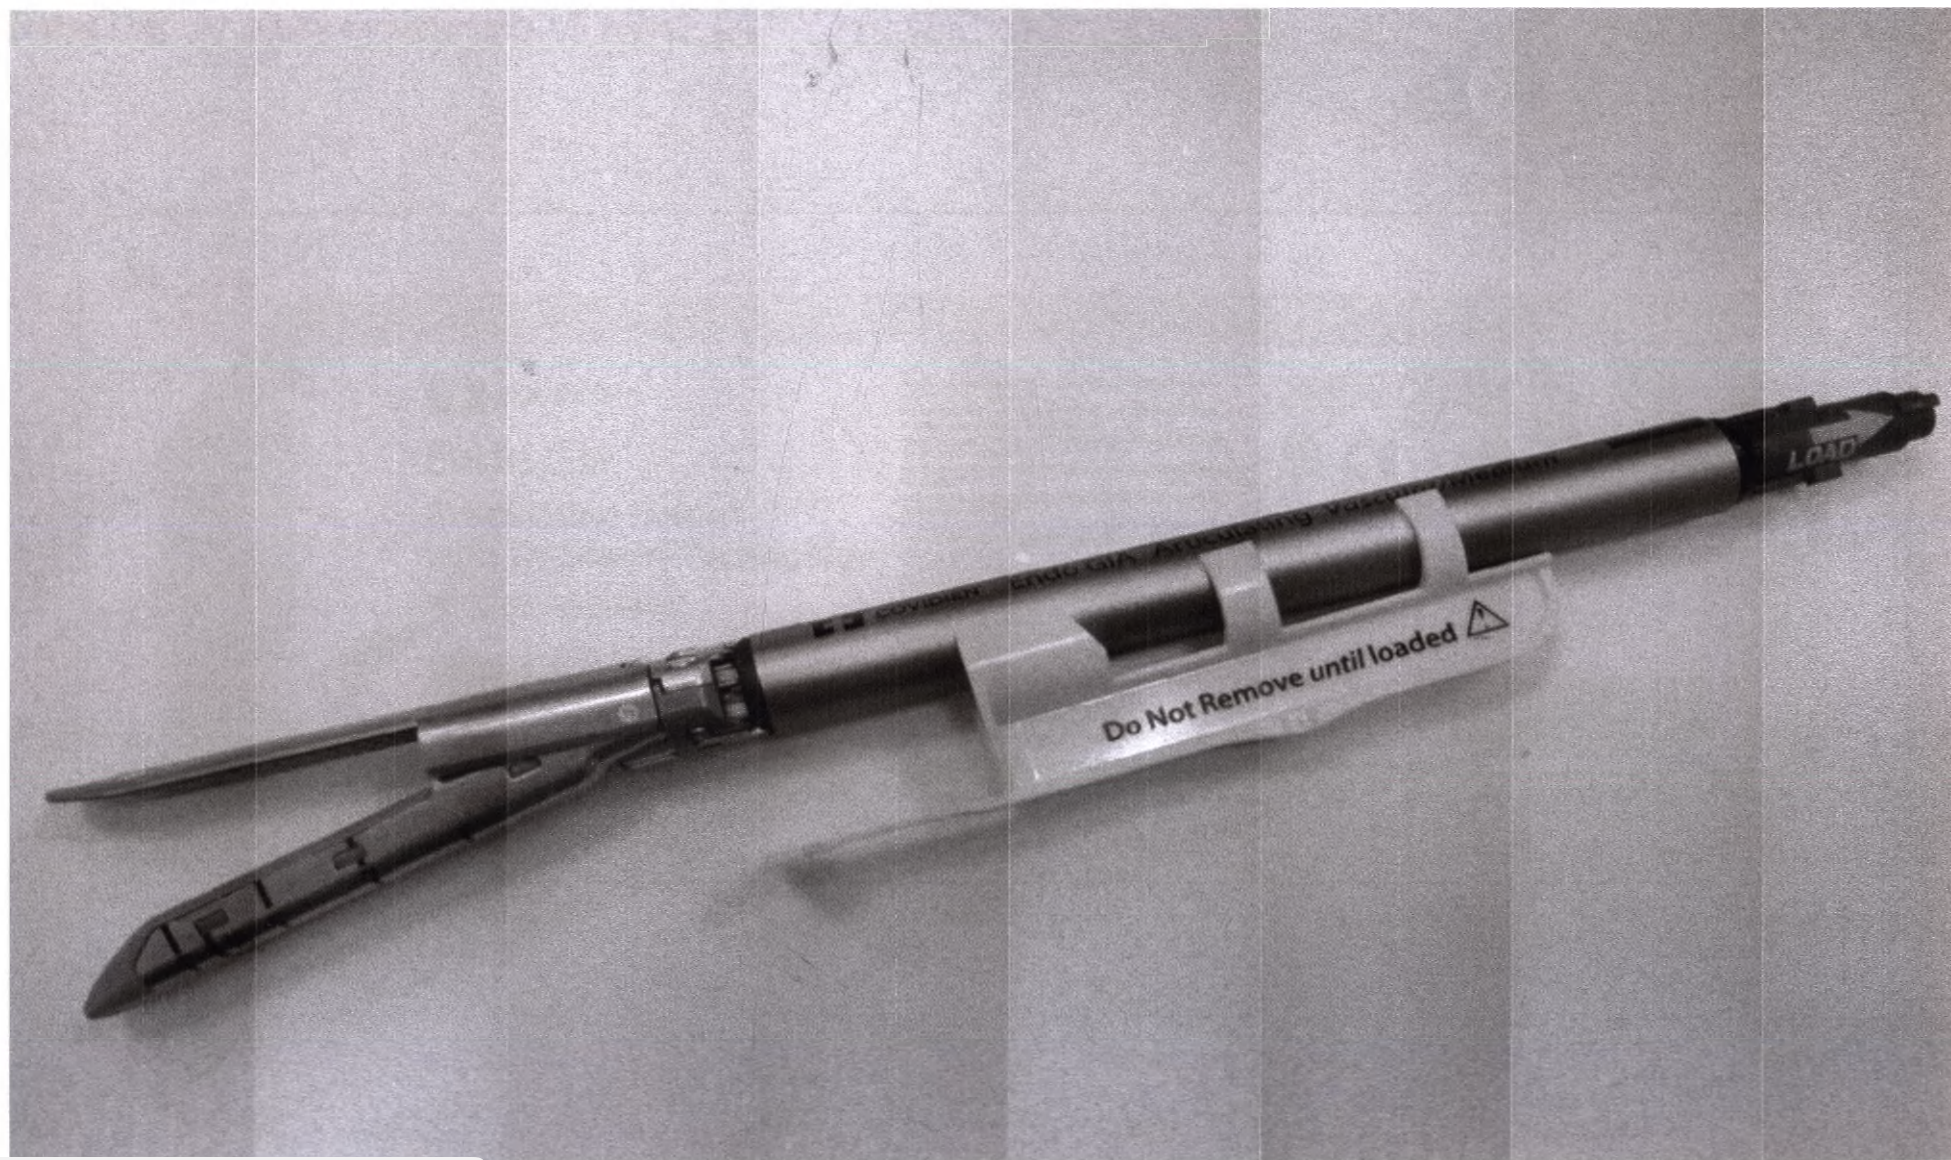


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple»

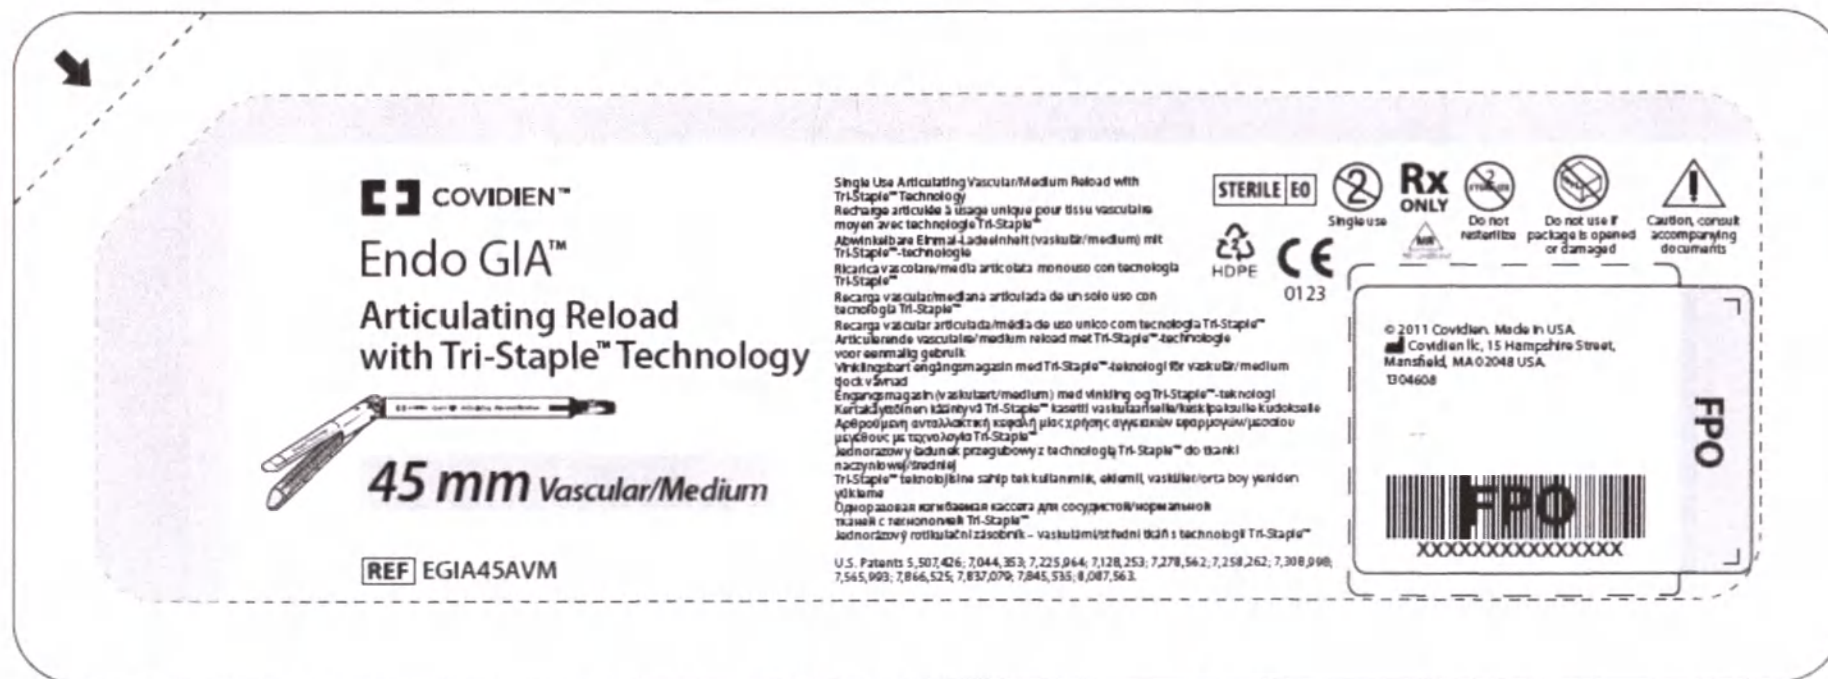


Пример русскоязычного стикера МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple»

	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		


5. Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 45 мм

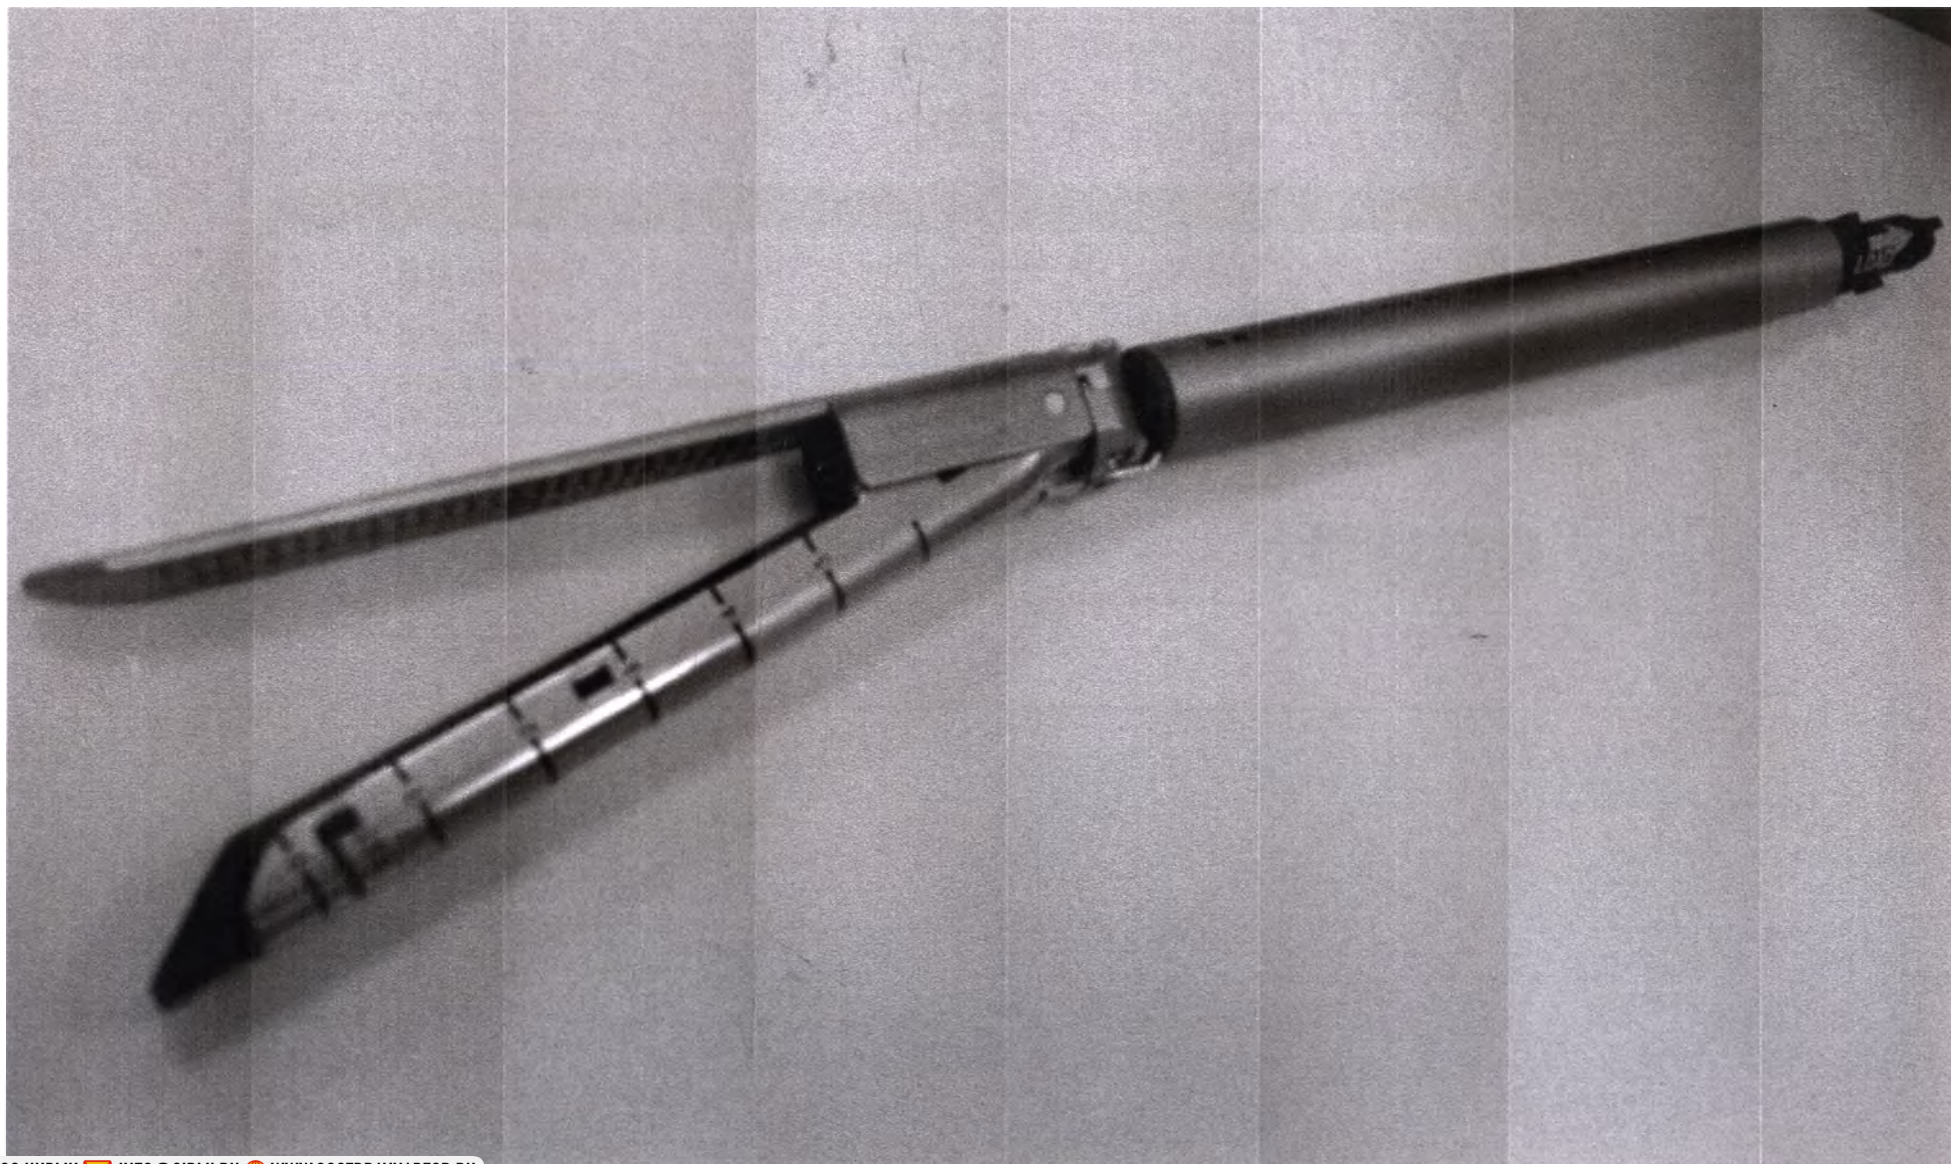


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 45 мм»

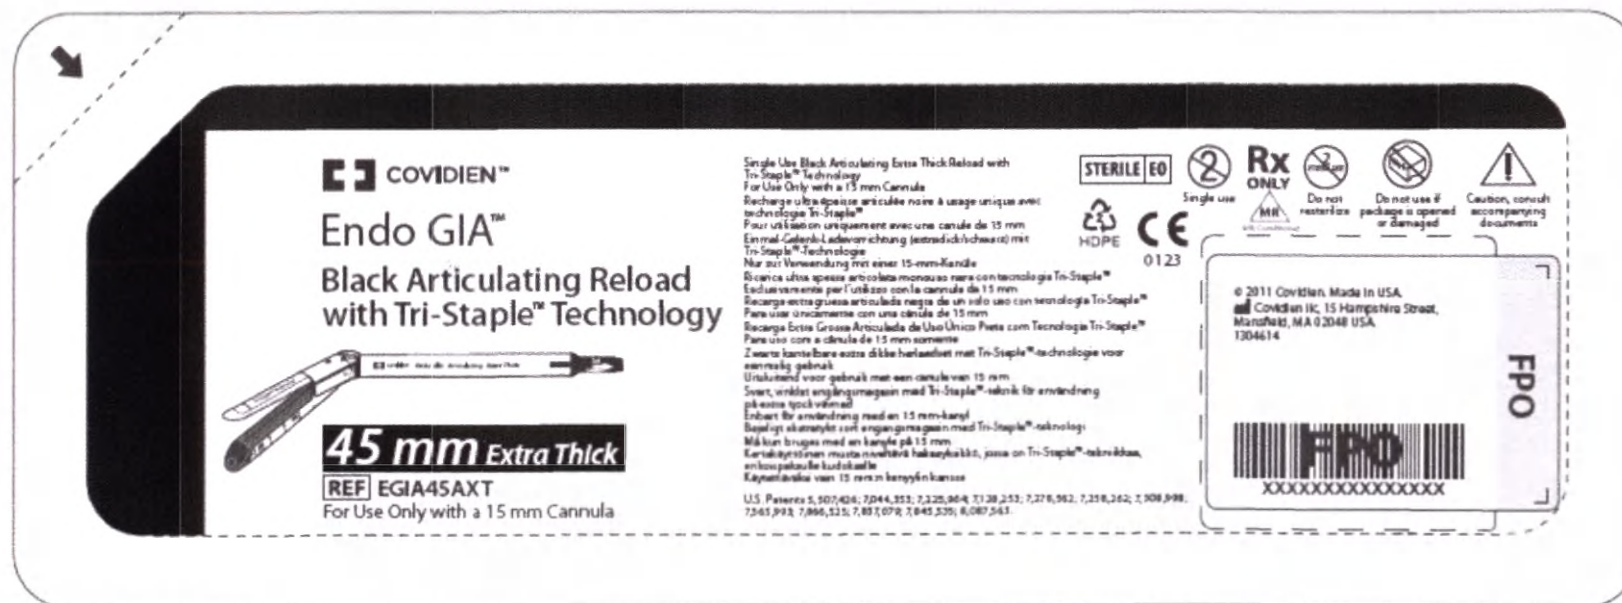


Пример русскоязычного стикера МИ «Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 45 мм»

	Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 45 мм	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № ____ от ____	
	Дата изгот./Серия/Годе до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		


6. Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple

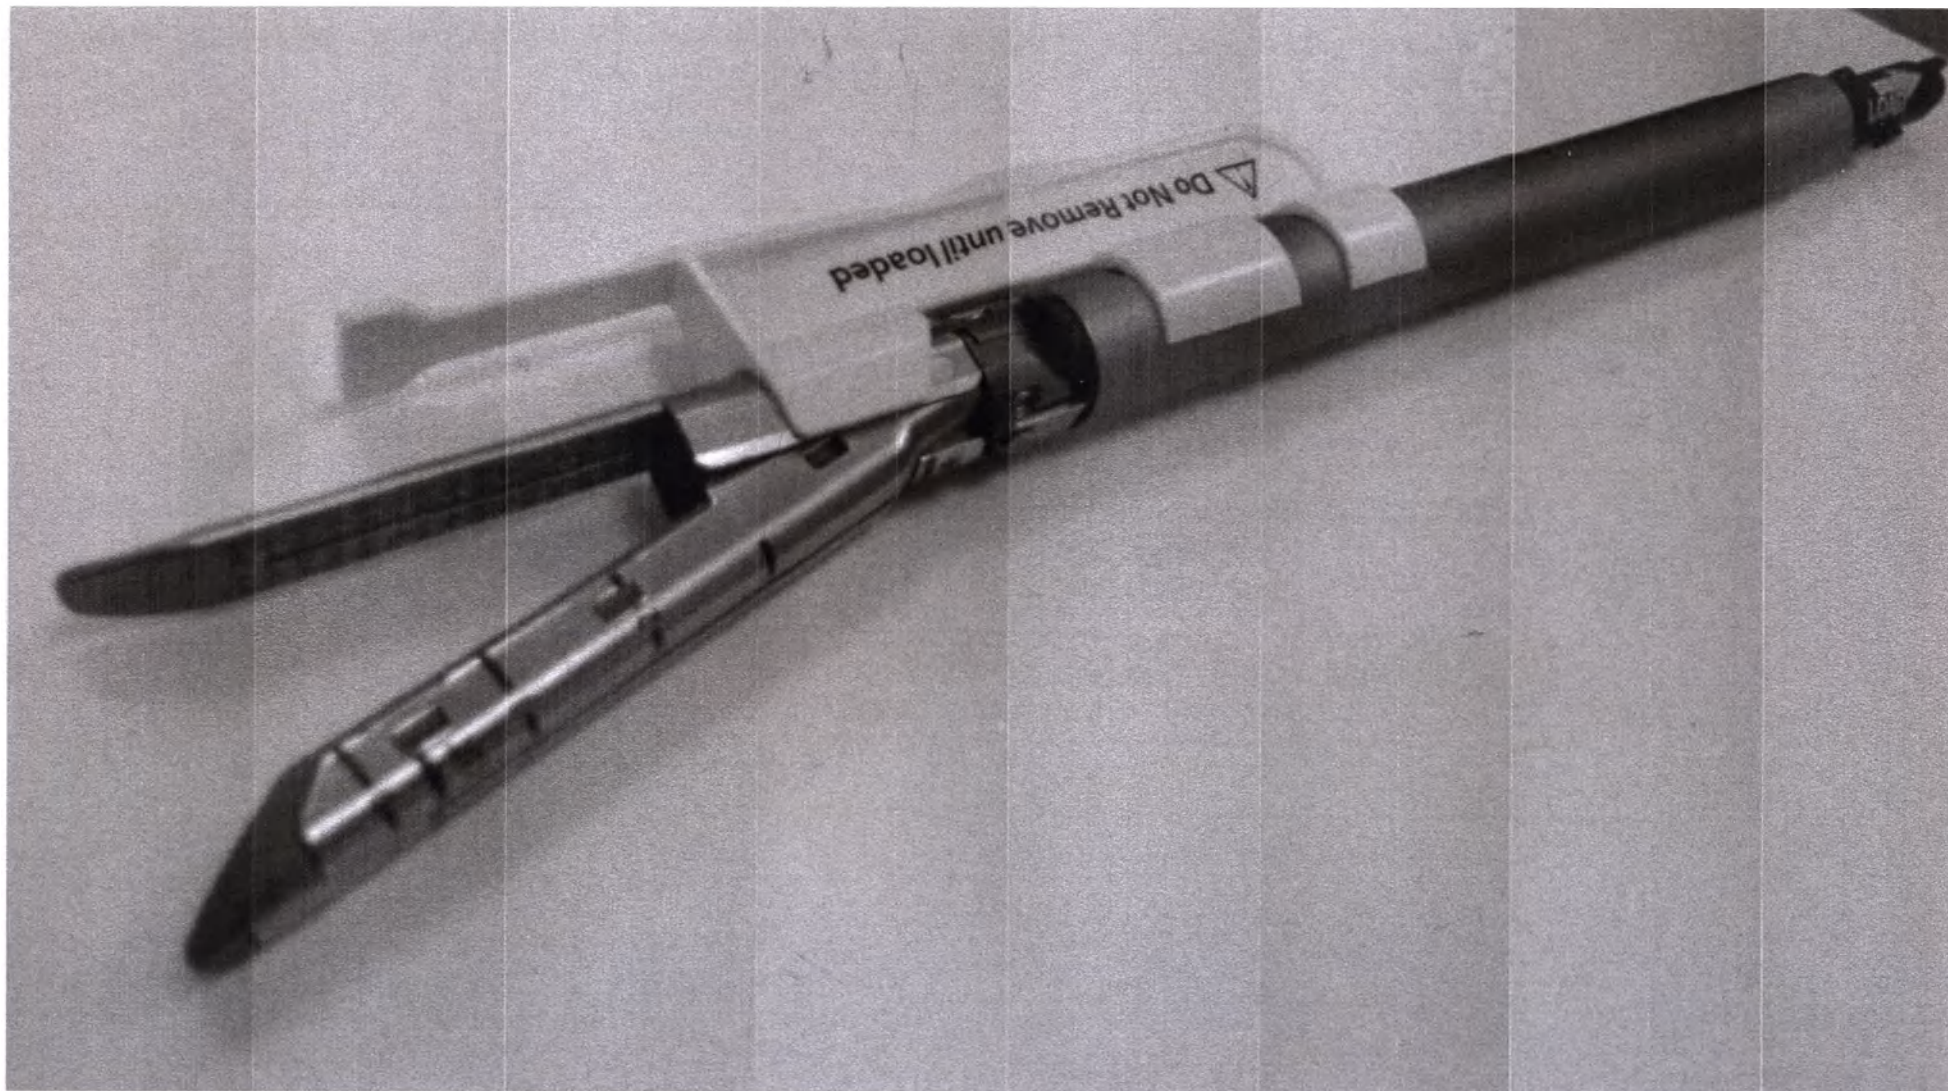


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple»

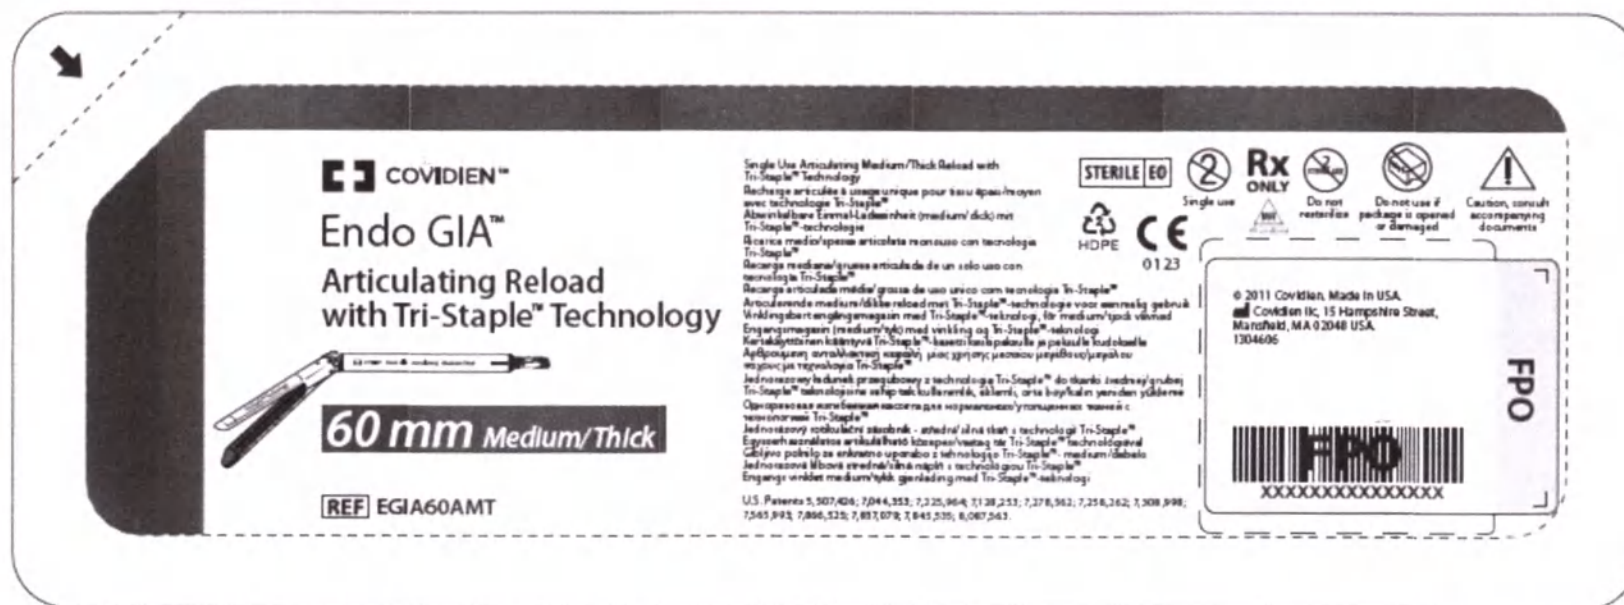


Пример русскоязычного стикера МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple»

	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение №__ от__	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие а пирогенно, нетоксично
		


7. Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple

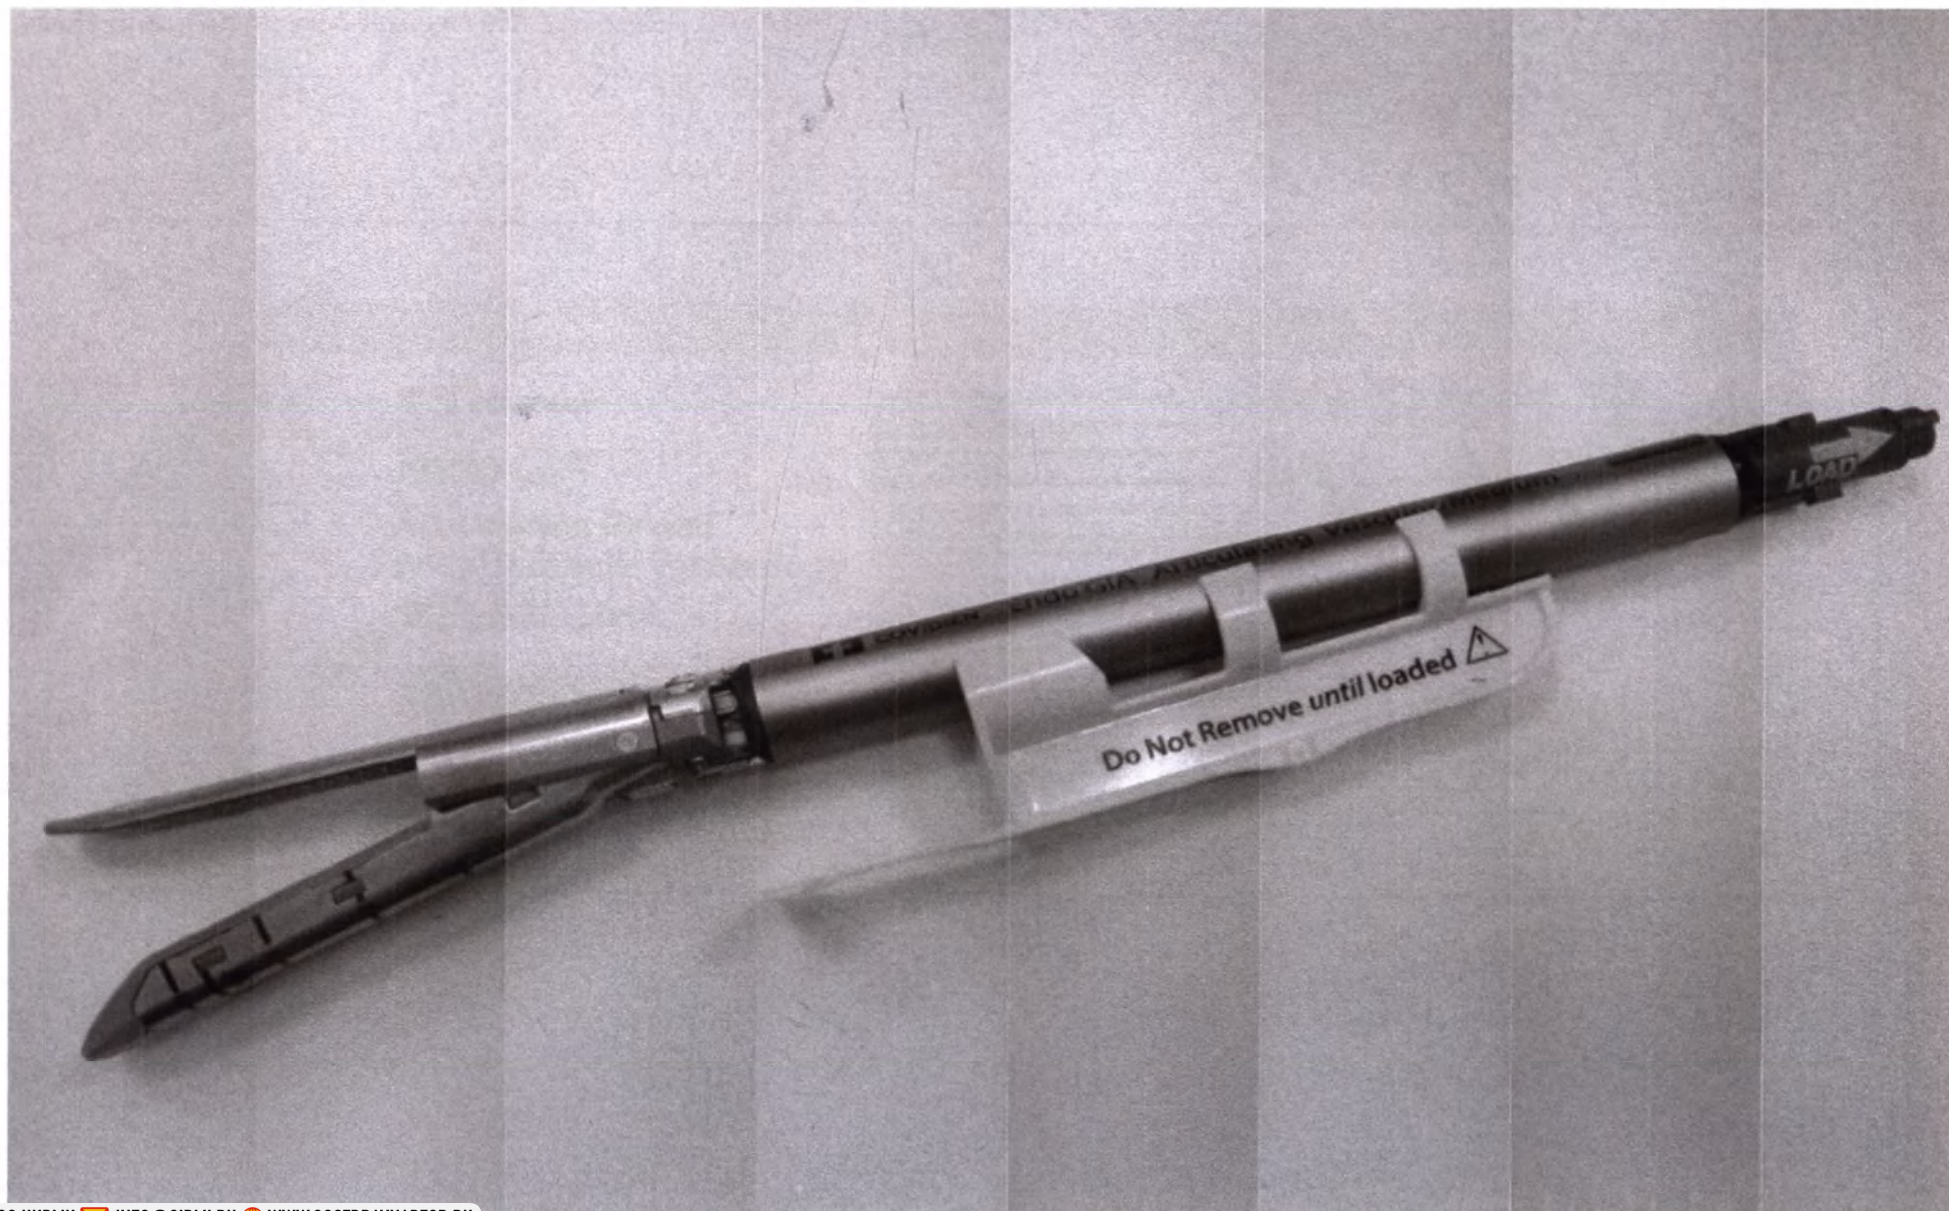


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple»

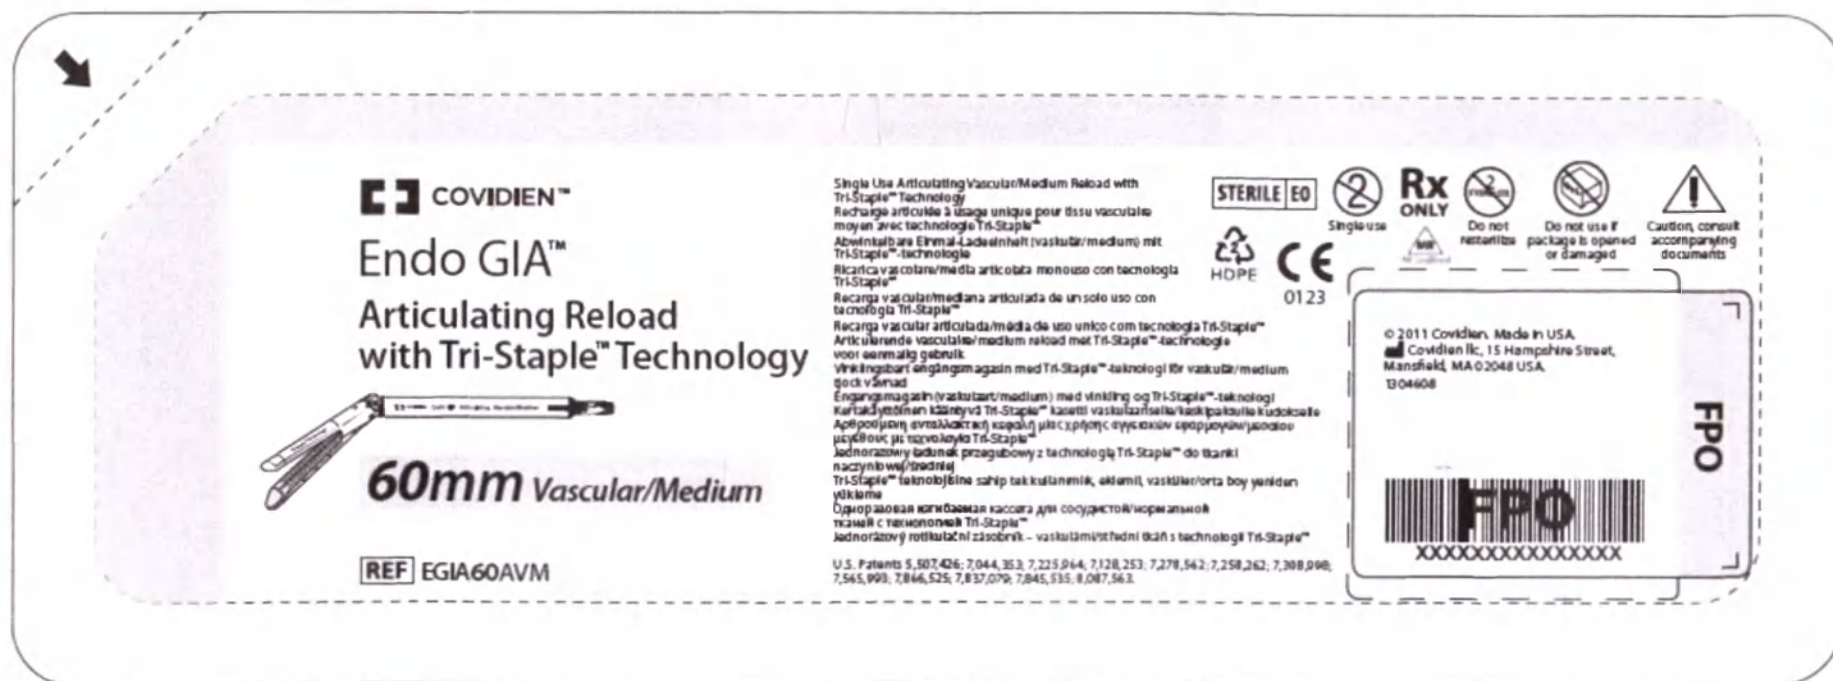


Пример русскоязычного стикера МИ «Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple»

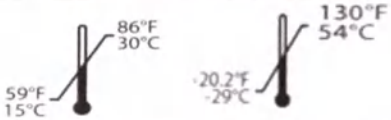	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей Endo GIA 60 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		

8. Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 60 мм

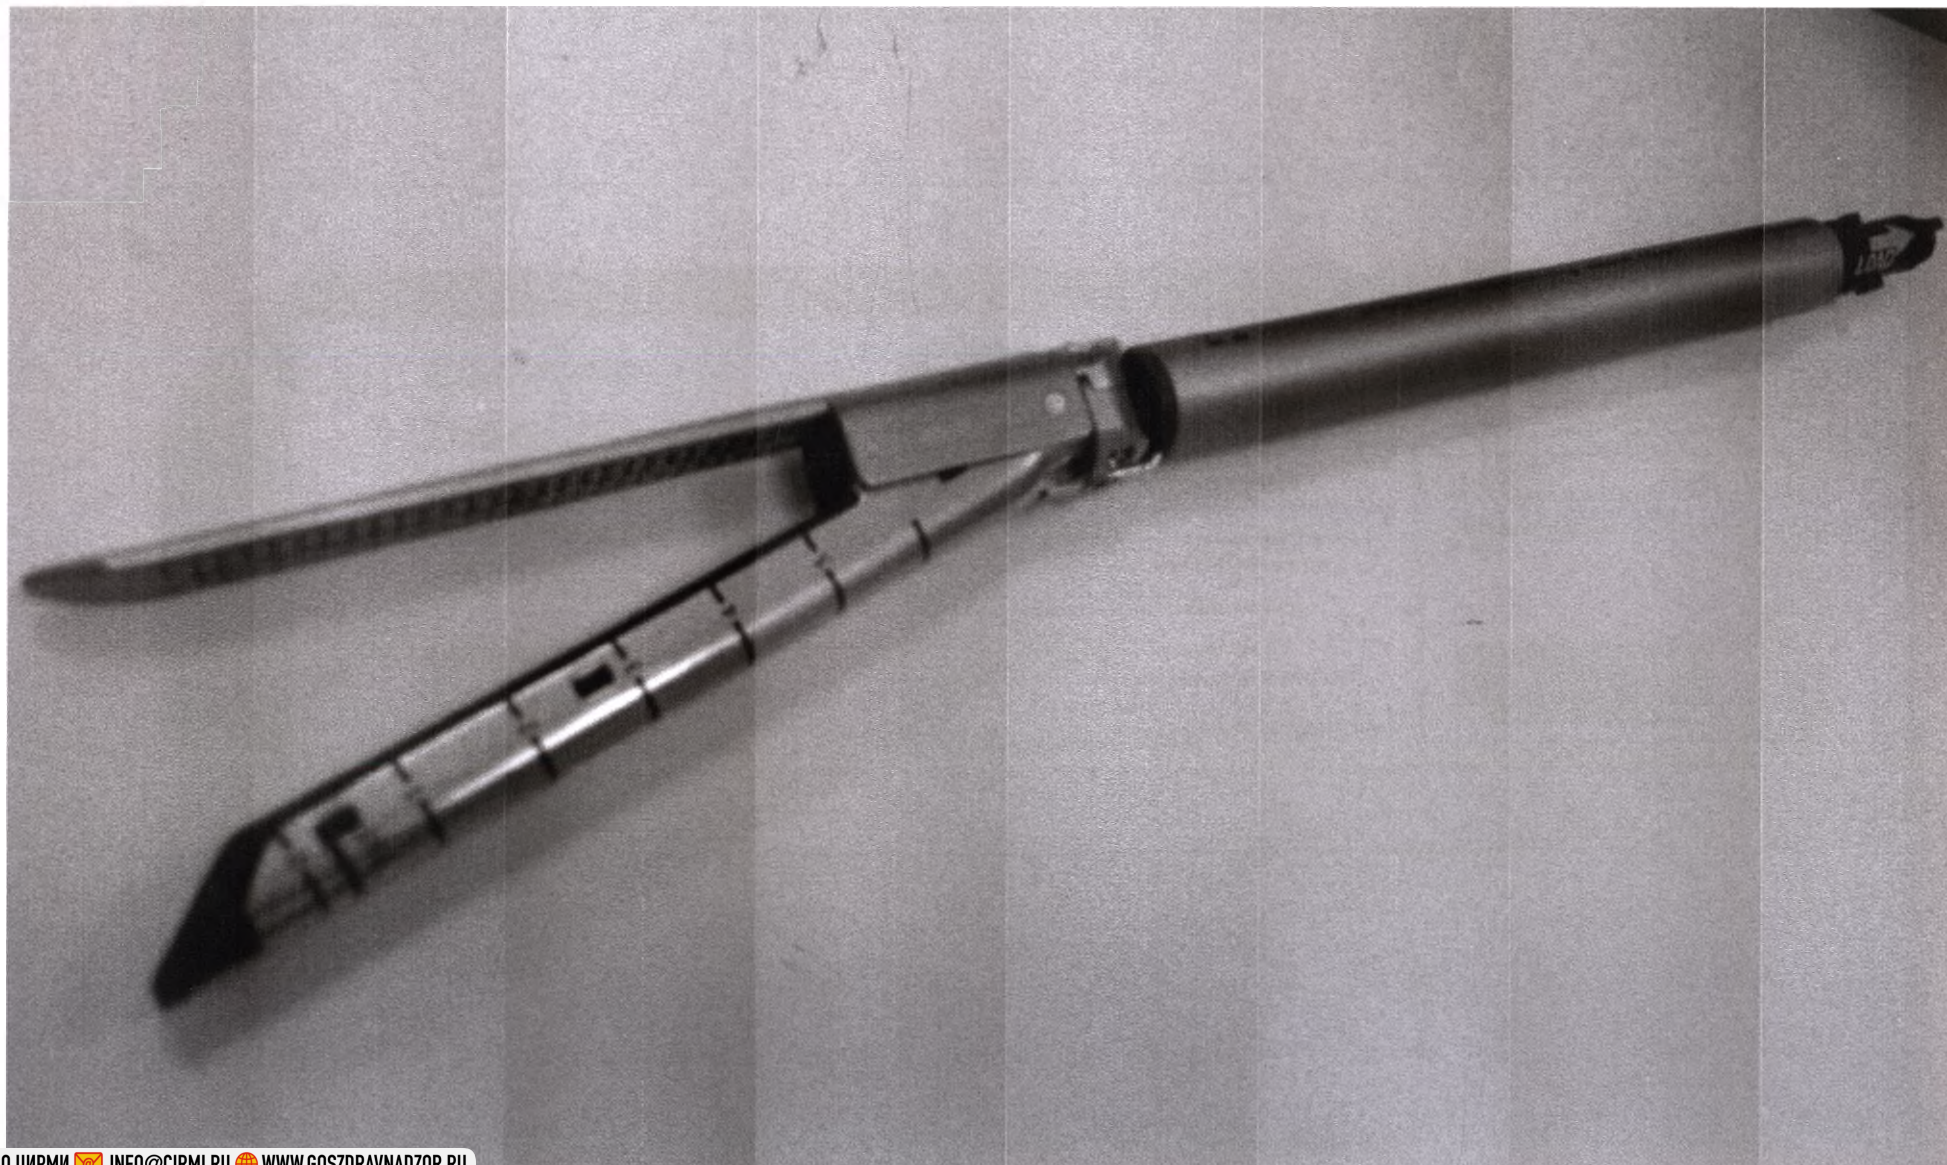

Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 60 мм»

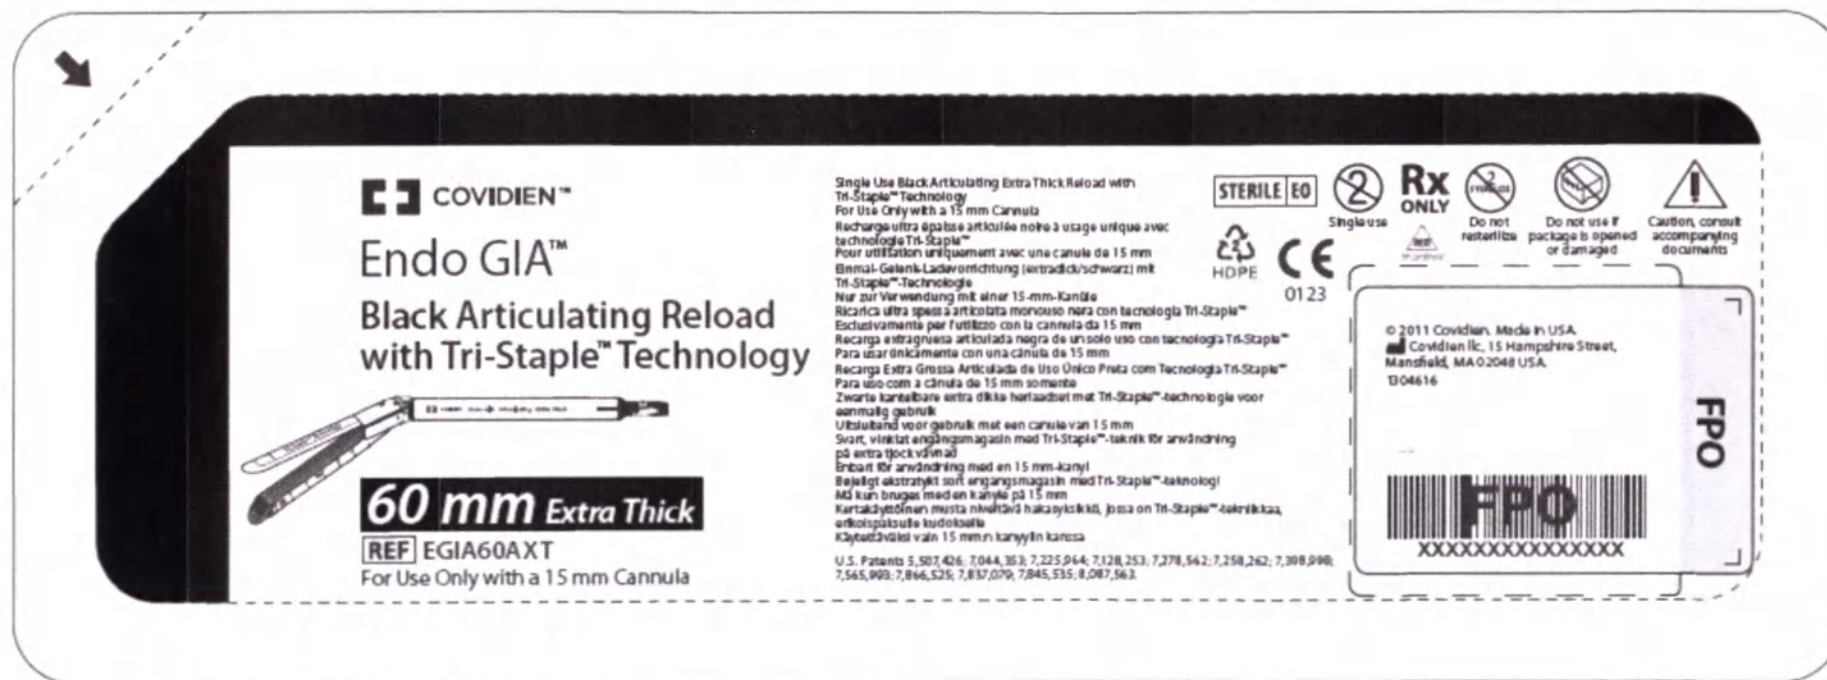


Пример русскоязычного стикера МИ «Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 60 мм»

	Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA 60 мм	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	
	Дата изгот./Серия/Годеи до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиногенно, нетоксично
		


9. Одноразовая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA с технологией Tri-Staple




Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA с технологией Tri-Staple»

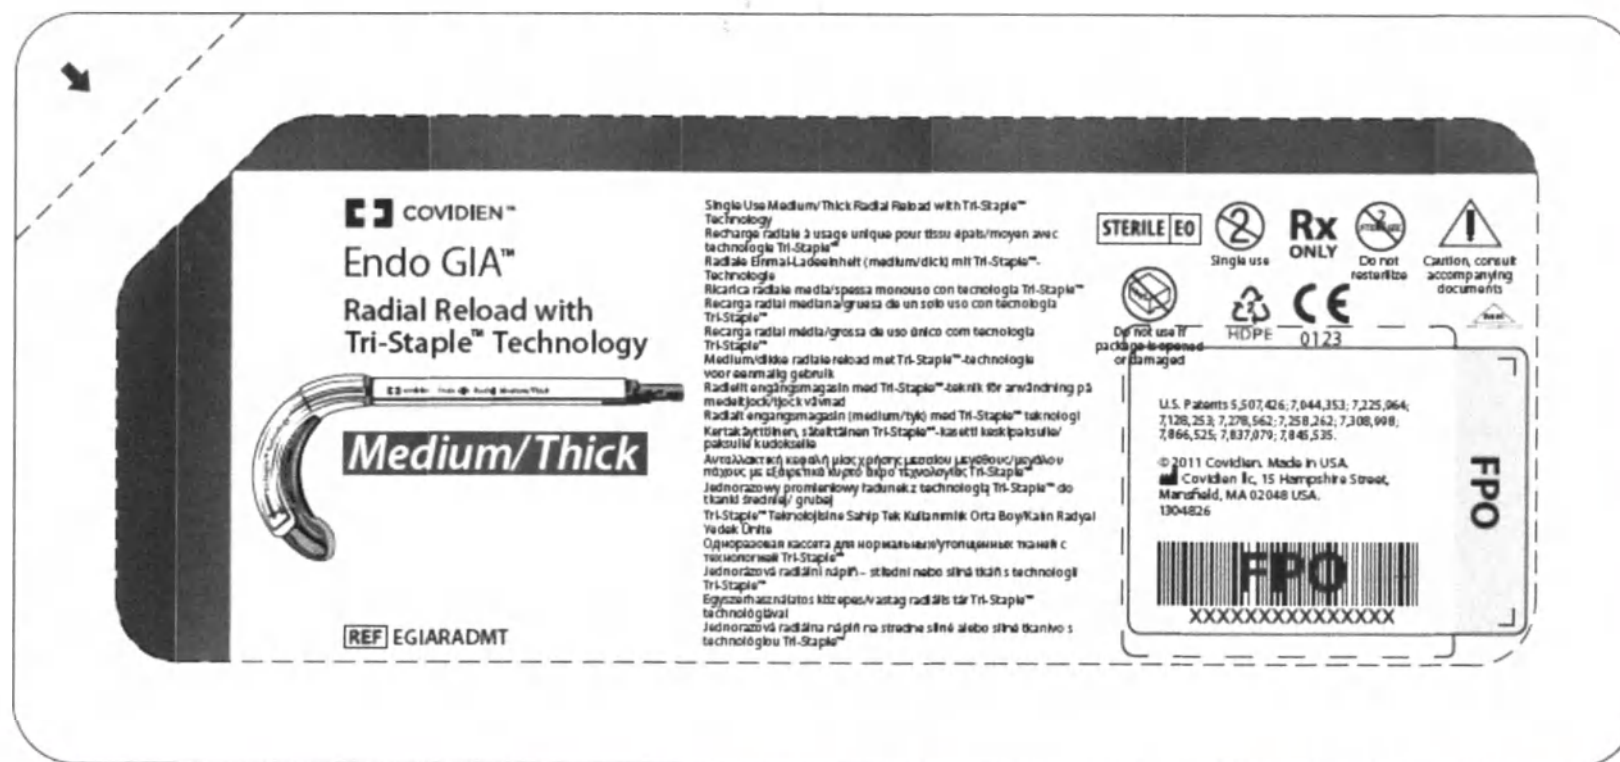


Пример стикера МИ «Одноразовая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA с технологией Tri-Staple»

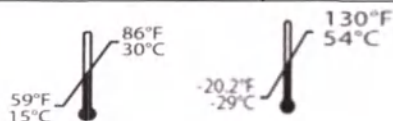	Одноразовая кассета для нормальных/утолщенных тканей Endo GIA с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
		


10. Черная загружаемая кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA

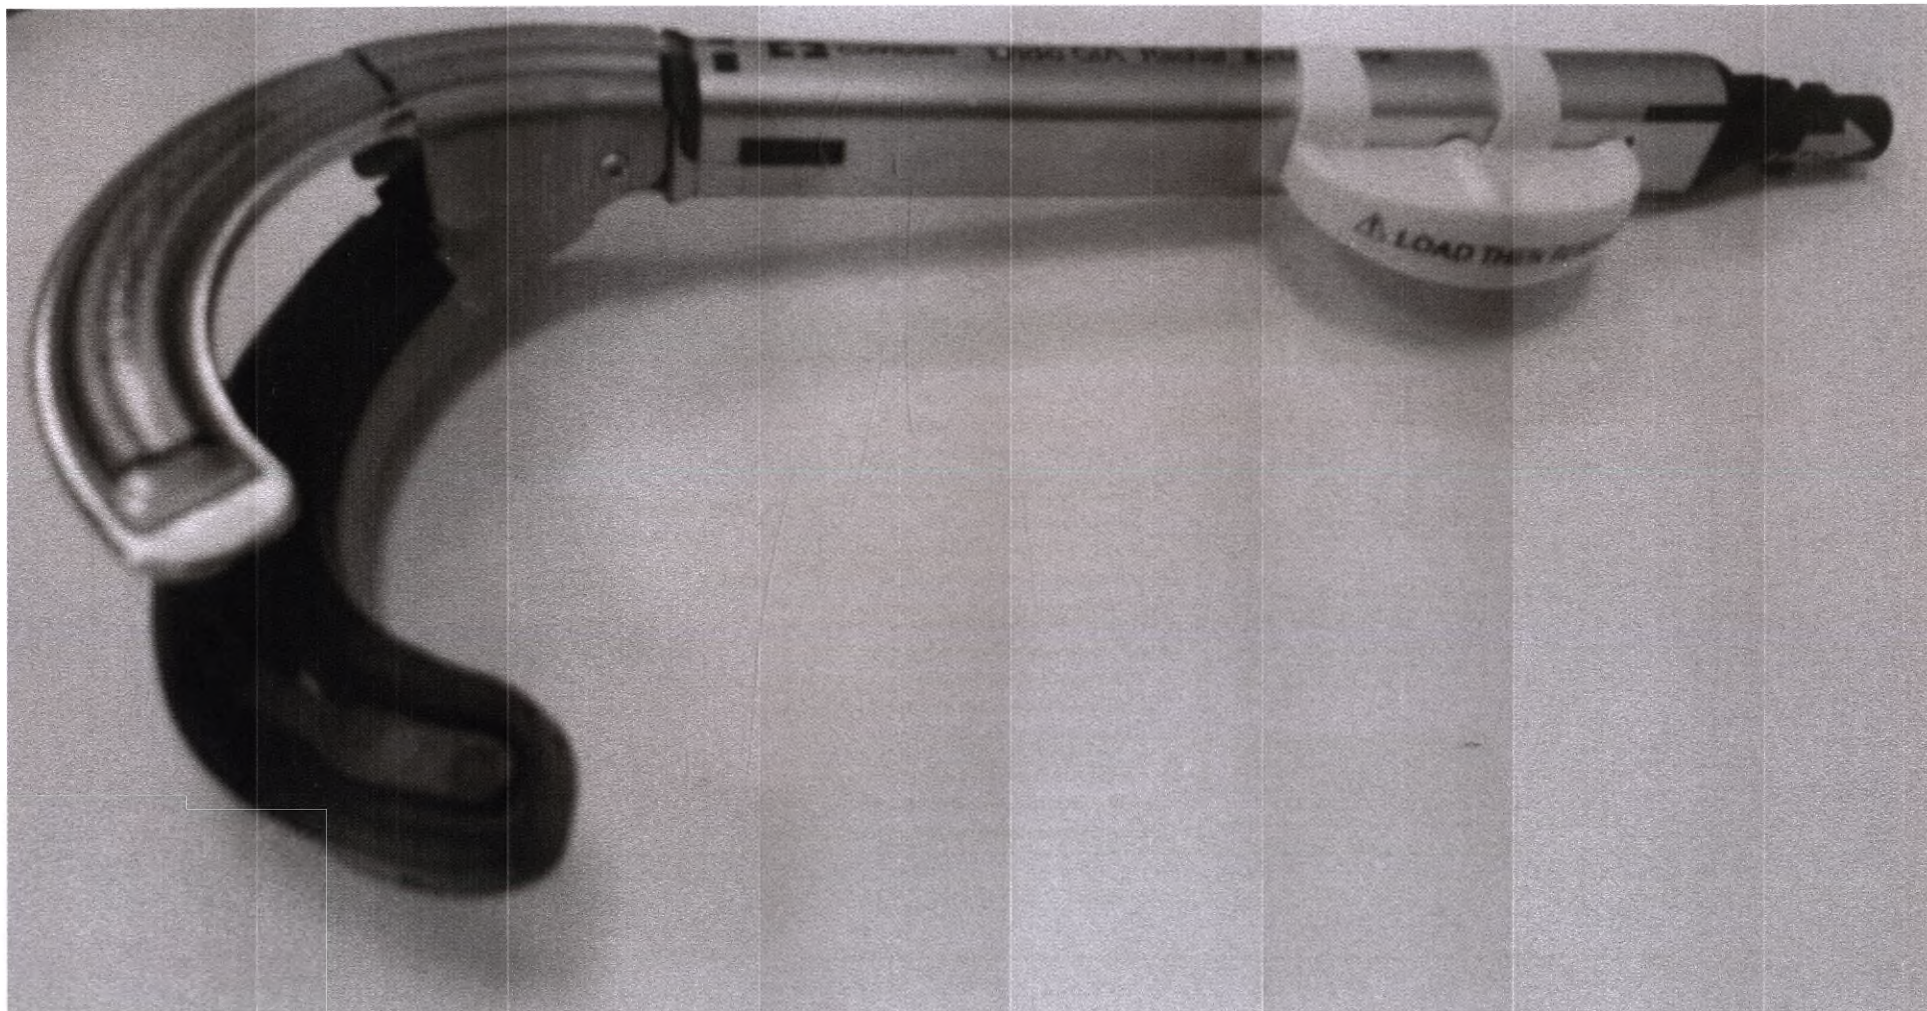


Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Черная загружаемая кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA»

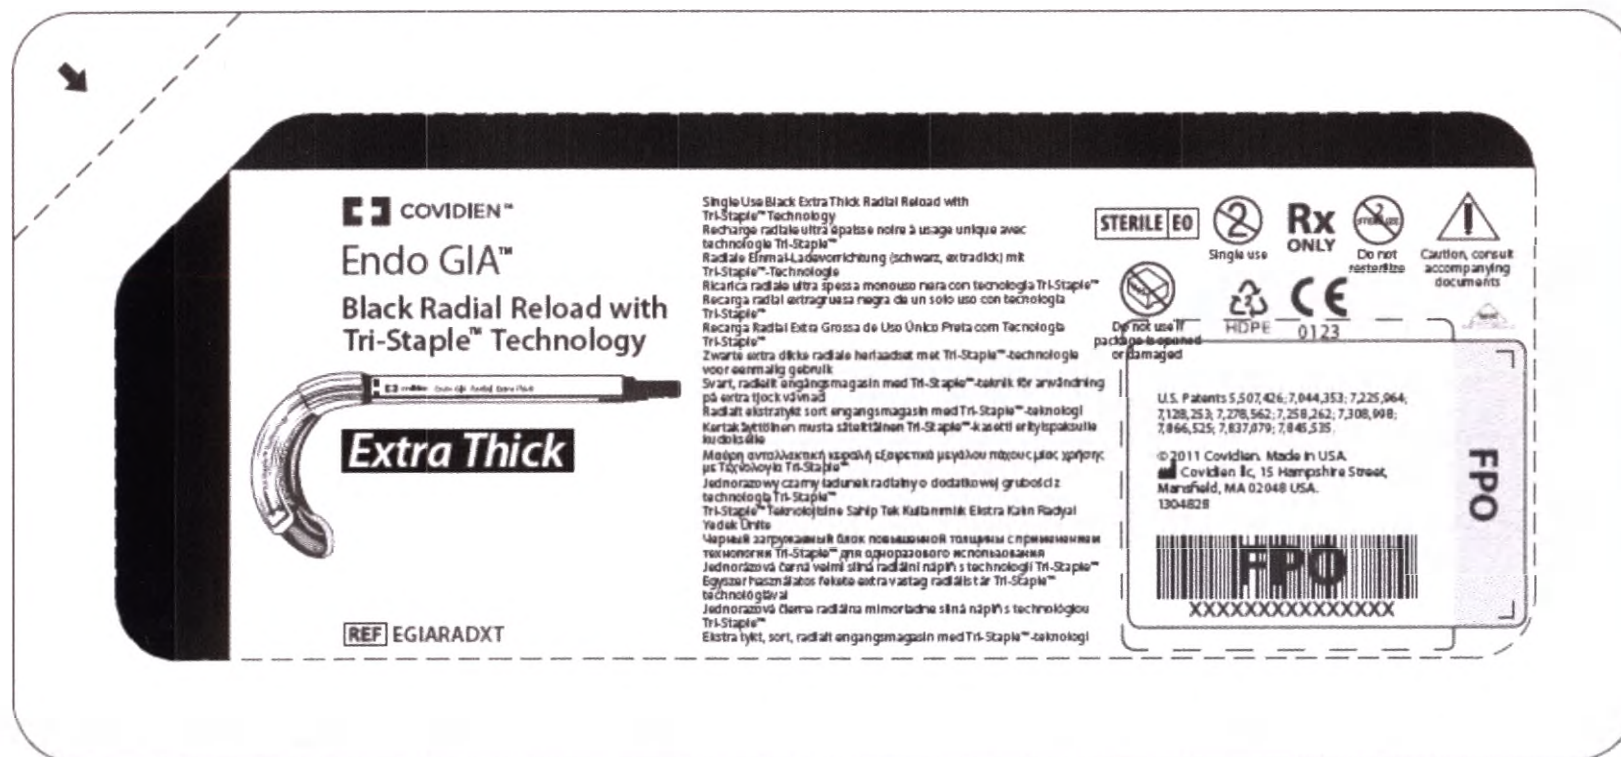


Пример стикера МИ «Черная загружаемая кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA»

	Черная загружаемая кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple для одноразового использования Endo GIA	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение №__ от __	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично
	 	

11. Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета для ультратонкой/сосудистой ткани Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple.

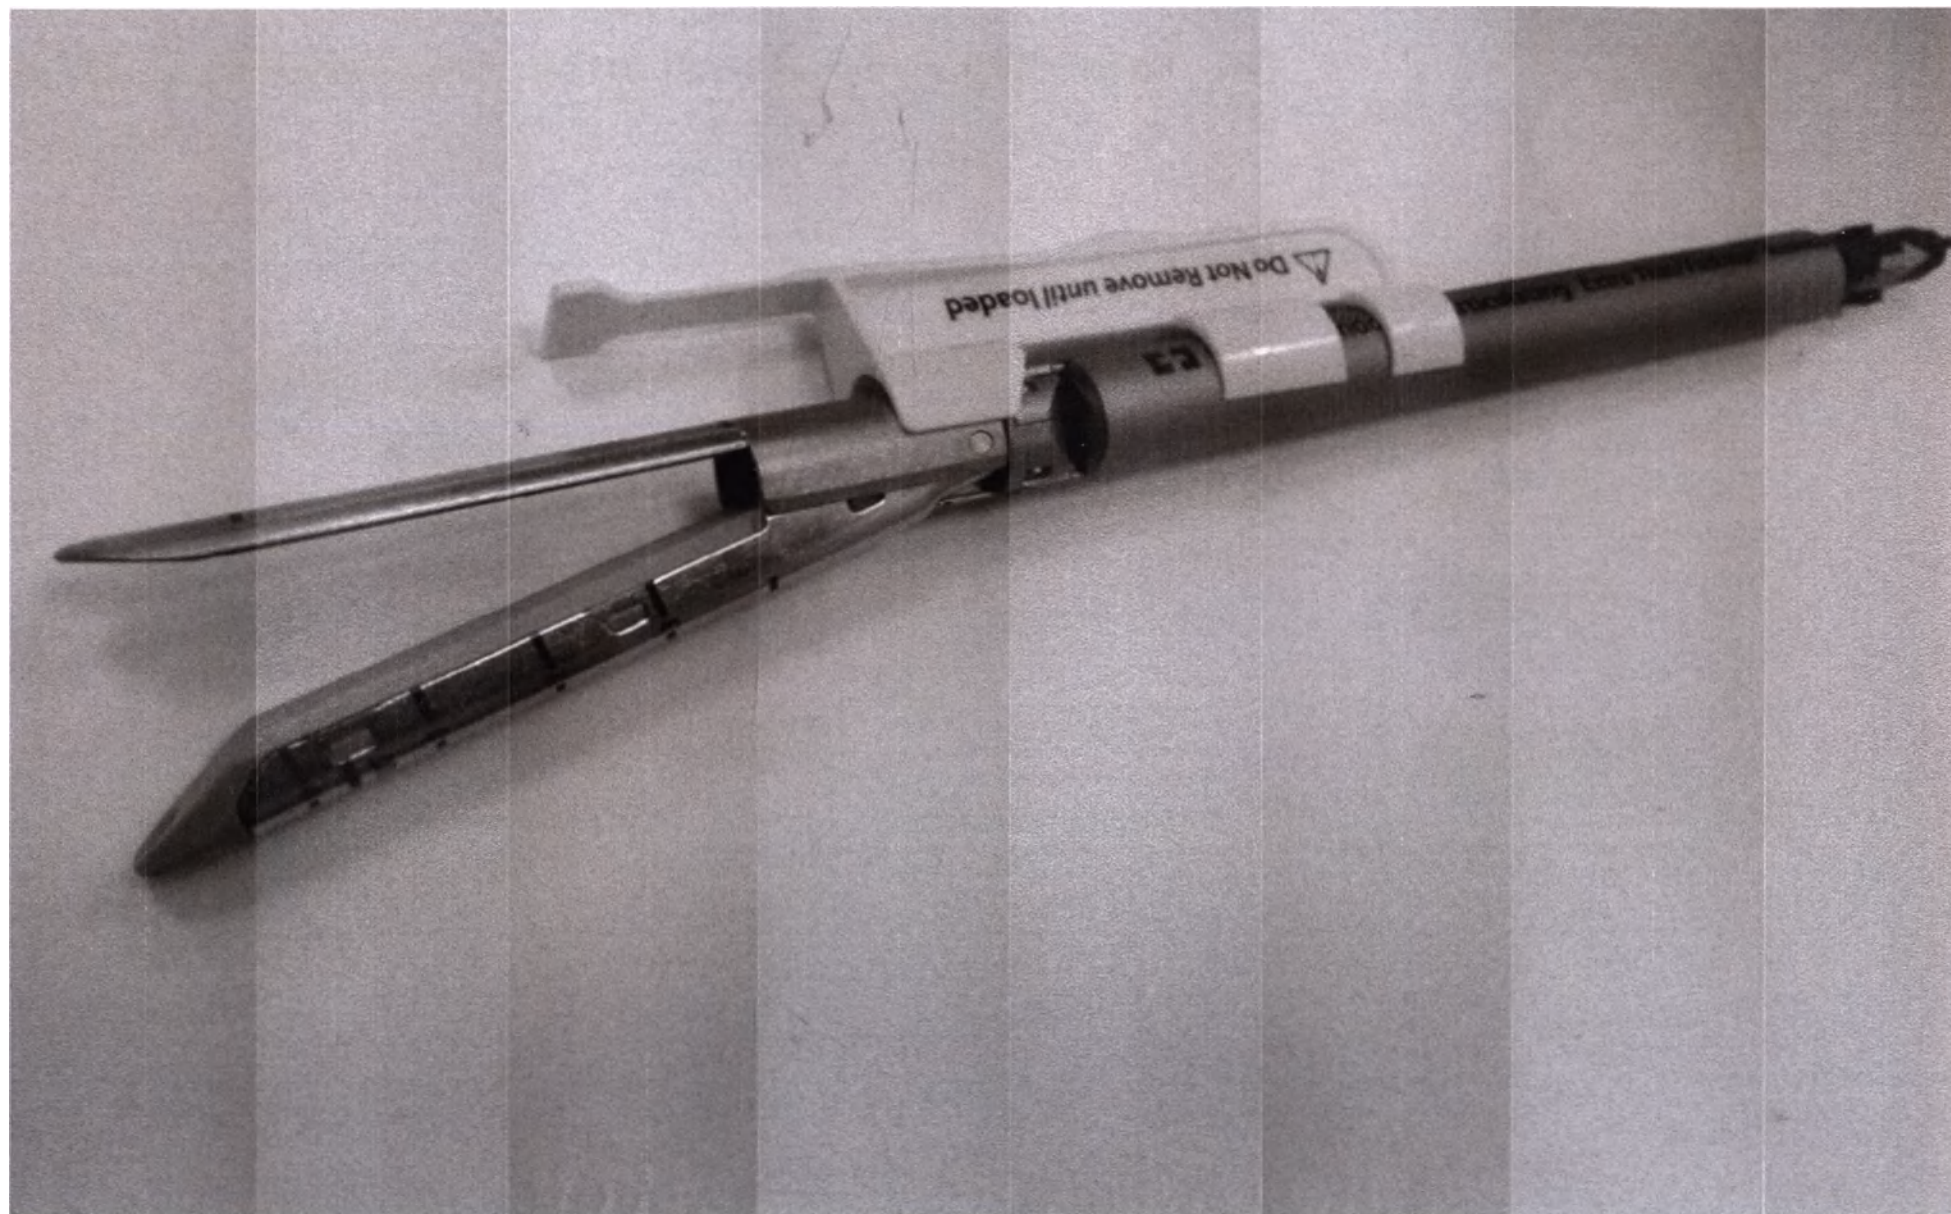

Пример маркировки на индивидуальном пакете (первичная упаковка) для МИ «Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета для ультратонкой/сосудистой ткани Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple.»

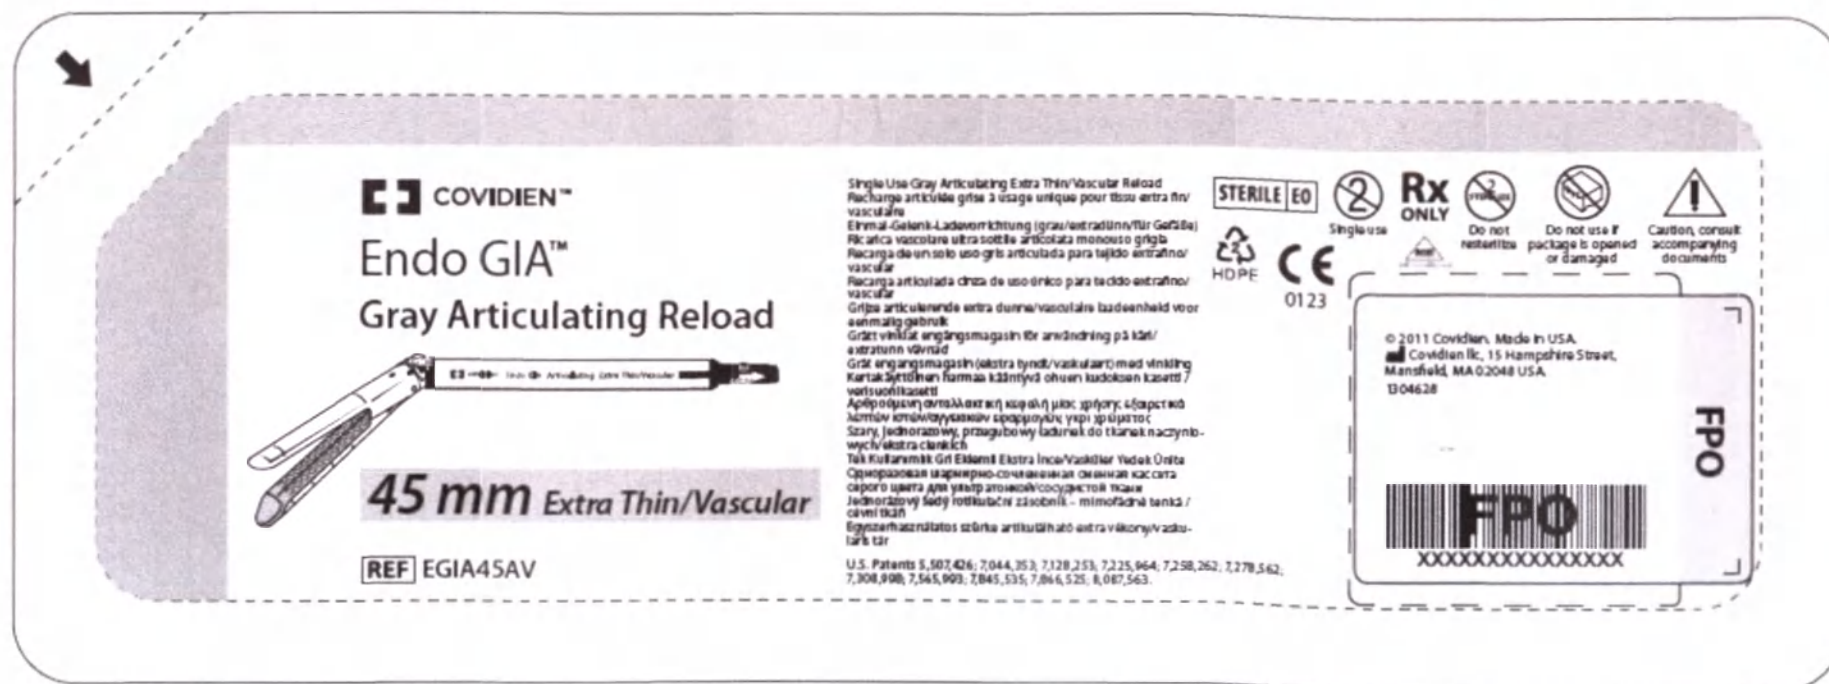

Пример стикера МИ «Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета для ультратонкой/сосудистой ткани Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple»

	Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета для ультратонкой/сосудистой ткани Endo GIA 45 мм с технологией Tri-Staple	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № ____ от ____	
Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке Изделие XX апиrogenно, нетоксично	



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"

39 листа(ов)

