

Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здравоохранение»

2023 г.



«Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

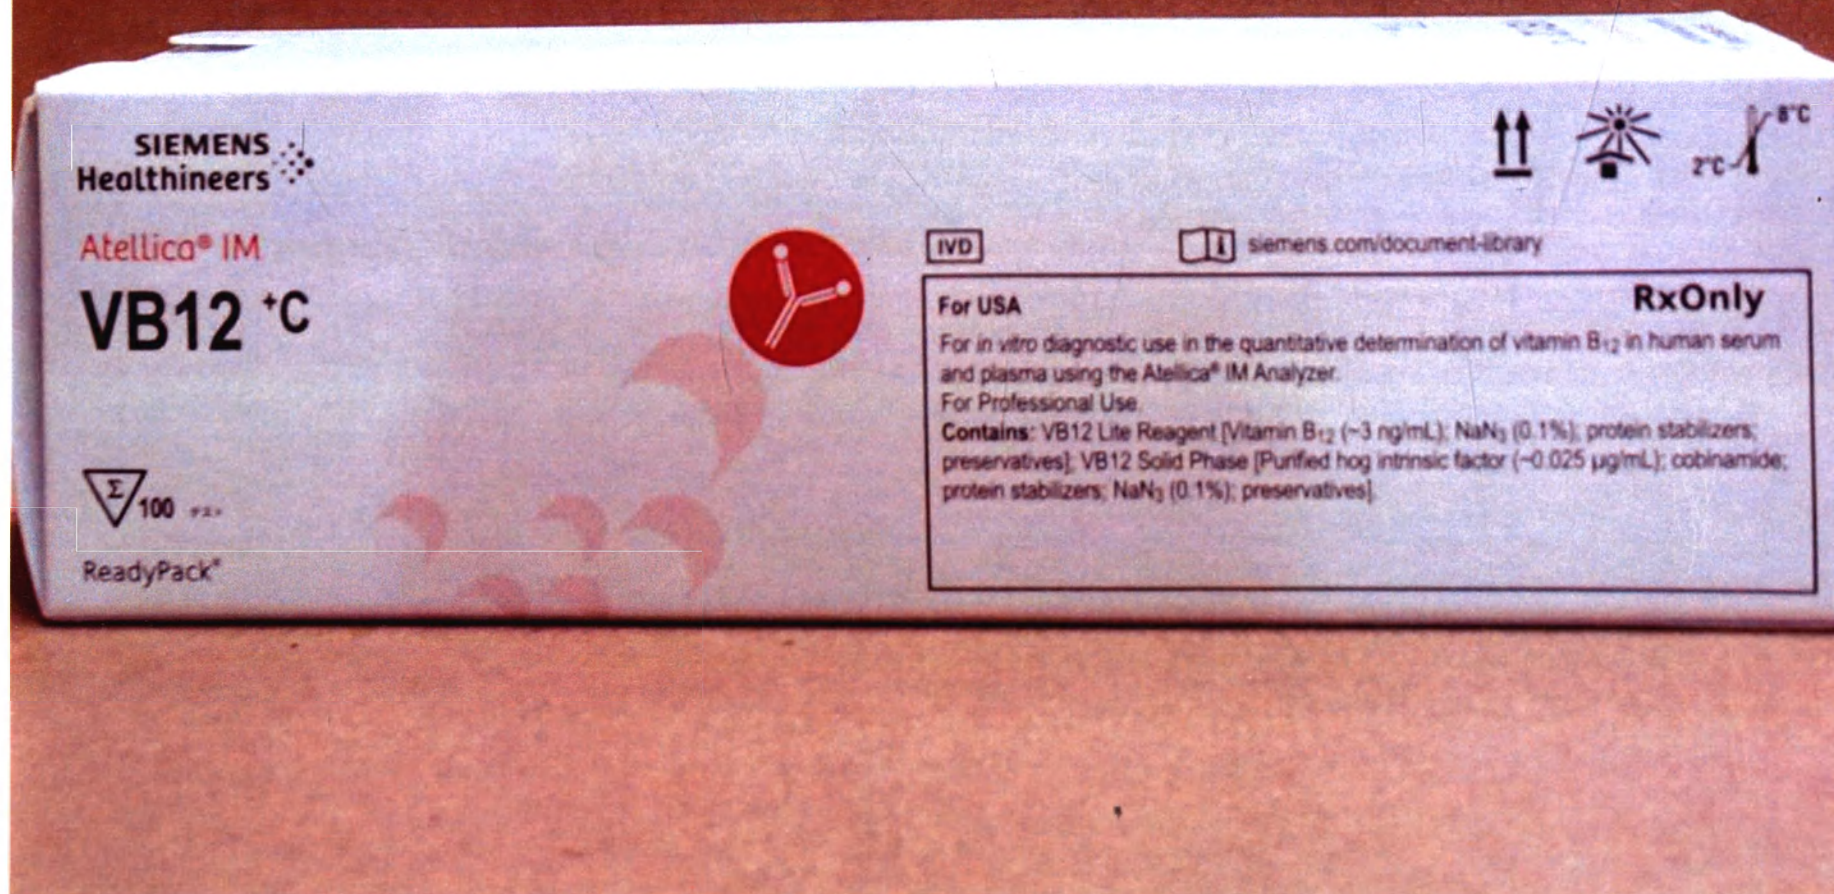


Рисунок 1. Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12)); I. Фасовка

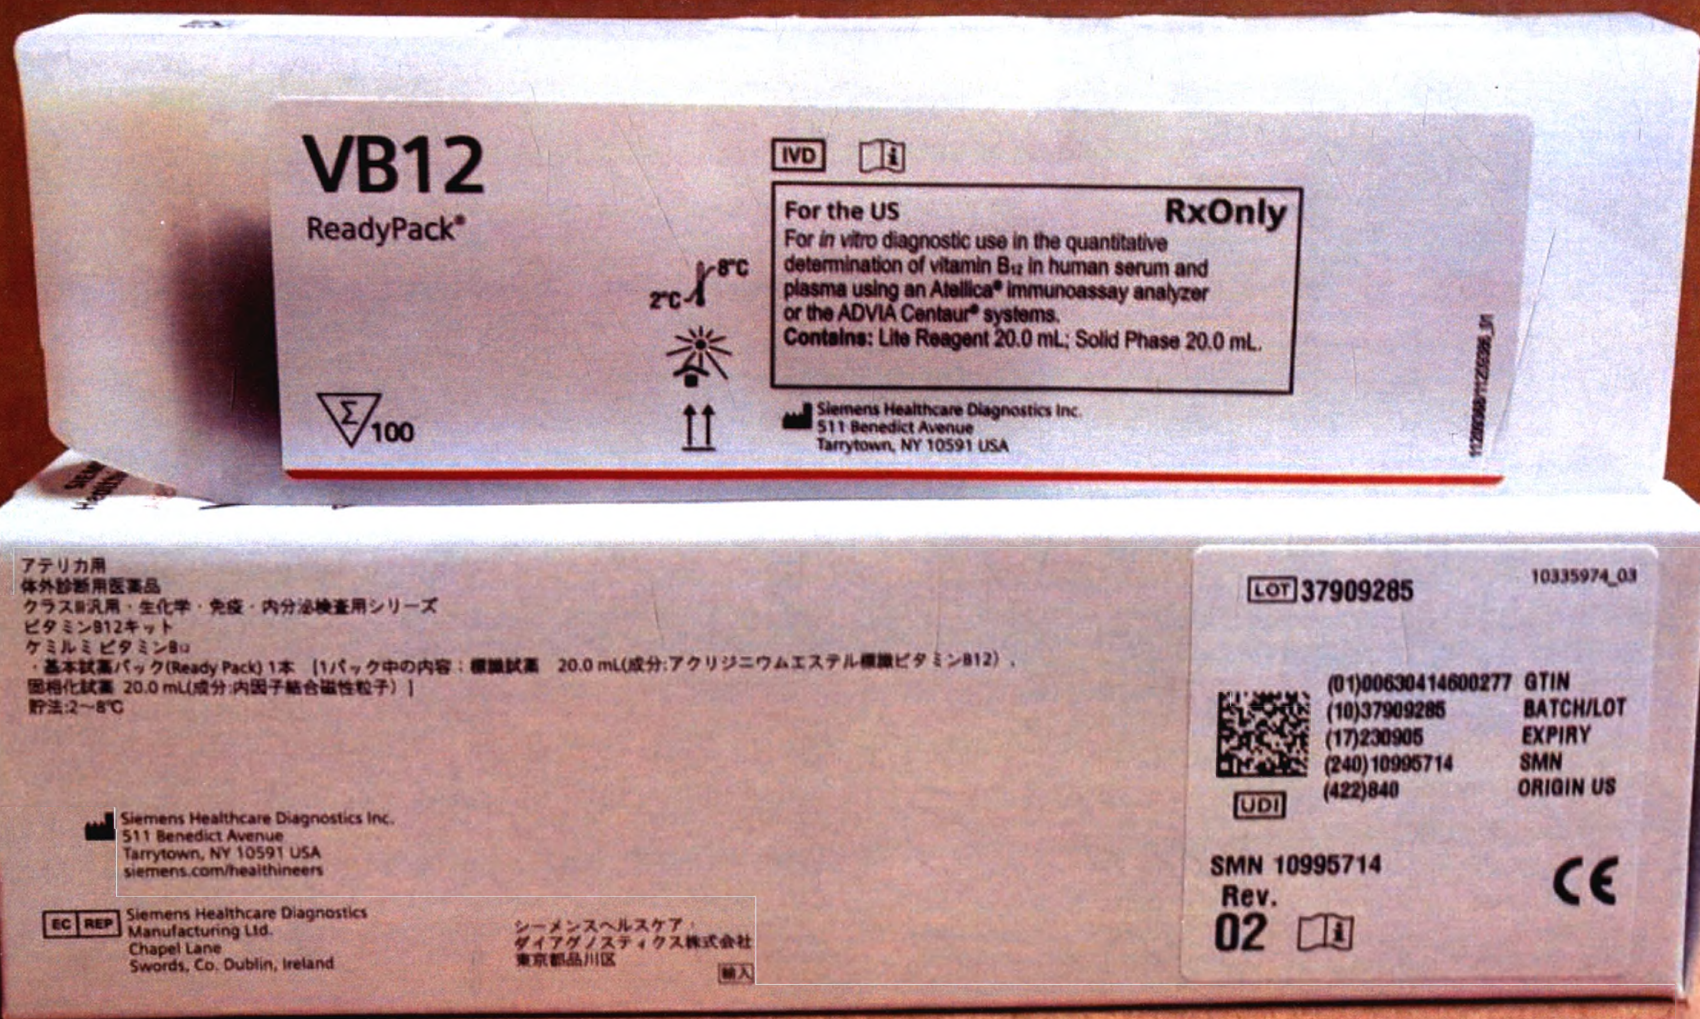


Рисунок 2. Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12)): I. Фасовка

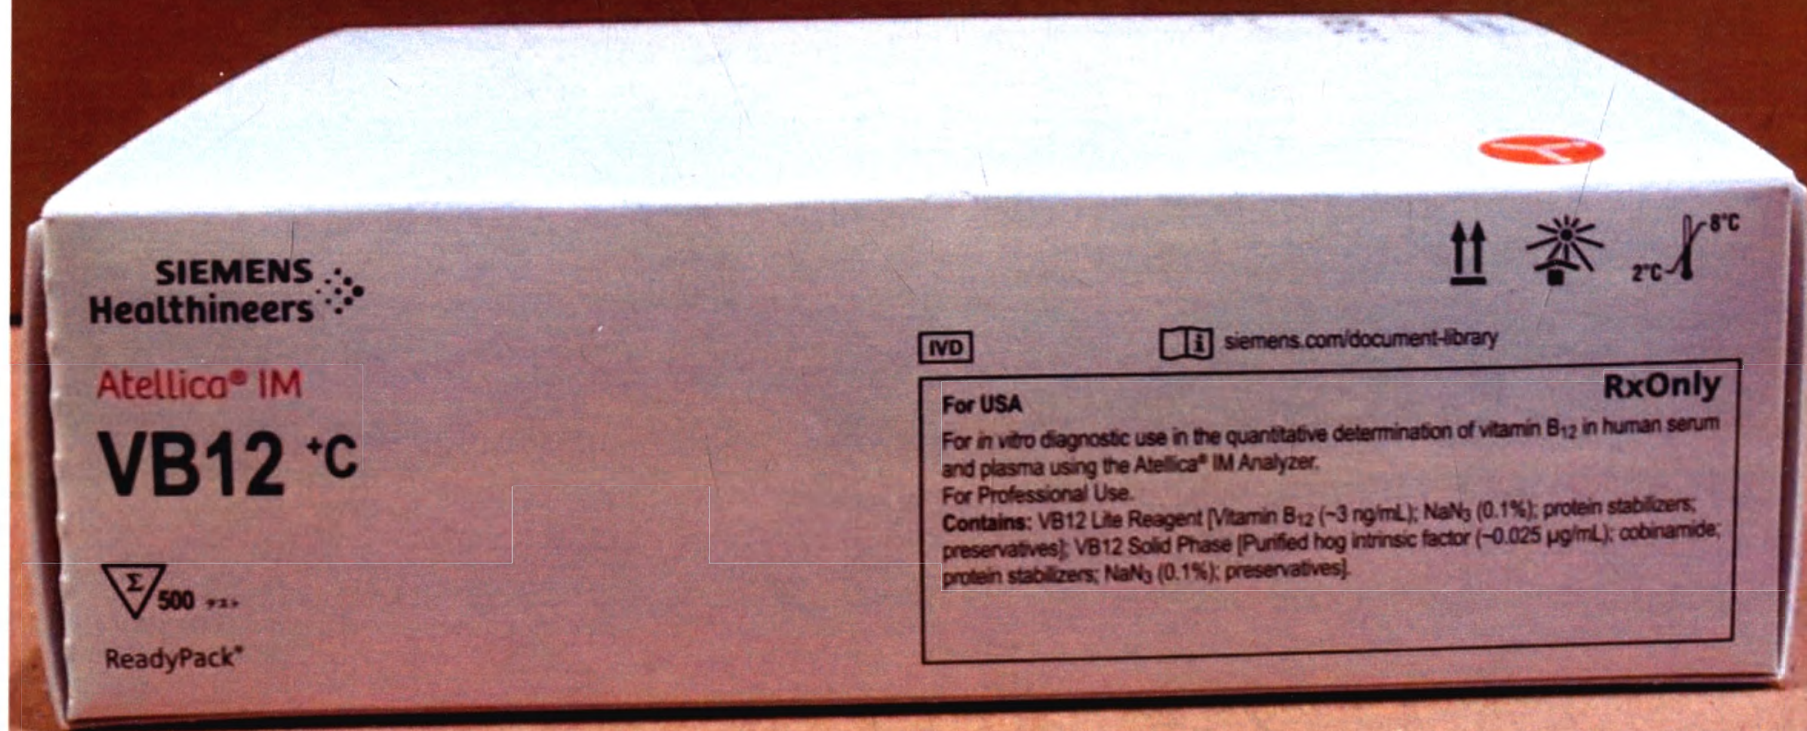


Рисунок 3. Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12)): II. Фасовка

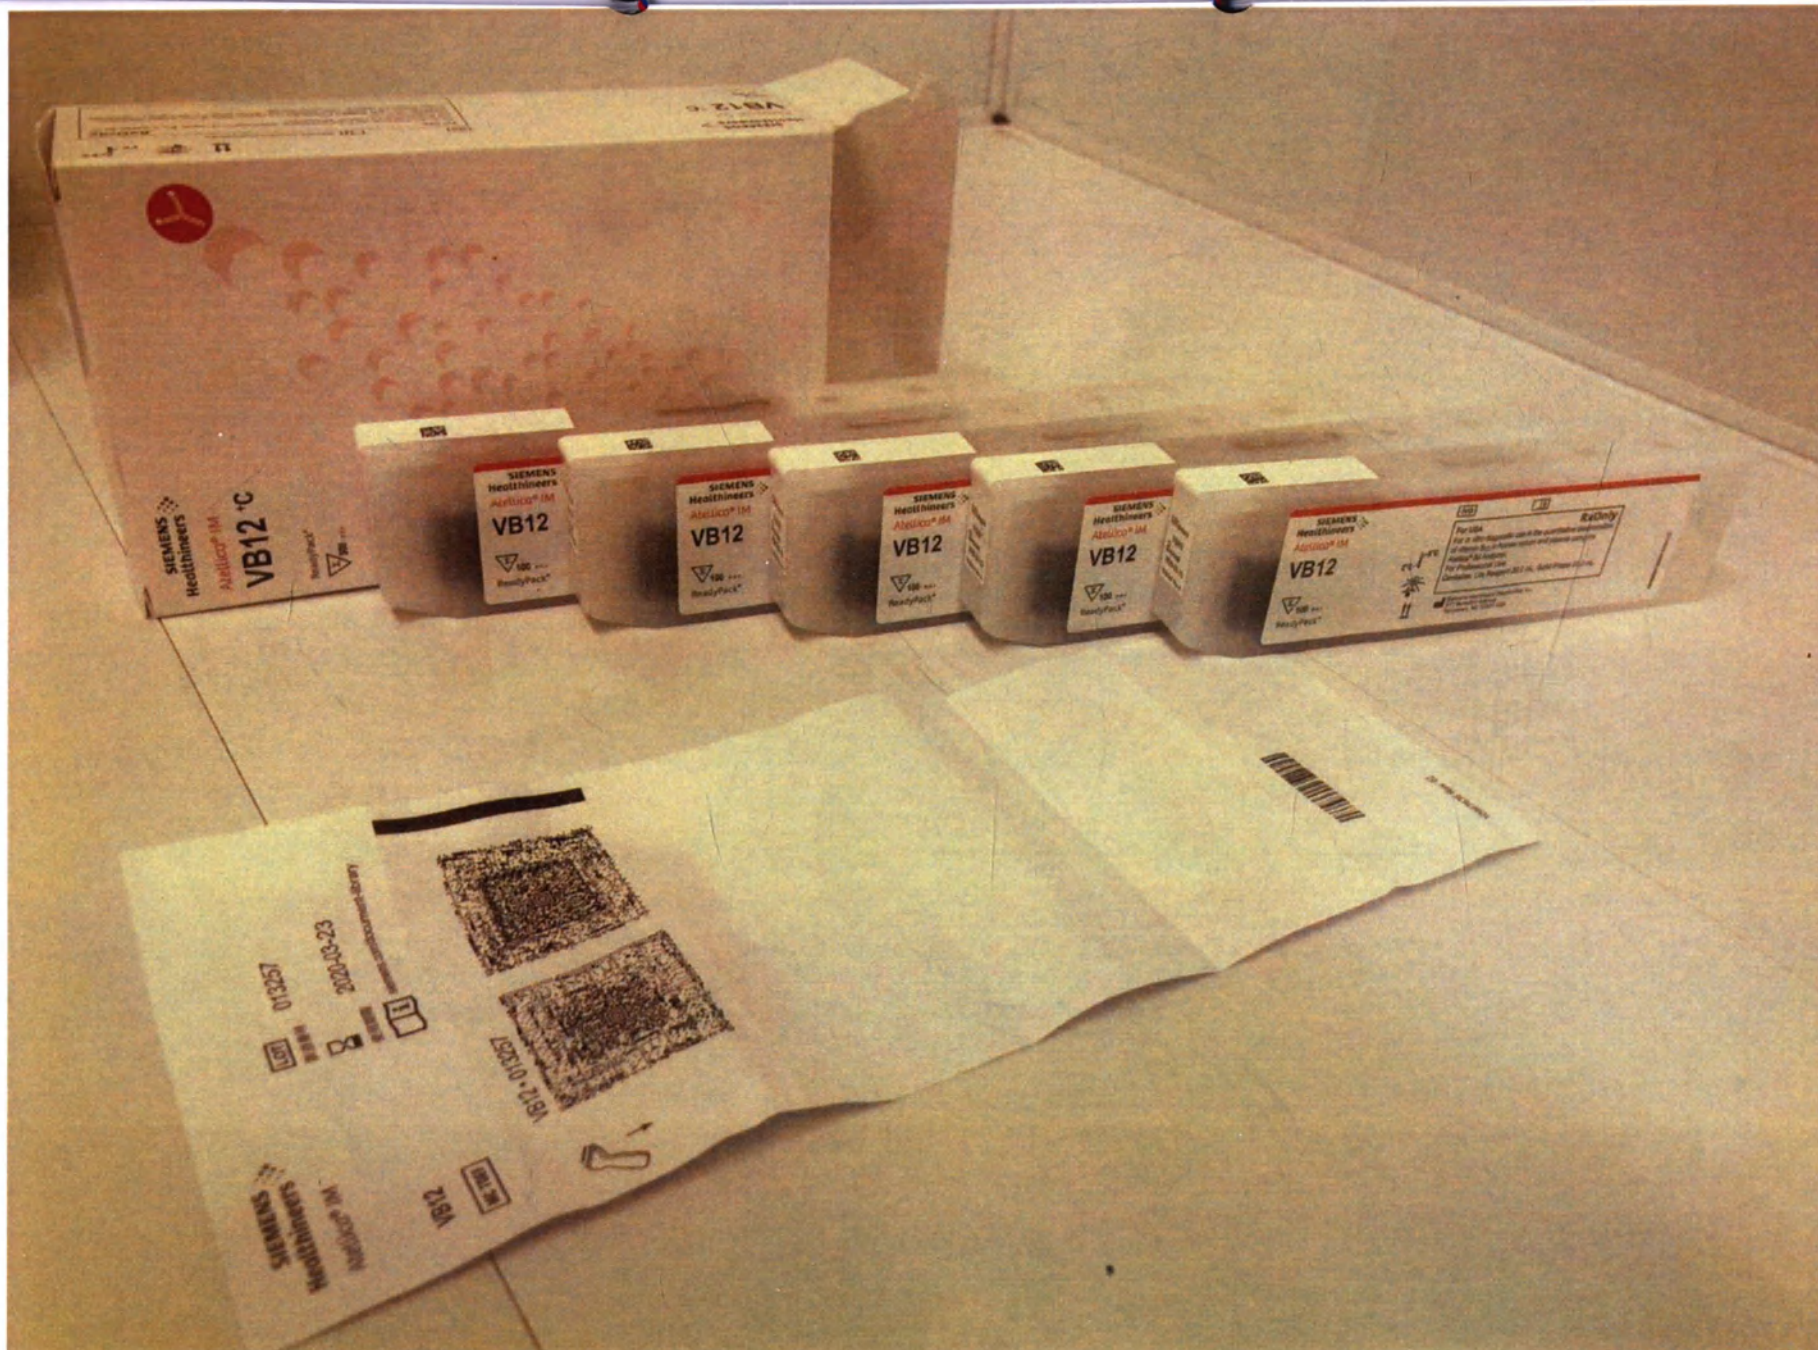


Рисунок 4. Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12)): II. Фасовка

VB12

ReadyPack®

IVD



For the US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of vitamin B₁₂ in human serum and plasma using an Atellica® immunoassay analyzer or the ADVIA Centaur® systems.

Contains: Lite Reagent 20.0 mL; Solid Phase 20.0 mL.

2°C 8°C



Σ 100



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

11209368/11209396_01

VB12

ReadyPack®

IVD



For the US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of vitamin B₁₂ in human serum and plasma using an Atellica® immunoassay analyzer or the ADVIA Centaur® systems.

Contains: Lite Reagent 20.0 mL; Solid Phase 20.0 mL.

2°C 8°C



Σ 100



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

11209368/11209396_01

Рисунок 5. Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12)): 1. Основной

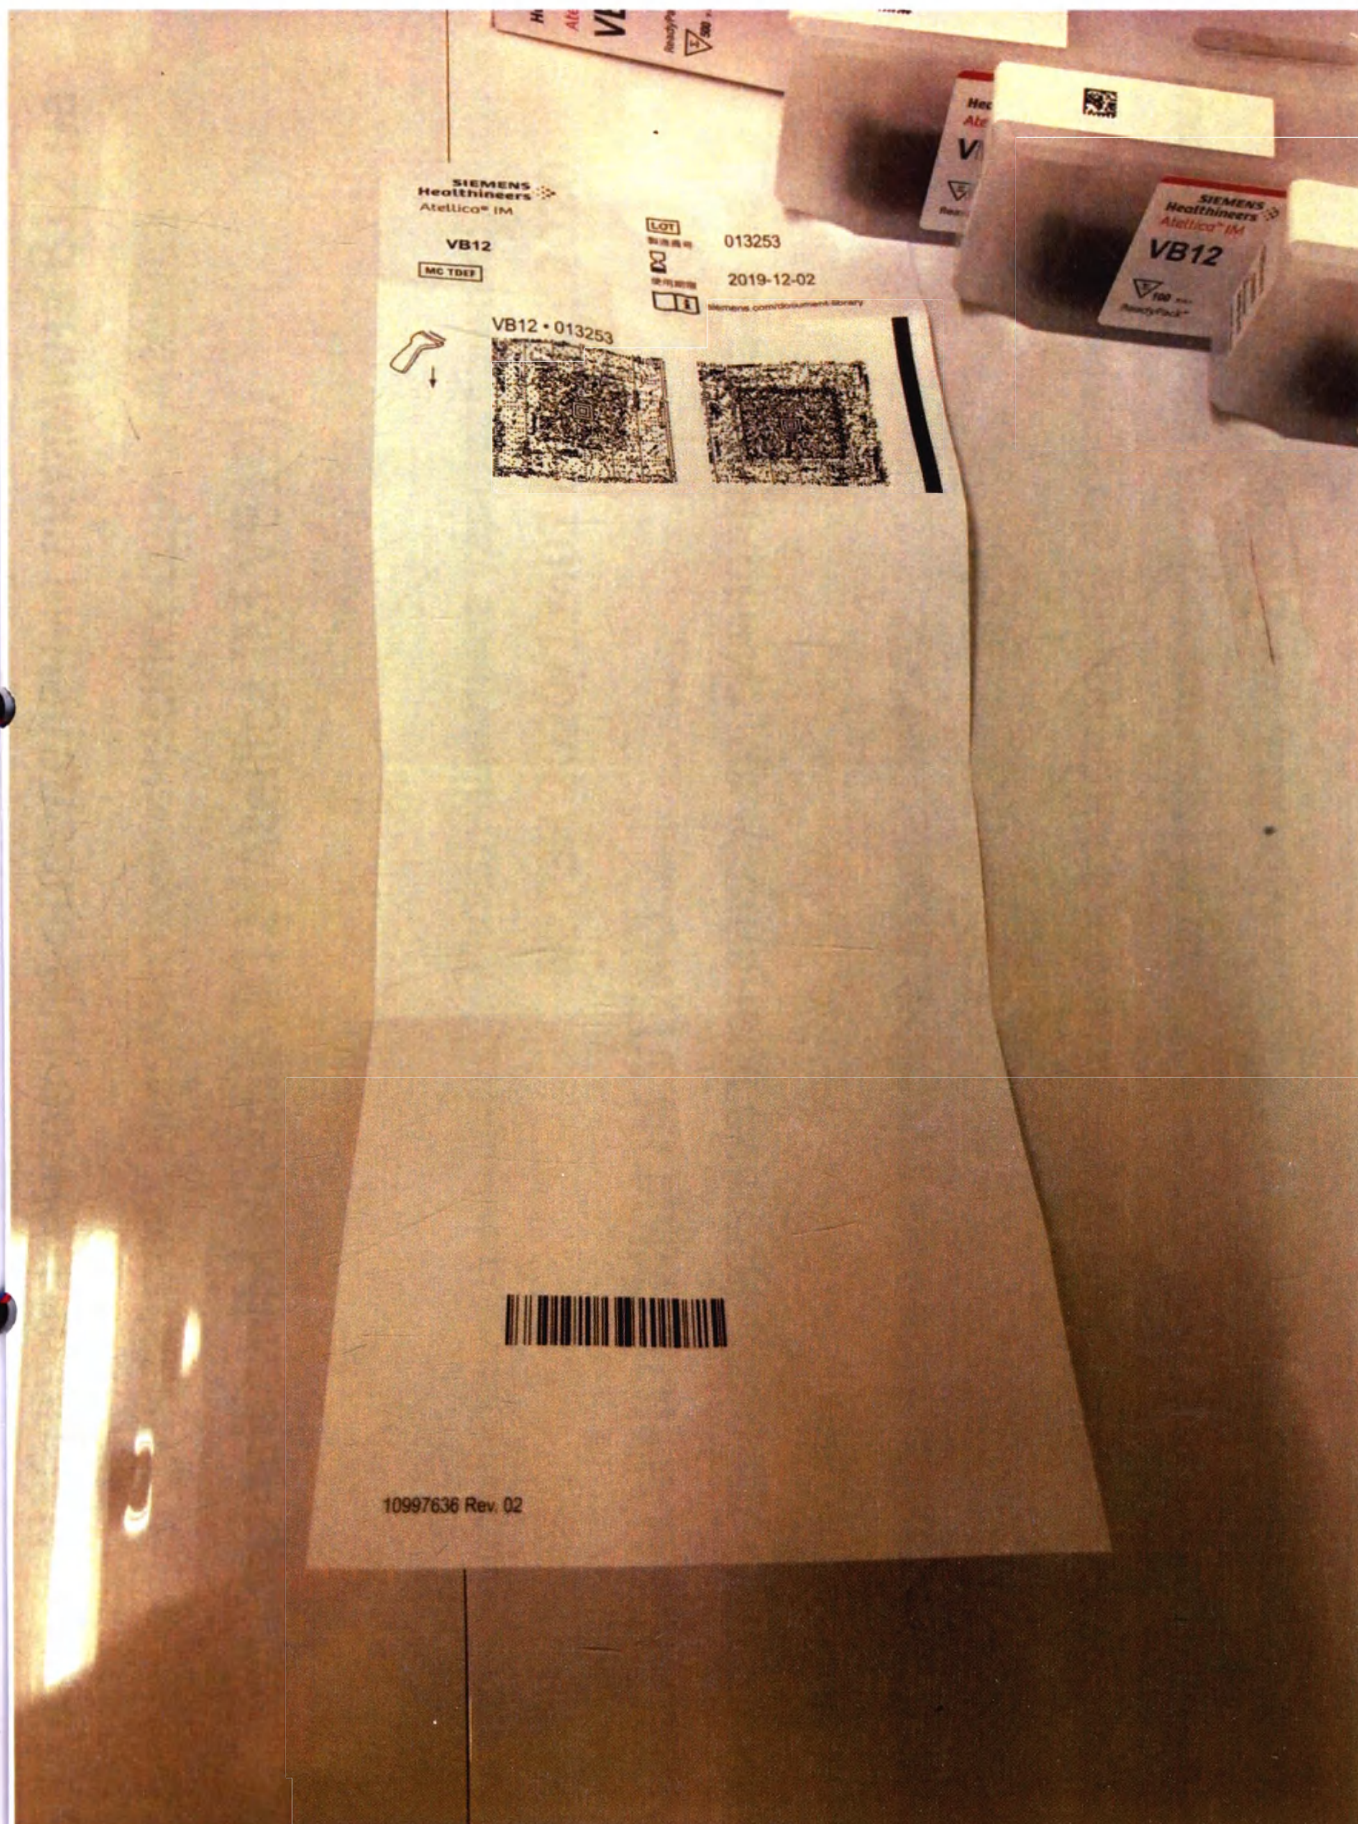


Рисунок 6. Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12)); 2. Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM VB12.

10995714

Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/12402 от 06.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

10995715

Набор реагентов для определения витамина B12 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 (Atellica IM VB12))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/12402 от 06.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96



Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

