

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»





Н.А. Горшкова
2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Дилуэнт для витамина B12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Vitamin B12 Diluent (Atellica IM VB12 DIL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

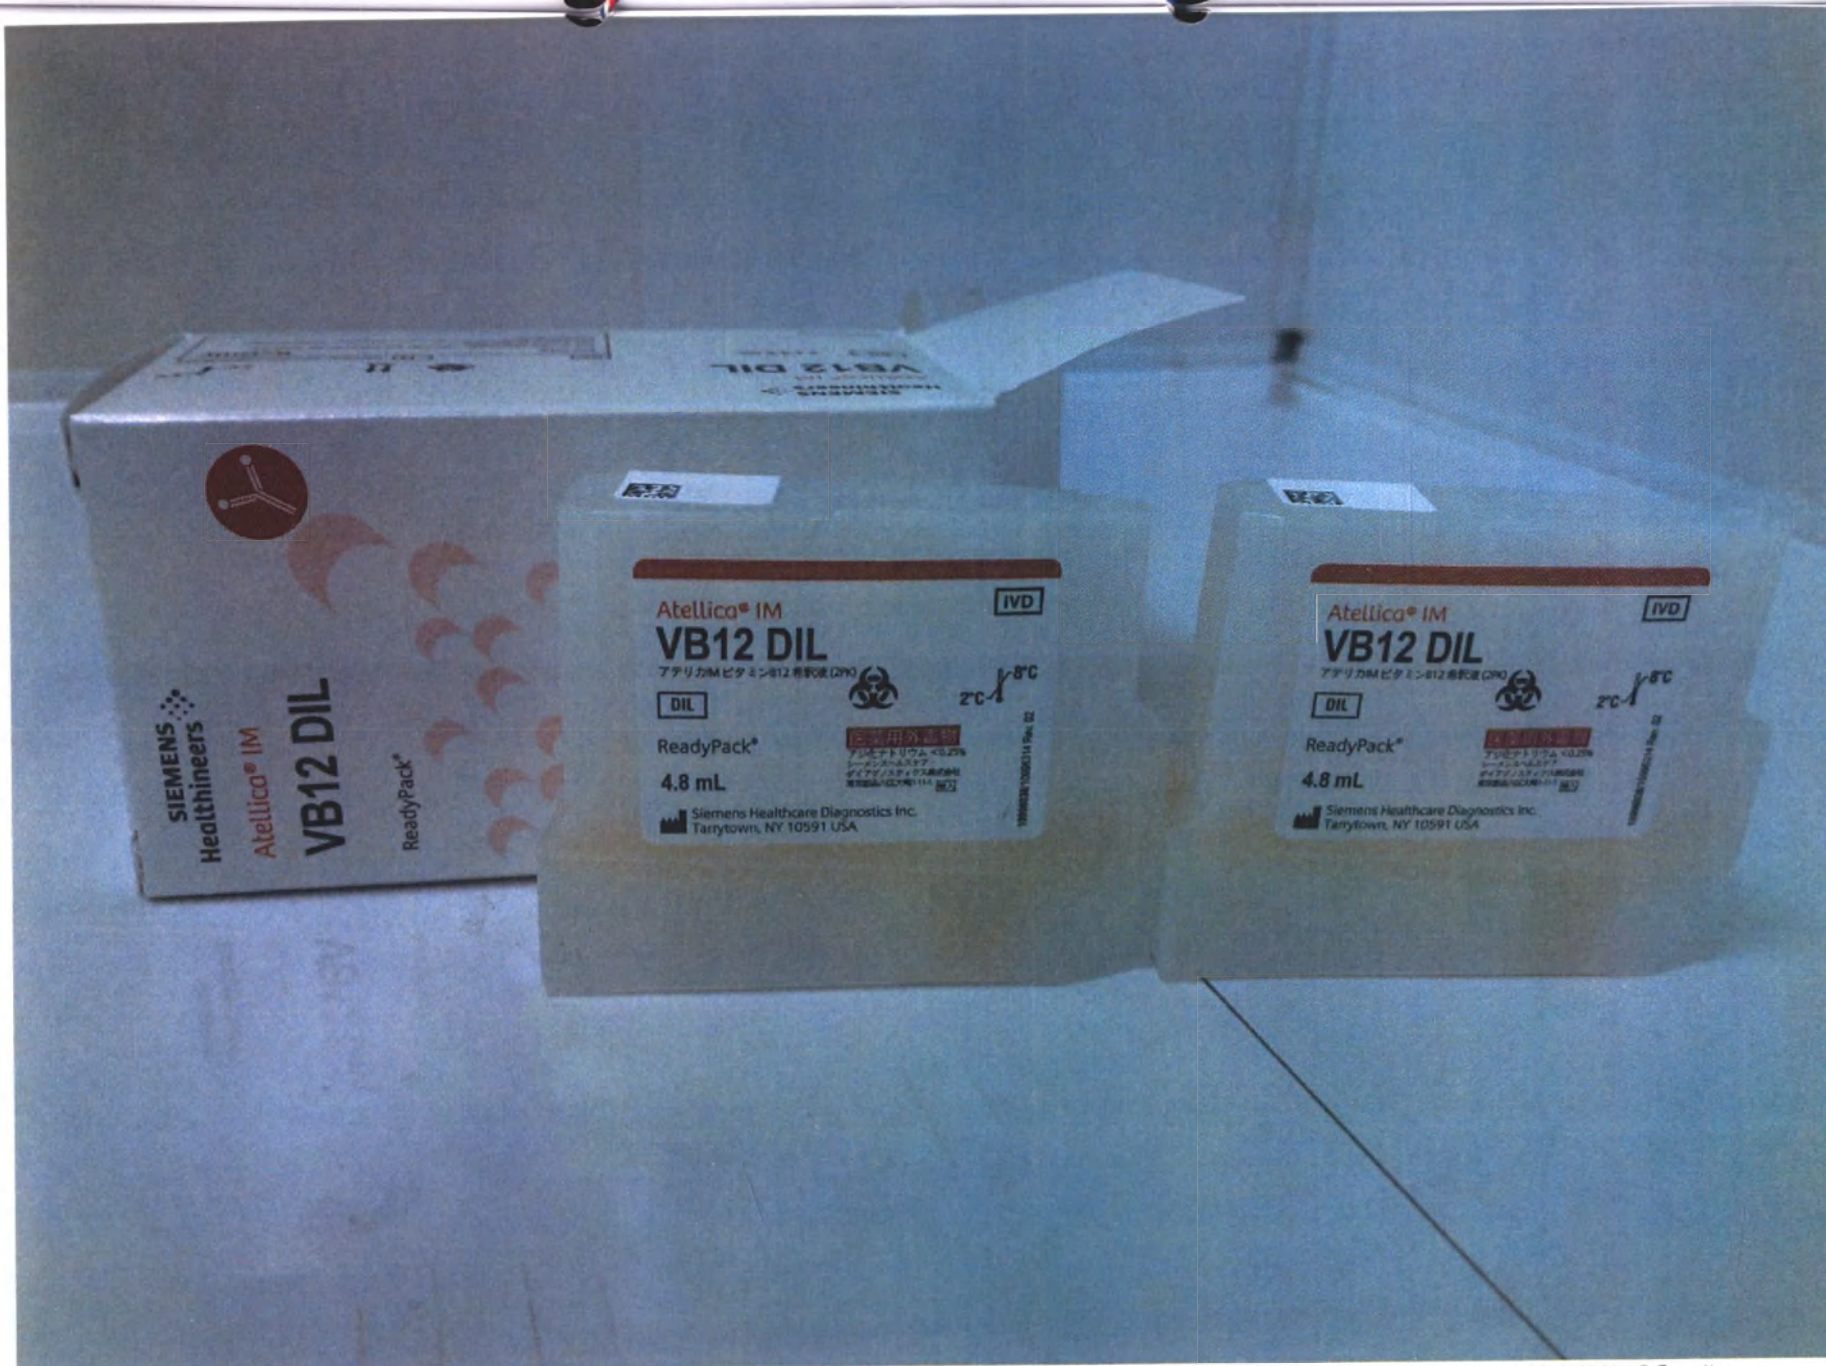

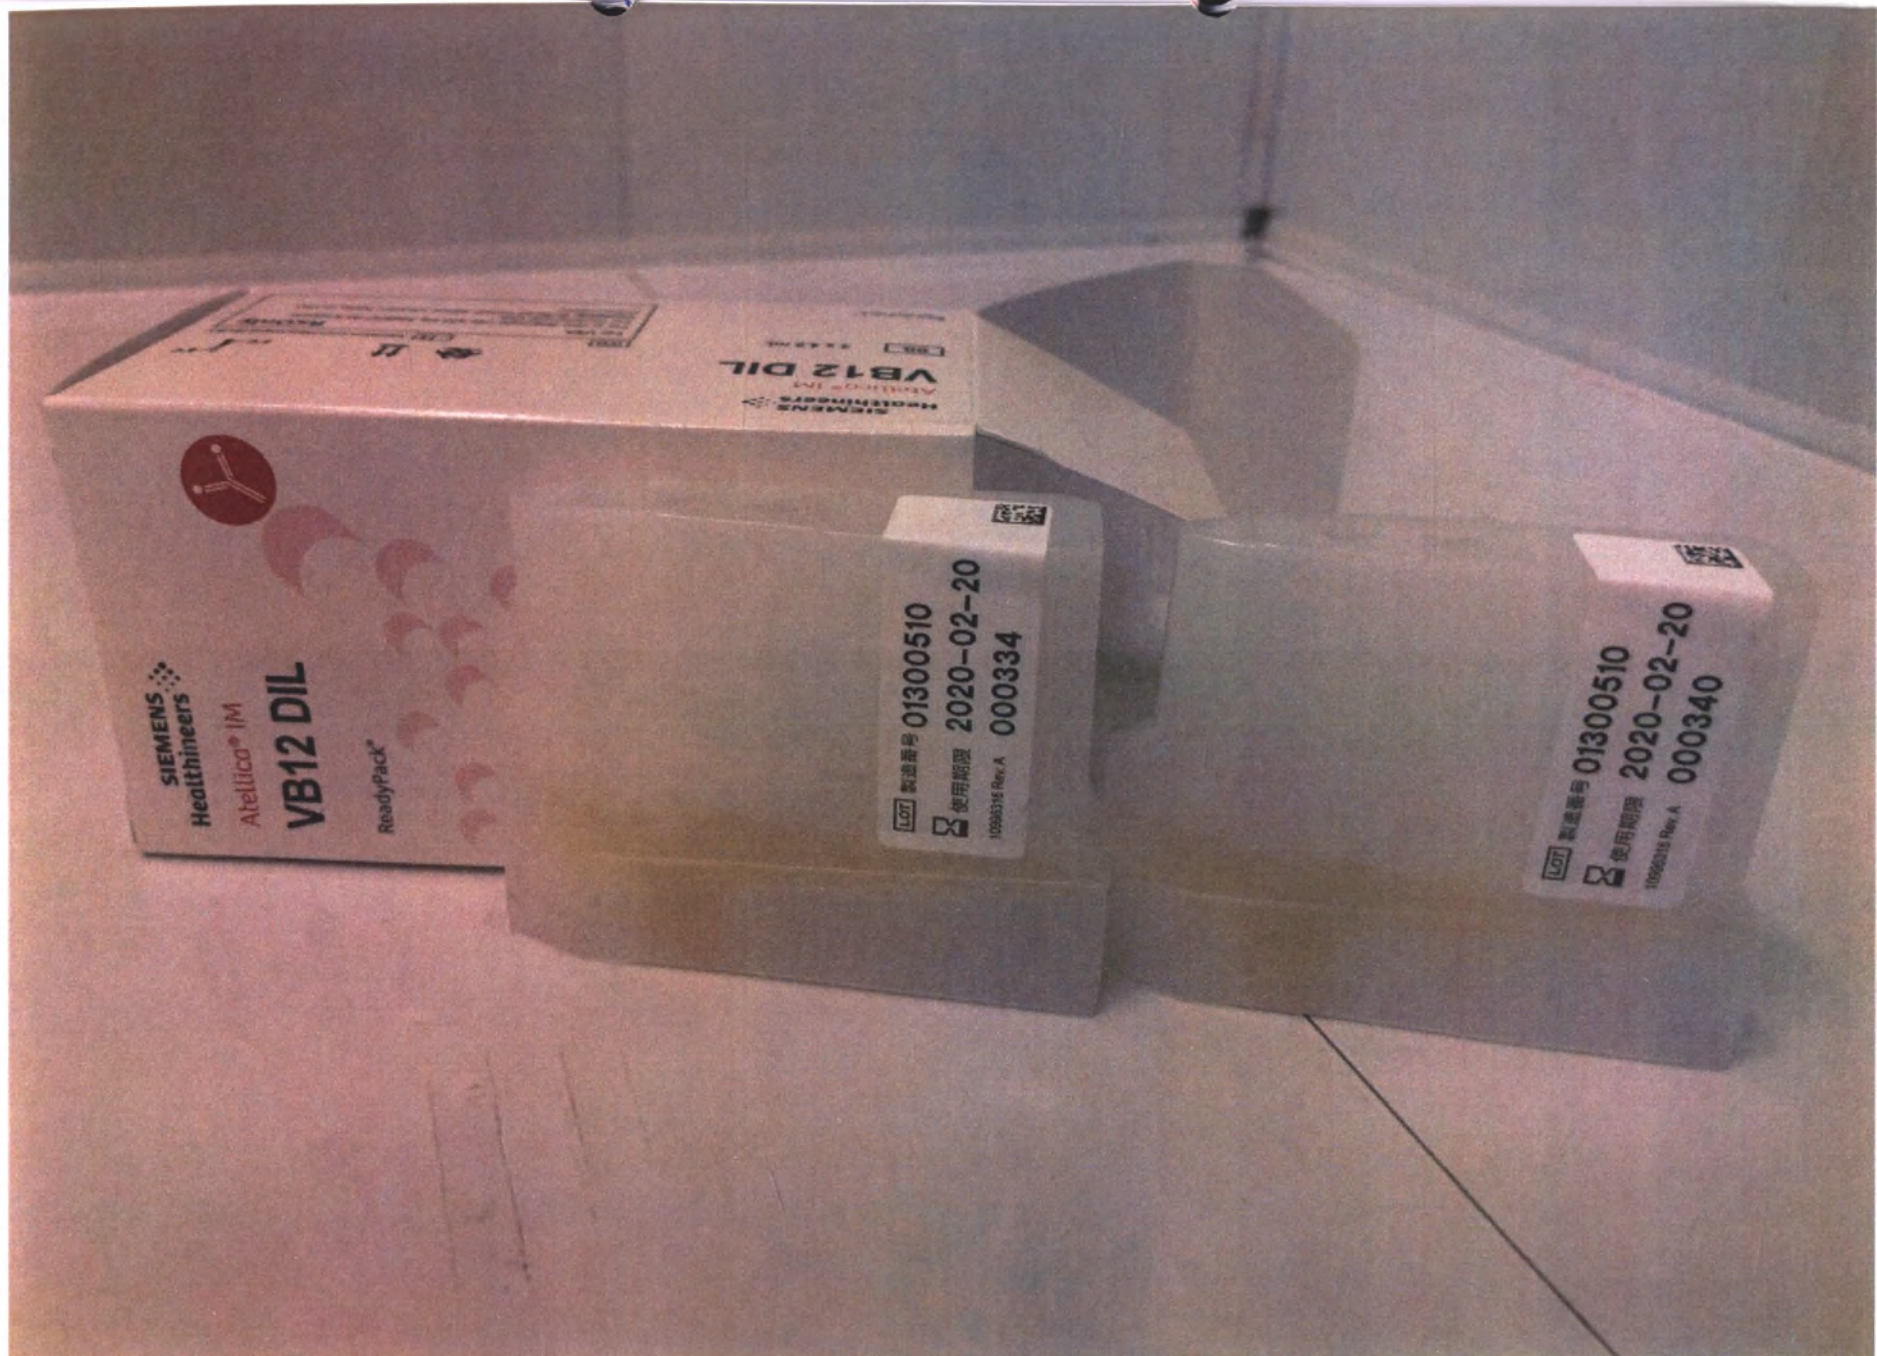

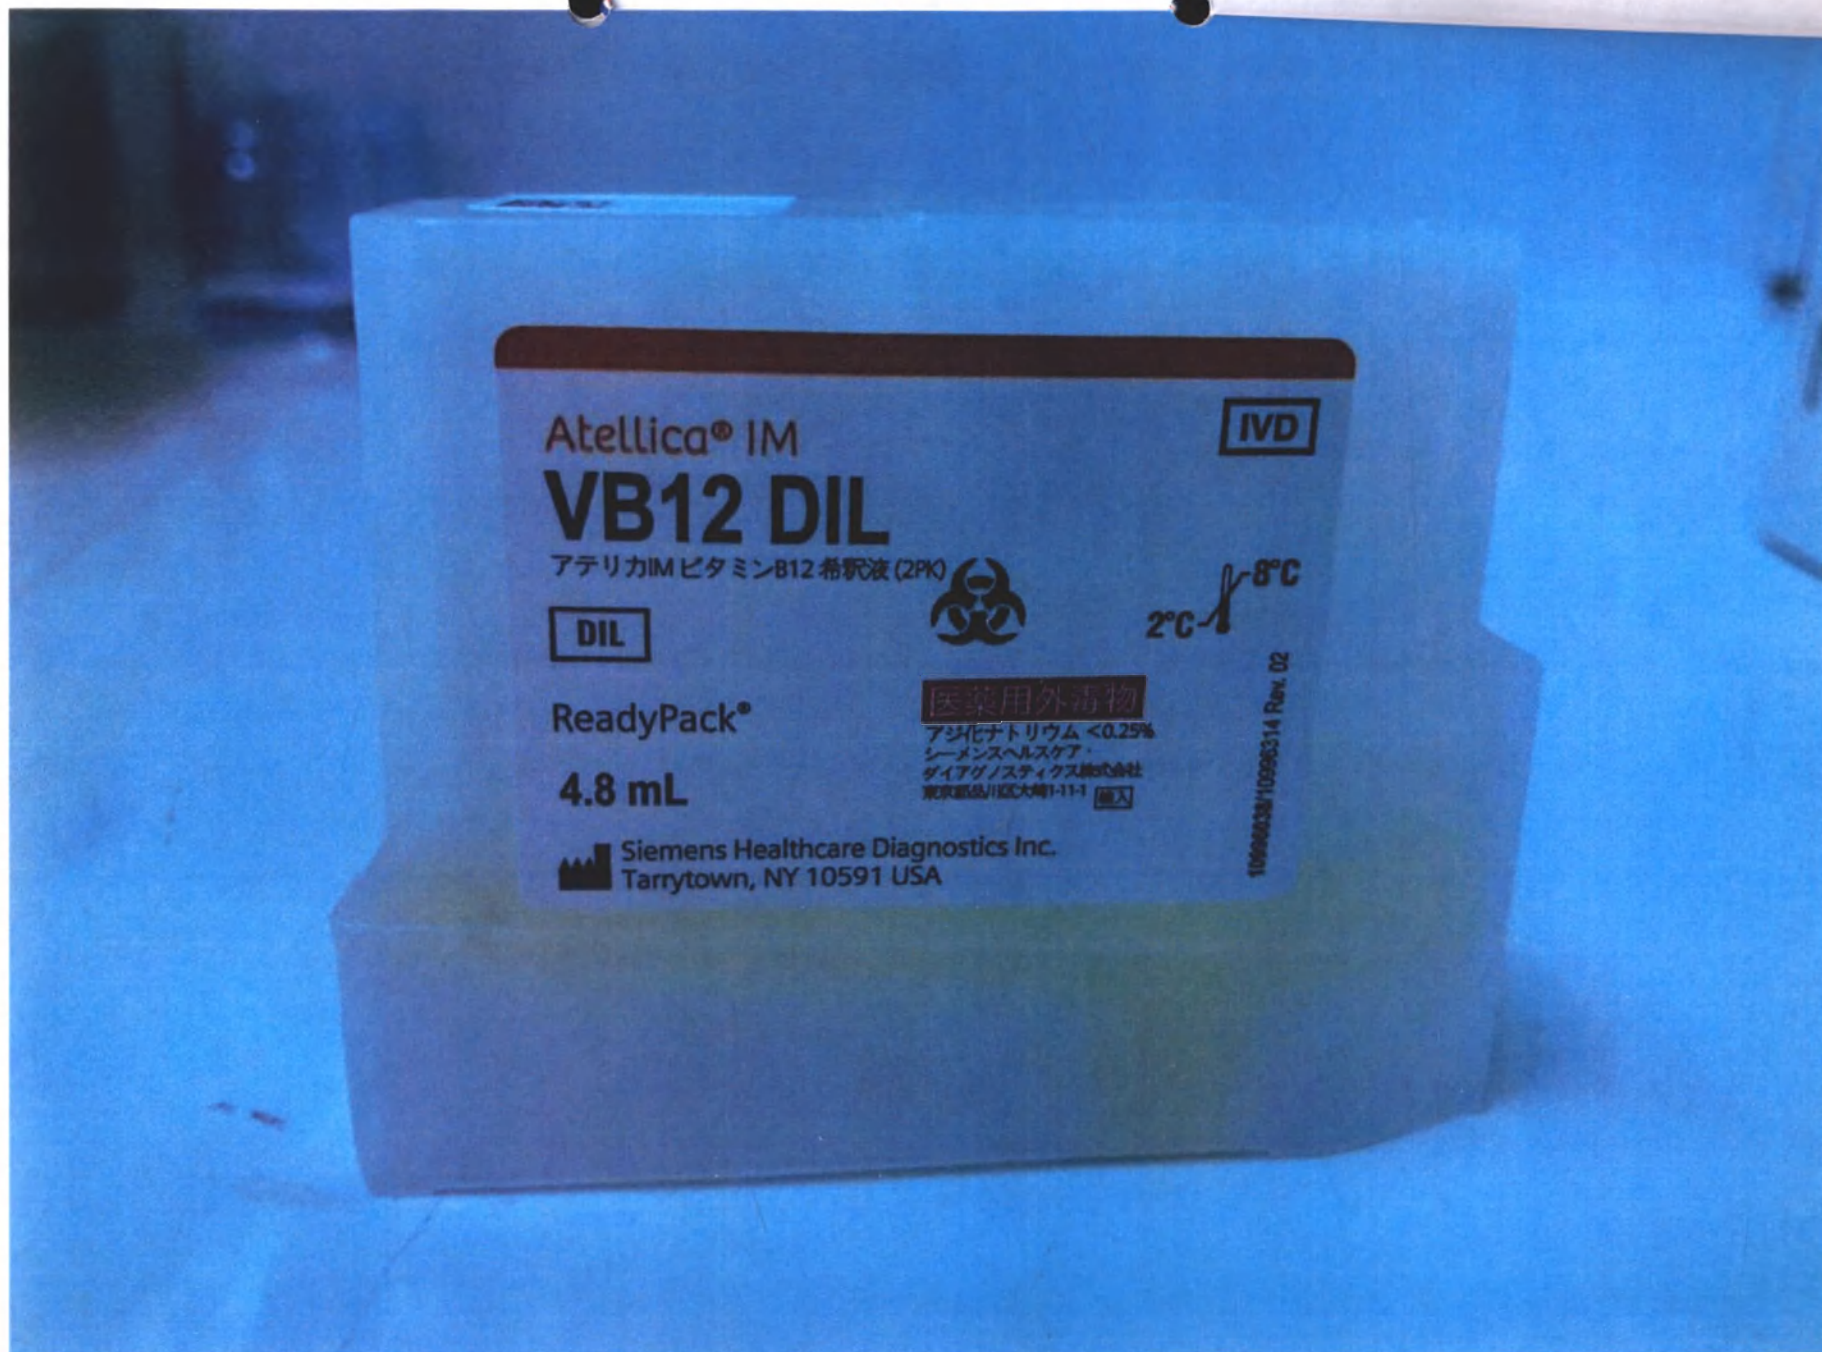


Рисунок 3. Дилуэнт для витамина B12 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin B12 Diluent (Atellica IM VB12 DIL)): Дилуэнт для витамина

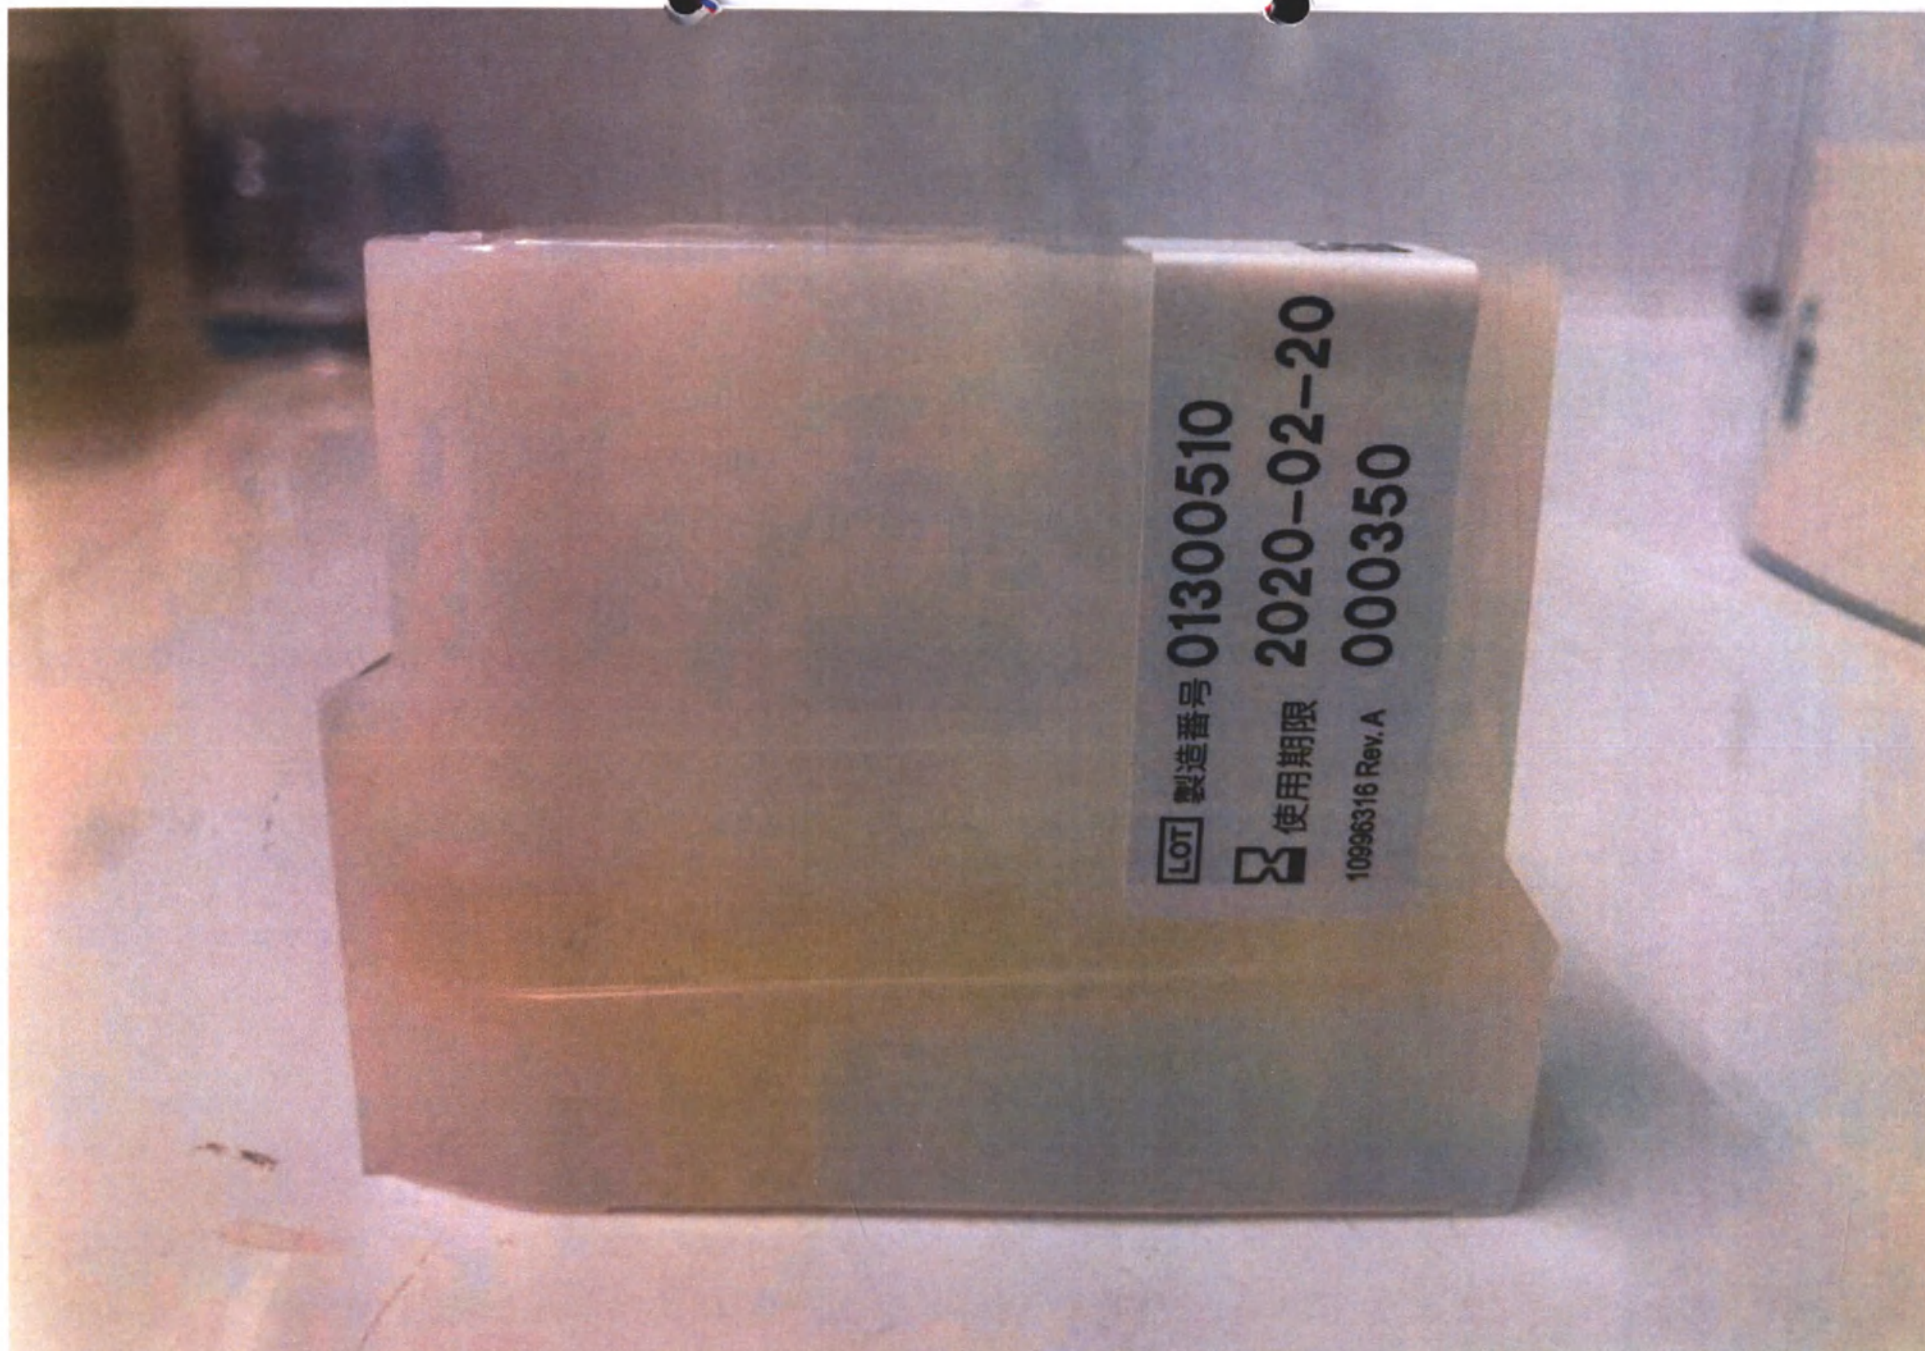


Рисунок 4. Диллюент для витамина В12 для анализаторов иммунохимических серий Atellica (Atellica IM Vitamin B12 Diluent (Atellica IM VB12 DIL.)): Диллюент для витамина

Всего прошито и пронумеровано _____ листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

