

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИнертГаз Медикал»

А.В. Потапов

«14» декабря 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Комплекса терапевтического ксенонового
NobiliXe по ТУ 32.50.21-004-36017358-2019»**



Рисунок 1 – Корпус в сборе, ООО «ИнертГаз Медикал», Россия

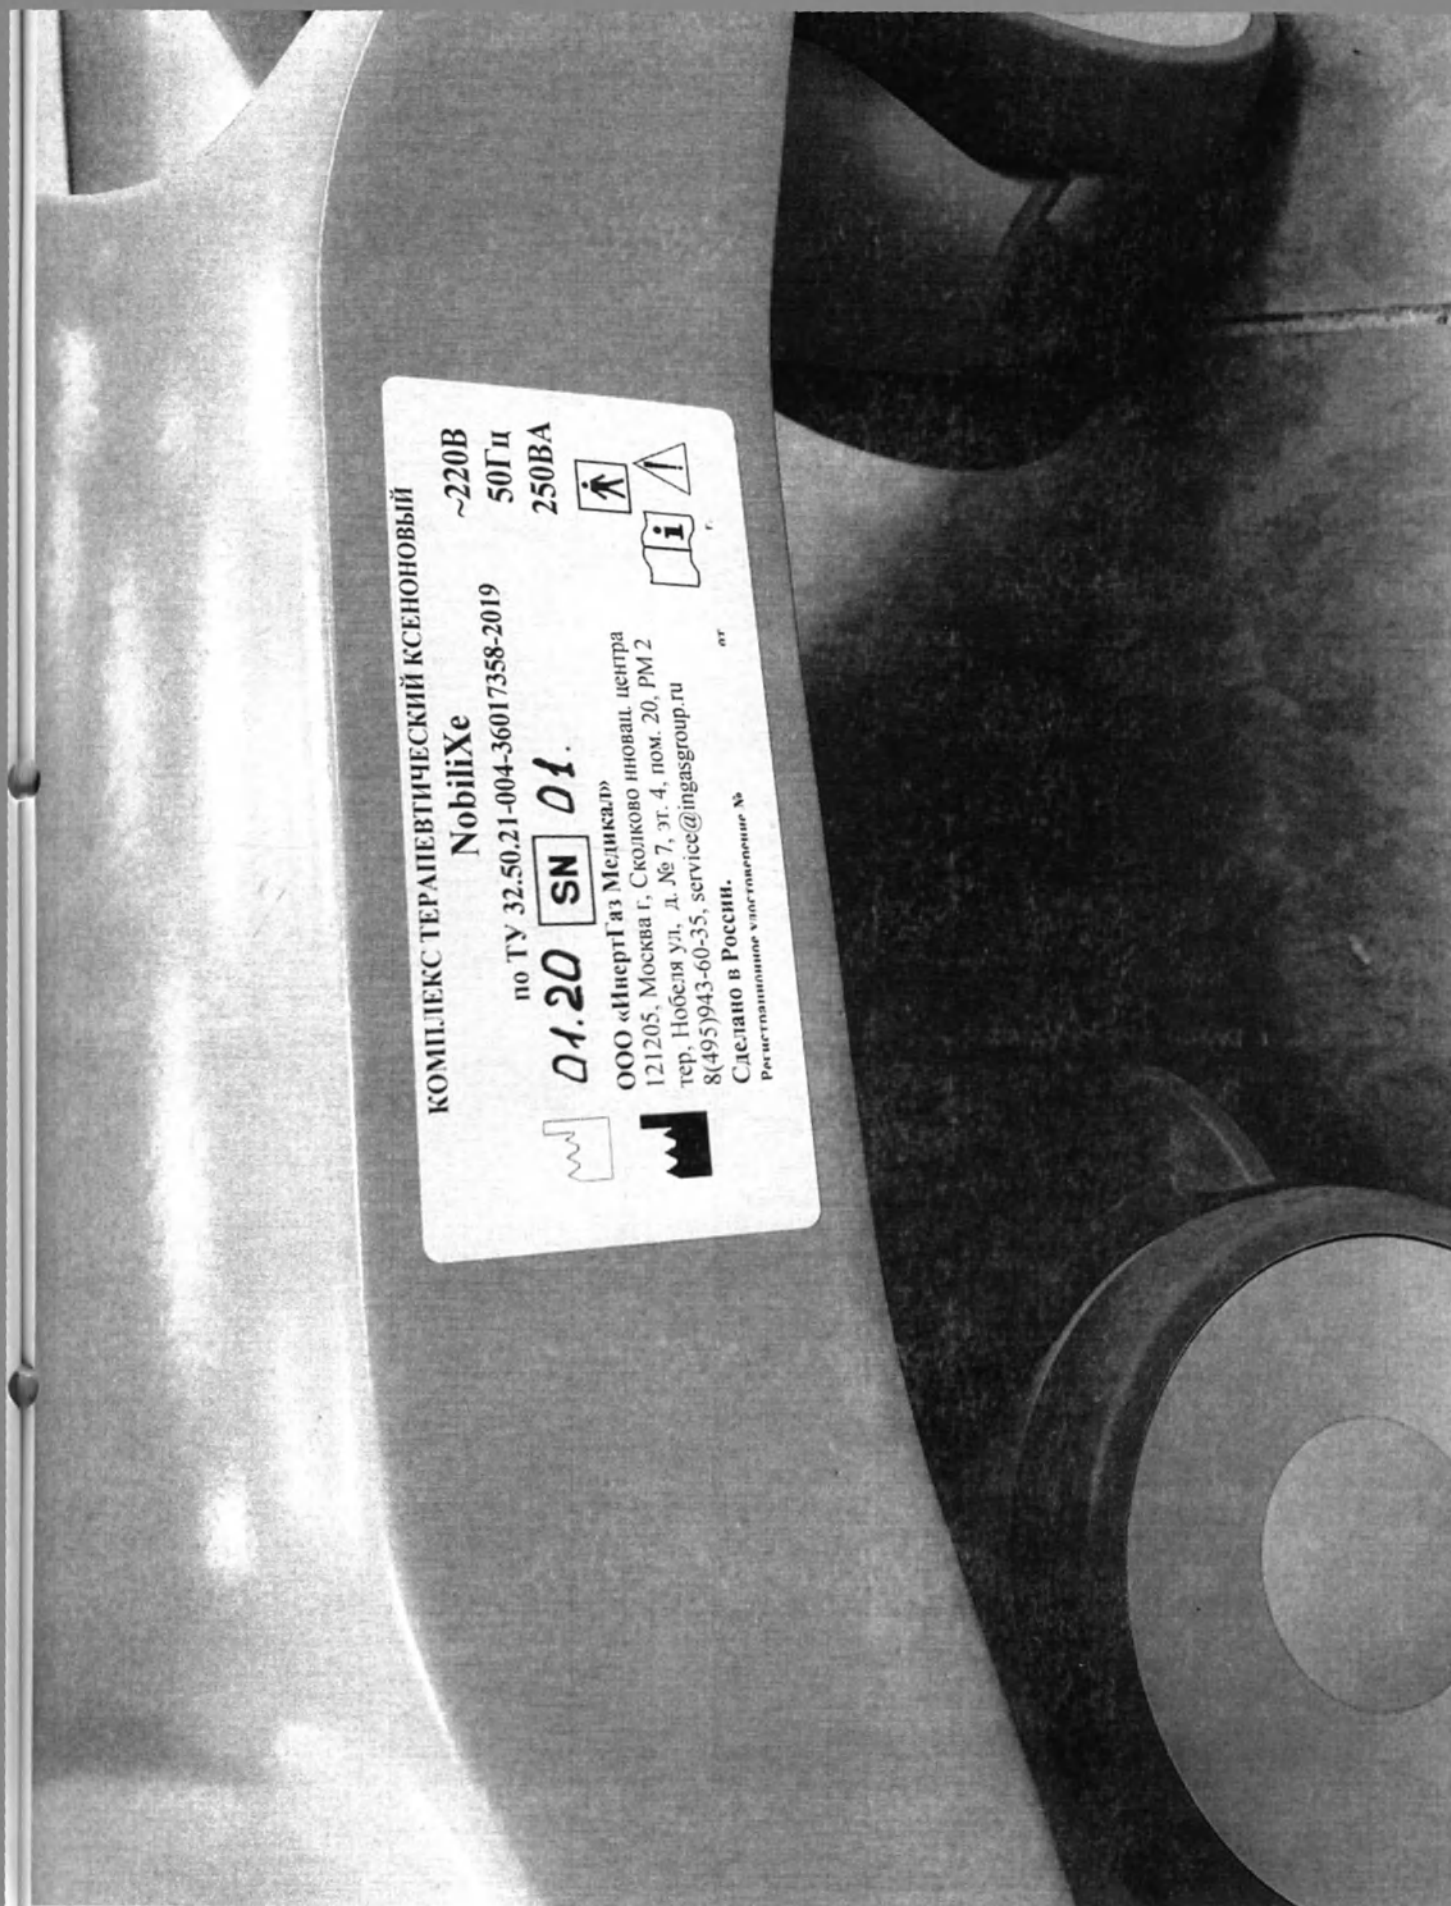


Рисунок 2 – Маркировка. «Комплекса терапевтического ксенонового NobiliXe по ТУ 32.50.21-004-36017358-2019»

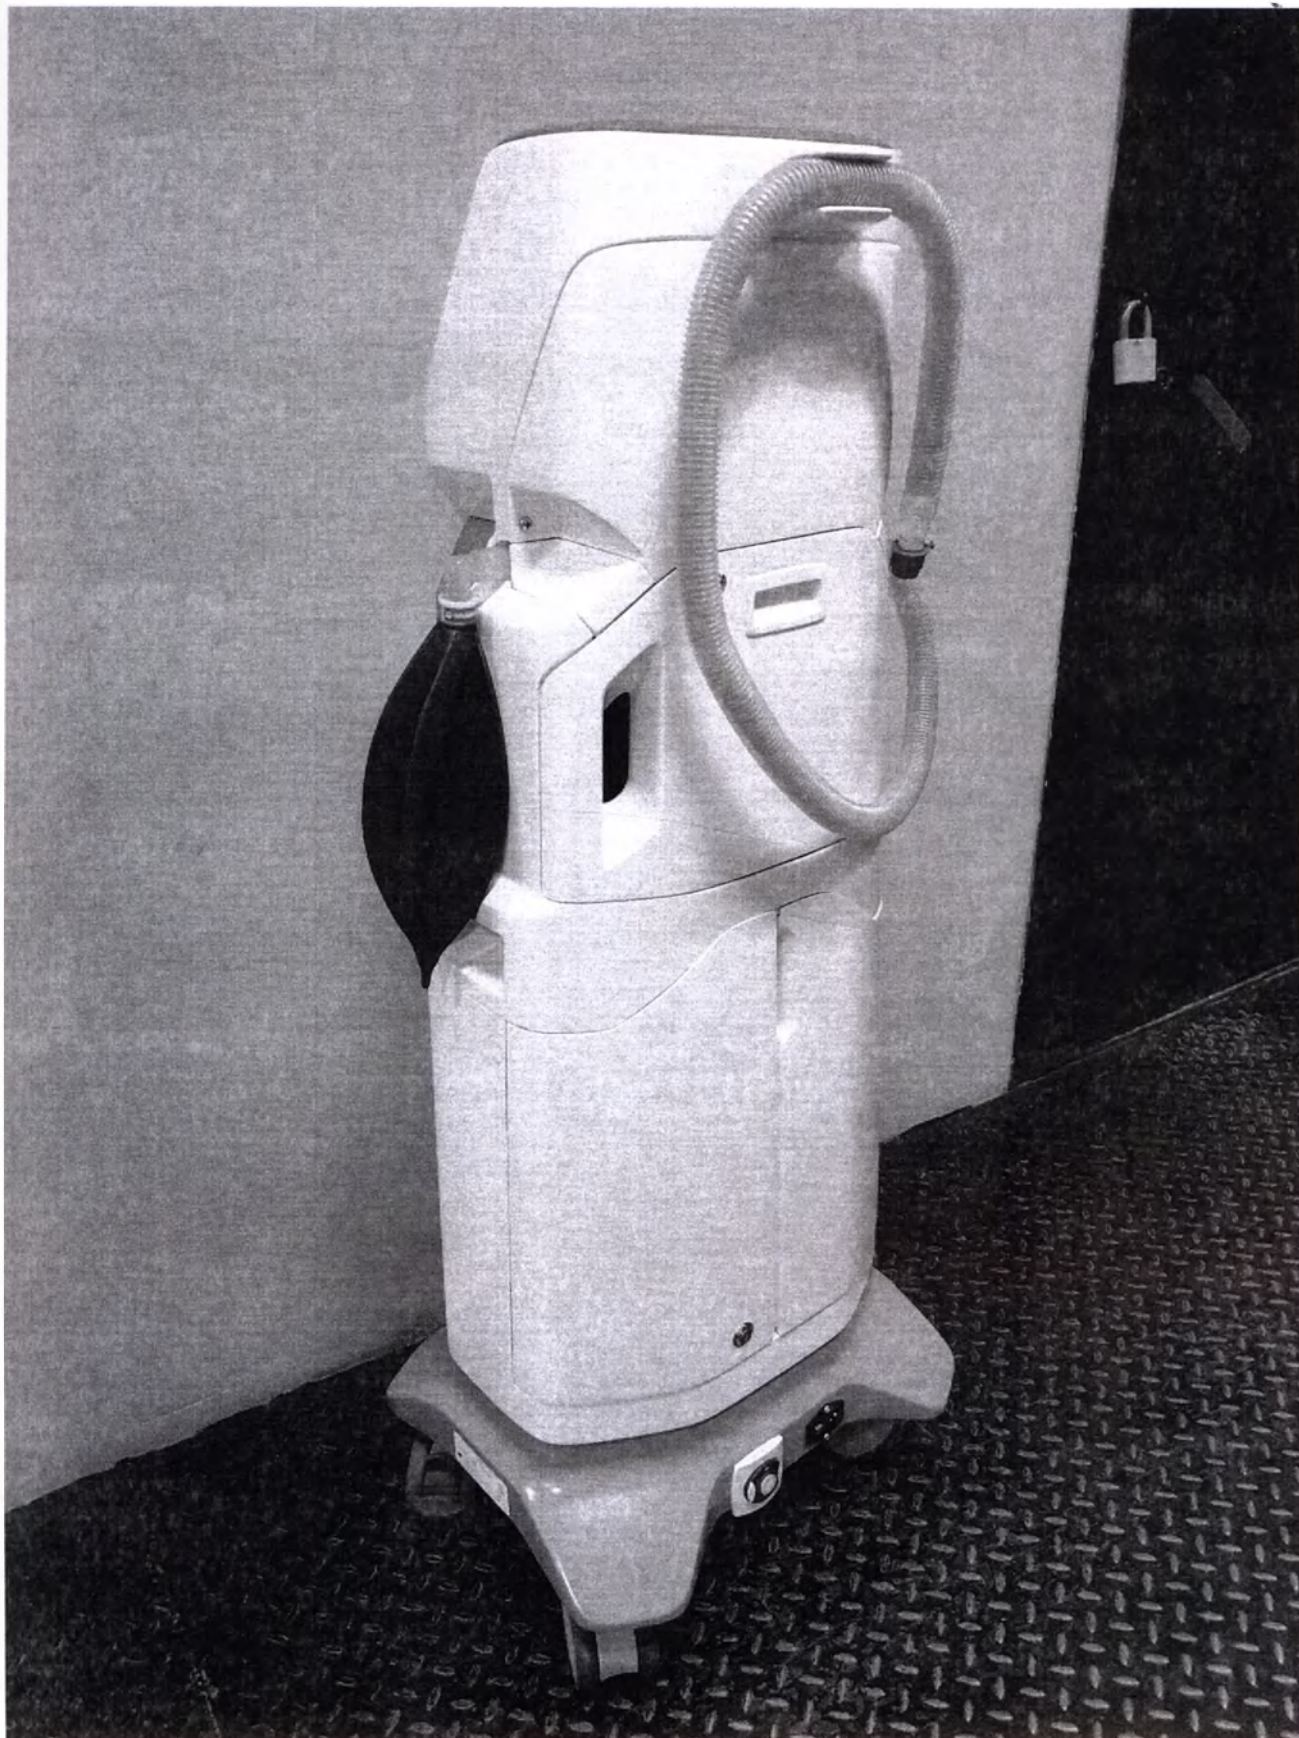


Рисунок 3 – Корпус в сборе. Вид сзади. Производство ООО «ИнертГаз Медикал», Россия.

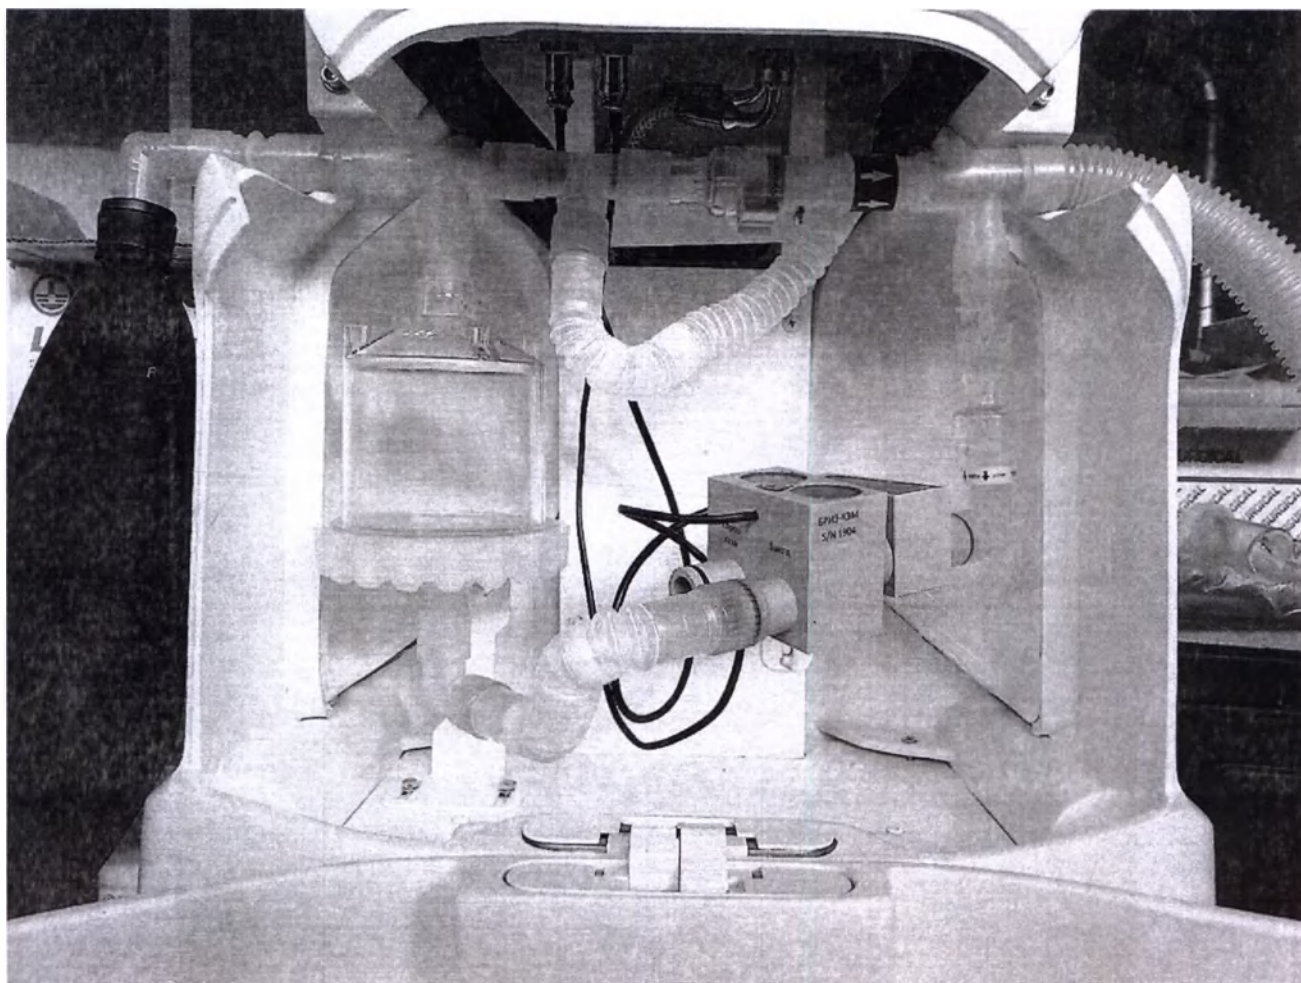


Рисунок 4 – Корпус в сборе с открытой откидывающейся крышкой. Производство ООО «ИнертГаз Медикал», Россия. На фотографическом изображении вид на дыхательный контур Комплекса терапевтического ксенонового NobiliXe в сборе.

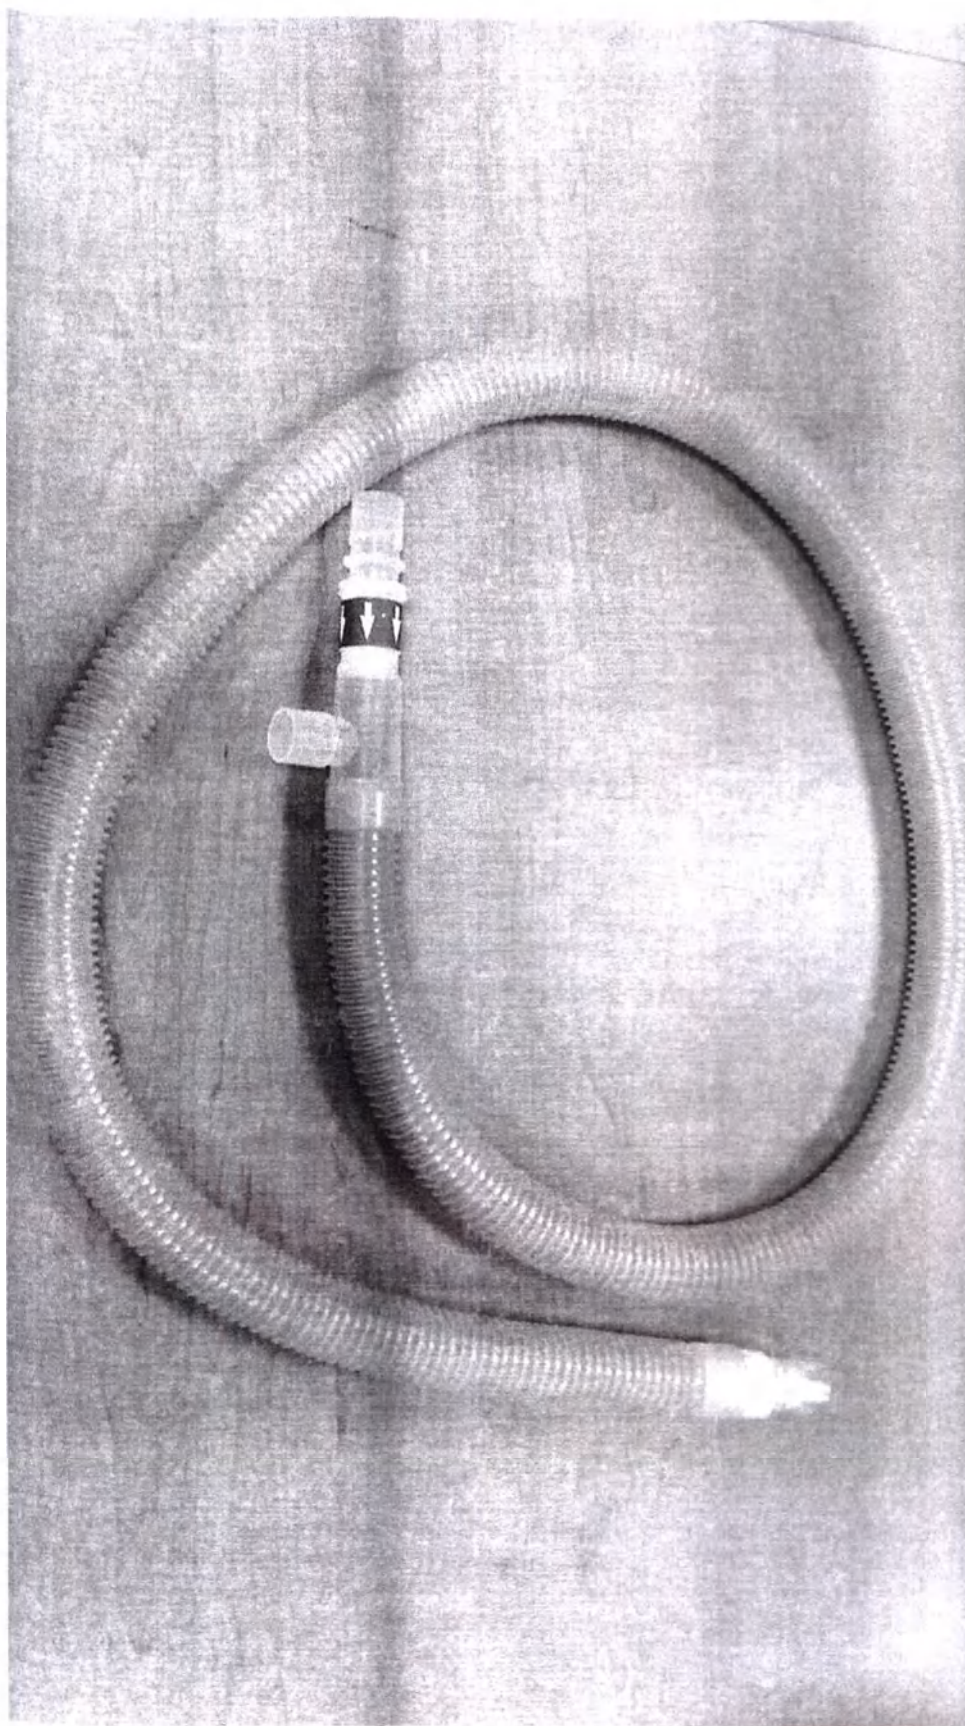


Рисунок 5 – Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные антимикробные для взрослых, для детей, для новорожденных с обогревом или без, производства «Интерсерджикал Лтд.» («Intersurgical Ltd.»), Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

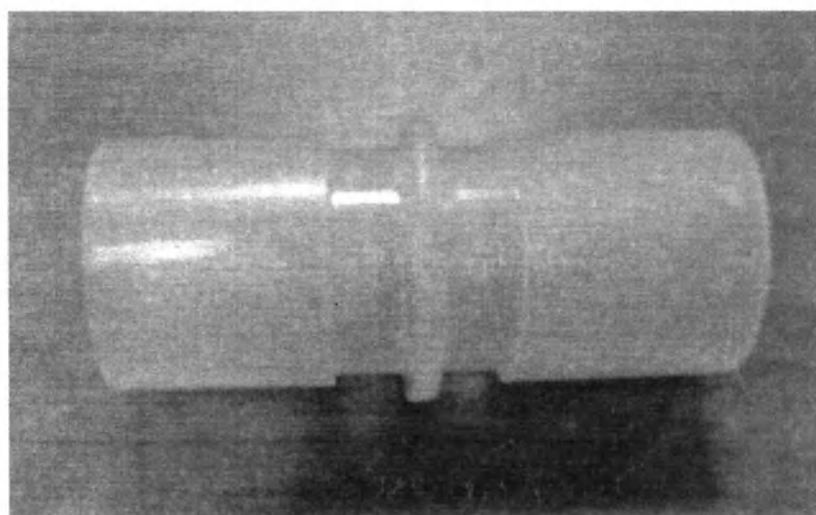
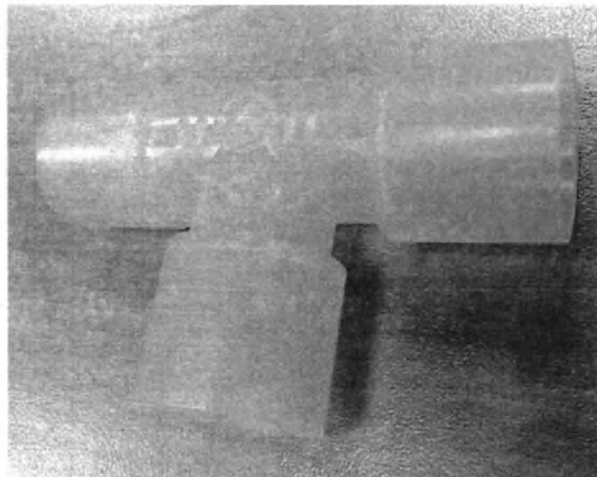
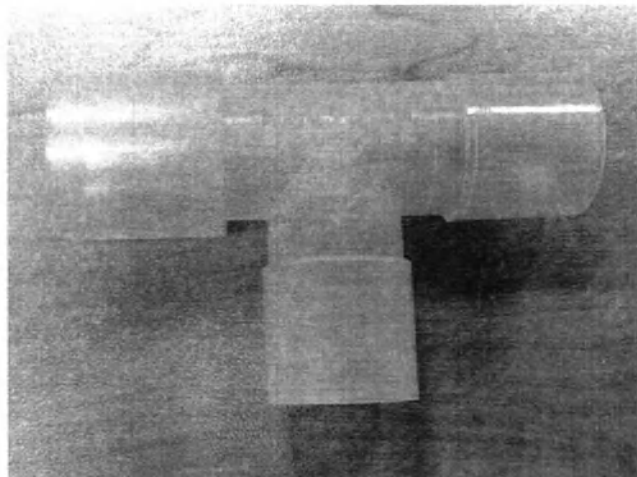
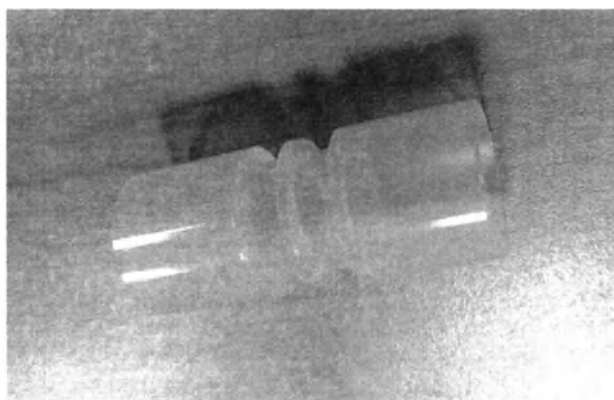
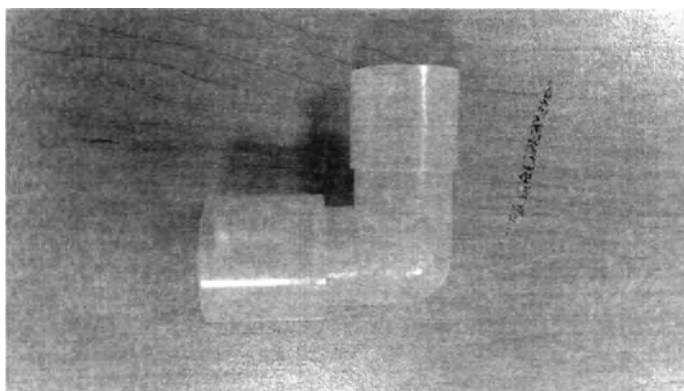


Рисунок 6 – Соединители с портами и без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, мундштуки (загубники), производства «Интерсерджикал Лтд.» («Intersurgical Ltd.»), Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

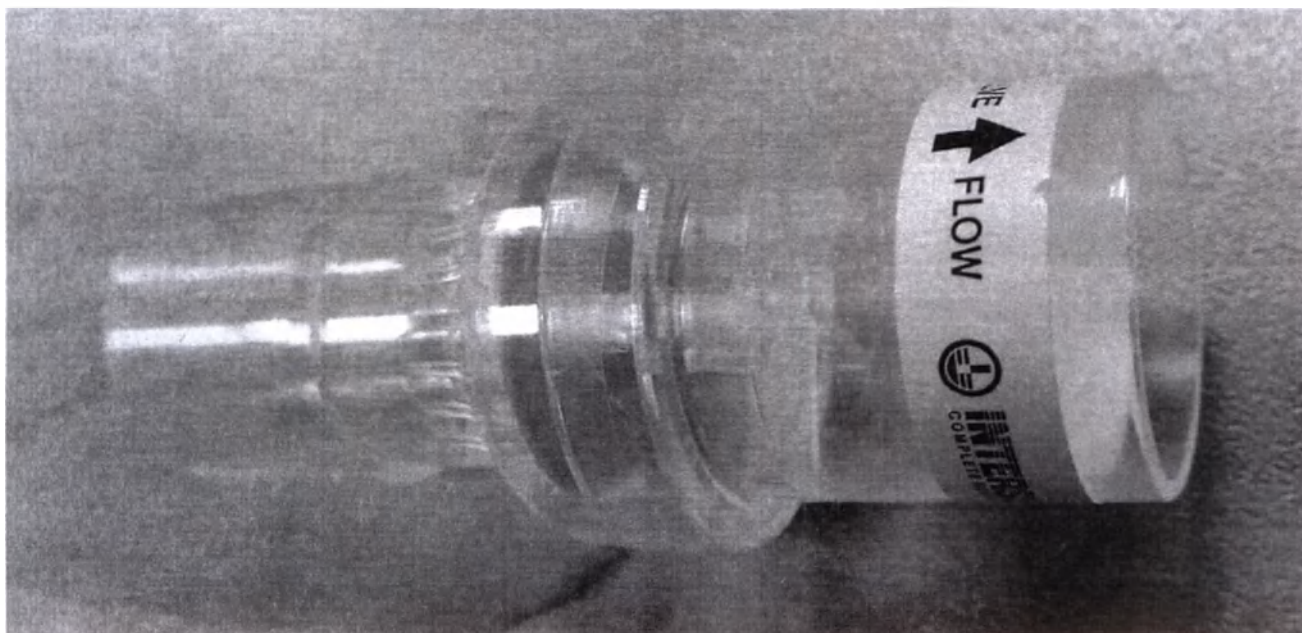


Рисунок 7 – Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны реверсивные и неревверсивные клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления, производства «Интерсерджикал Лтд.» («Intersurgical Ltd.»), Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

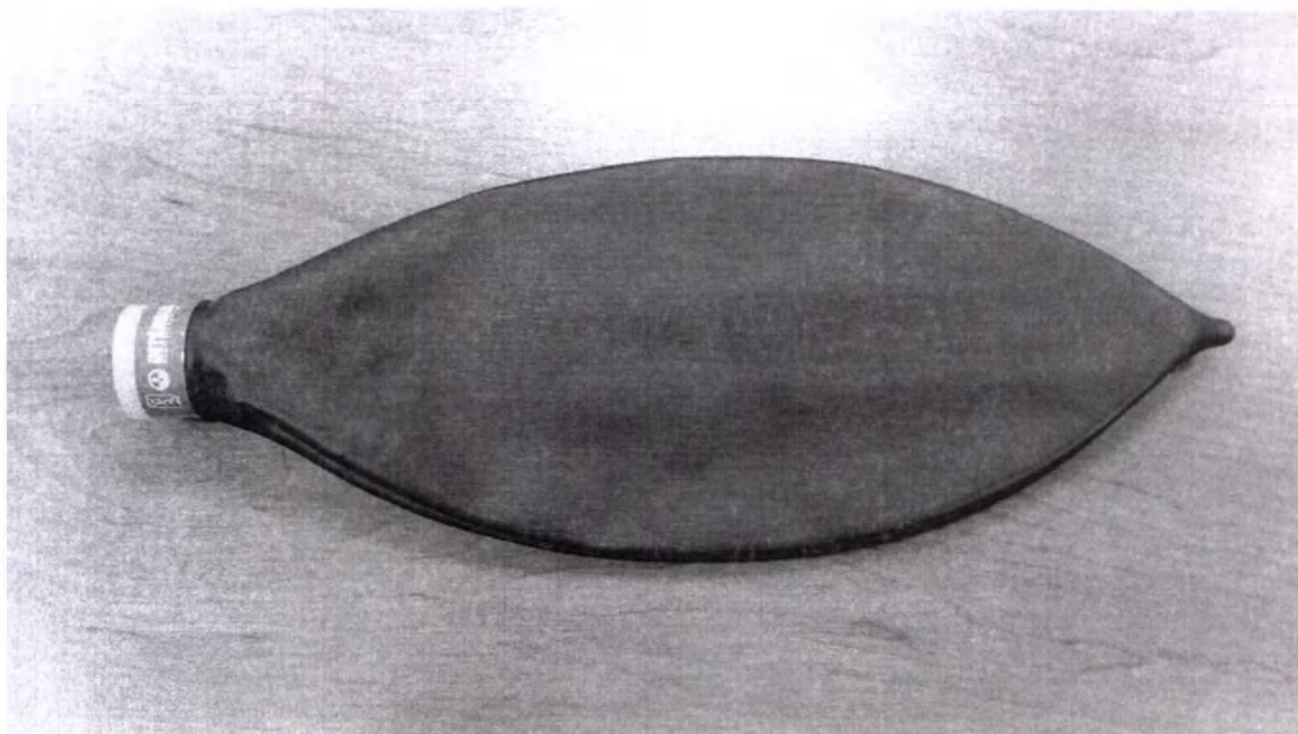


Рисунок 8 – Дыхательные мешки объемом: 2.0 л, 3.0 л, 5.0 л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлей или без; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без, производства «Интерсерджикал Лтд.» («Intersurgical Ltd.»), Великобритания, РУ

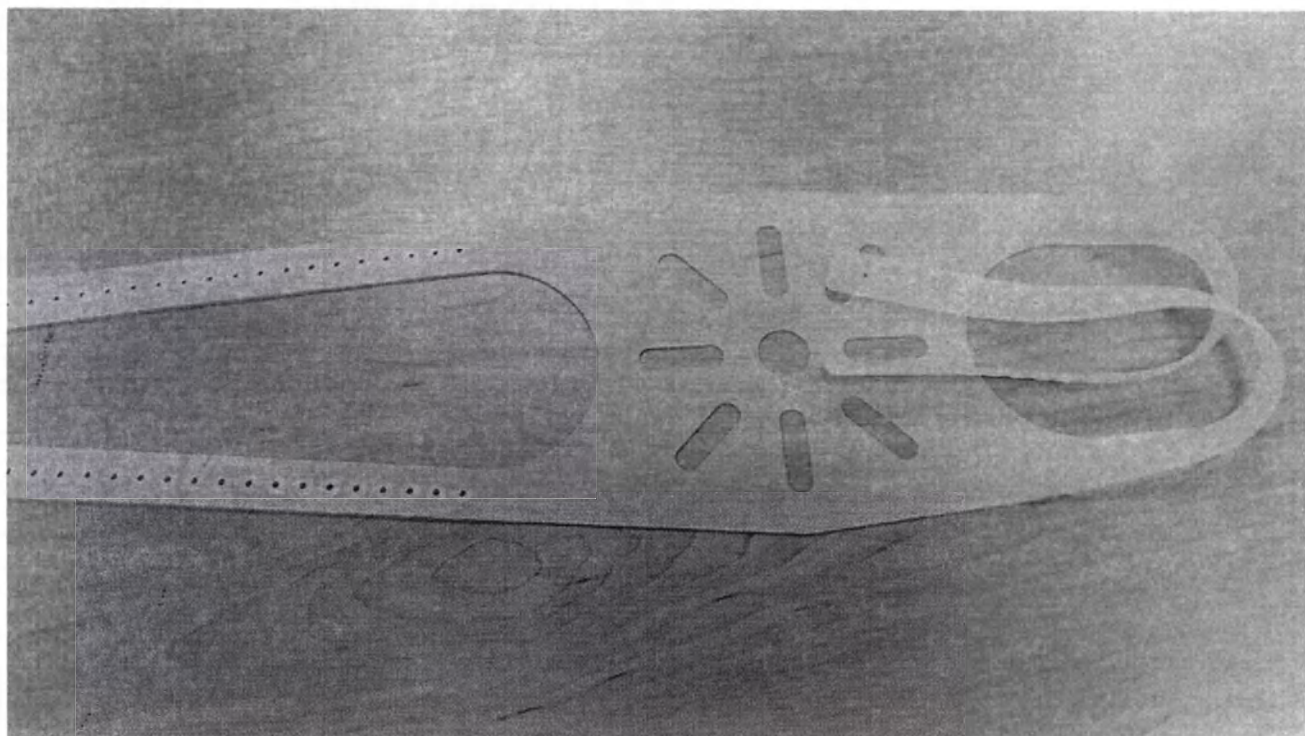


Рисунок 9 – Держатели-фиксаторы для масок – эластомерные головные, кольцо, производства «Интерсерджикал Лтд.» («Intersurgical Ltd.»), Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

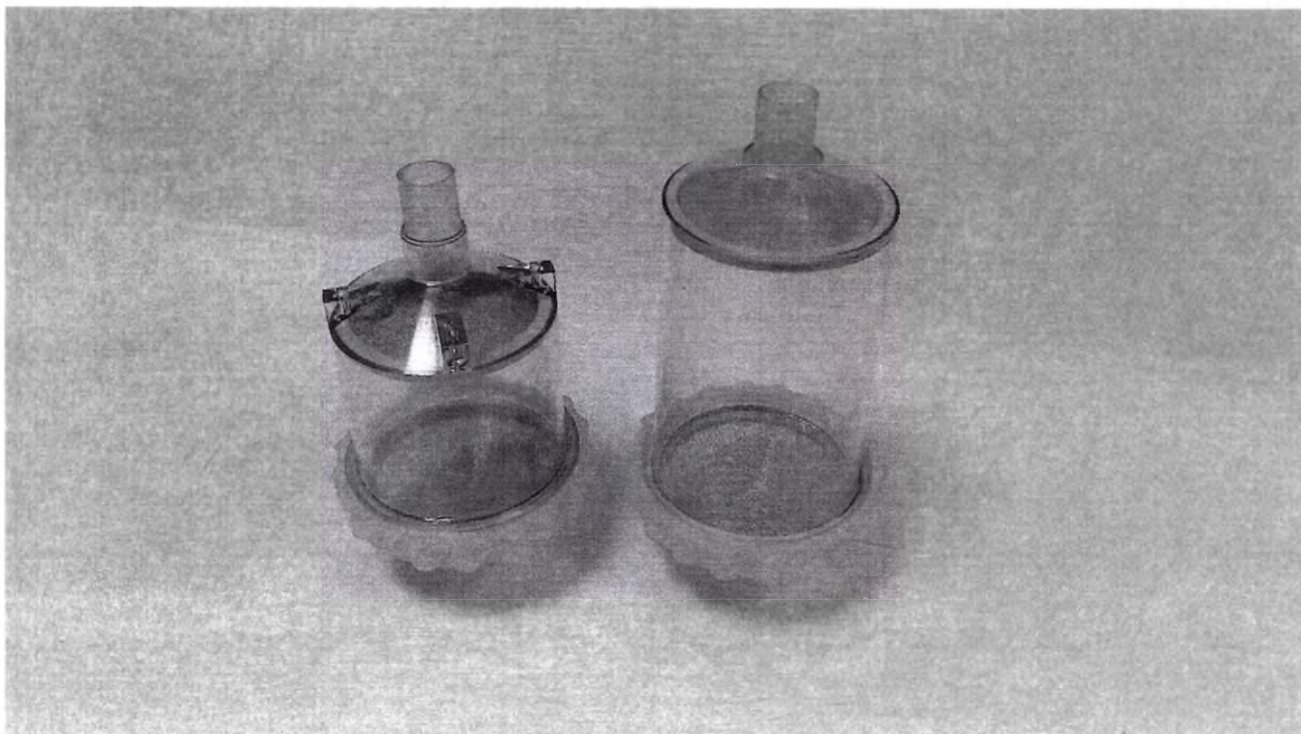


Рисунок 10 – Адсорбер, ОАО «Уральский приборостроительный завод», Россия



Рисунок 11 – Кабель питания сетевой, производства Гембирд Электроникс ЛТД (Gembird Electronics Ltd.), Кутаї



Рисунок 12 – Аккумулятор, производства ООО «Источники Питания», Россия / Шензен Топвау Нью Энерджи Ко. Лтд. (Shenzhen Topway New Energy Co. Ltd.), Китай / Шензен Сошине Баттери Ко. Лтд. (Shenzhen Soshine Battery Co. Ltd), Китай

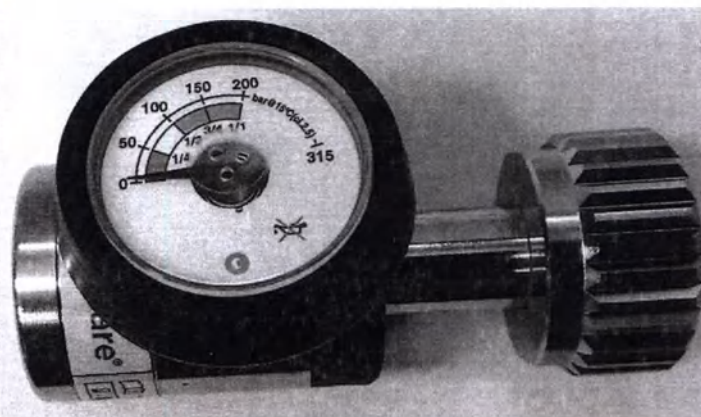
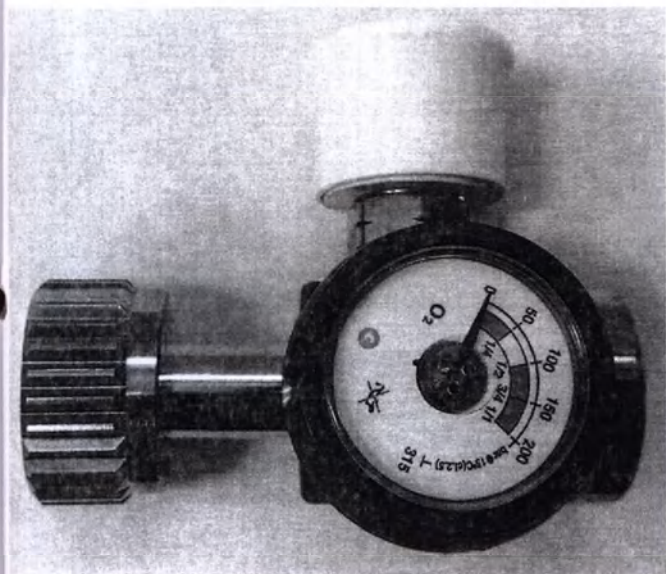


Рисунок 13 – Регулятор давления, производства «ДжисуИ с.р.о.» (GCE s.r.o.), Чехия

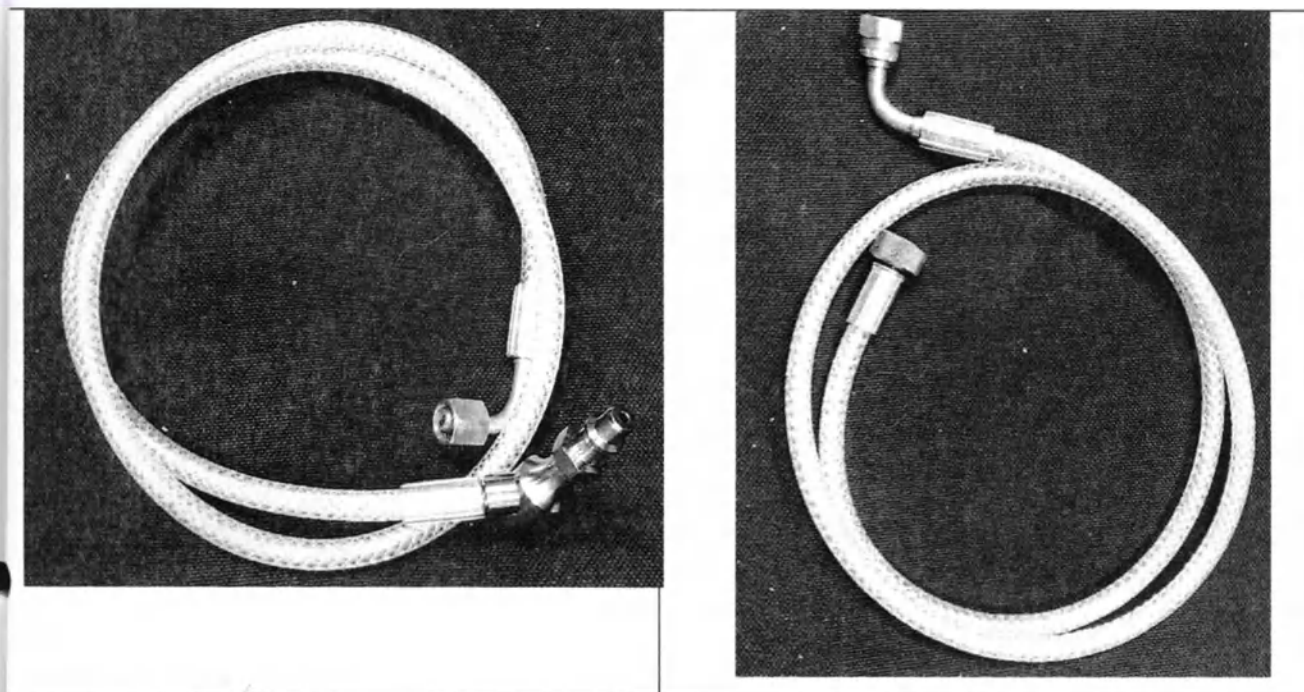


Рисунок 14 – Рукав низкого давления, производства ООО «ИнертГаз Медикал», Россия



Рисунок 15 – Баллон, производства Лаксфер (Luxfer), Великобритания

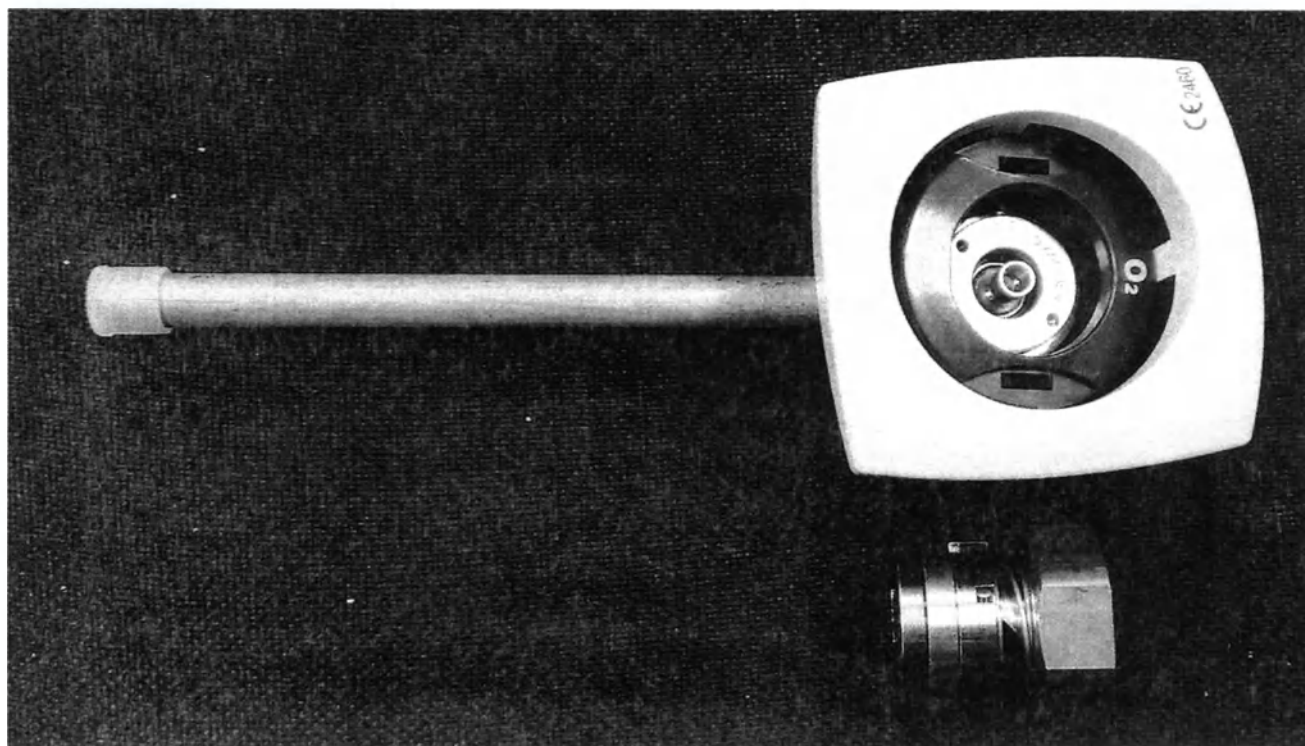


Рисунок 16 – Пневморазъем к кислородной сети, производства «ДжиСиИ с.р.о.» (GCE s.r.o.), Чехия



Рисунок 17 – Анестезиологические маски, размерами 2, 3, 4, 5, 6: EcoMask II, Quadralite, экономичная анестезиологическая лицевая, маска лицевая анатомическая, производства «Интерсерджикал Лтд.» («Intersurgical Ltd.»), Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

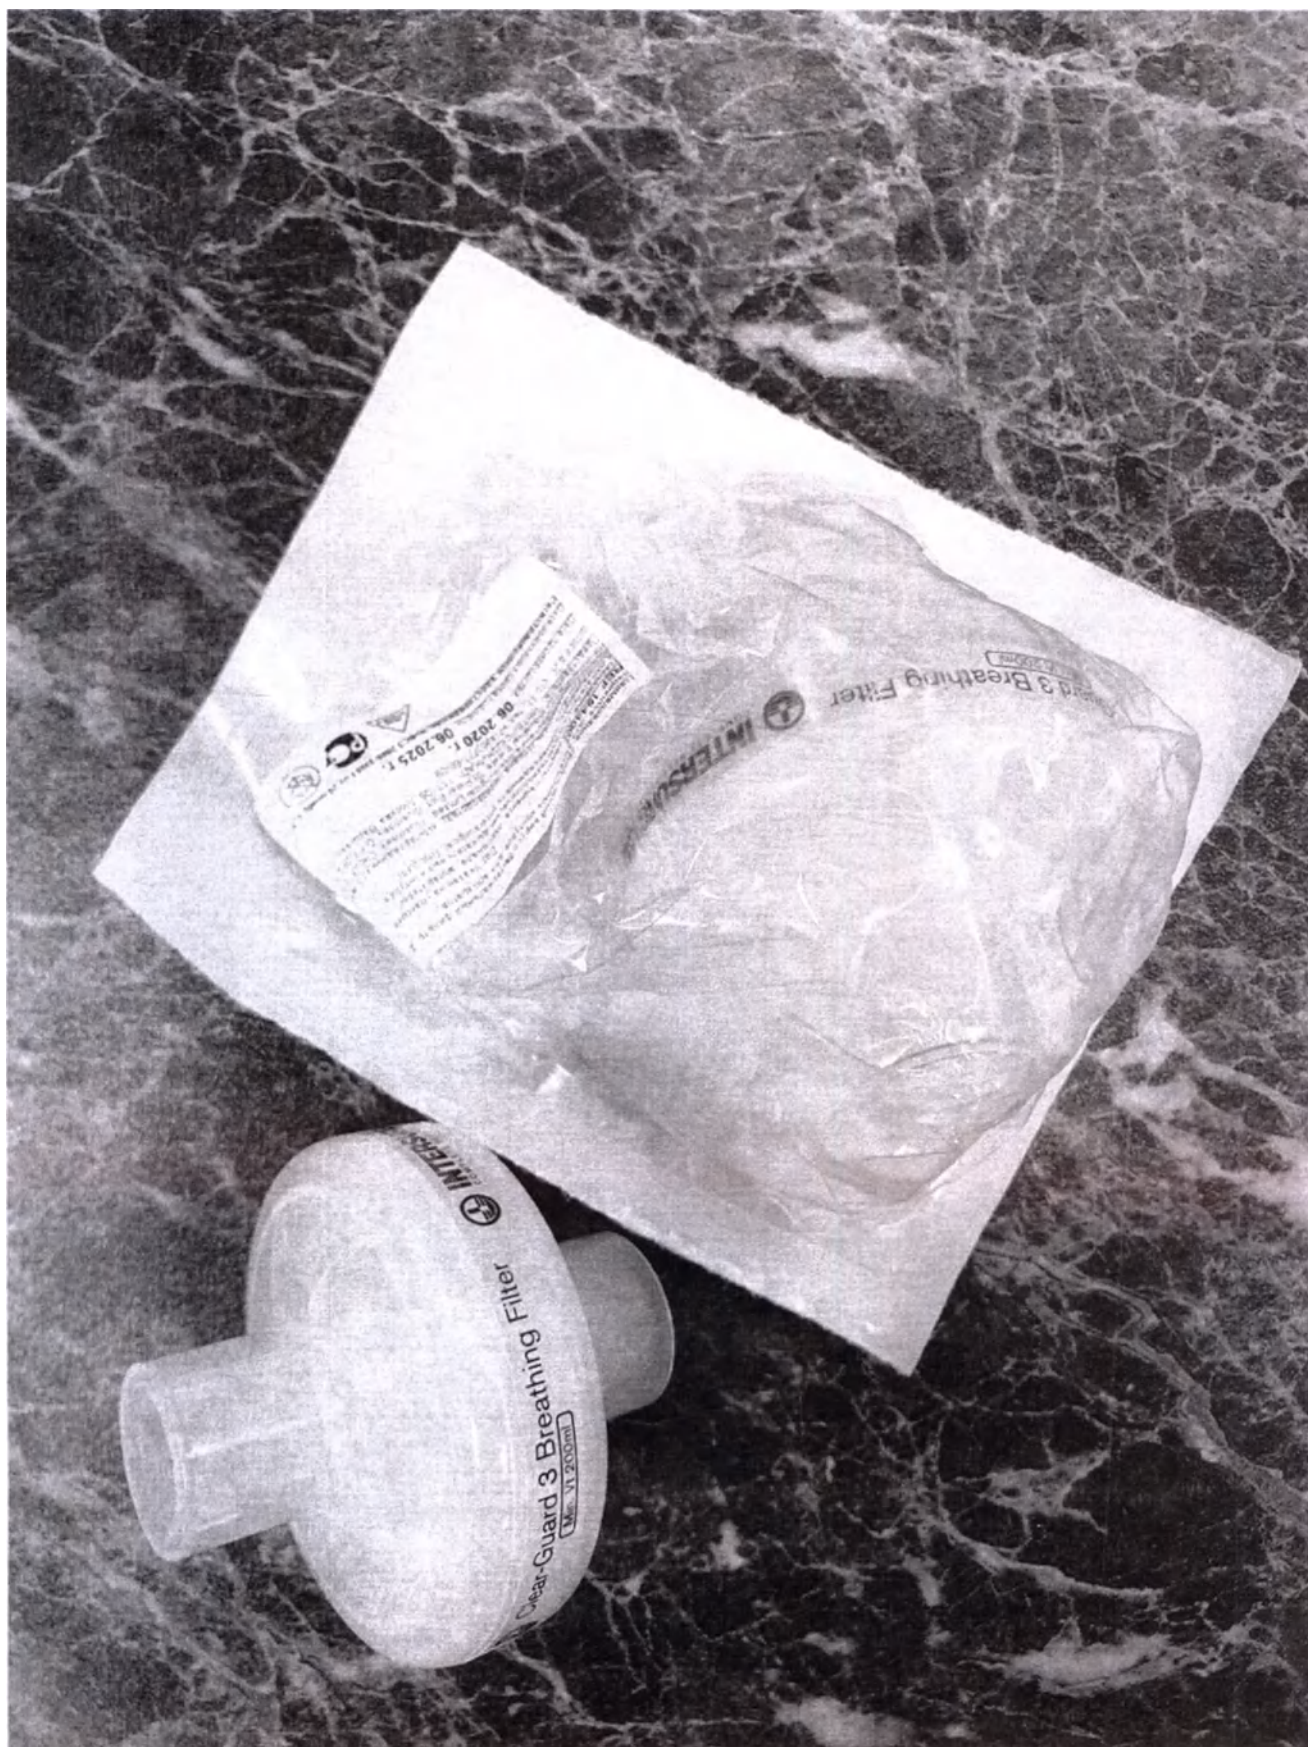


Рисунок 18 – Фильтры дыхательные вирусно-бактериальные, «Интерседжикал Лтд.», «Intersurgical Ltd.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551



Рисунок 19 – Абсорбент углекислого газа, «Интерседжикал Лтд.», «Intersurgical Ltd.»,
Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 20 листов
Генеральный директор
ООО «ИнертГаз Медикал»
Потапов А.В.

