

Фотографические изображения медицинского изделия

Монитор медицинский EX5841-KS в составе

«Утверждаю»

Генеральный директор

«ООО КШТЭ ВОСТОК»


Производства

EIZO GmbH

**Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim,
Germany**



Мартин Пьер Колас

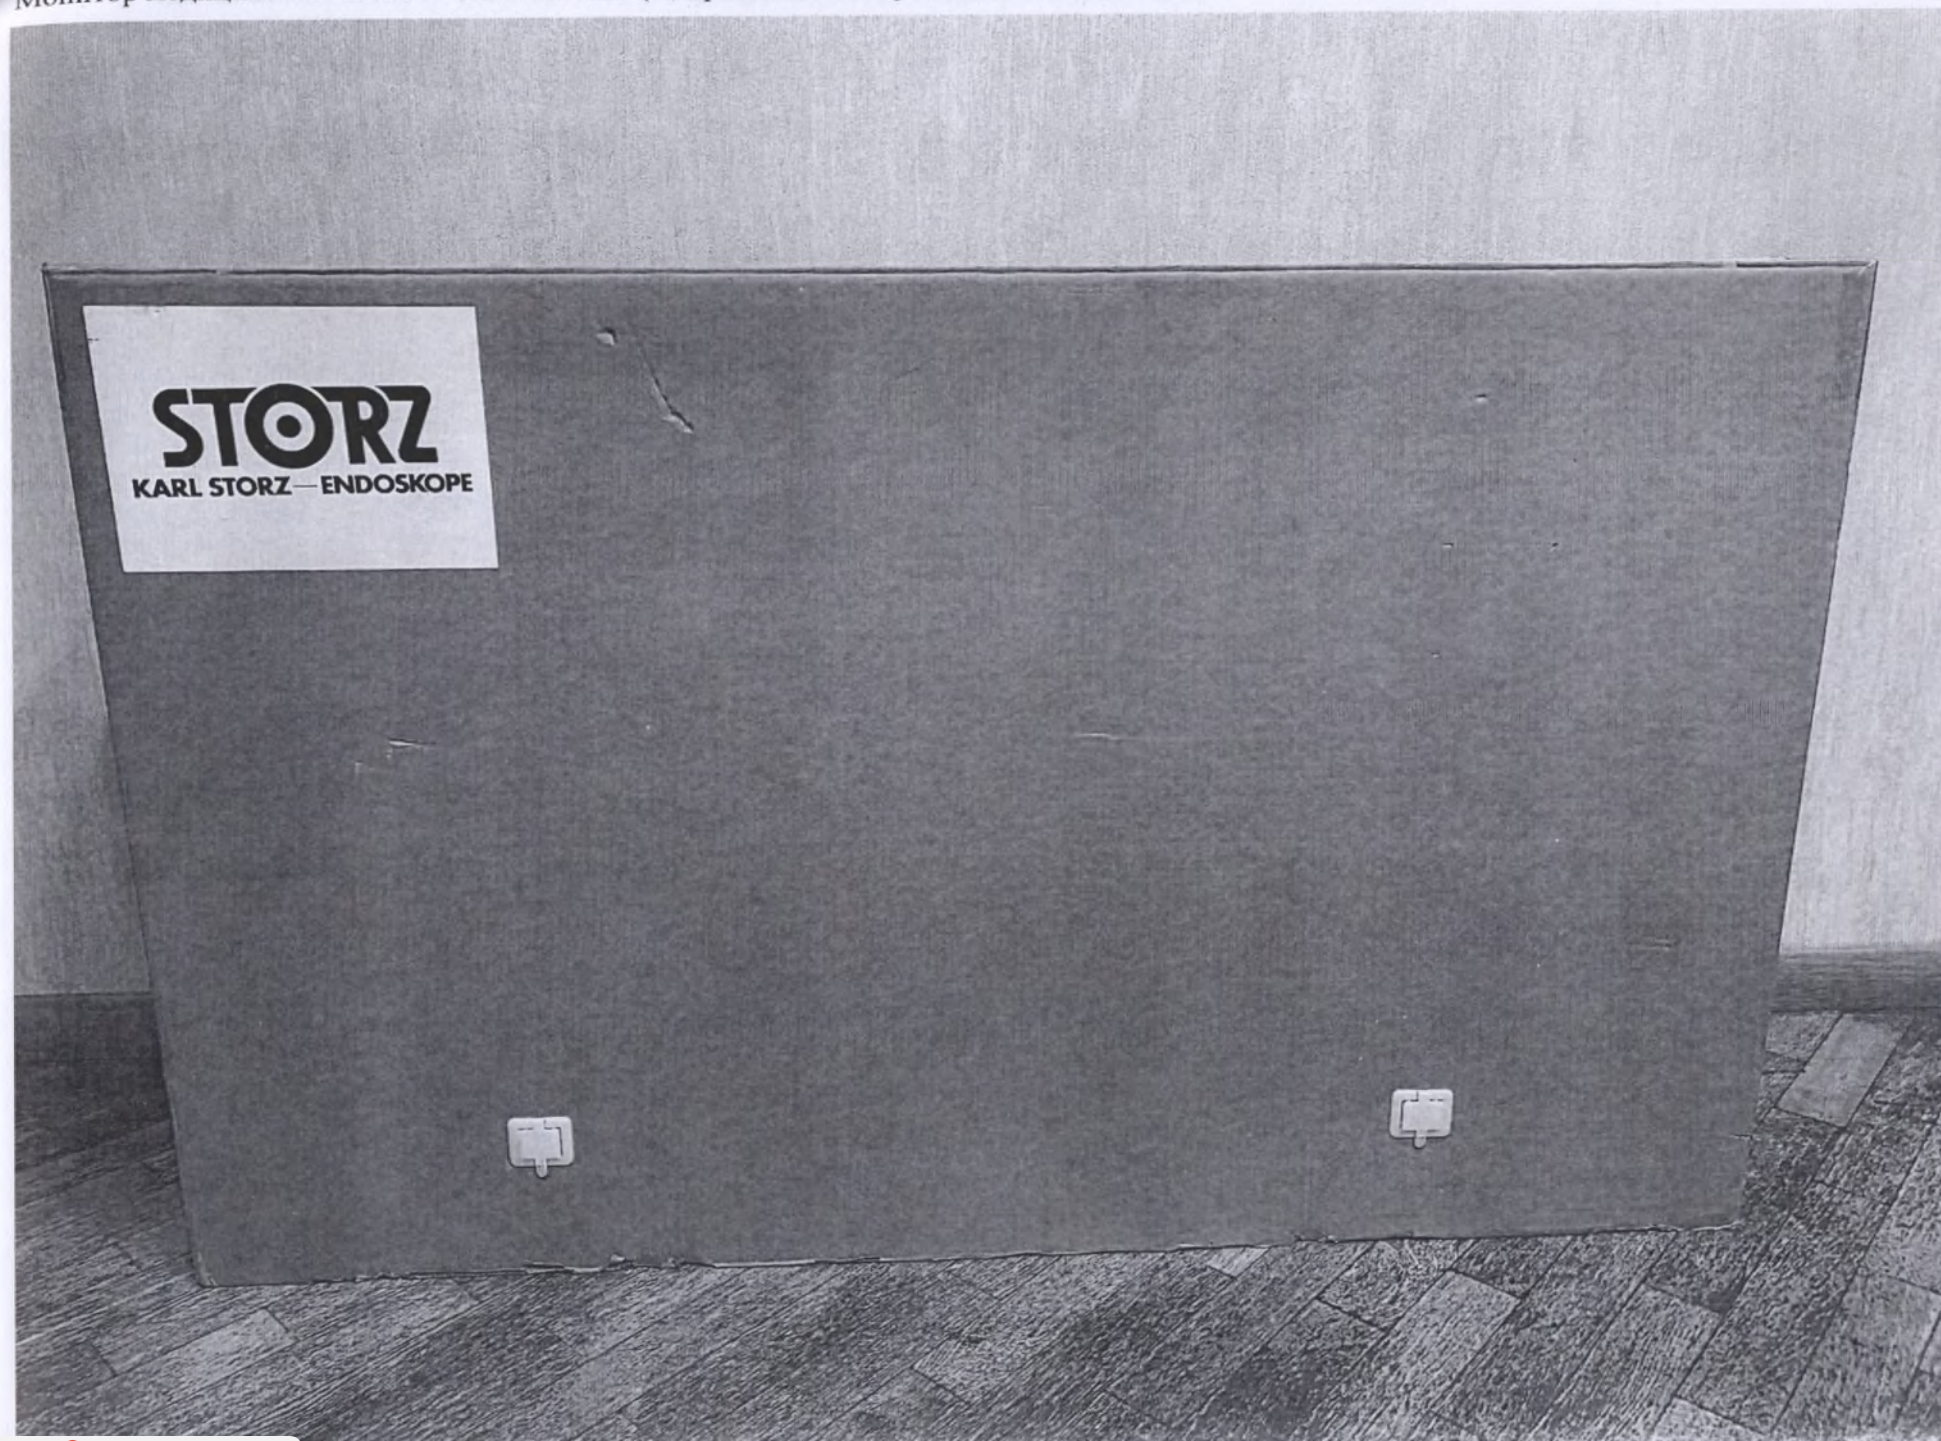


Монитор медицинский EX5841-KS в составе (Маркировка потребительской упаковки)



EX5841-KS

HW	01
SW	01
QTY	01



GTIN (01) 04251303300397

SN (21) 10000000103


REF (240) 6GF62008CA02

MOD (241) TM440

REV (20) 01



FC Class B




EIZO GmbH
Carl-Benz-Straße 3
76761 Rülzheim
Germany

2018-11

Country of origin: Germany

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.
This regulation is limited to the state of California in the United States.

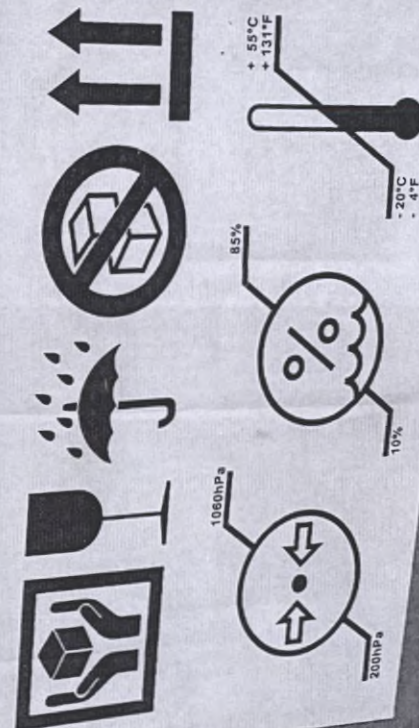

Vertrieb durch / distributed by
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

SN 100000000103

QTY 1

REF TM440

58" 4K-Monitor
58" 4K Monitor
Ecran 4K de 58
Monitor 4K da 58
Monitor 4K de 58
Monitor 4K de 58





IS 13252 (Part 1)




R41142816
www.dus.gov.in

(01)04251303300397(240)TM440(21)100000000103

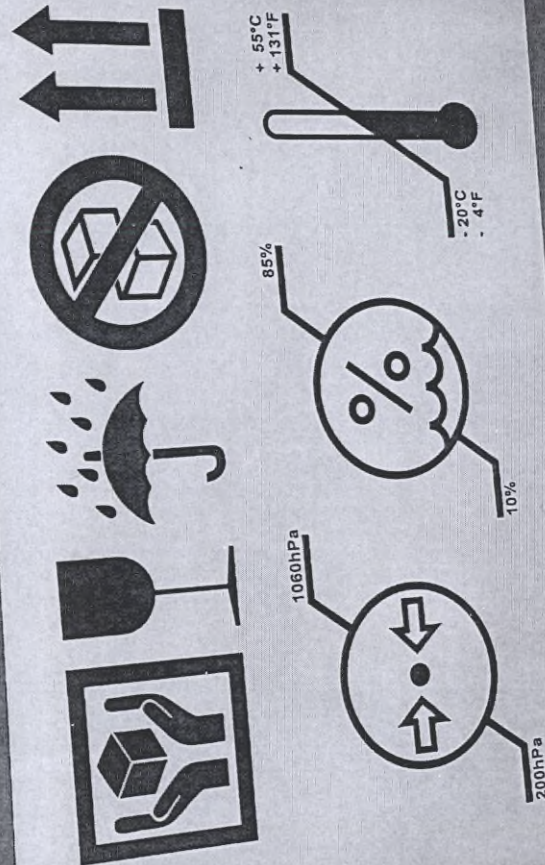

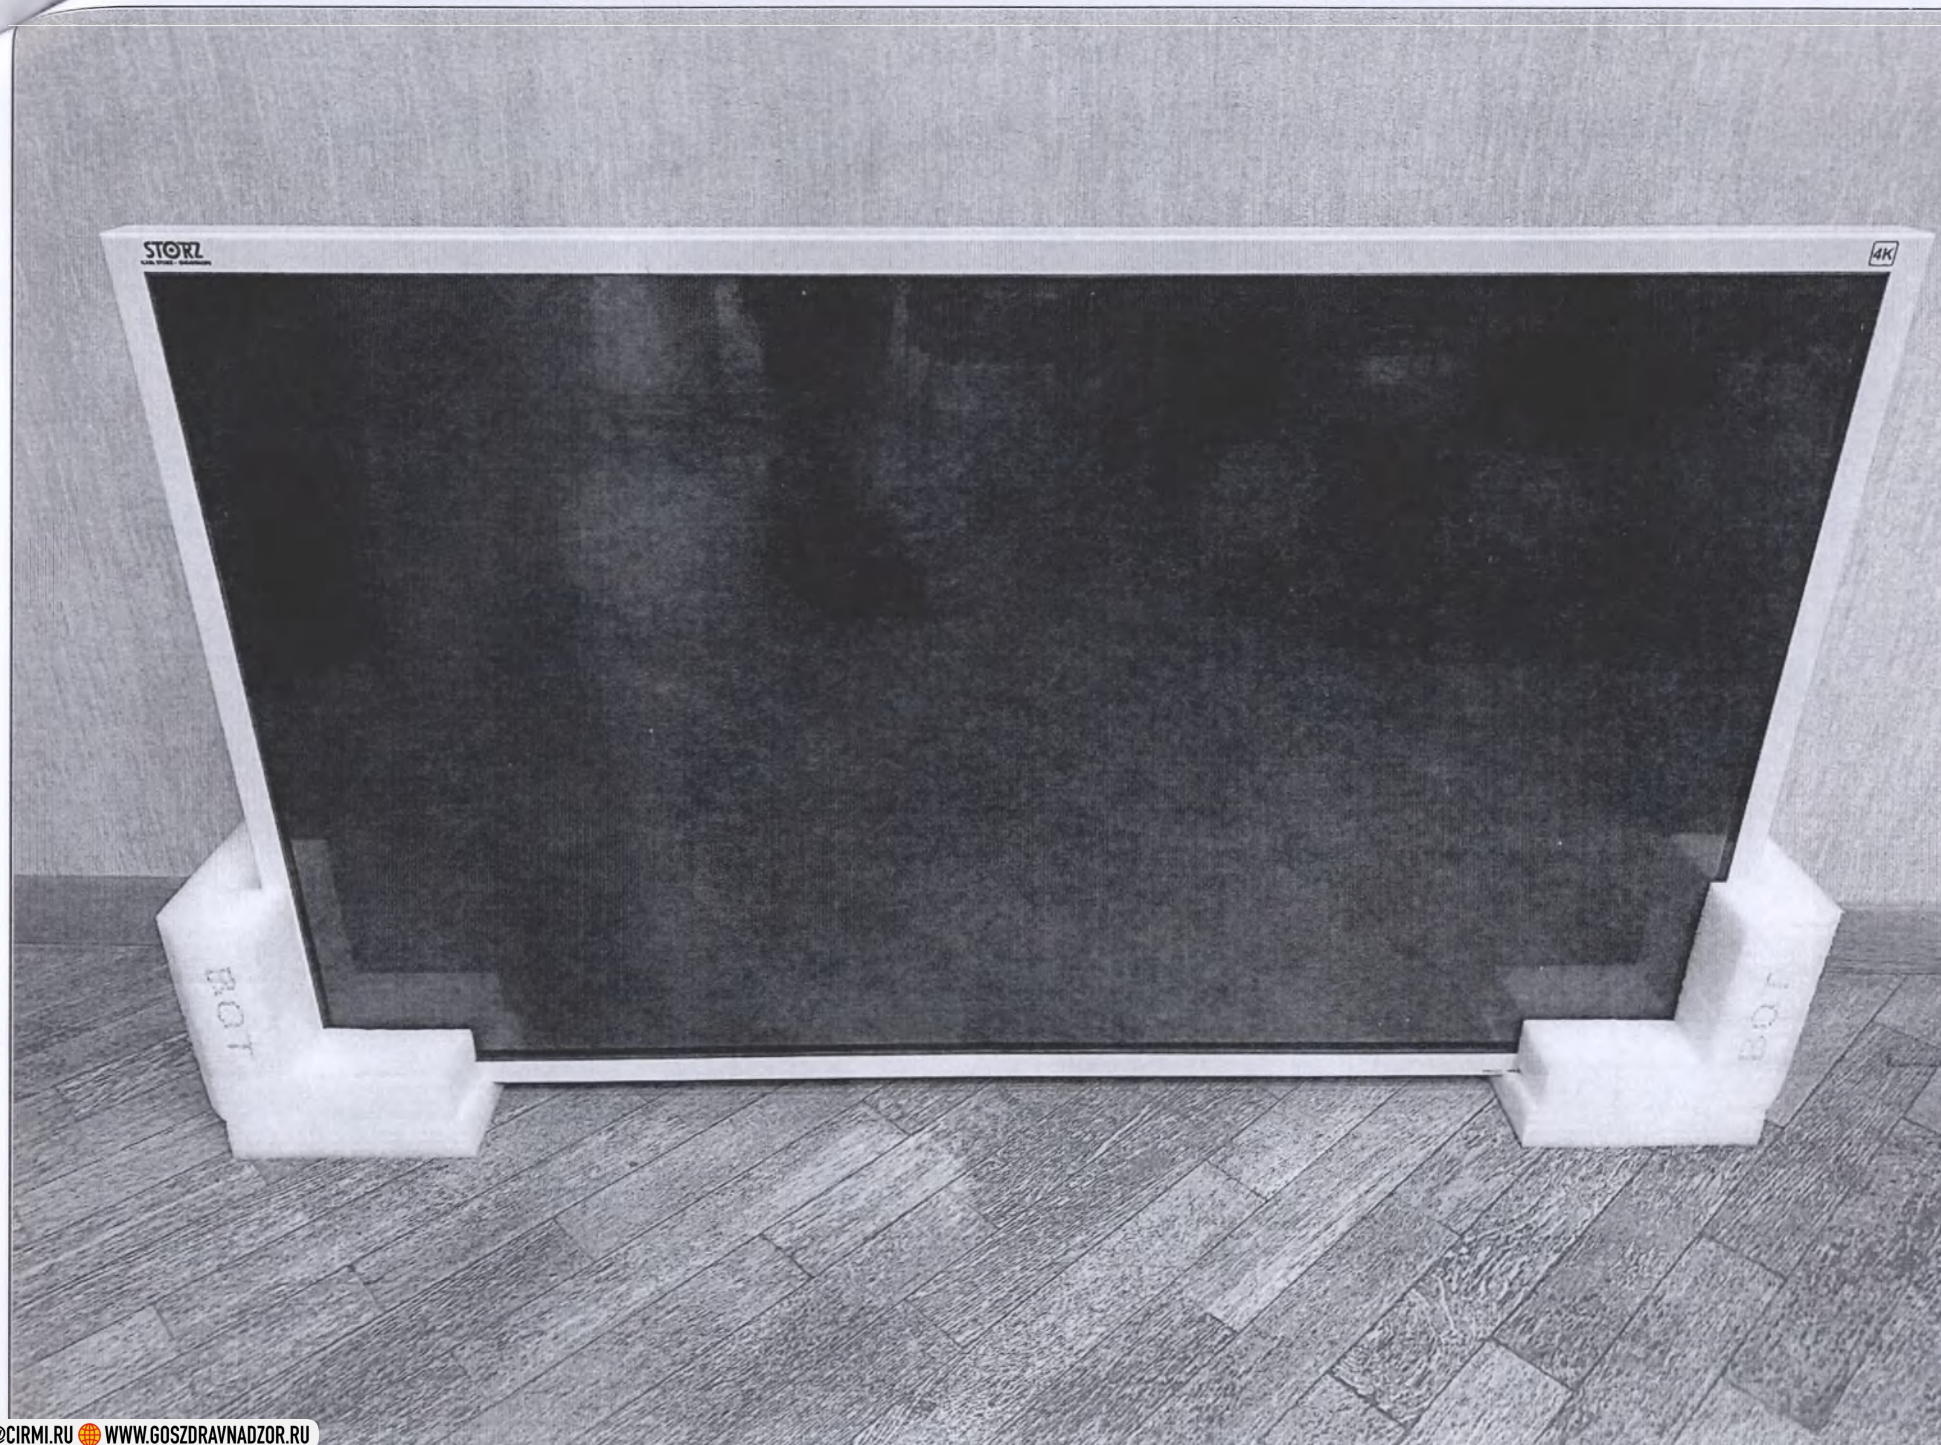

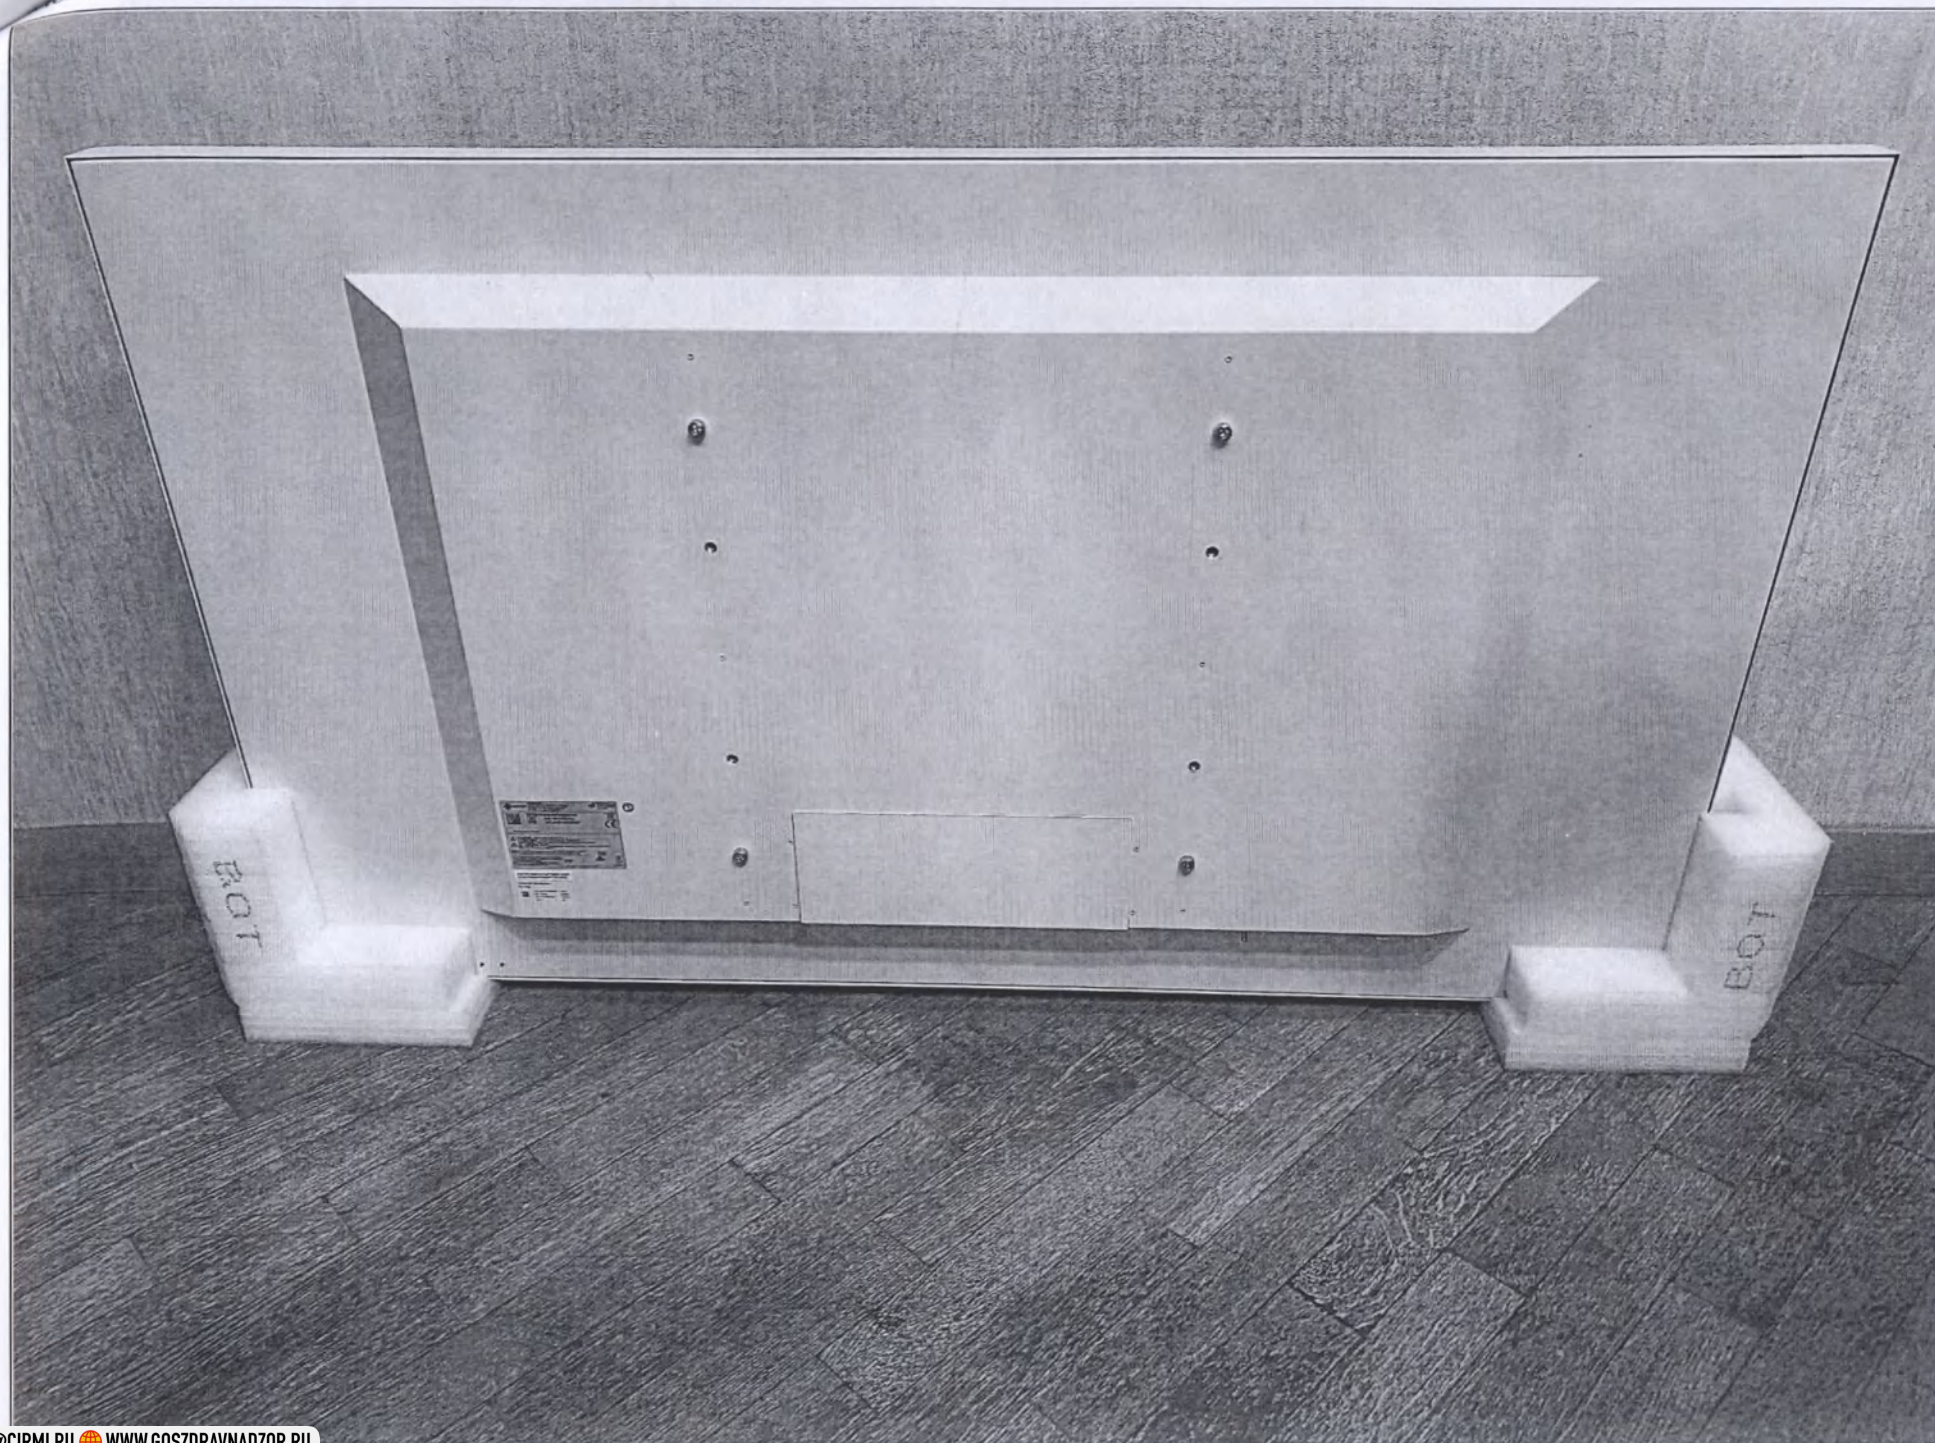

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOP

TM440

147.3 cm (58 inch) class Color LCD Monitor
147.3 厘米 (58 英寸) 级彩色液晶显示器EIZO GmbH
Carl-Benz-Straße 3
76761 Rülzheim
Germany

Electrical Safety



GTIN

(01) 04251303300397

SN

(21) 10000000103

REF

型号 (240) 6GF62008CA02



E113208



德国制造 Made in Germany

**CAUTION:** Risk of electric shock. Do not open.**ATTENTION:** Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.**ACHTUNG:** Gefahr des elektrischen Schlages. Rückwand nicht entfernen.

小心: 有触电的风险。请勿打开。

警告: 高压注意 サービスマン以外の方は裏ぶたをあけないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。



This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The equipment must be connected to a grounded main outlet.

Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.

这设备必须连接至接地主插座。

電源コードのアースは必ず接地してください。

Apparatet skall anslutas till jordat nätuttag.

IS 13252 (Part 1)

R-41142816
www.bis.gov.in

IP32



Input Rating/输入额定值: 100 - 240 V ~ 2.0 - 0.9 A 50 / 60 Hz

ASE10007114

仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
仅适用于非热带气候条件下安全使用。TM440 58" 4K Monitor
Rx Only

(01) 04251303300397

GTIN

(240) TM440


MODEL


(21) 10000000103


SERIAL


(20) 01


REV

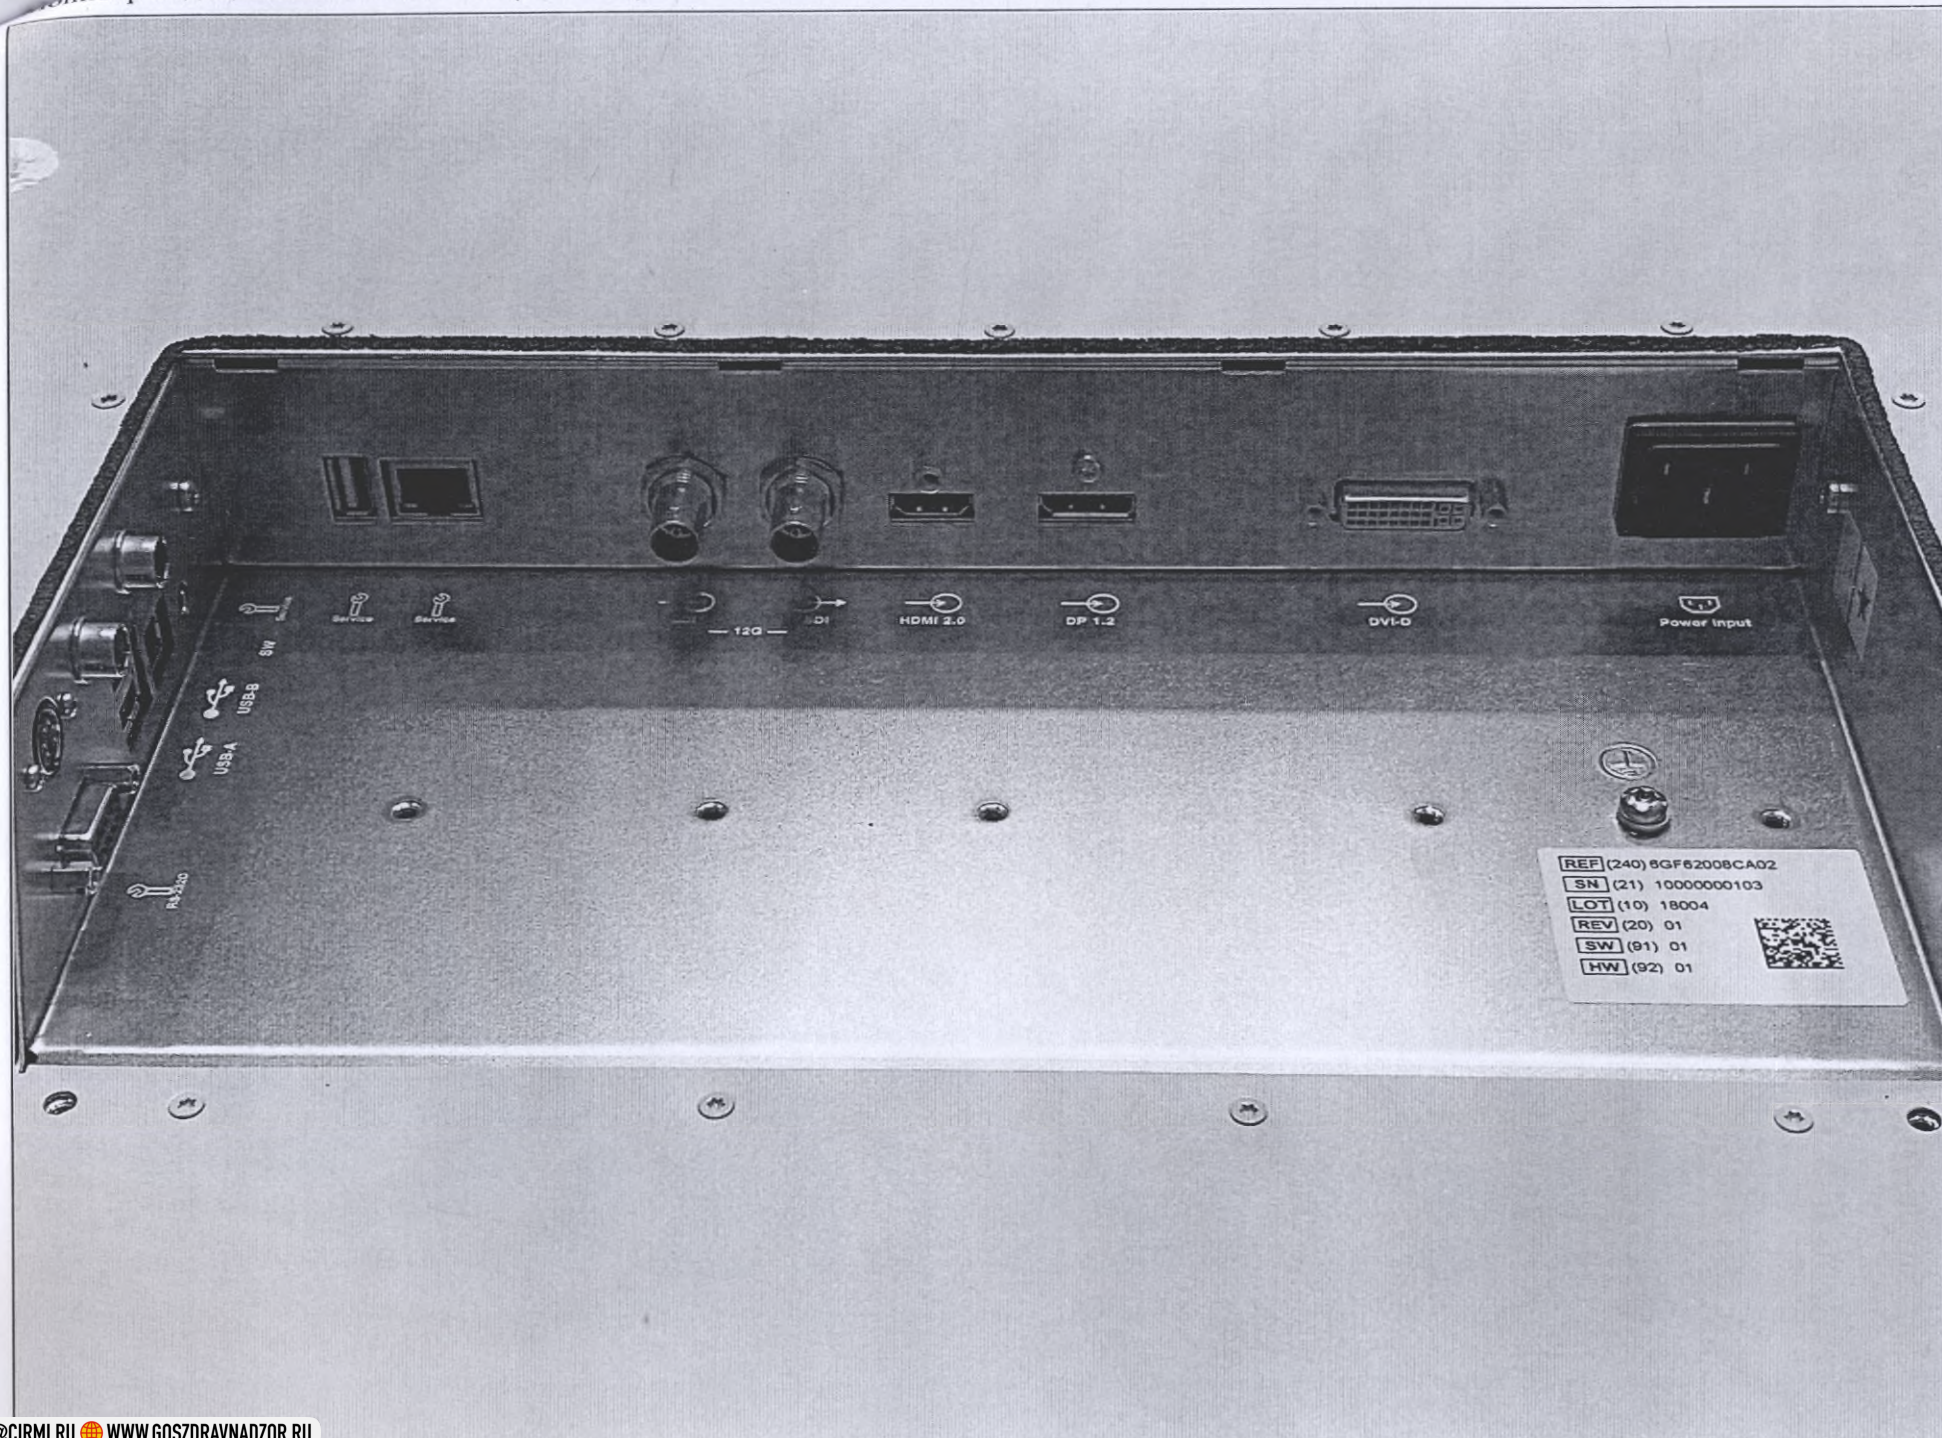


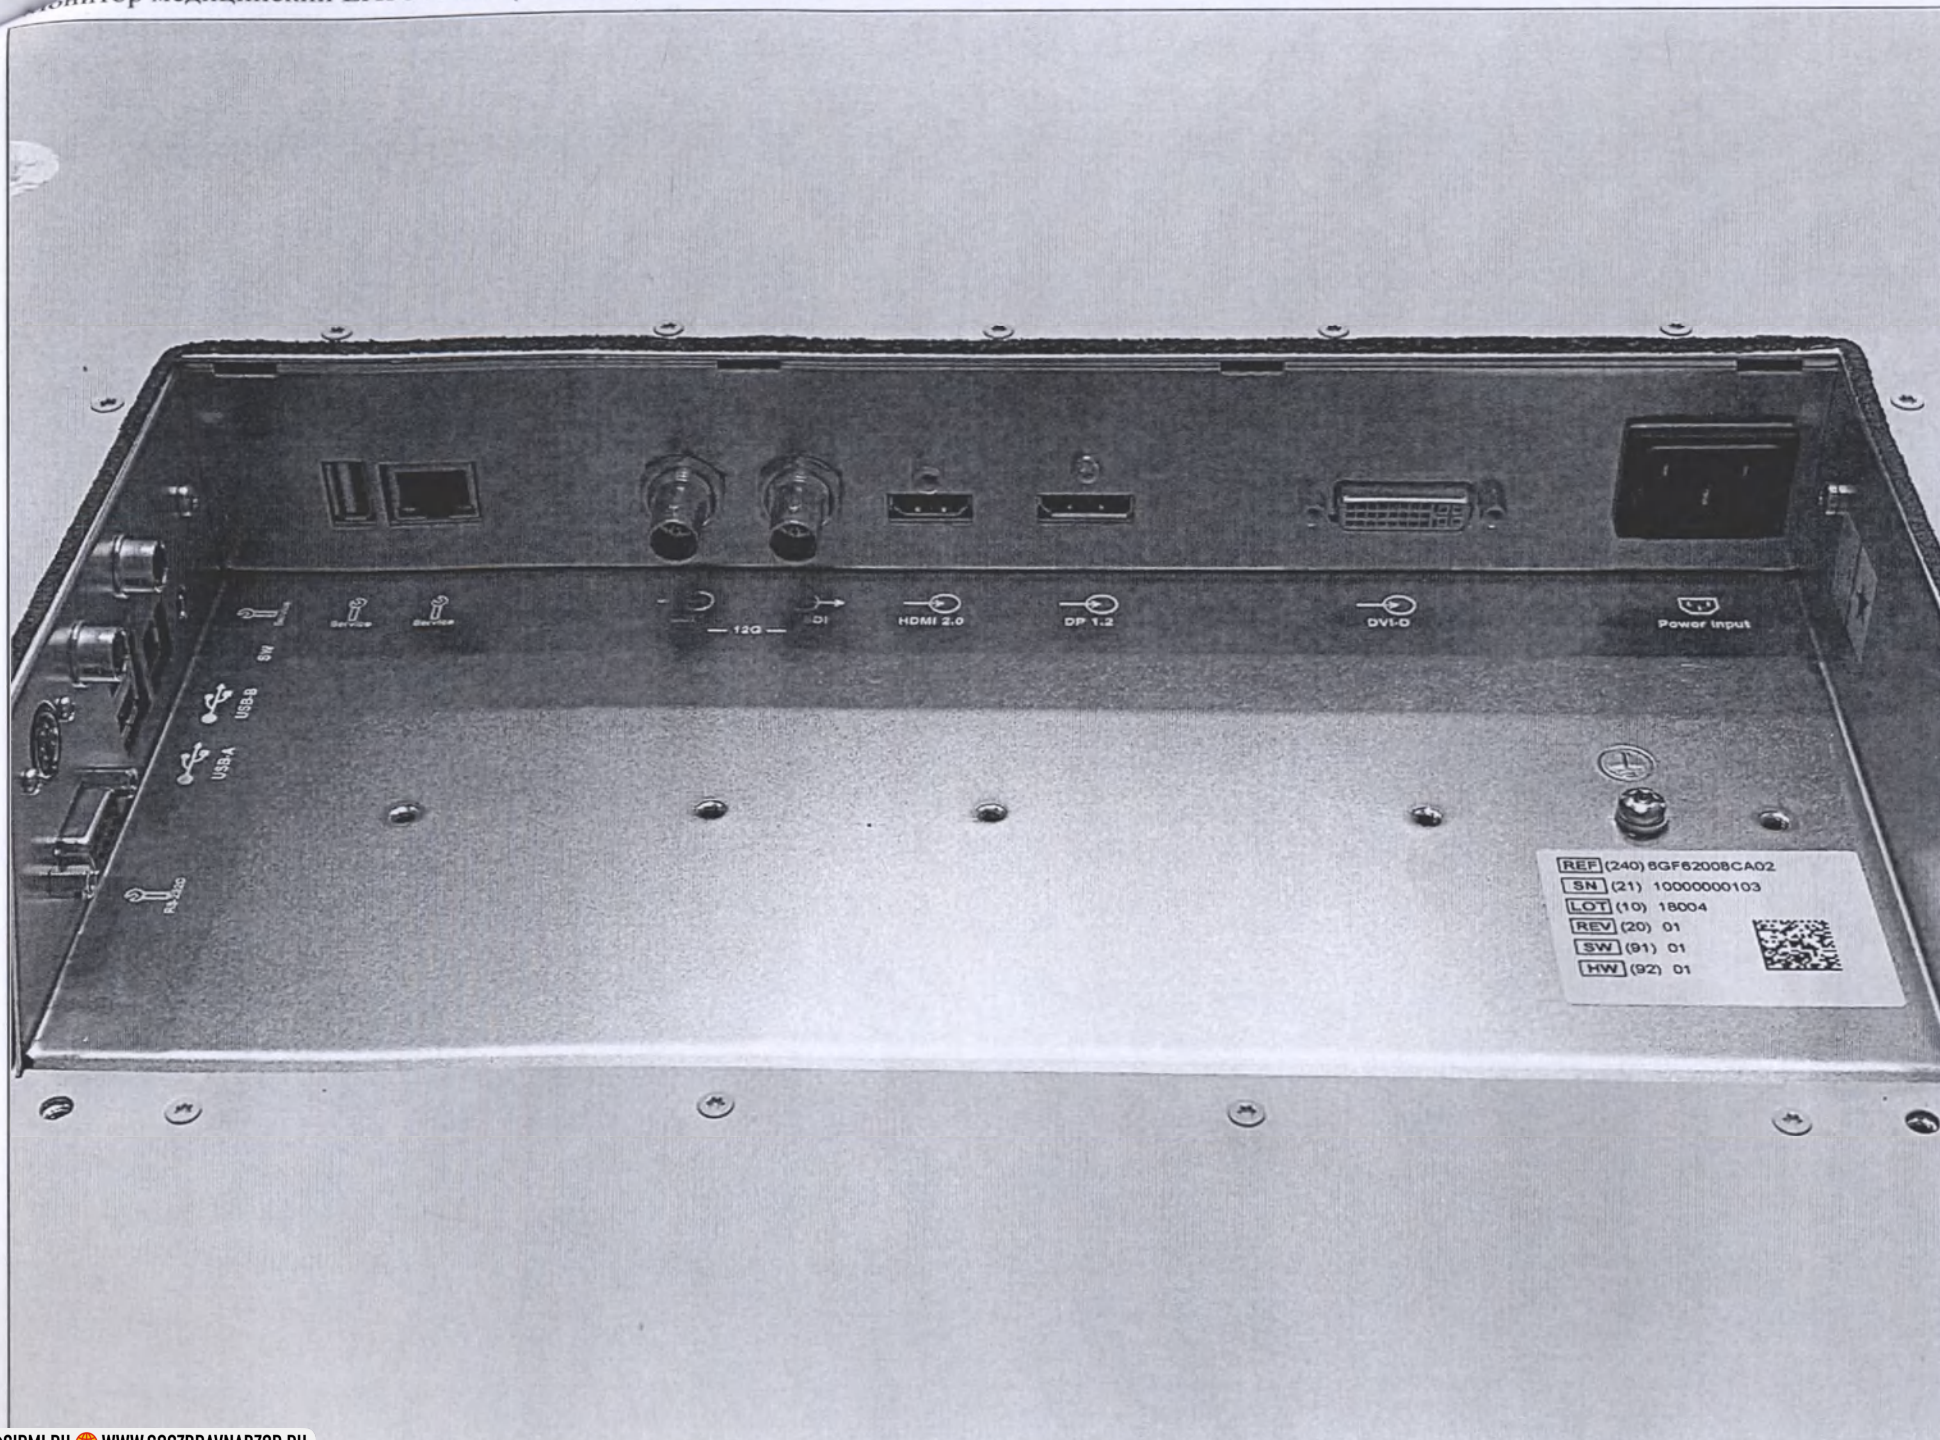


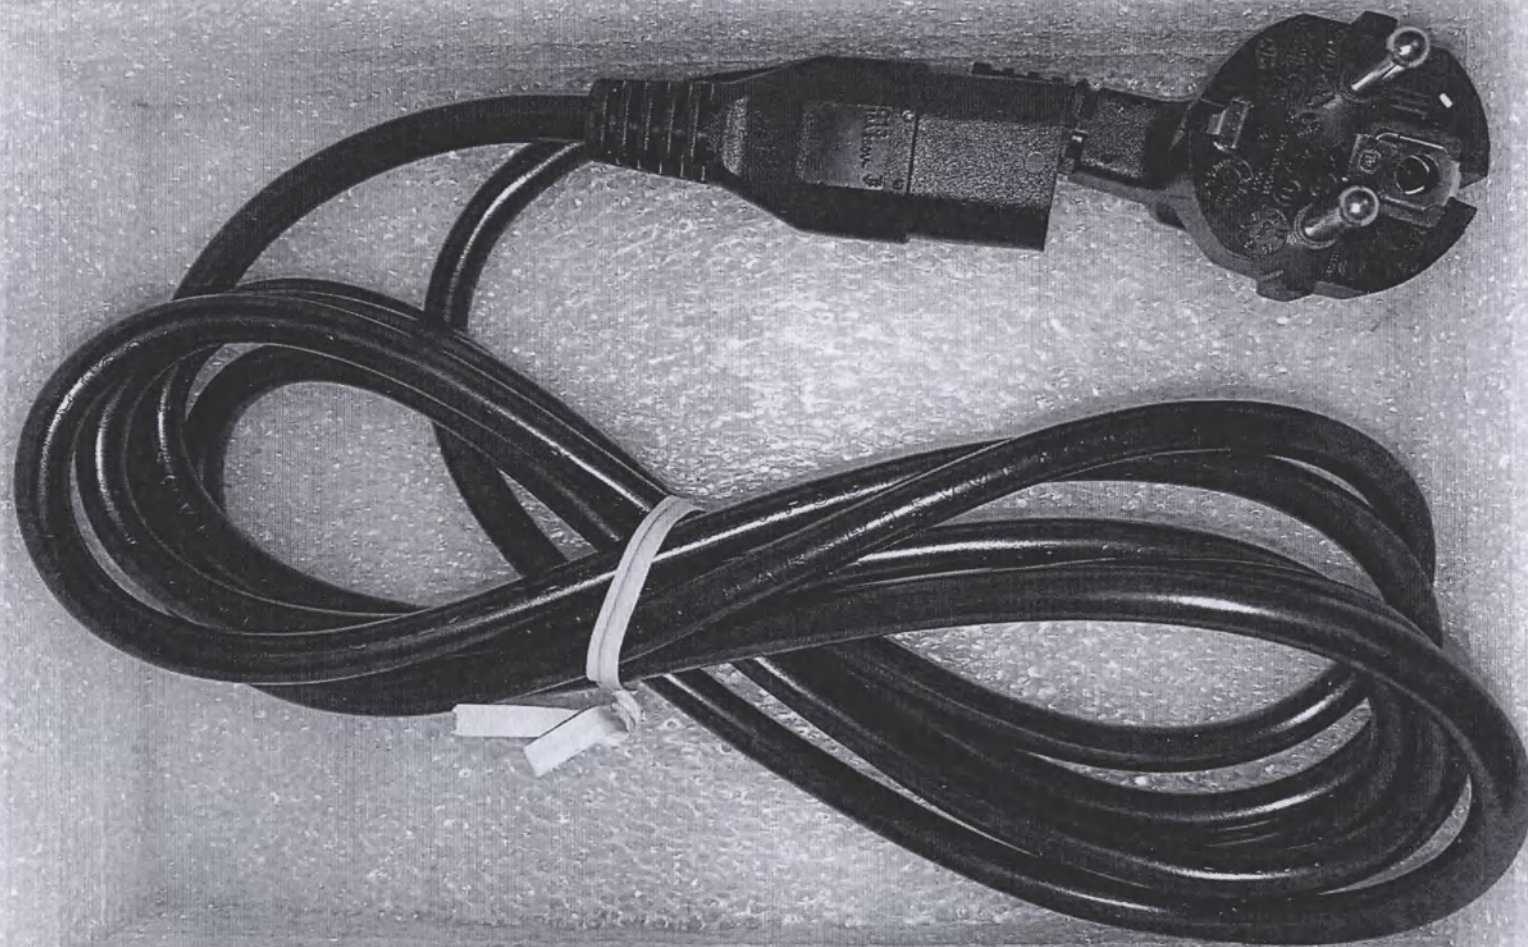

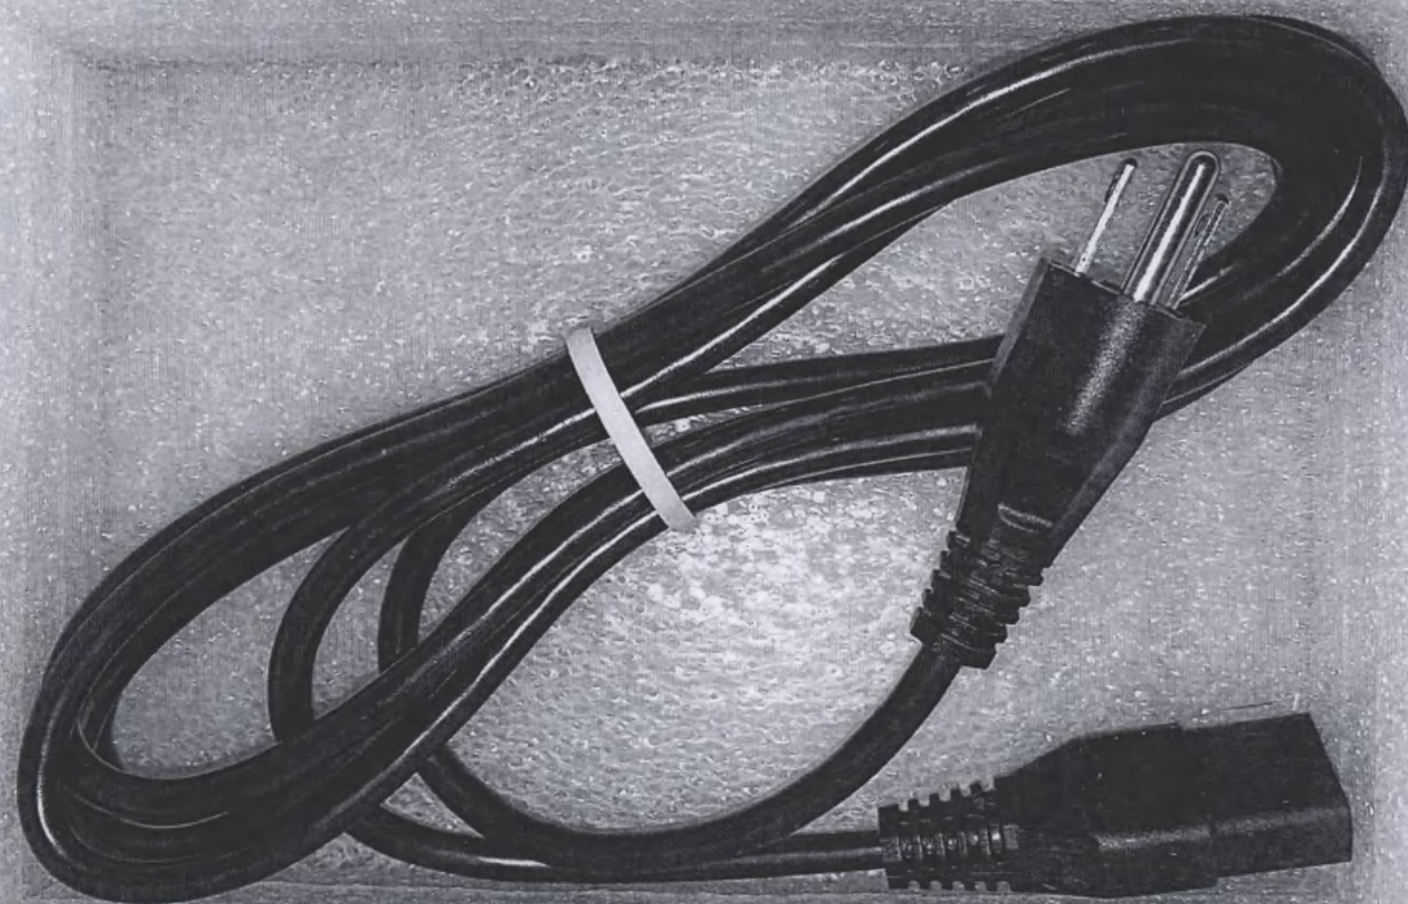

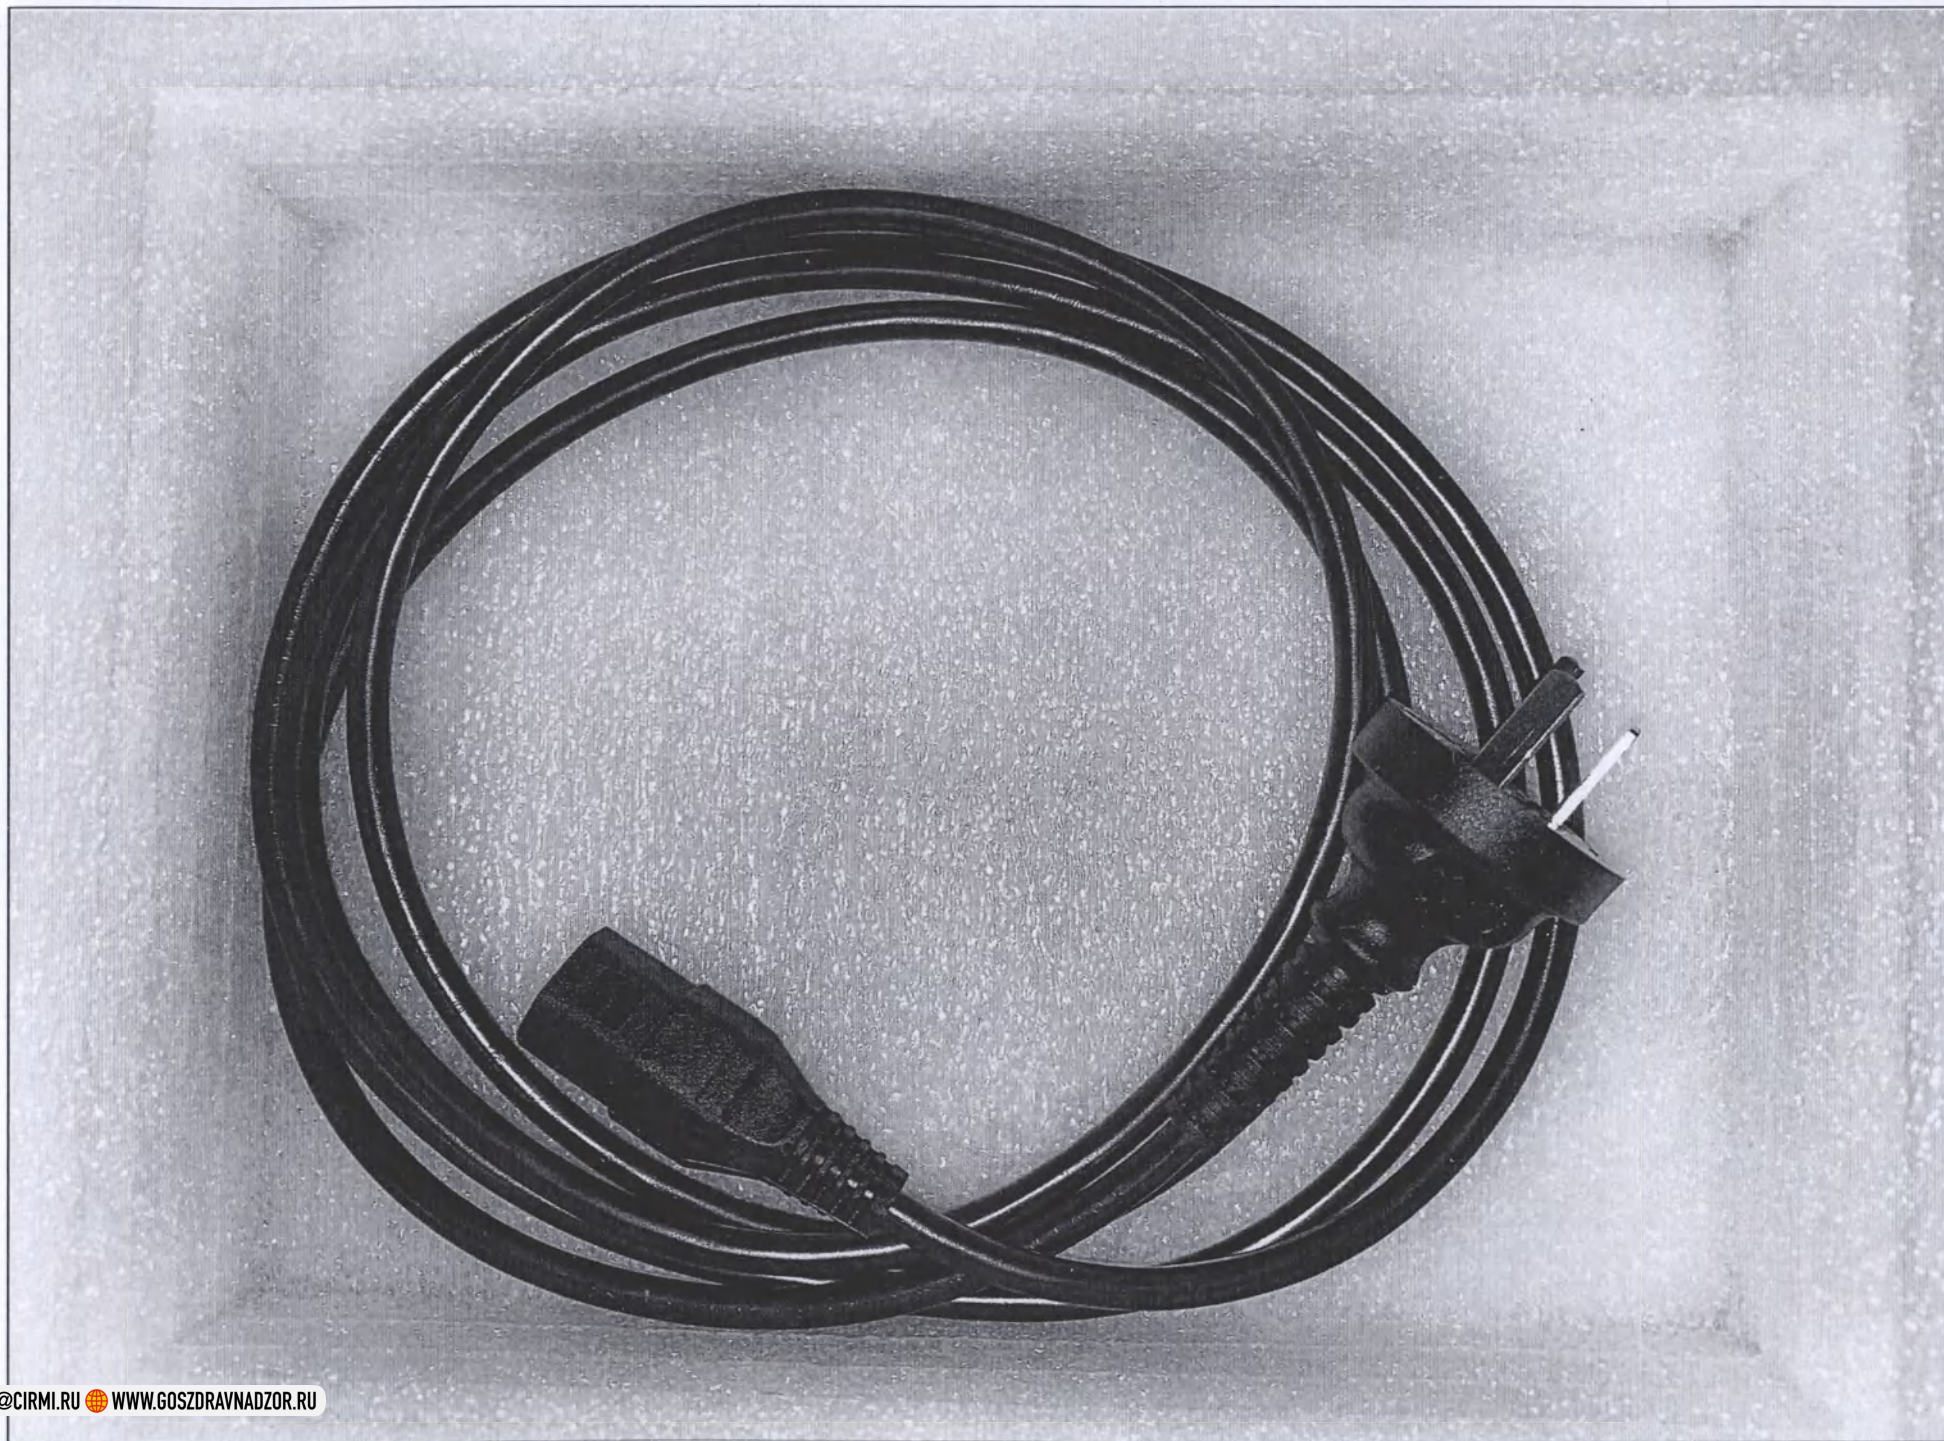

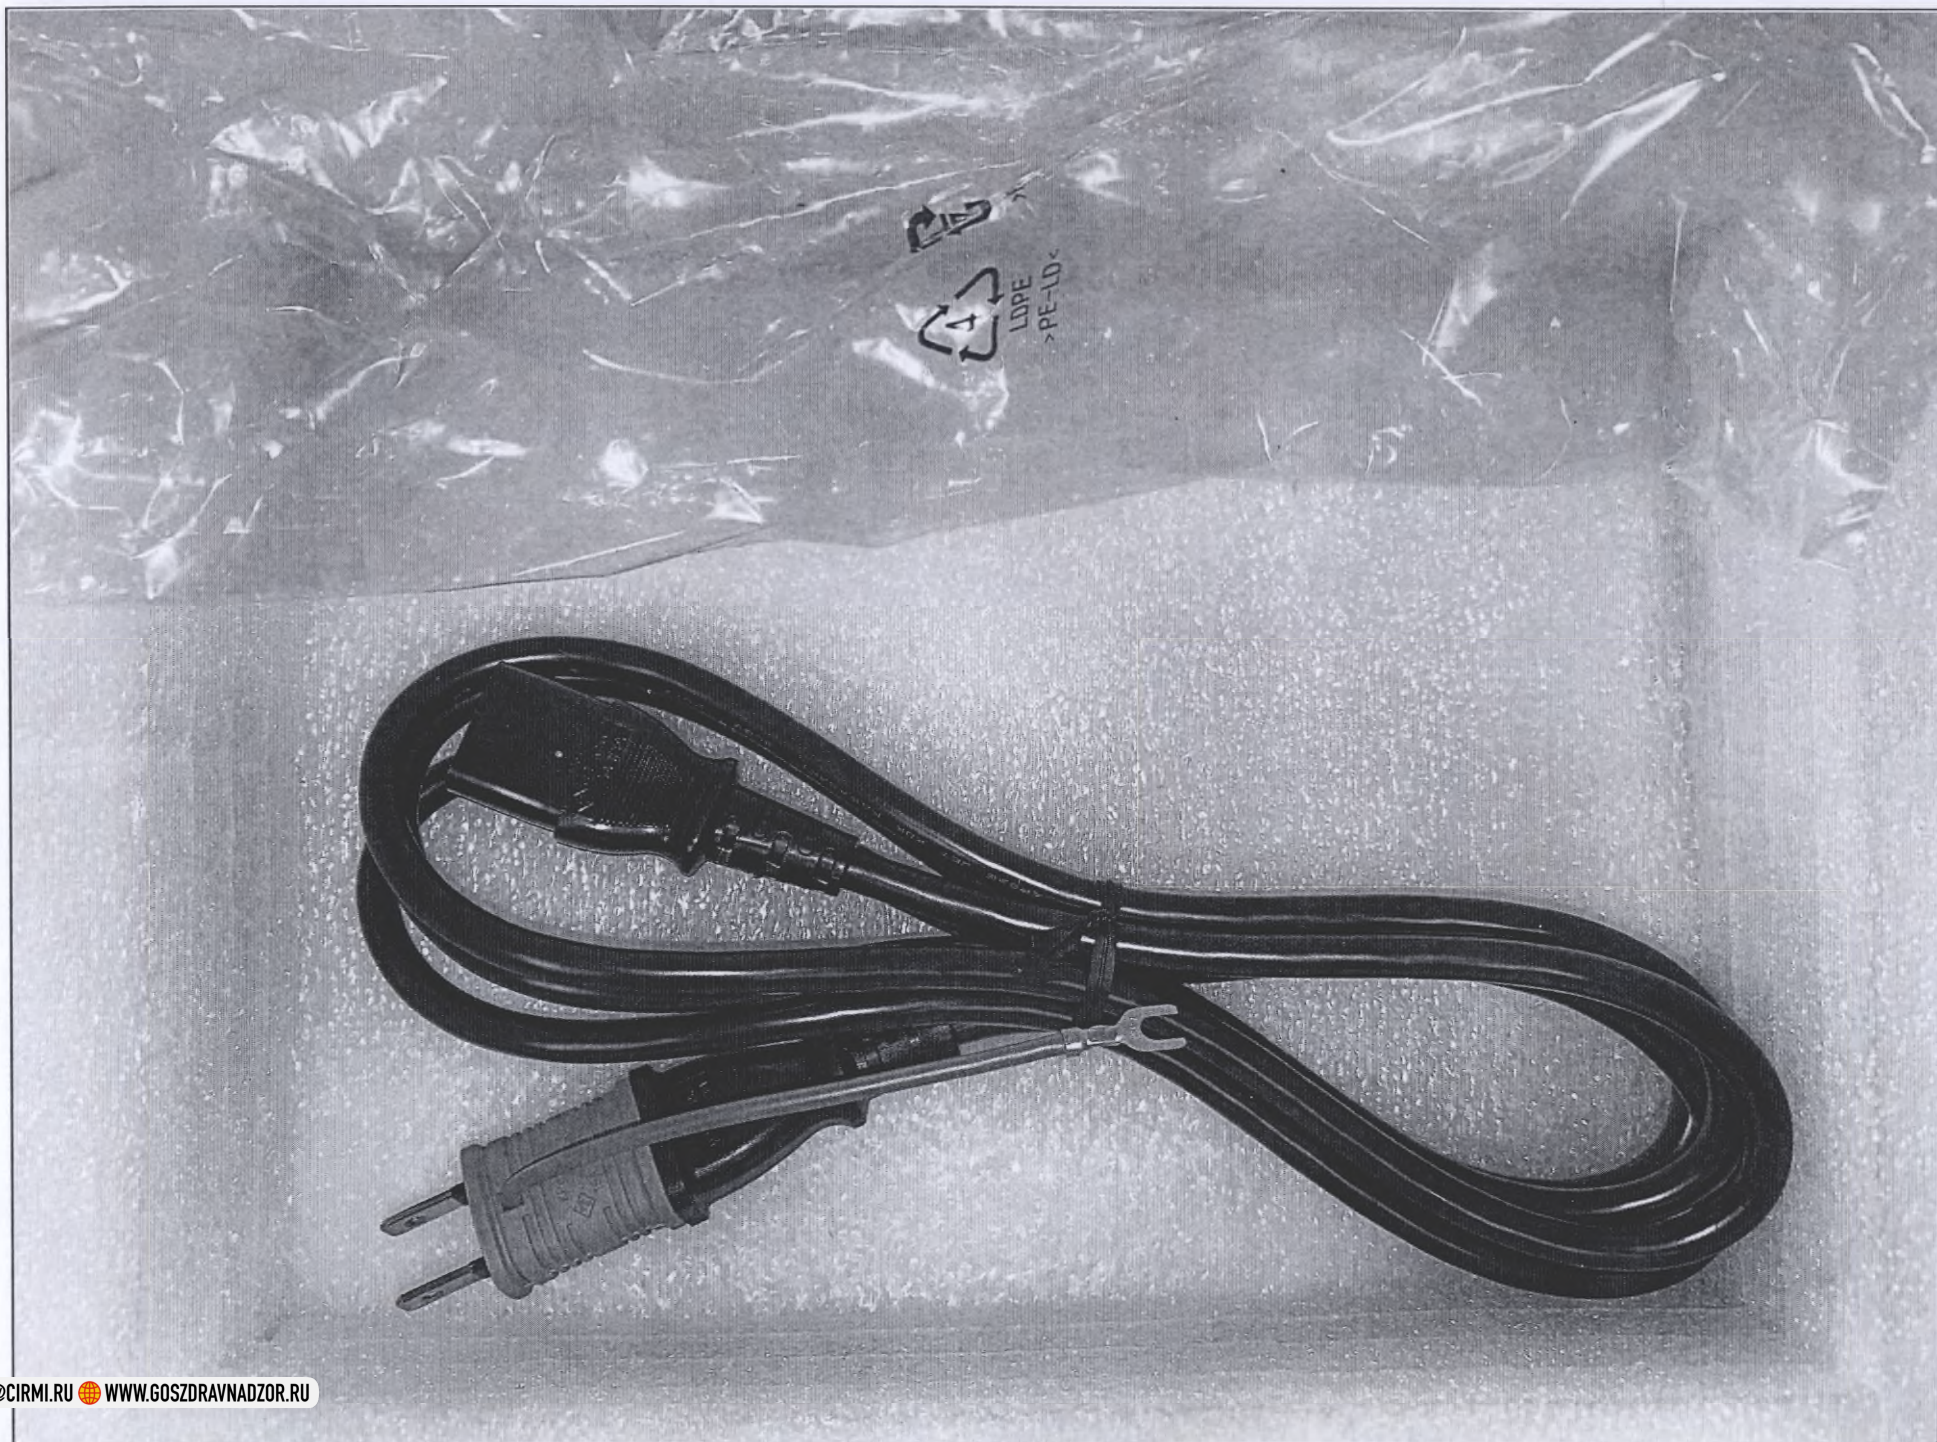

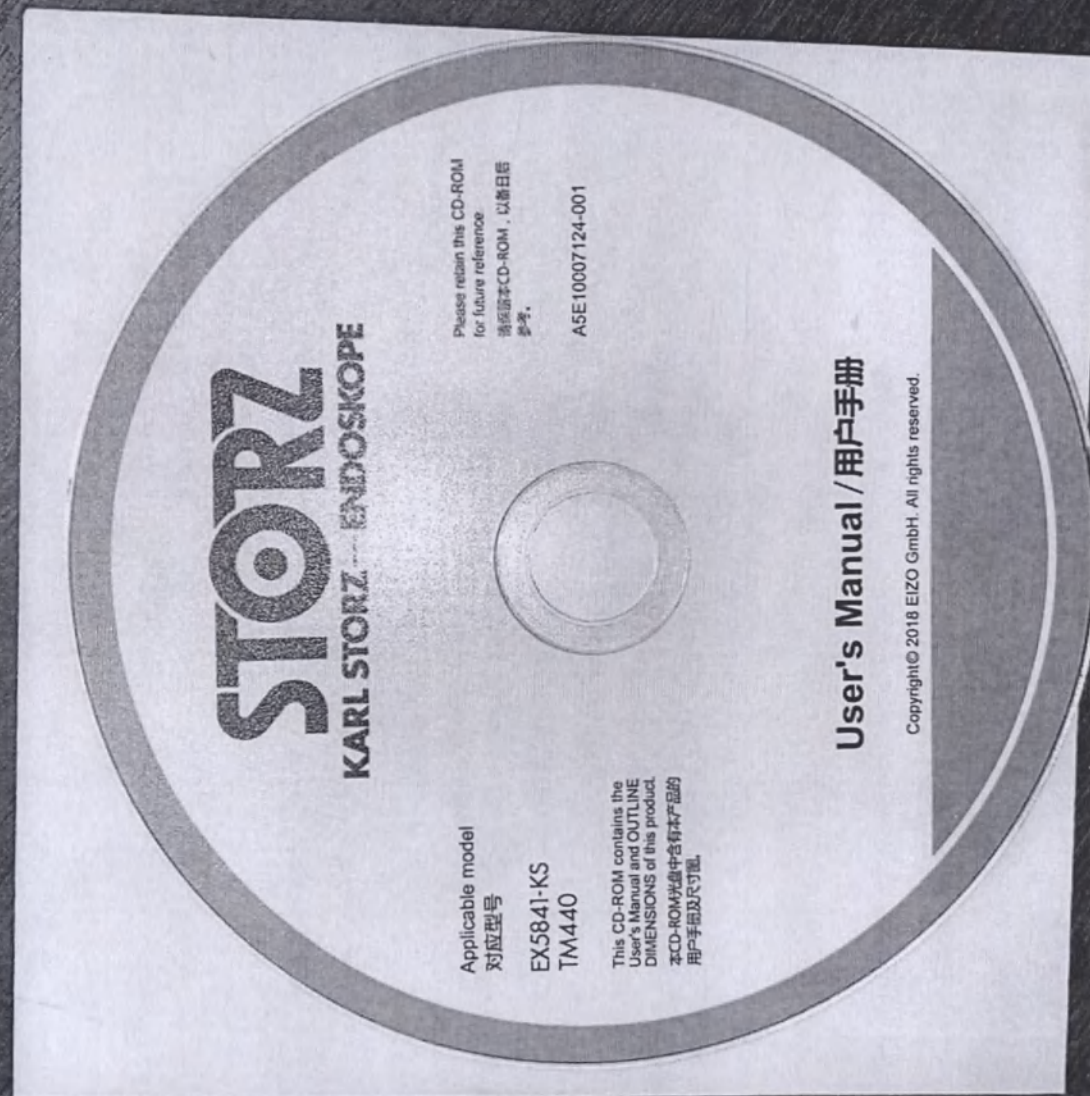

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Инструкцию по эксплуатации



TM440

Модель
прибор

Монитор 4K 58"

EX5841-KS
6GF62008CA02



ПРОШИТО 14

ЛИСТОВ 14

