

Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»



Чигринцев Е.А.
2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

«Мульти-Дилуент 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1)»


производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Мульти-Дилуент 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1). Фасовка 1(25,0 мл/уп – 2шт). Общий вид



Рисунок 2. Мульти-Дилуэнт 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1). Фасовка 2 (25,0 мл/уп – 6шт). Общий вид

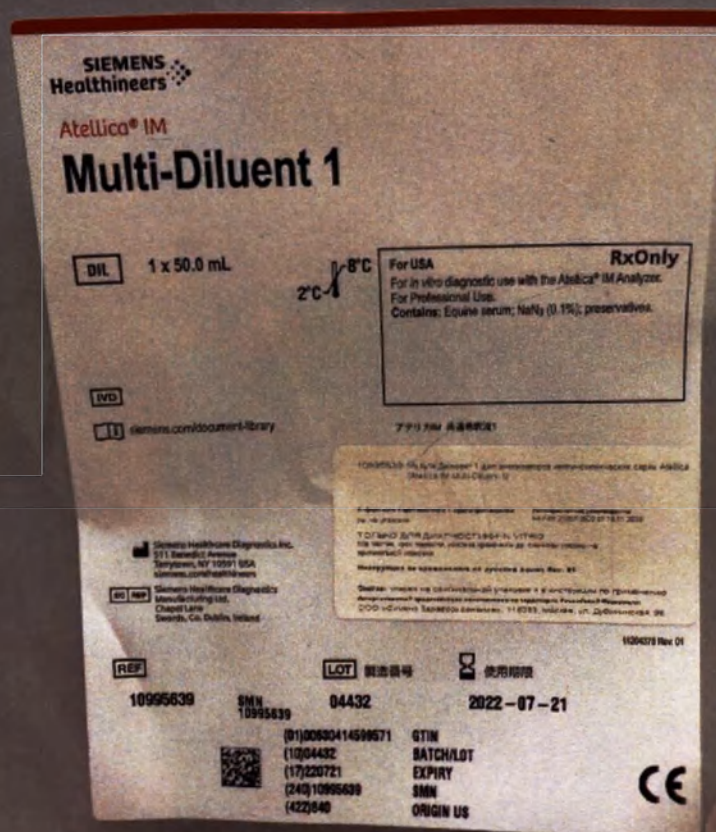

сунк 3. Мульти-Дилуент 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1). Фасовка 3(50,0 /уп – 1шт). Общий вид


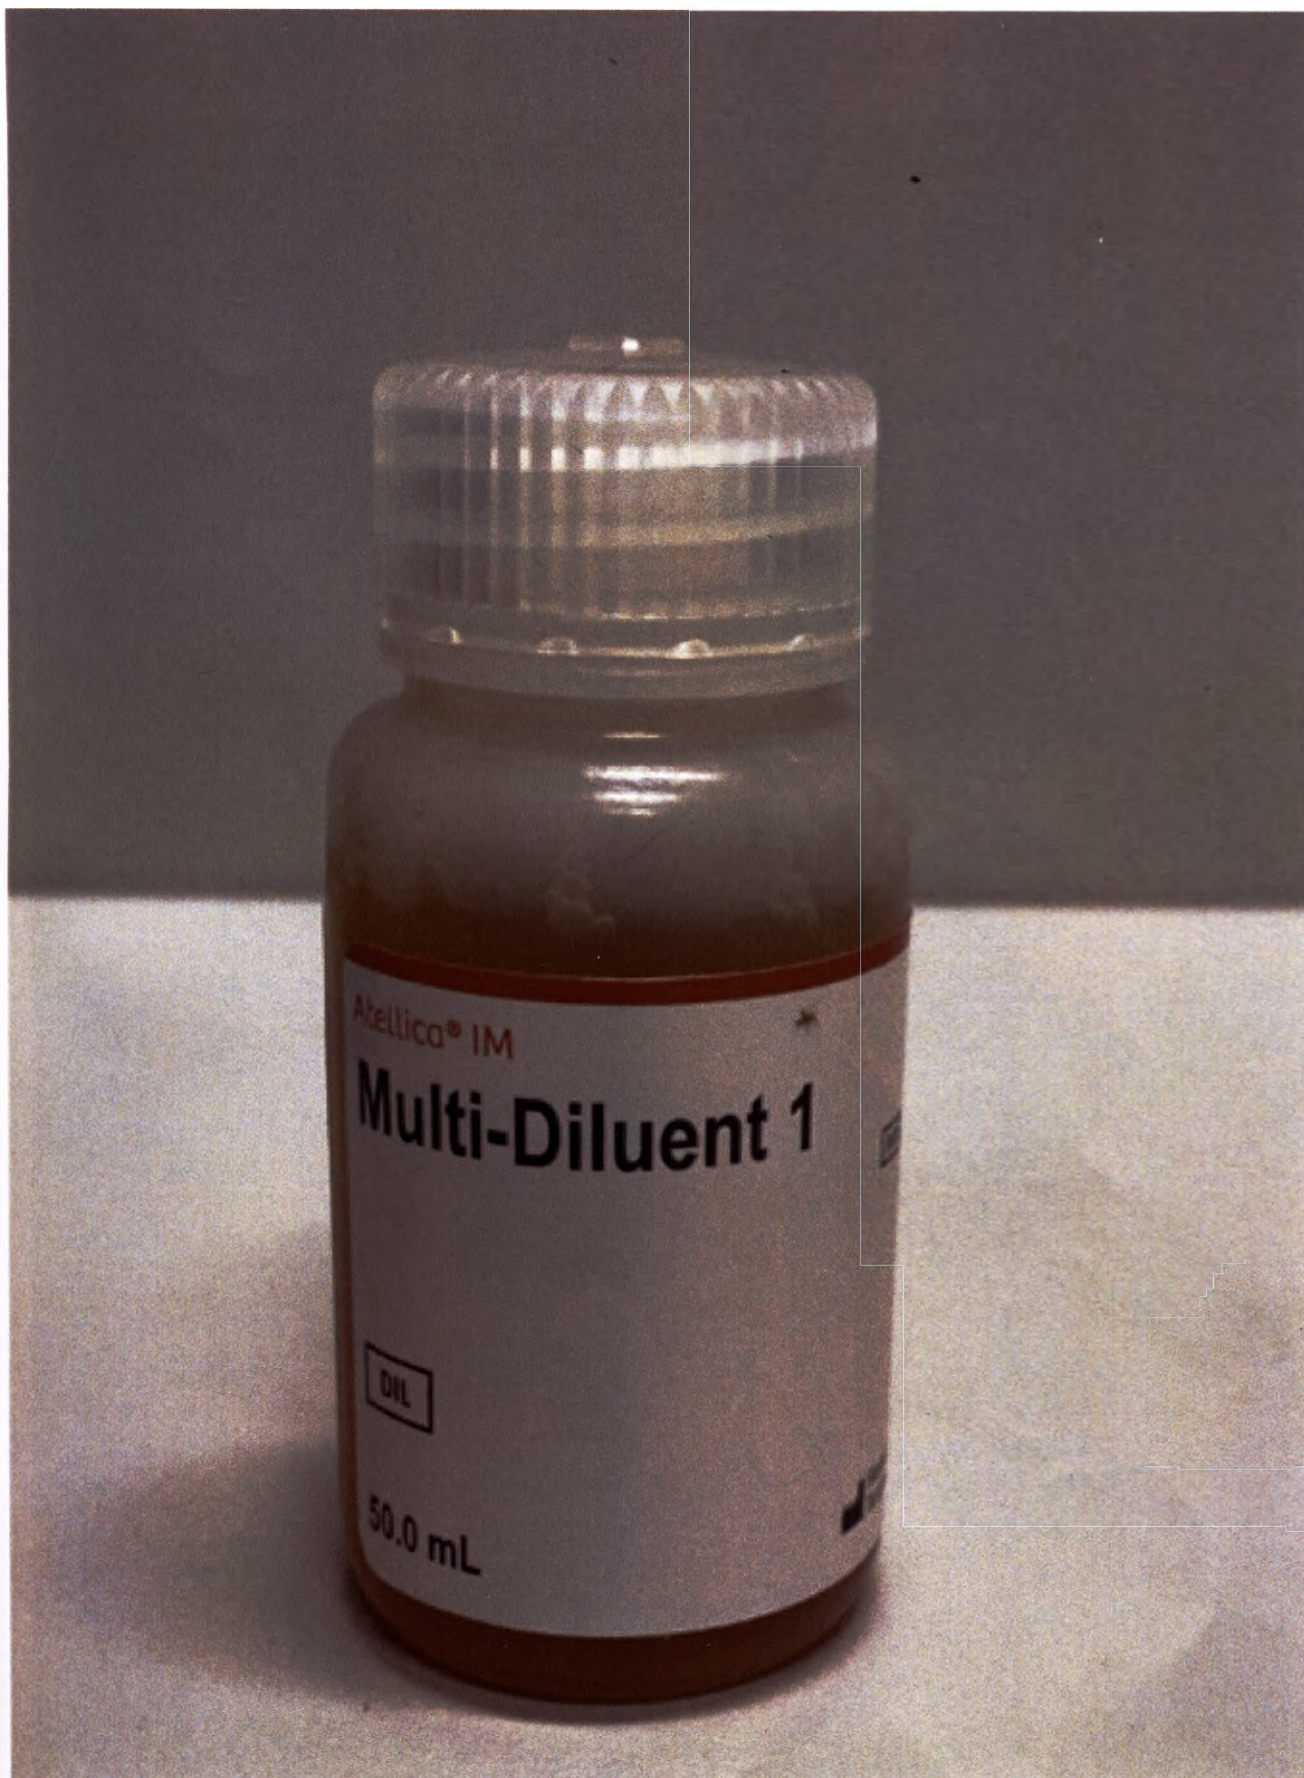


Рисунок 4. Мульти-Дилуэнт 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1). Фасовка 3. Мульти-дилуэнт 1 (Atellica IM Multi-Diluent 1) – 50,0 мл/флакон



Рисунок 5. Мульти-Дилуэнт 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1). Фасовки 1, 2. Мульти-дилуэнт 1 (Atellica IM Multi-Diluent 1) – 25,0

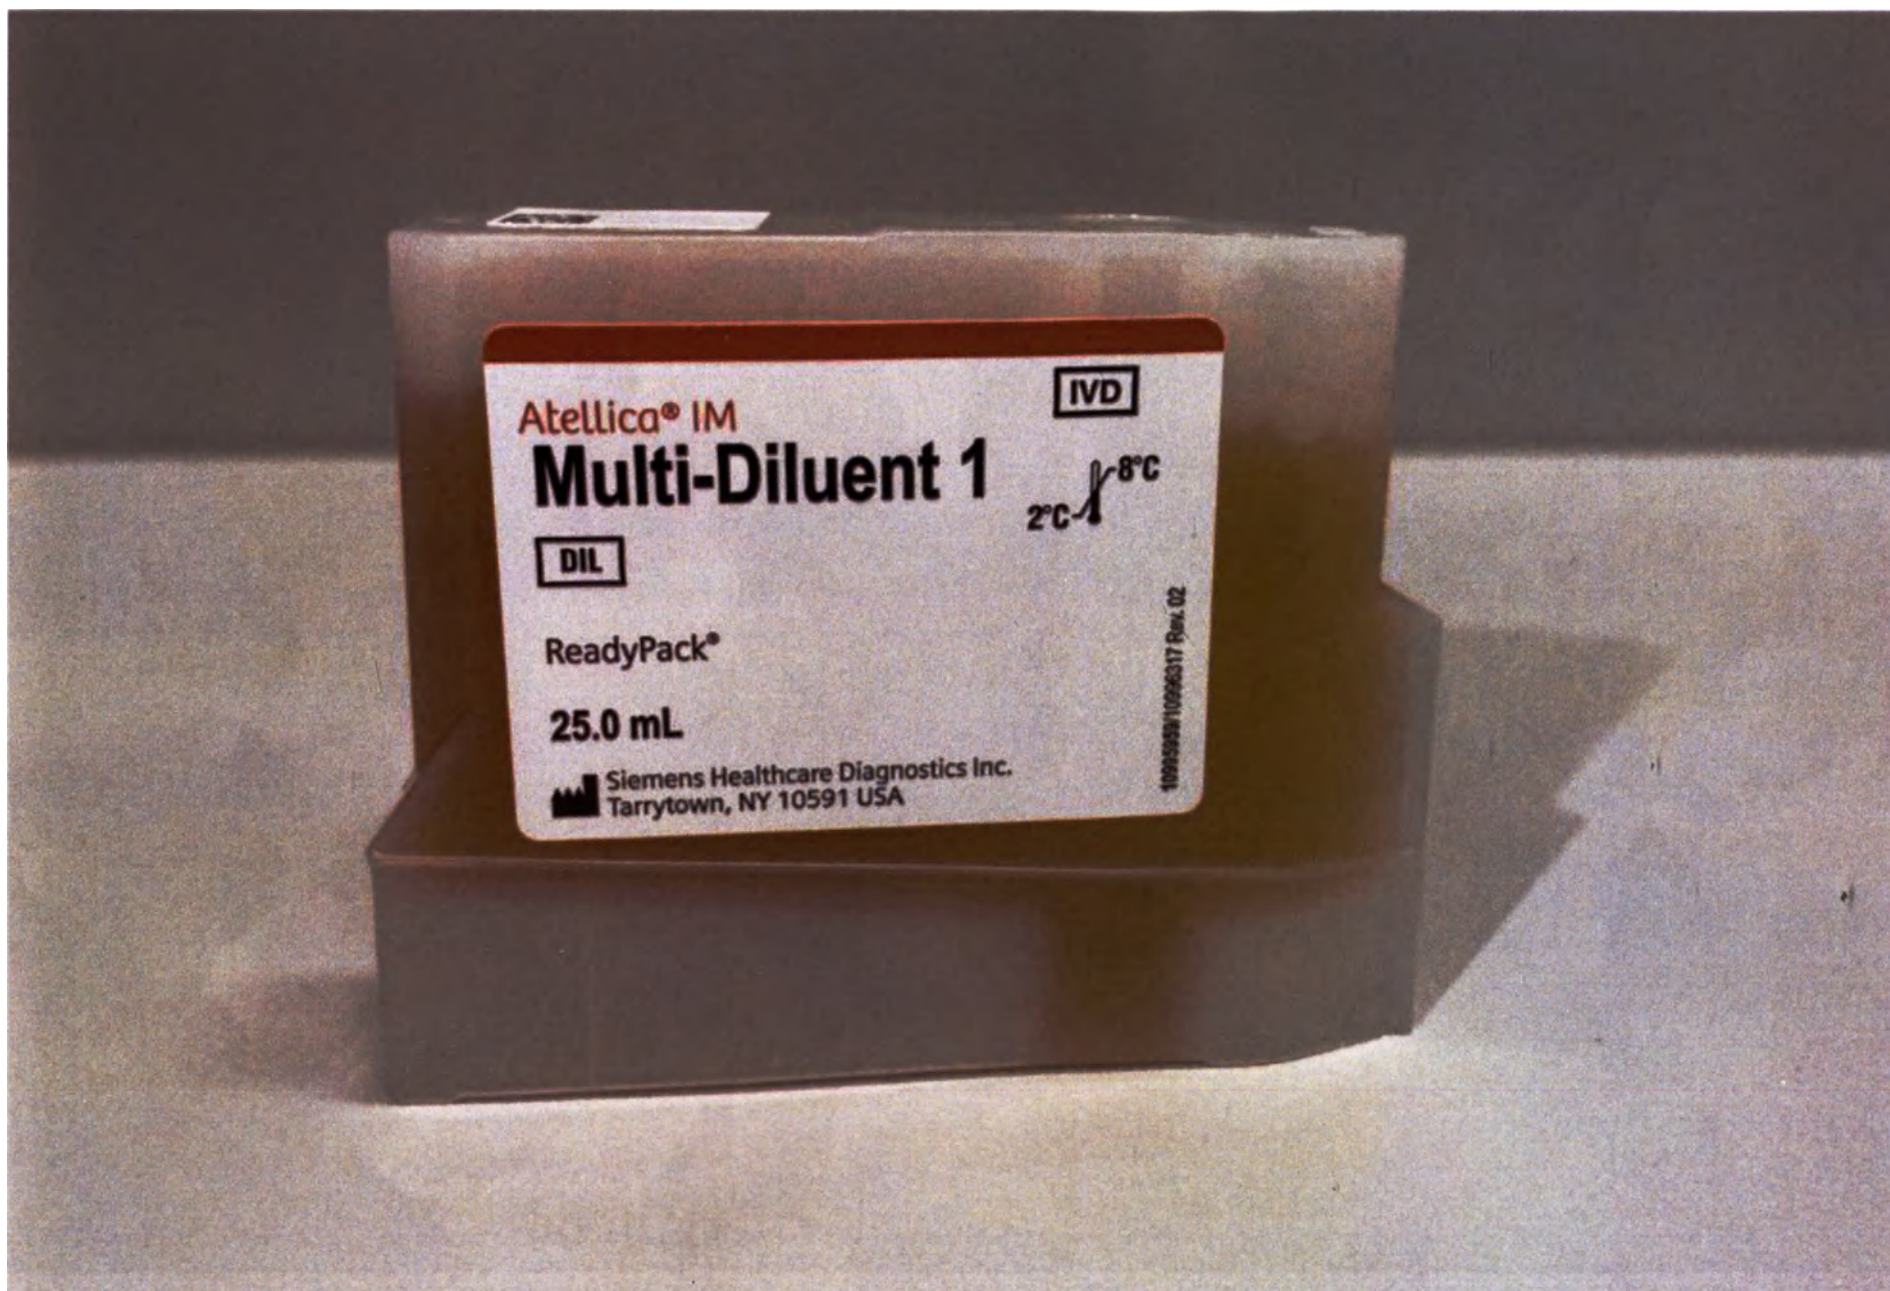

10995638 Мульти-Дилуэнт 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica
(Atellica IM Multi-Diluent 1)

Информация о производителе и стране производства
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение
№ P3H 2020/12603 от 18.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 6. Мульти-Дилуэнт 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1) – Маркировка, наносимая на упаковку (Применимо для Фасовок 1 и 2)

アテリカIM 共通希釈液1

10995639 Мульти-Дилуент 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica
(Atellica IM Multi-Diluent 1)

Информация о производителе и стране производства

см. на упаковке

Регистрационное удостоверение

№ P3H 2020/12603 от 18.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке


Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 7. Мульти-Дилуент 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 1) – Маркировка, наносимая на упаковку (Применимо для Фасовки 3)

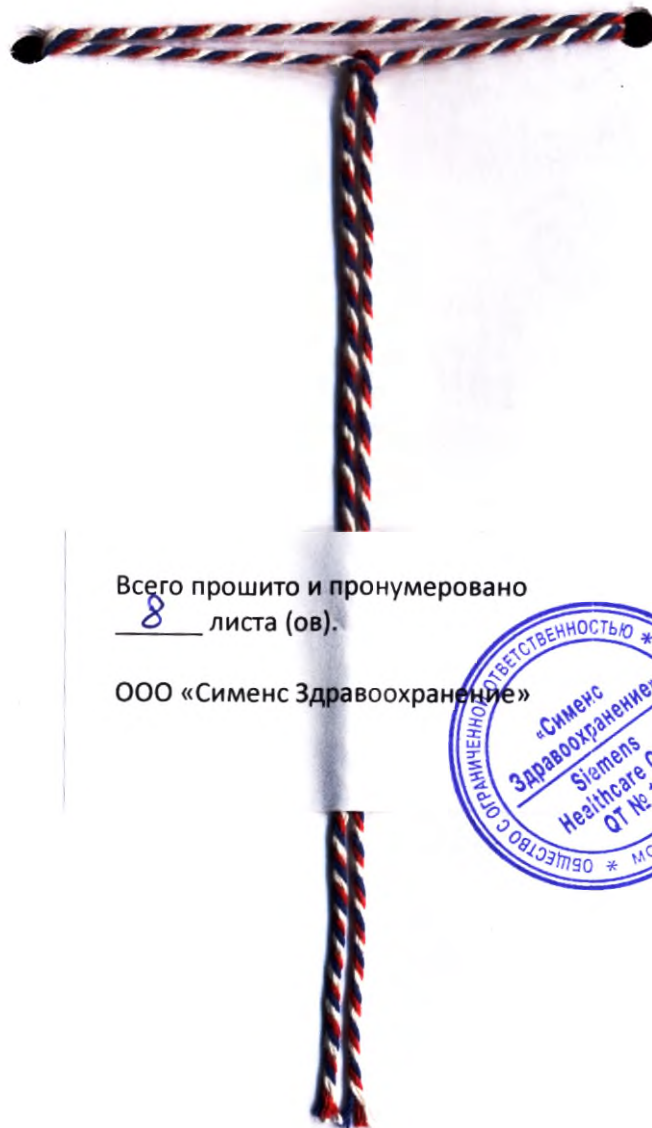

Всего прошито и пронумеровано
8 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»

