


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Син Чэнь
«28» августа 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса
иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
для диагностики in vitro, лоты 2020050221, 2020050211, 2020050301, 2020060111

Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020050221»:

- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgG - 2 шт

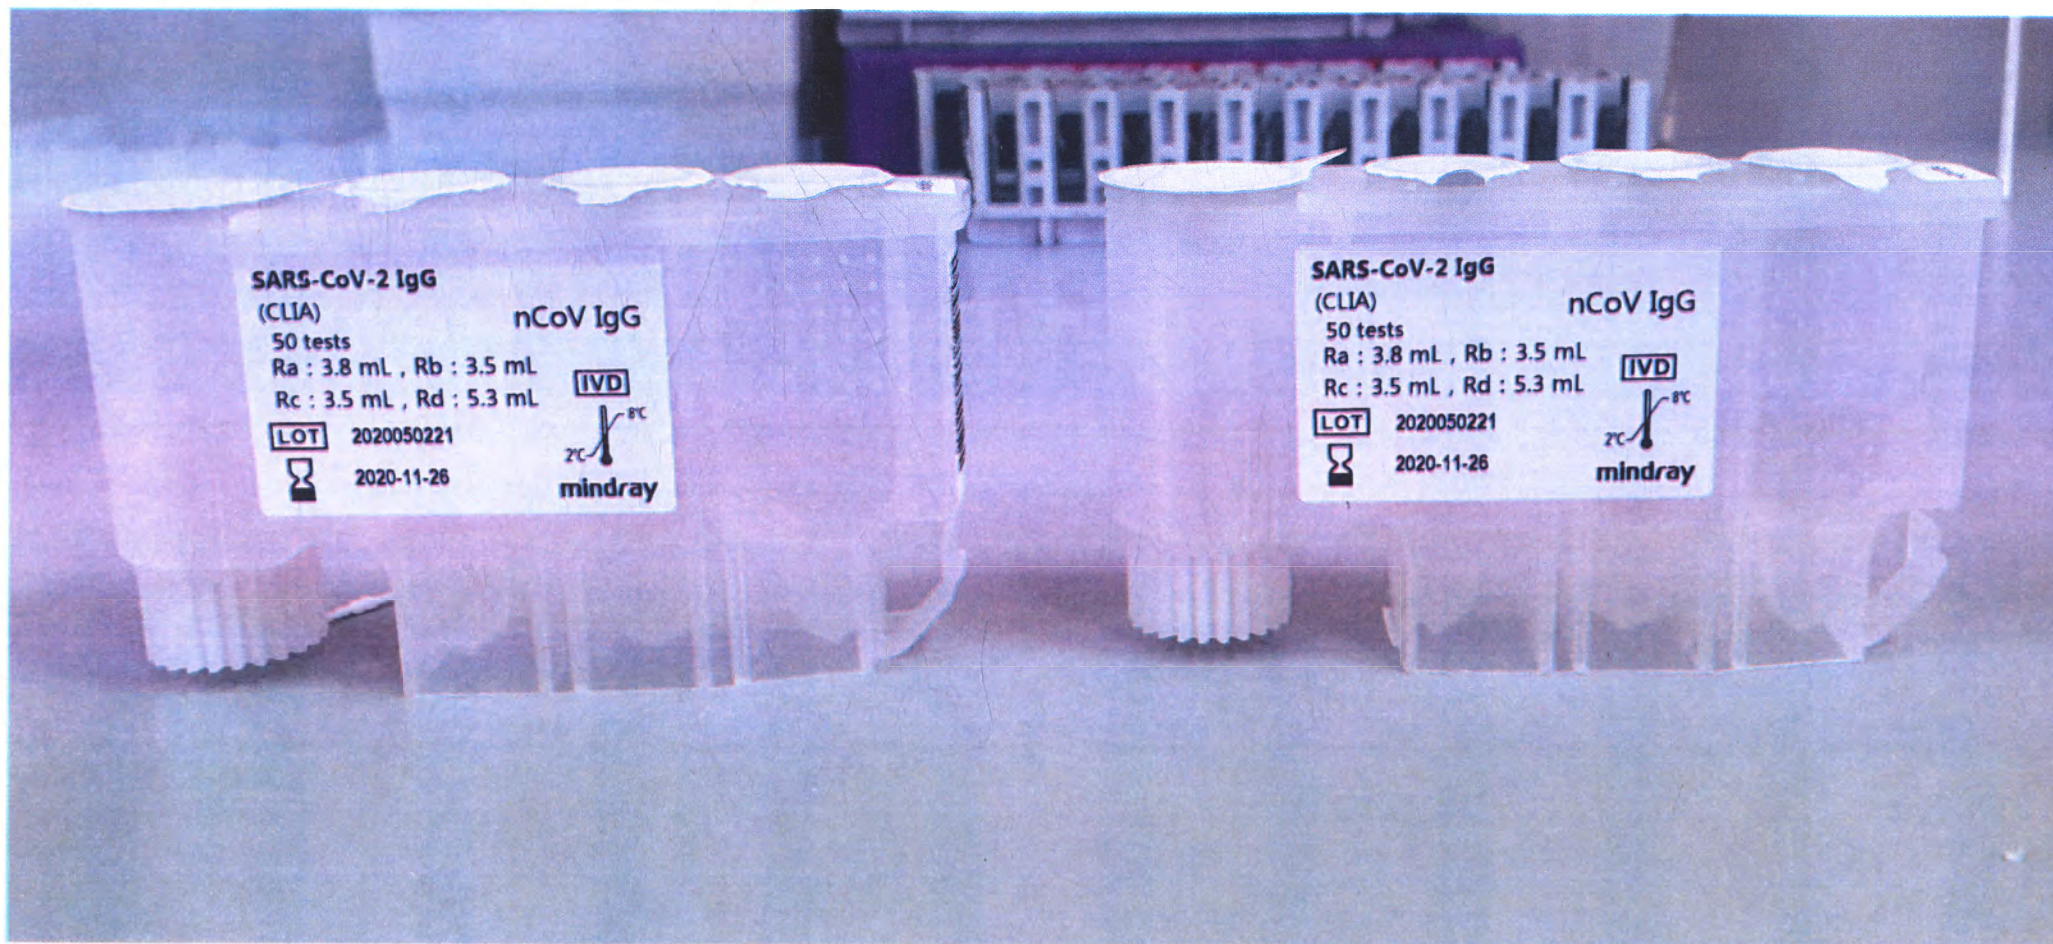

Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C0), уровень 0 – 1 шт



- Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C1), уровень 1 – 1 шт;



Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020050221»

mindray

SARS-CoV-2 IgG(CLIA)



Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)

2x50 tests



PMA202005022109194

REF

SARS-CoV-2 IgG121

P/N: 105-019883-00

LOT

2020050221



2020-11-26

047-035132-00 (1.0)

mindray

SARS-CoV-2 IgG(CLIA)

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)

2x50 tests

Contents: Ra : 2x3.8 mL, Rb : 2x3.5 mL, Rc : 2x3.5 mL, Rd : 2x5.3 mL
C0 : 1.2 mL, C1 : 1.0 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680 www.mindray.com


EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



CE

IVD




Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020050211»:

- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgG - 2 шт




калибратор SARS-CoV-2 IgG (C0), уровень 0 – 1 шт

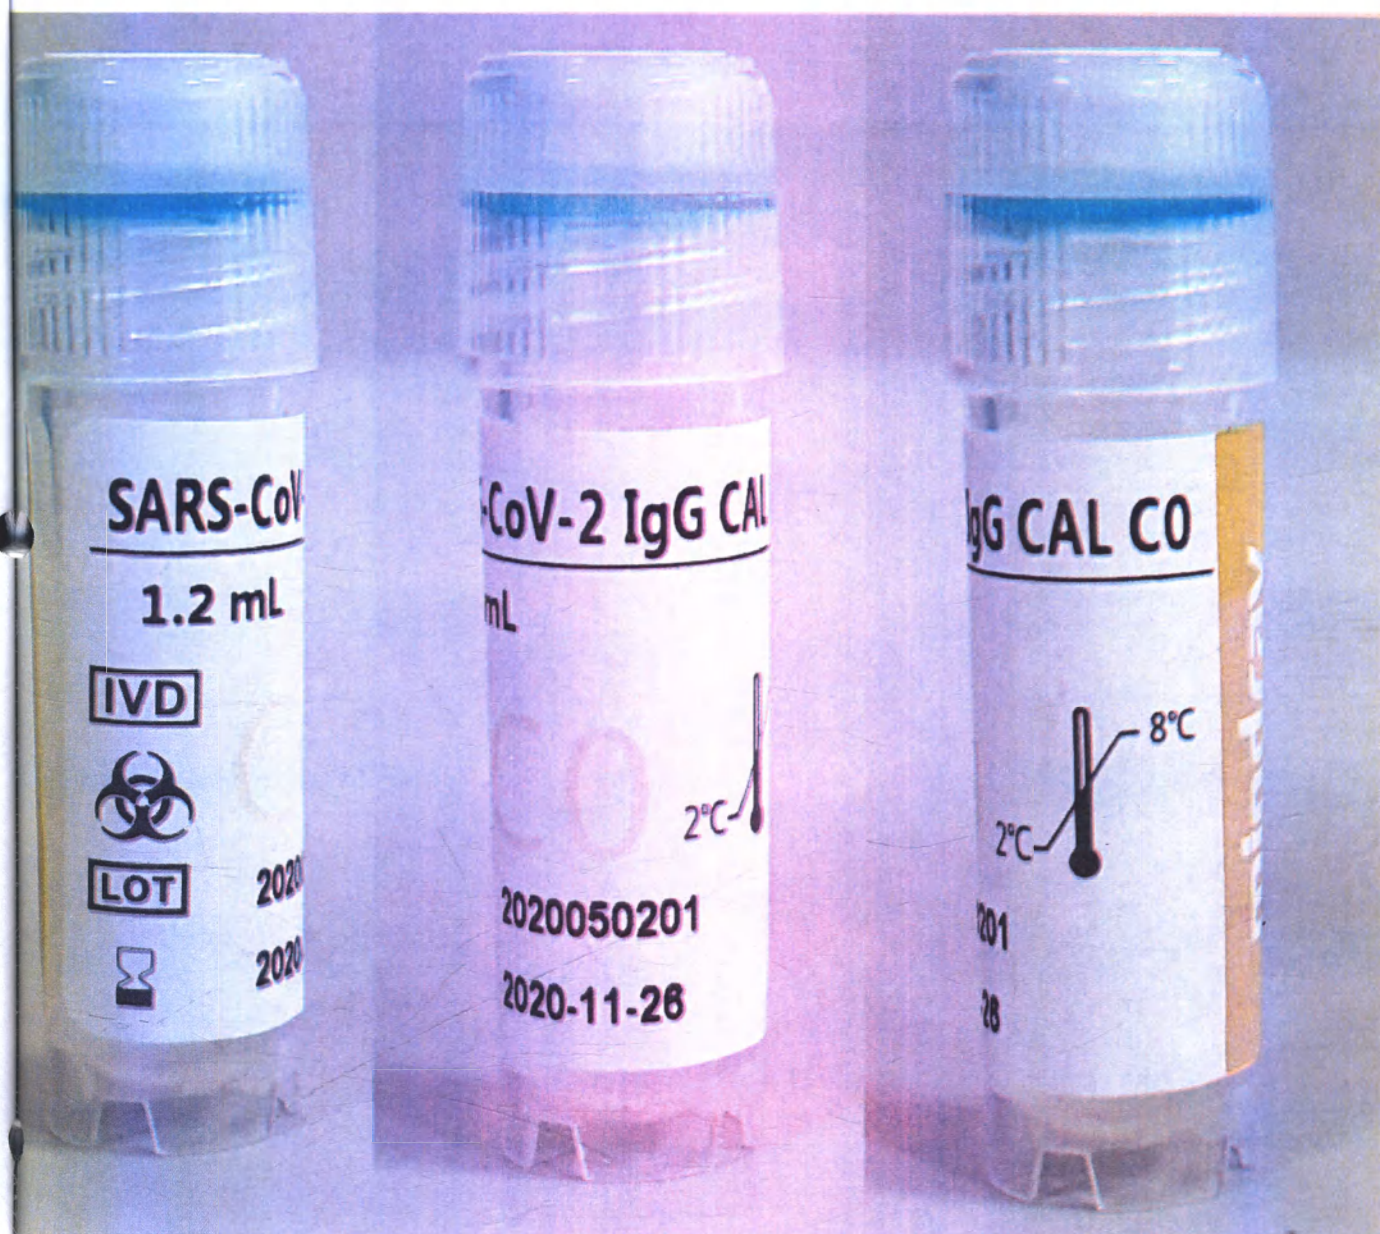

- Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C1), уровень 1 – 1 шт;



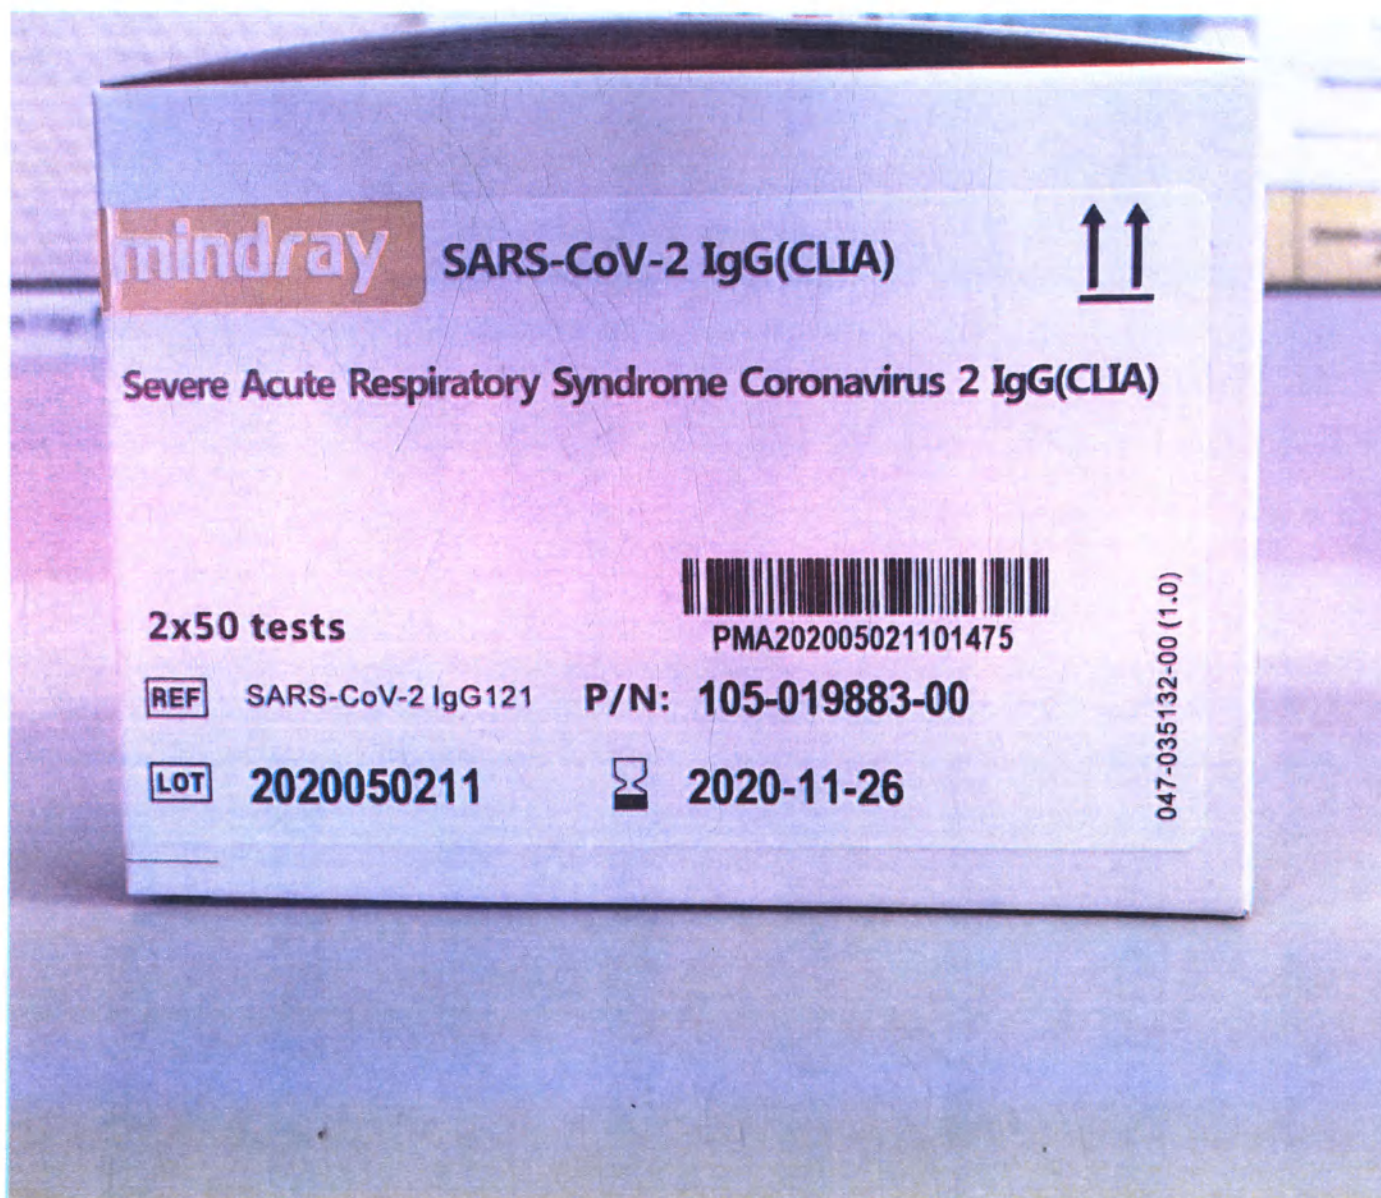

mindray

SARS-CoV-2 IgG(CLIA)

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)
2x50 tests

Contents: Ra : 2x3.8 mL, Rb : 2x3.5 mL, Rc : 2x3.5 mL, Rd : 2x5.3 mL
C0 : 1.2 mL, C1 : 1.0 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680 www.mindray.com


EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



CE


IVD




Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020050301»:

- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgG - 2 шт



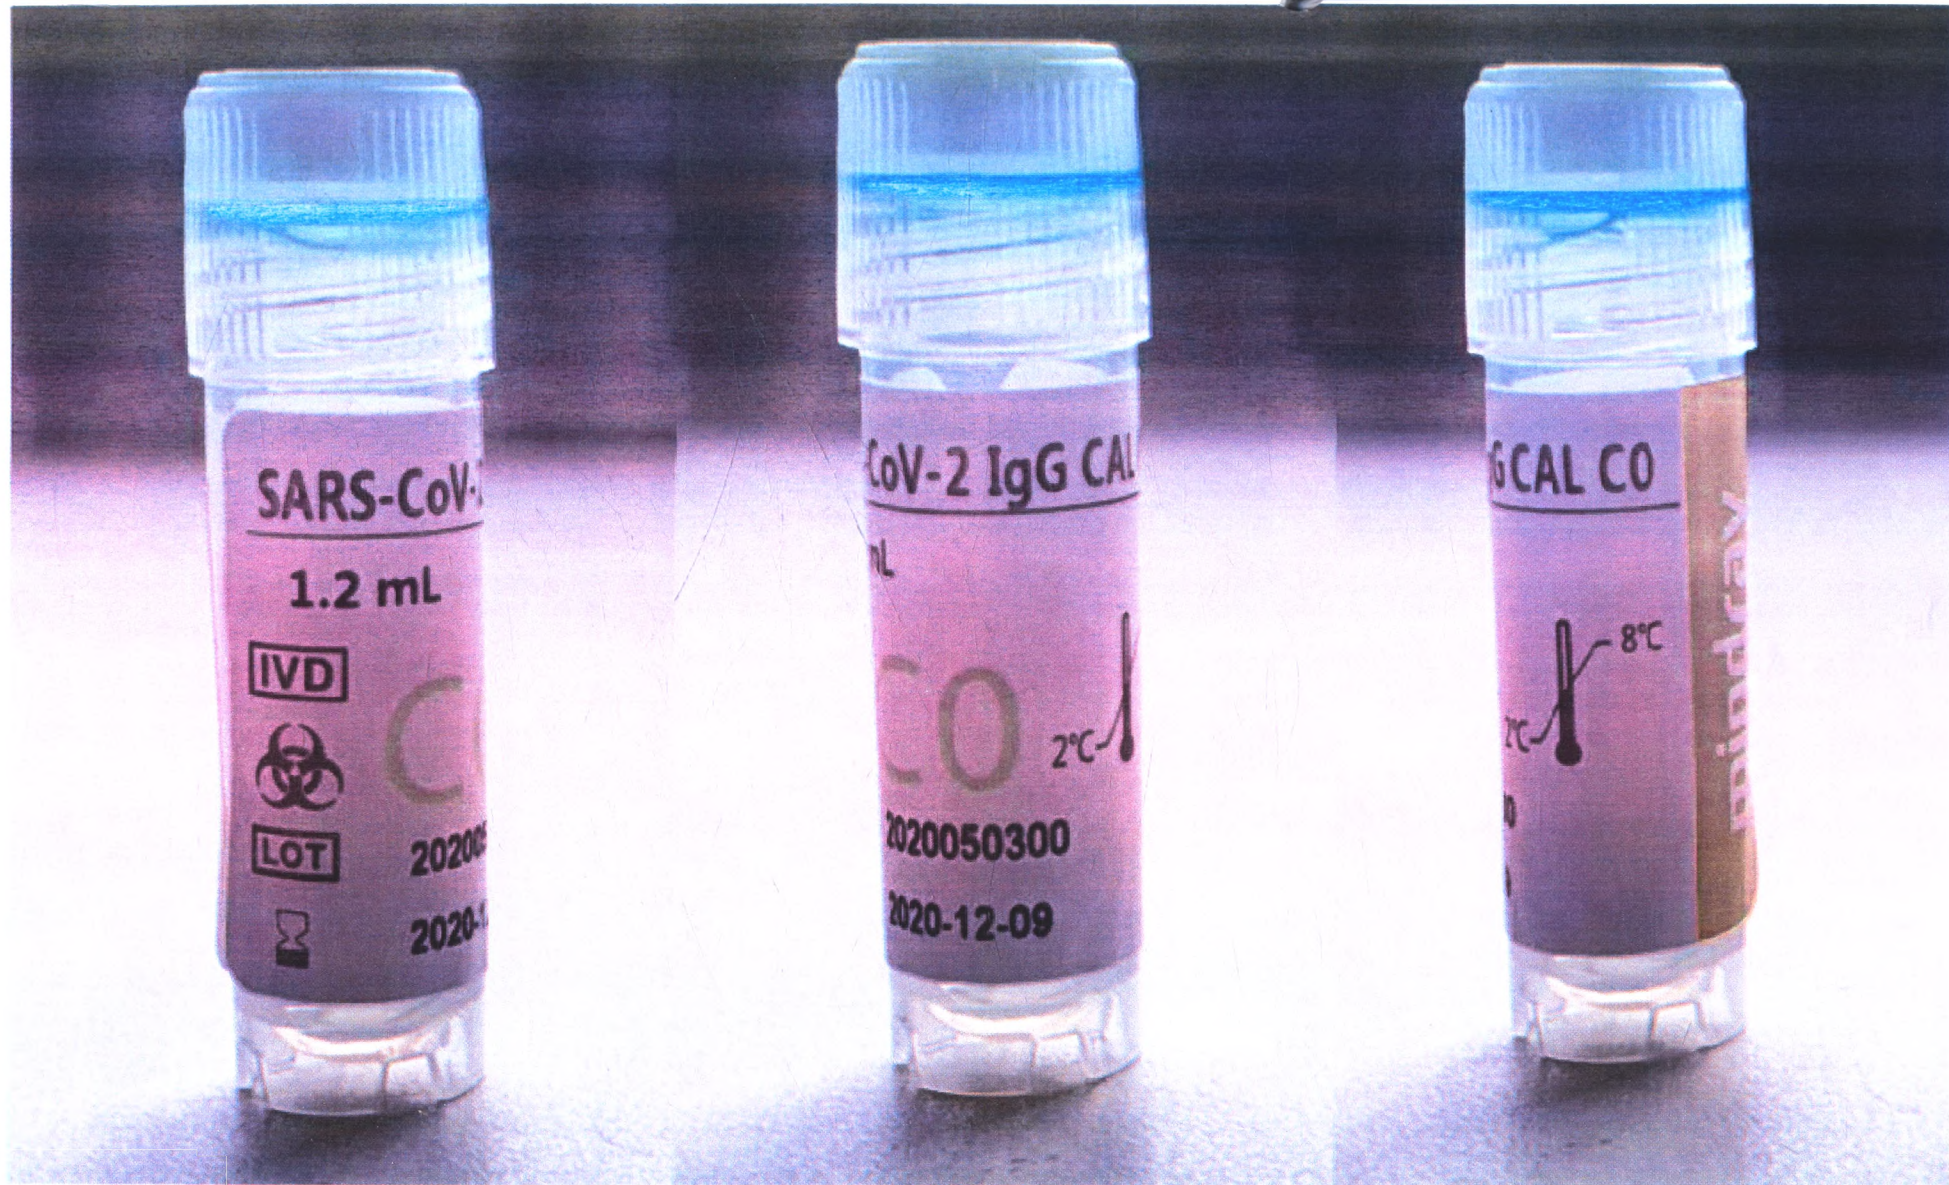

- Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C1), уровень 1 – 1 шт;

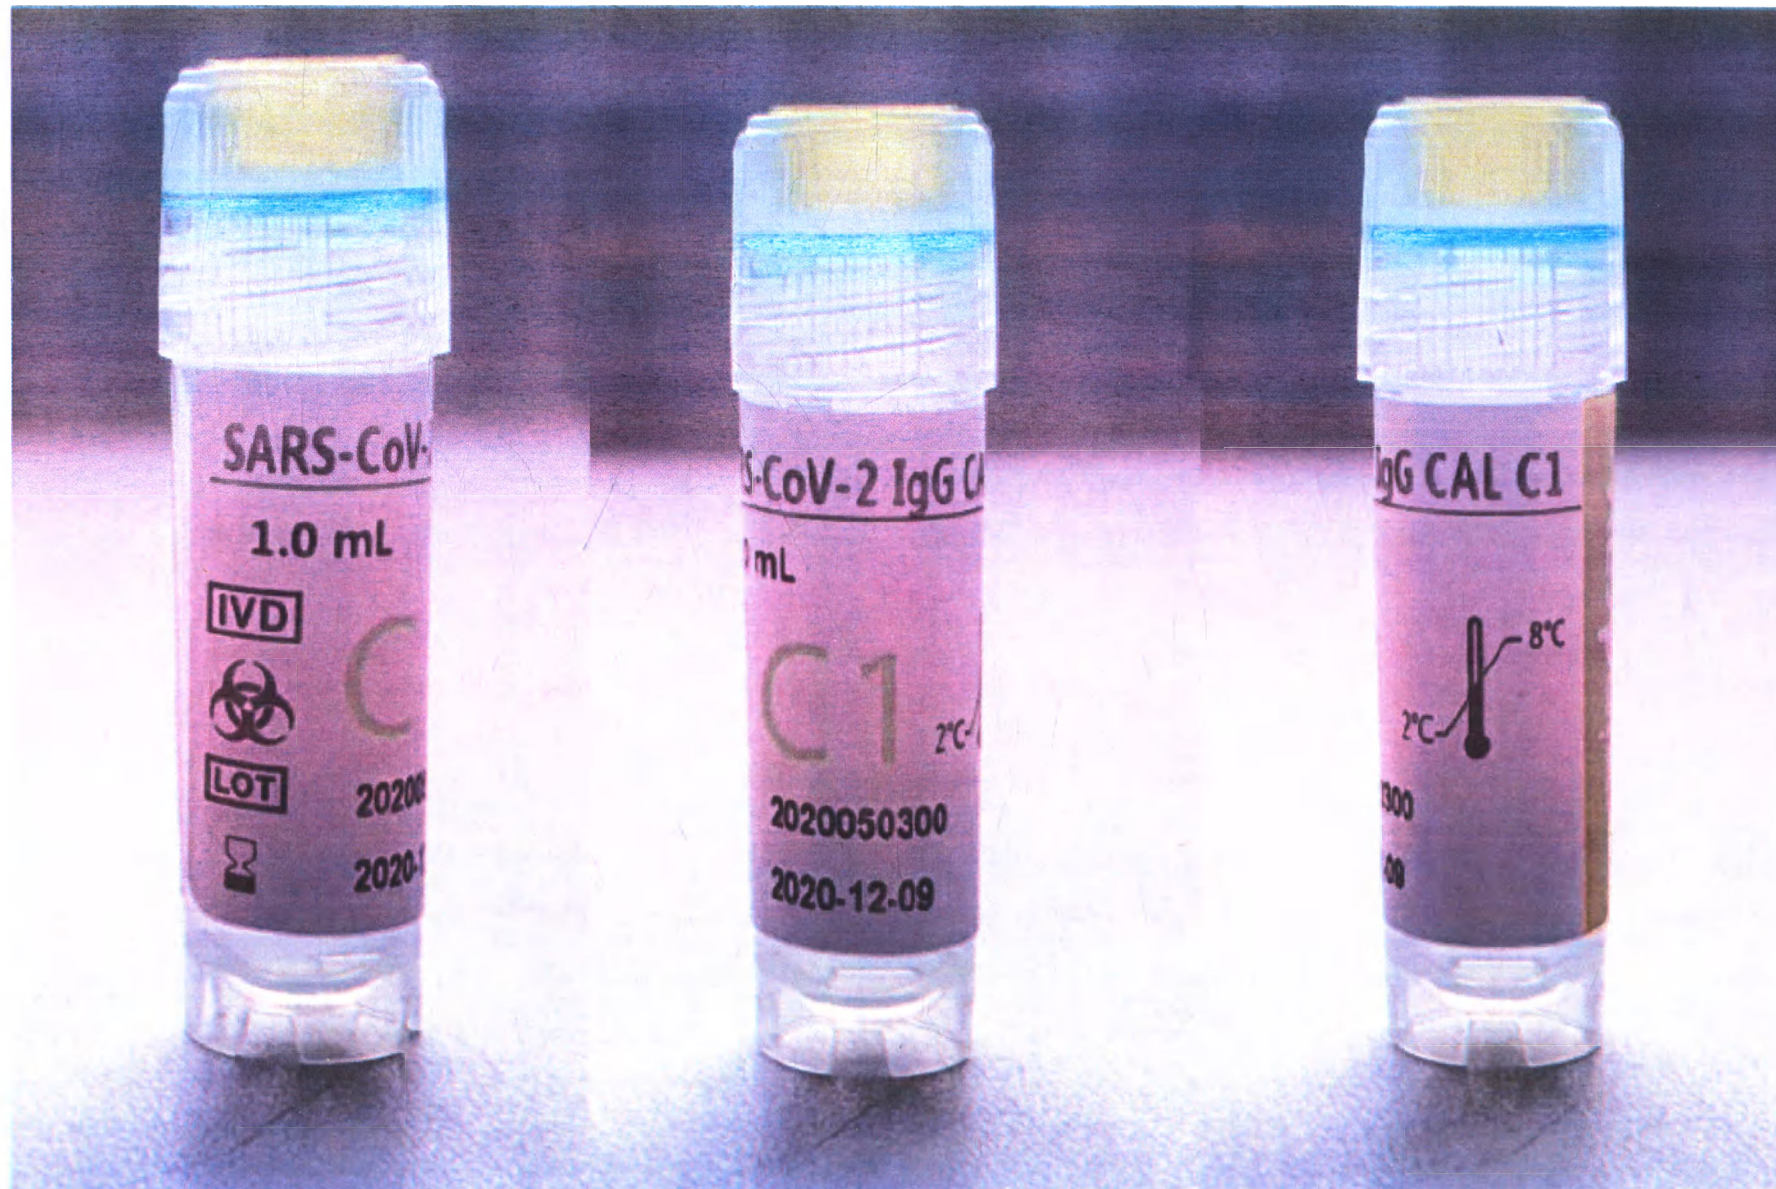

Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохсмилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020050301»



mindray

SARS-CoV-2 IgG(CLIA)

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)

2x50 tests

Contents: Ra : 2x3.8 mL, Rb : 2x3.5 mL, Rc : 2x3.5 mL, Rd : 2x5.3 mL
C0 : 1.2 mL, C1 : 1.0 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Xej 121th Road South, High-tech Industrial Park, Nantian, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888990 Fax: +86-755-76582600 www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Zellstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany




IVD




Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020060111»:

- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgG - 2 шт

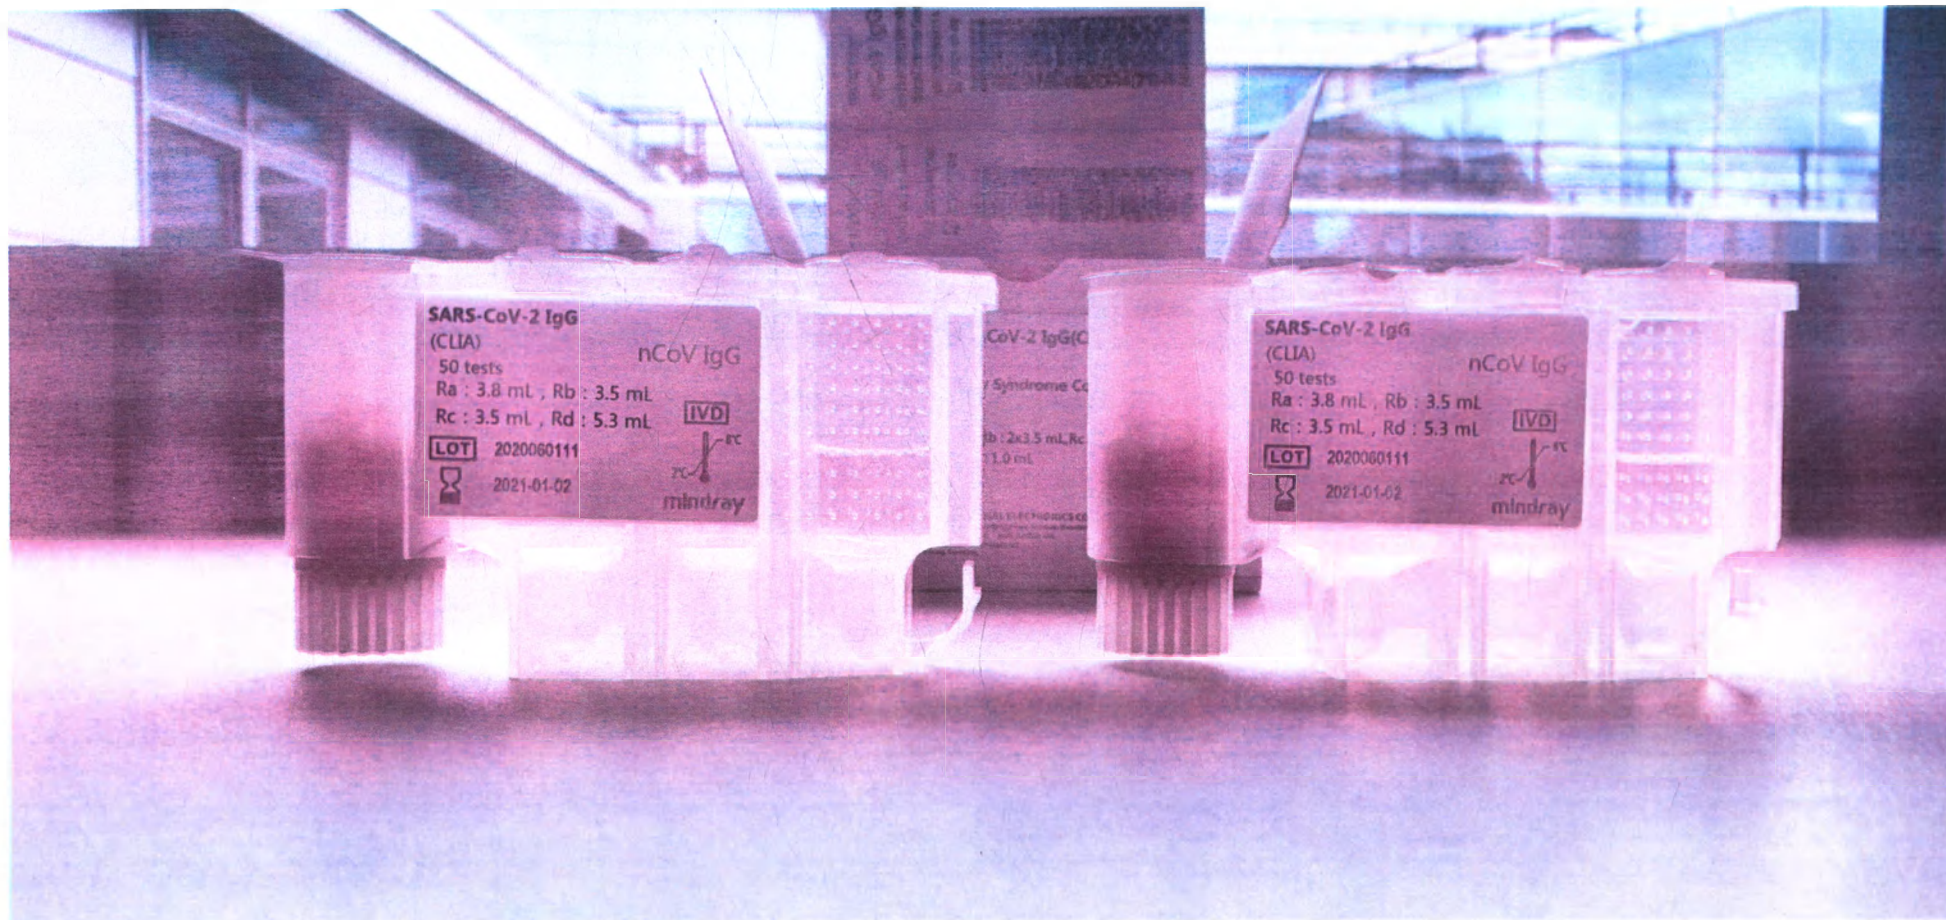




- Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C1), уровень 1 – 1 шт;

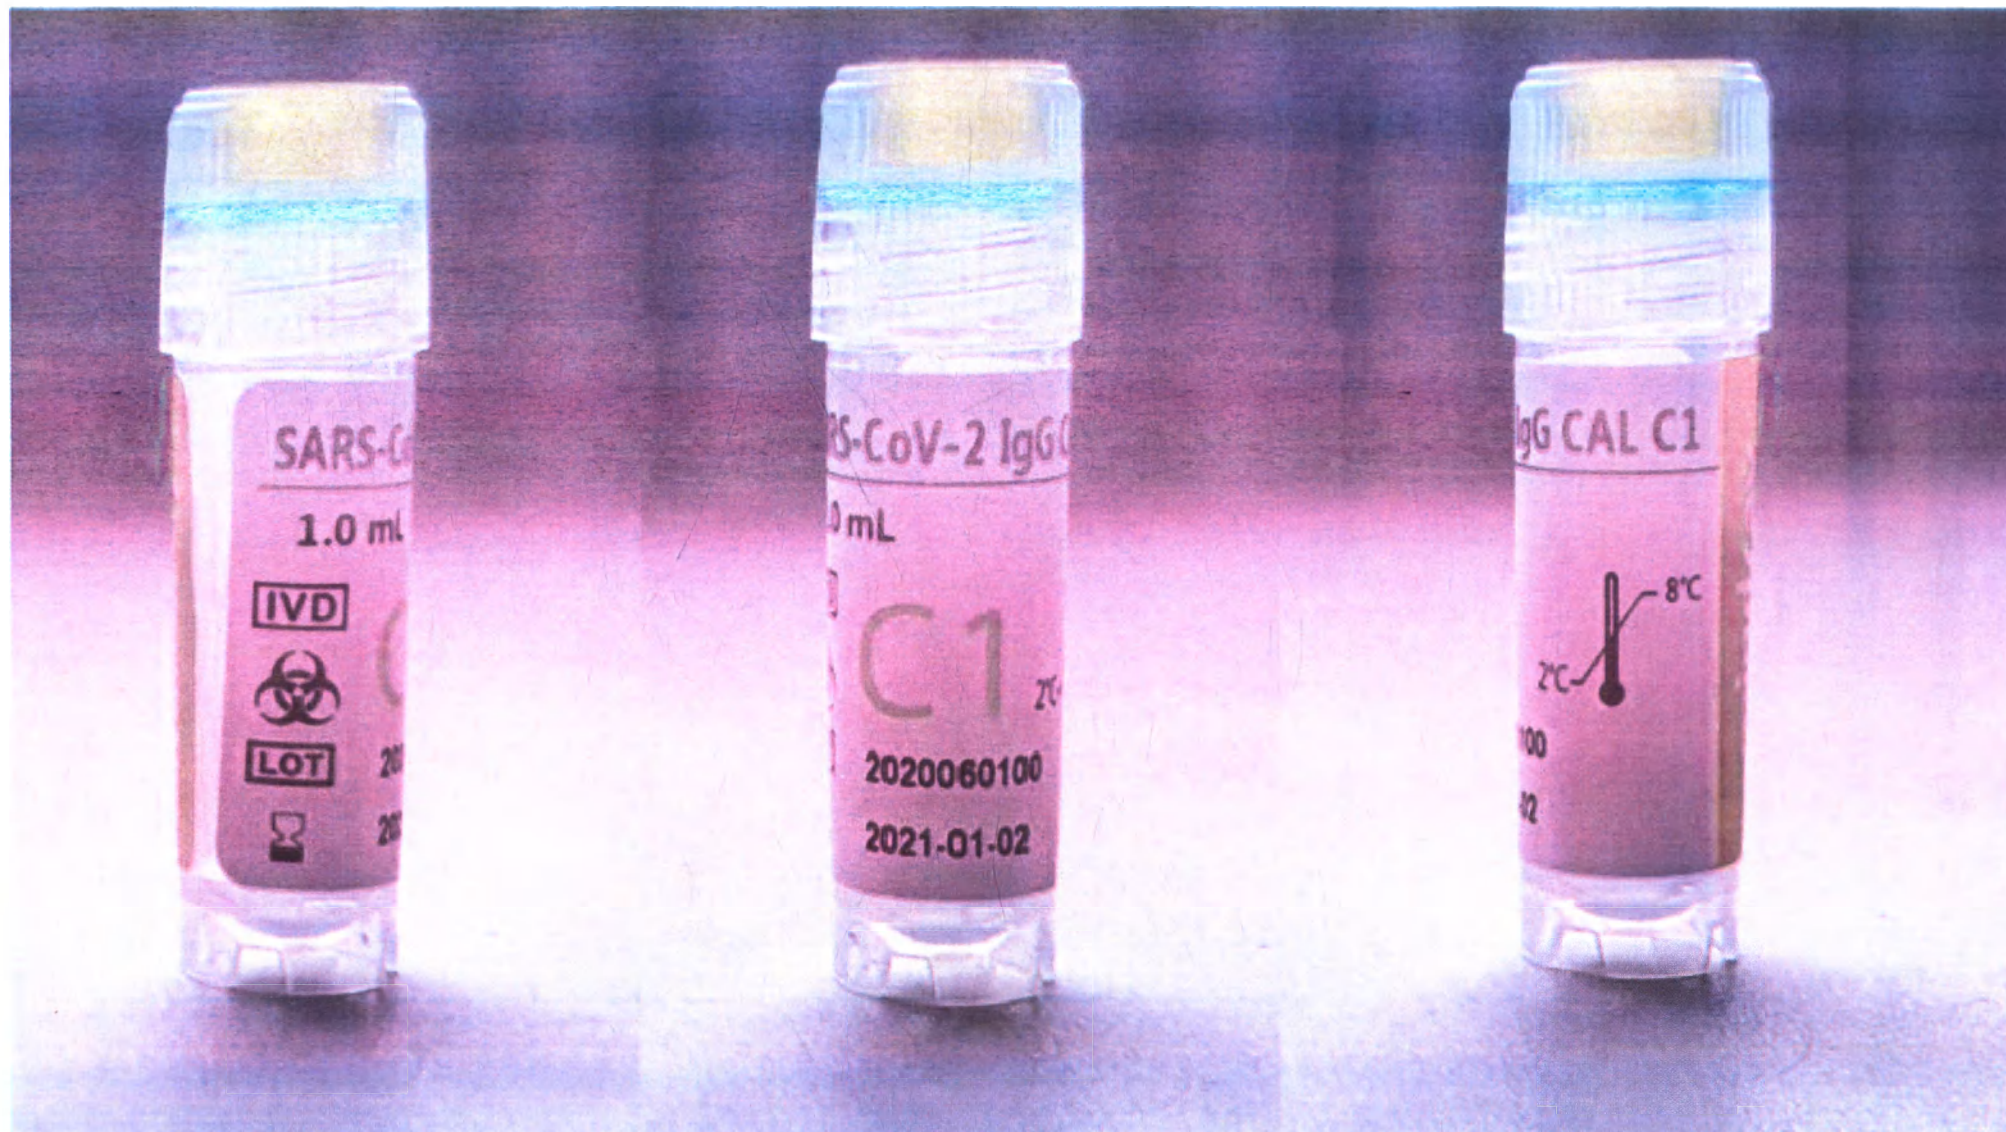

Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020060111»

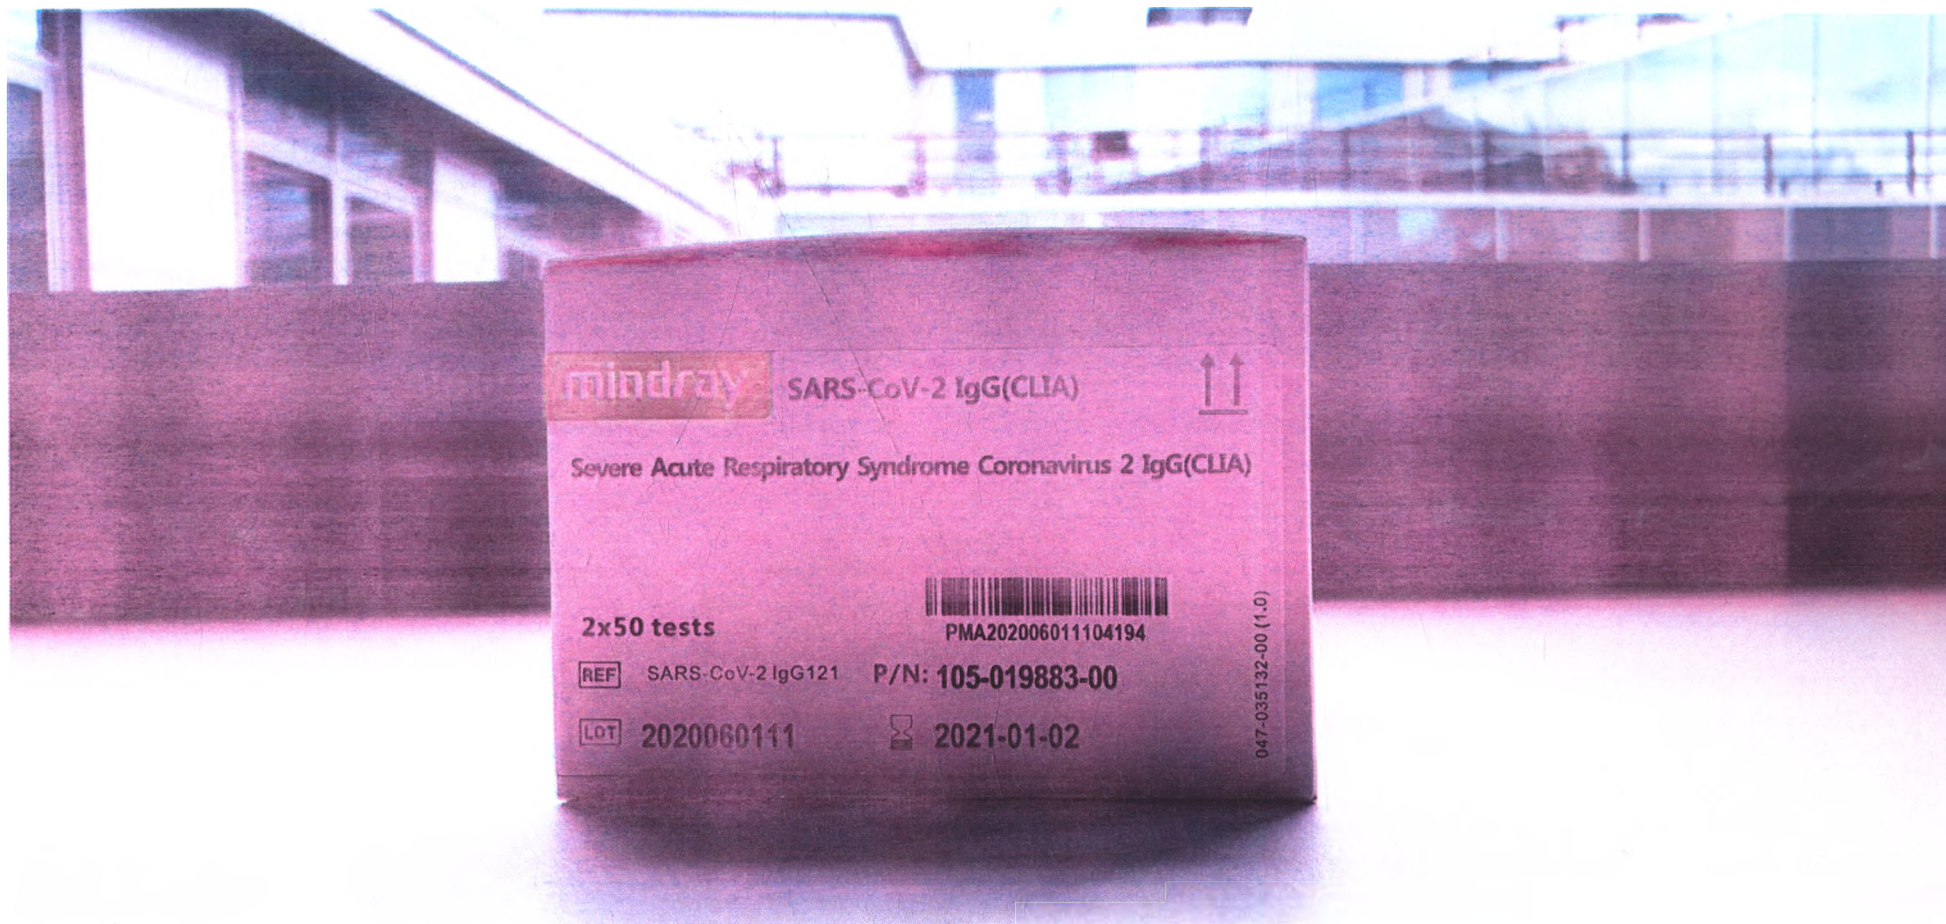

mindray

SARS-CoV-2 IgG(CLIA)

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)
2x50 tests

Contents: Ra : 2x3.8 mL, Rb : 2x3.5 mL, Rc : 2x3.5 mL, Rd : 2x5.3 mL
C0 : 1.2 mL, C1 : 1.0 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Epi 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Wanzhan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Tel: +86-755-81628995 Fax: +86-755-26562080 www.mindray.com




Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Lilienthalstraße 80, 20557 Hamburg, Germany



IVD



прочито и
скреплено печатью
21 нст

