

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель департамента
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина

2019 г




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Система ультразвуковая диагностическая
медицинская Vscan Extend с принадлежностями»**

1. Консоль с ультразвуковым датчиком



2. Консоль с ультразвуковым датчиком

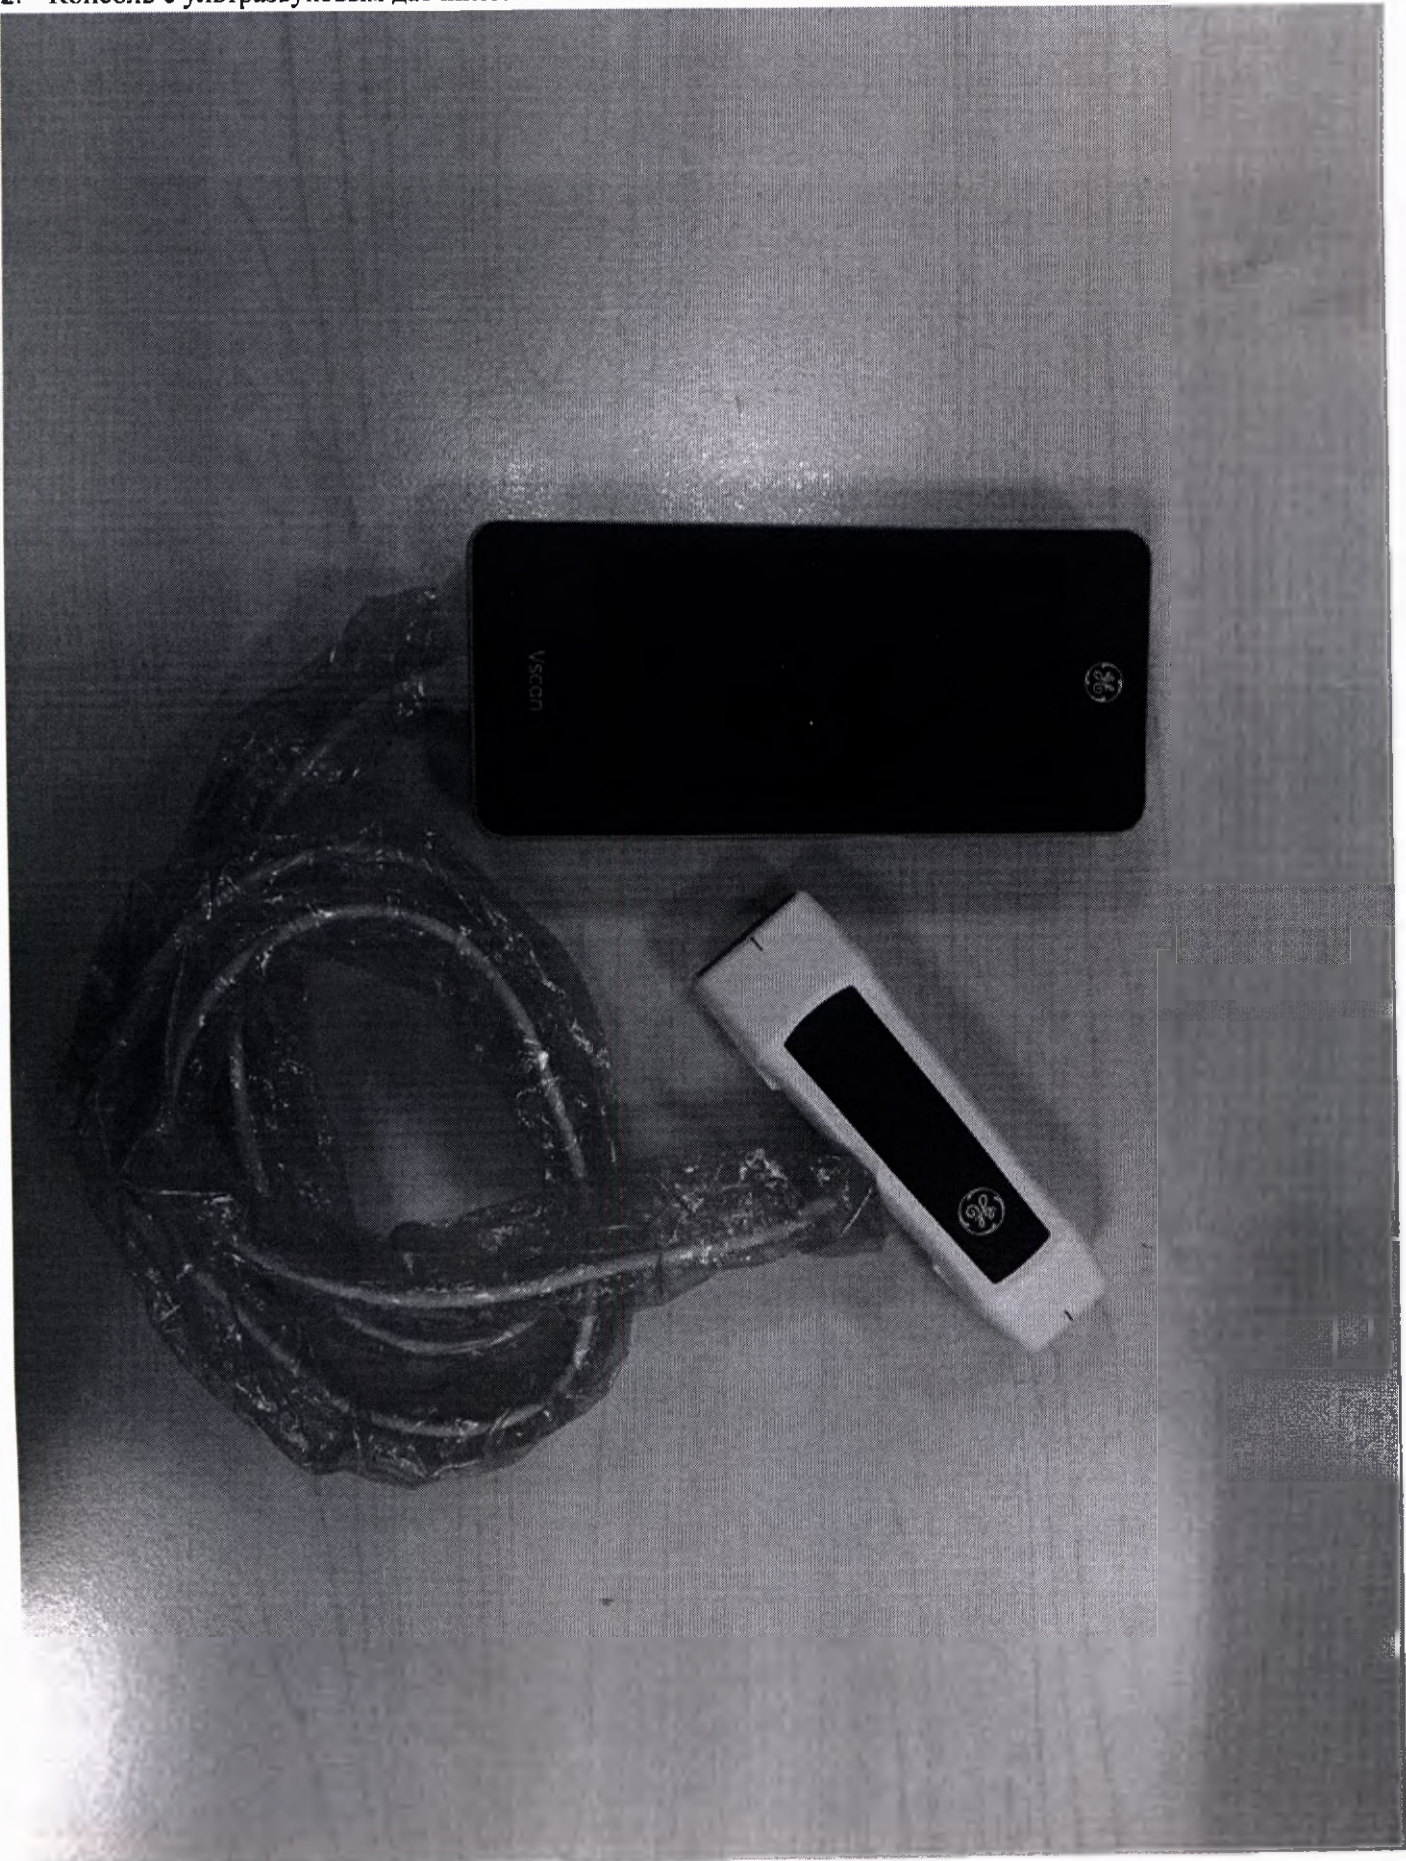

3. Маркировка изделия



5721785_05



GE Vingmed Ultrasound A/S
Strandpromenaden 45
3191 Horten Norway




CE



IP33



0123



“5693456”



12V 2A



Référez-vous à l'étiquette figurant à l'intérieur.
Siehe auch Innenetikett
Consultare l'etichetta interna
Refer label inside

Assembled in Romania

SN



VH163025XB
5754852_03

REF Vscan Extend P/N 5693455

UDI




(01)00840682121651
(11)181000
(21)VH163025XB

5758266-01


4. Сетевой адаптер питания





5. Инструкция пользователя на русском языке (не более 5 шт.)

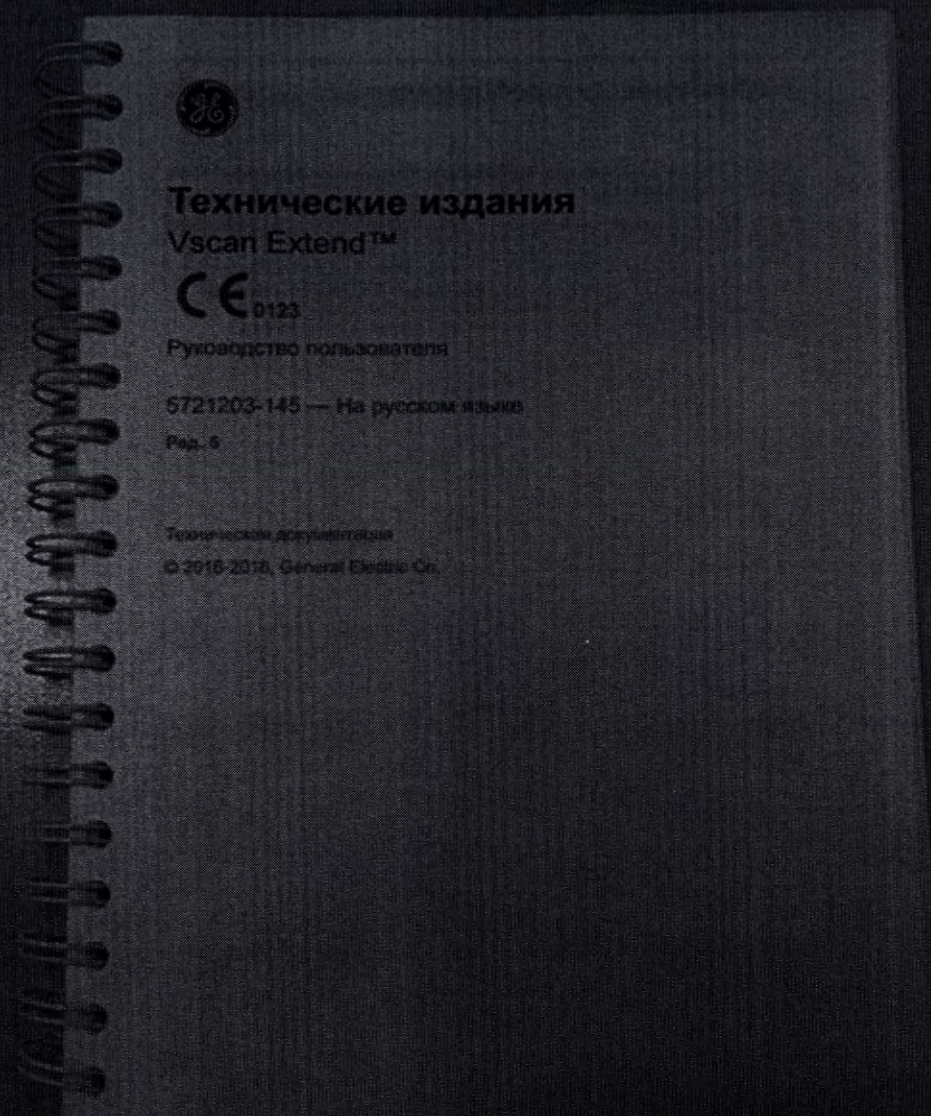



6. Аккумуляторная батарея (не более 3 шт.)

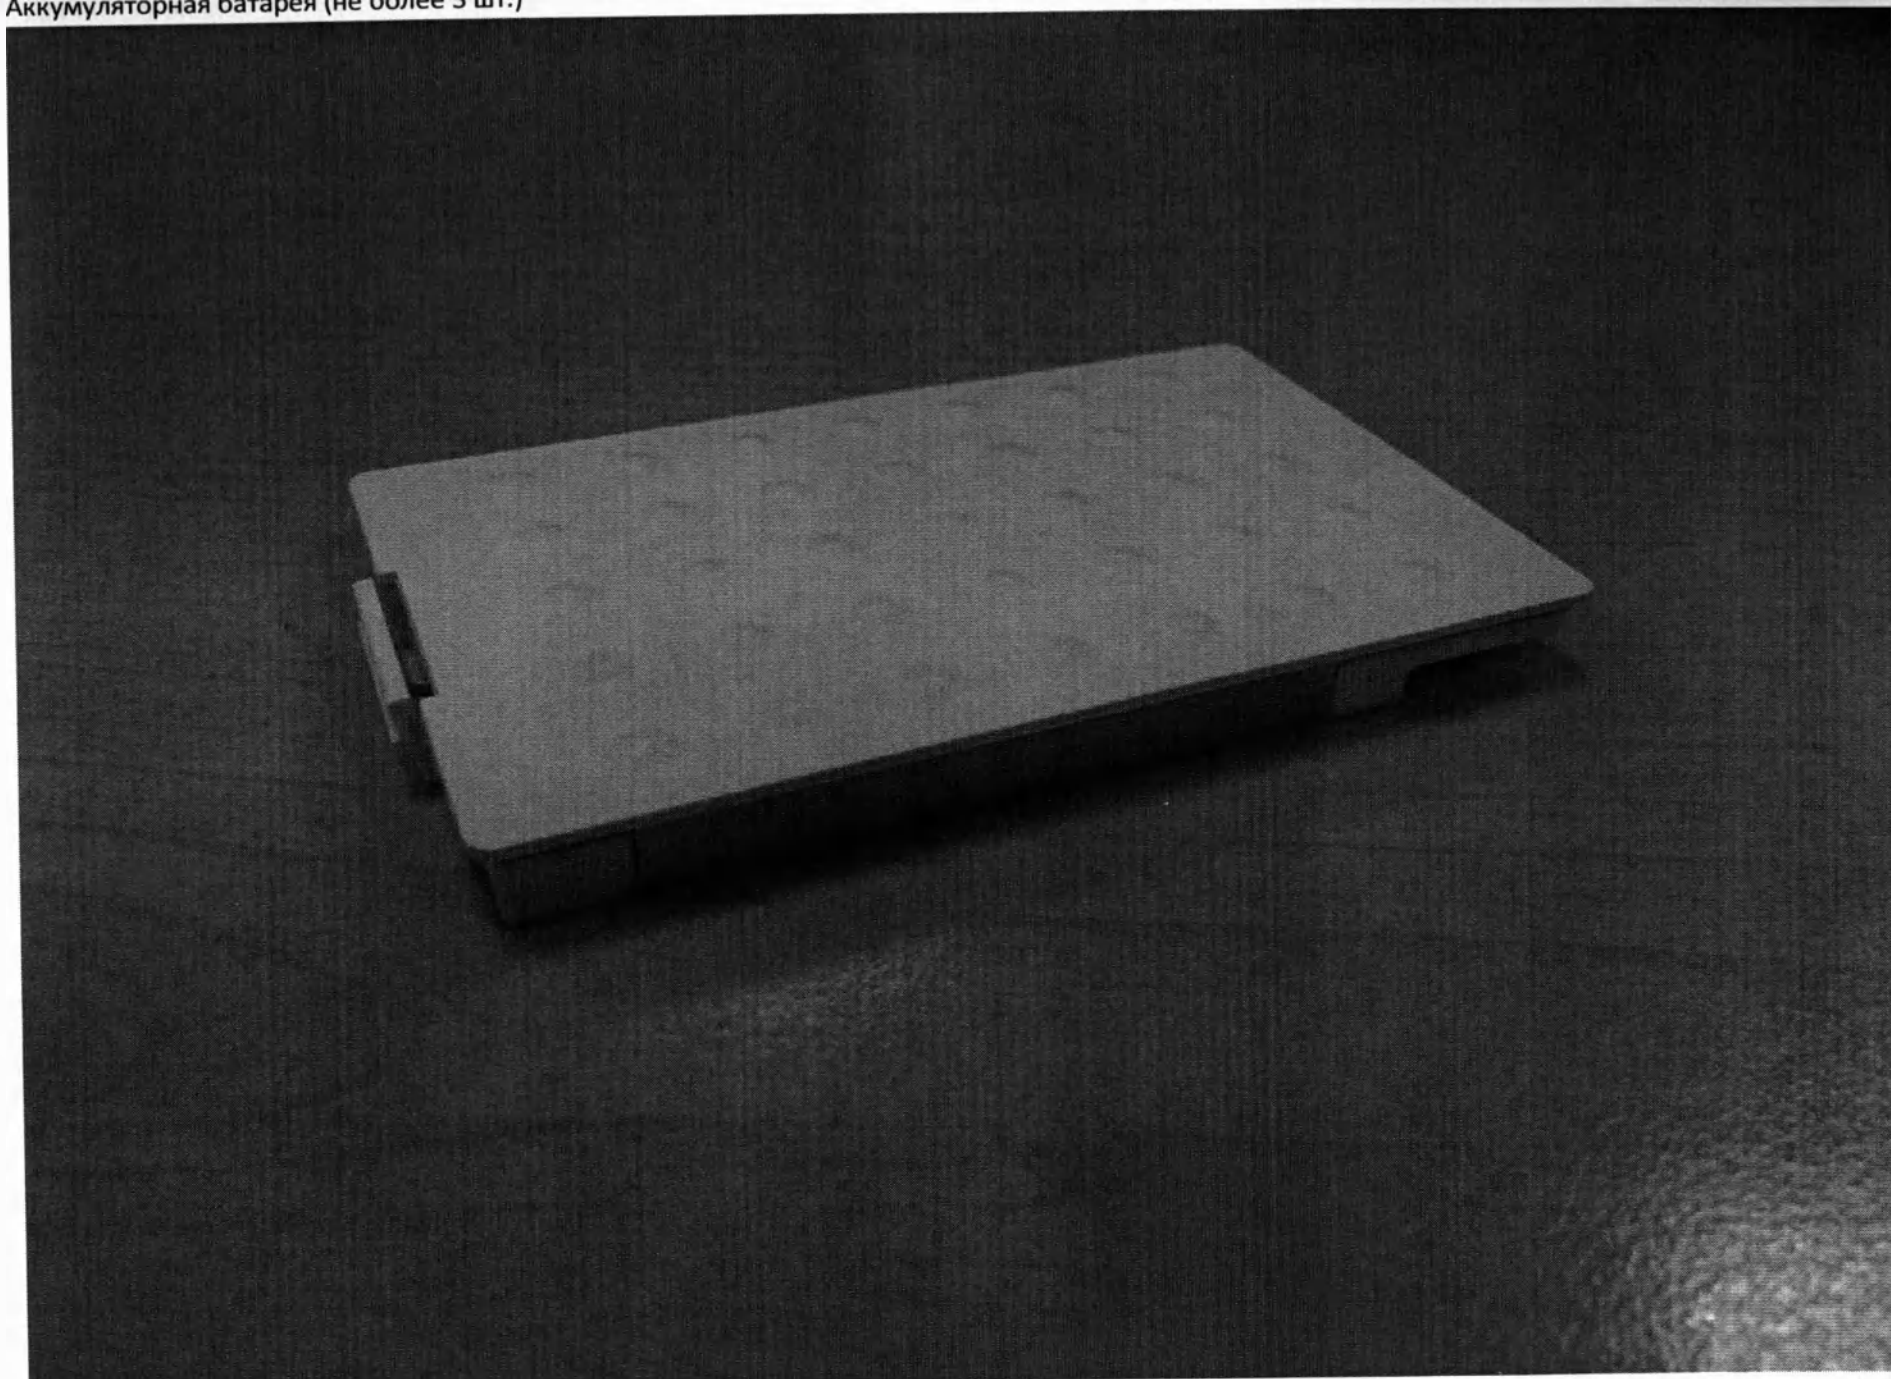

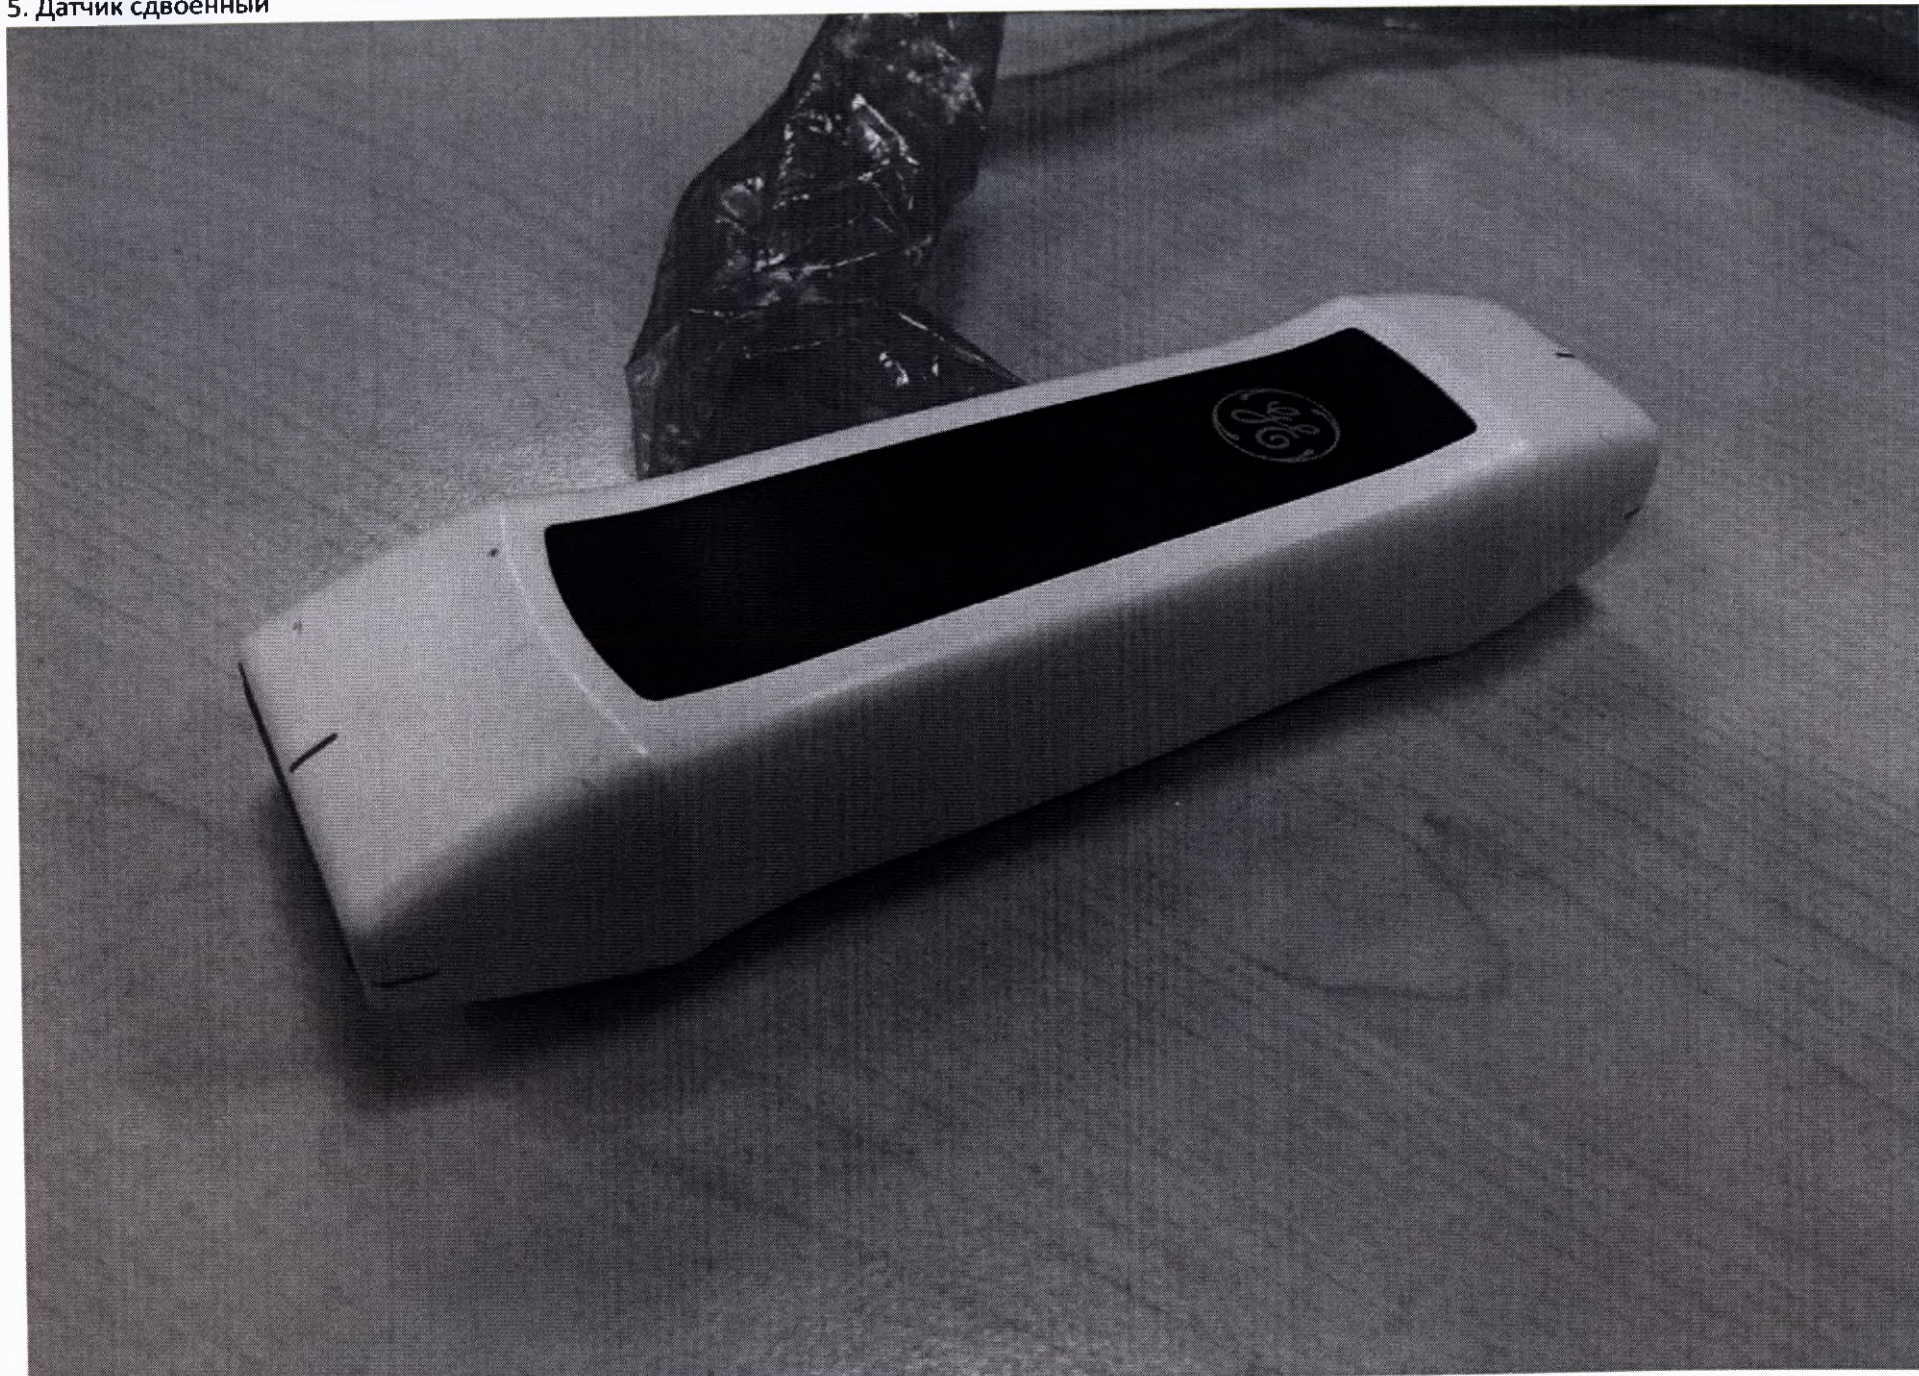

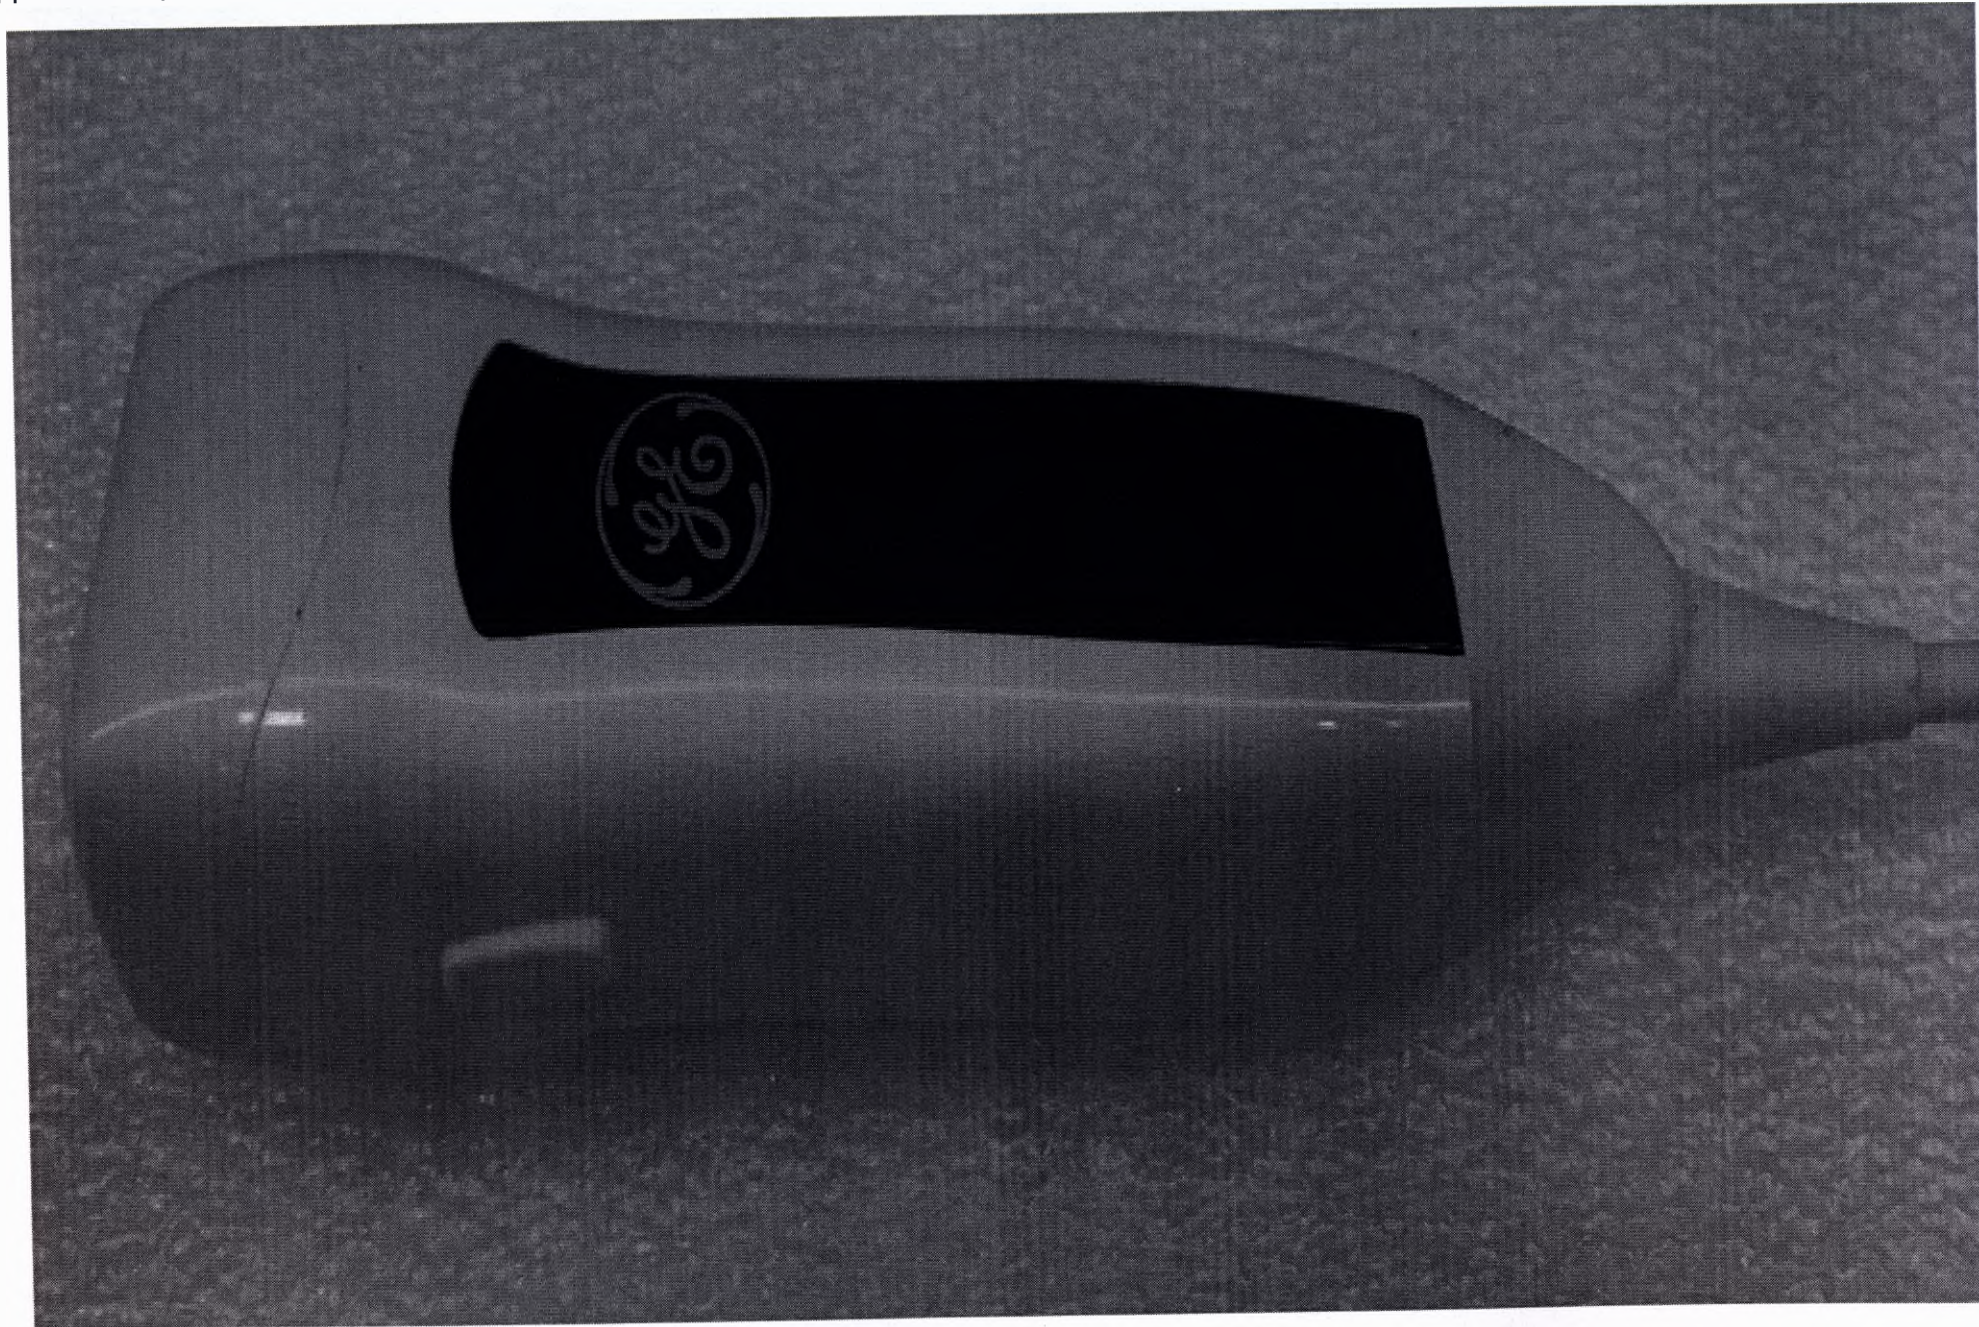

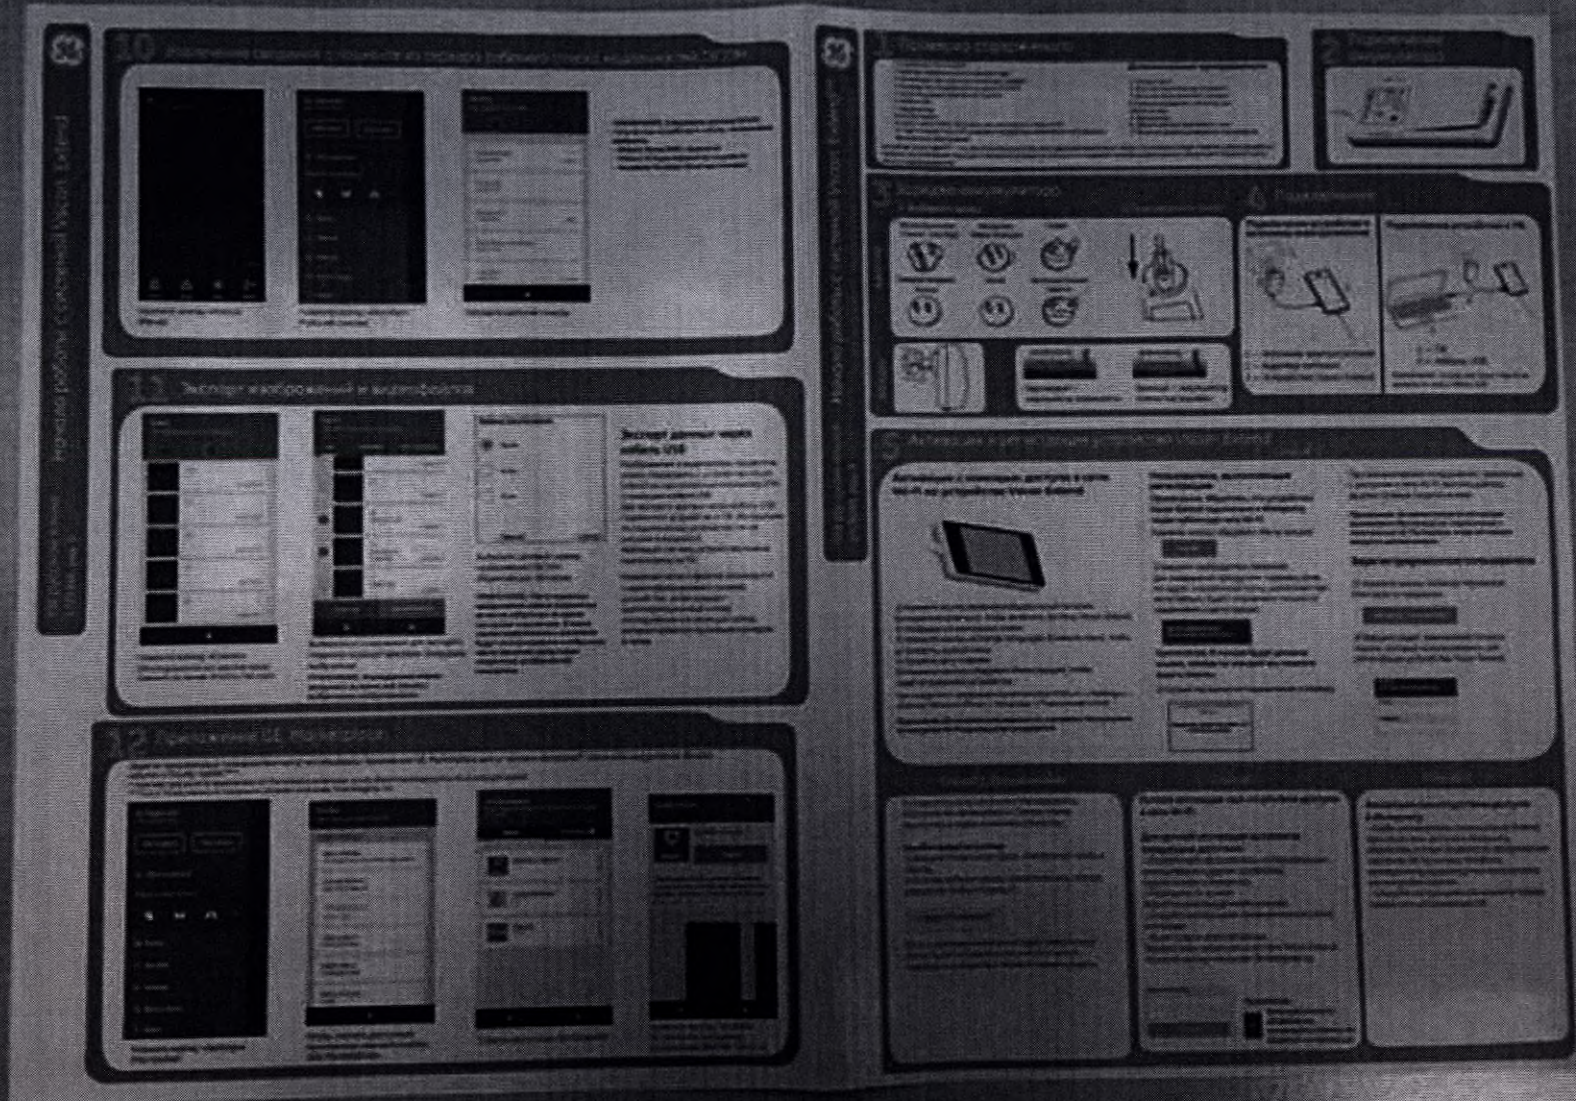


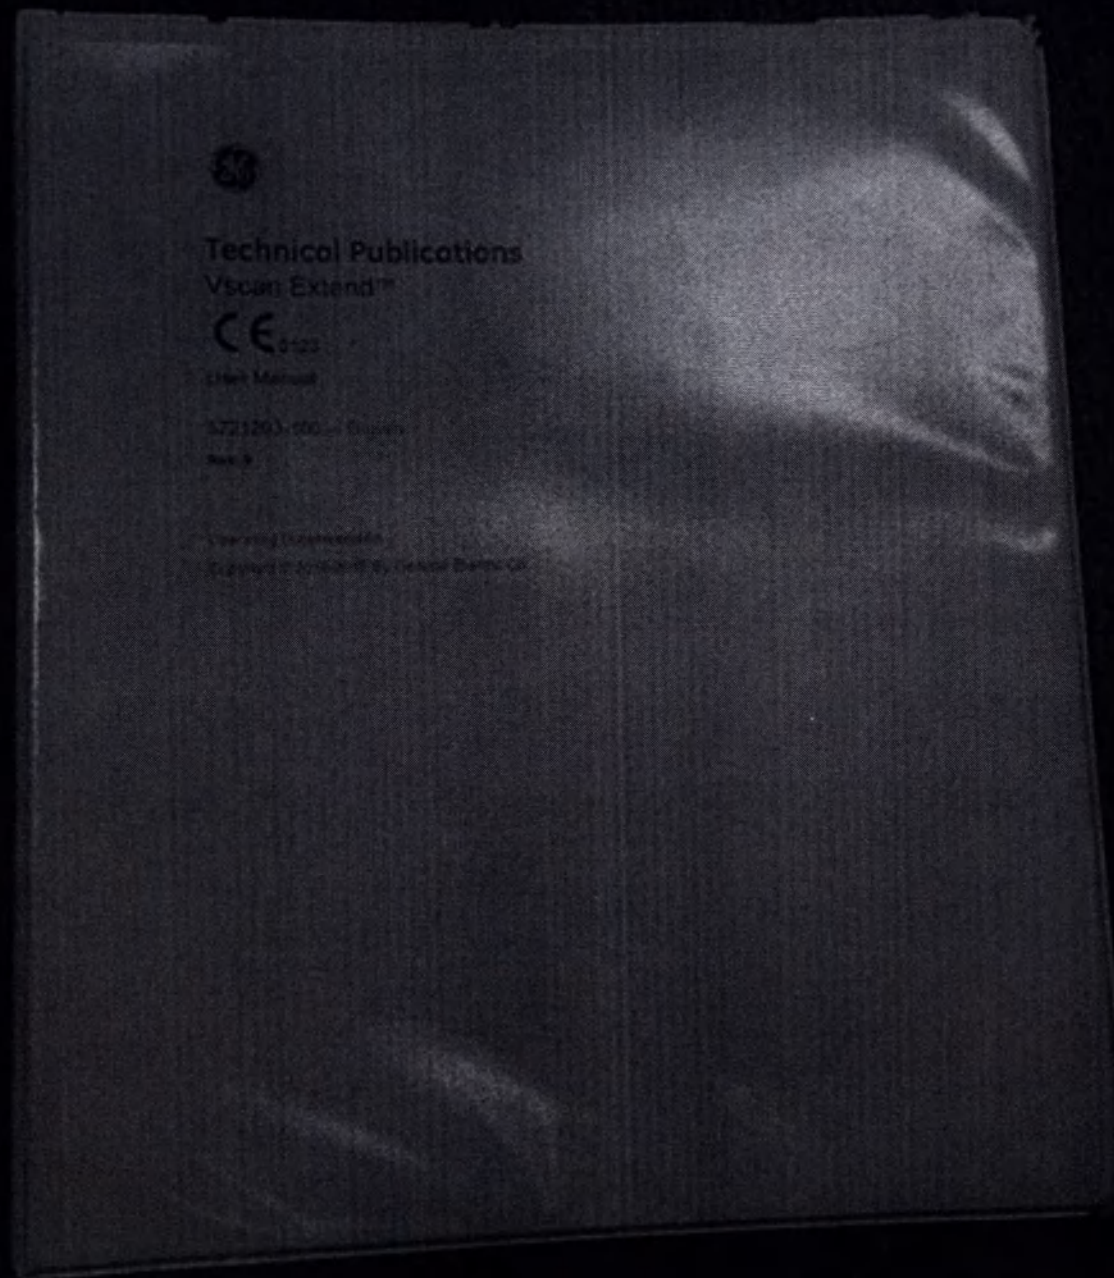




10. Футляр для транспортировки сканера и принадлежностей



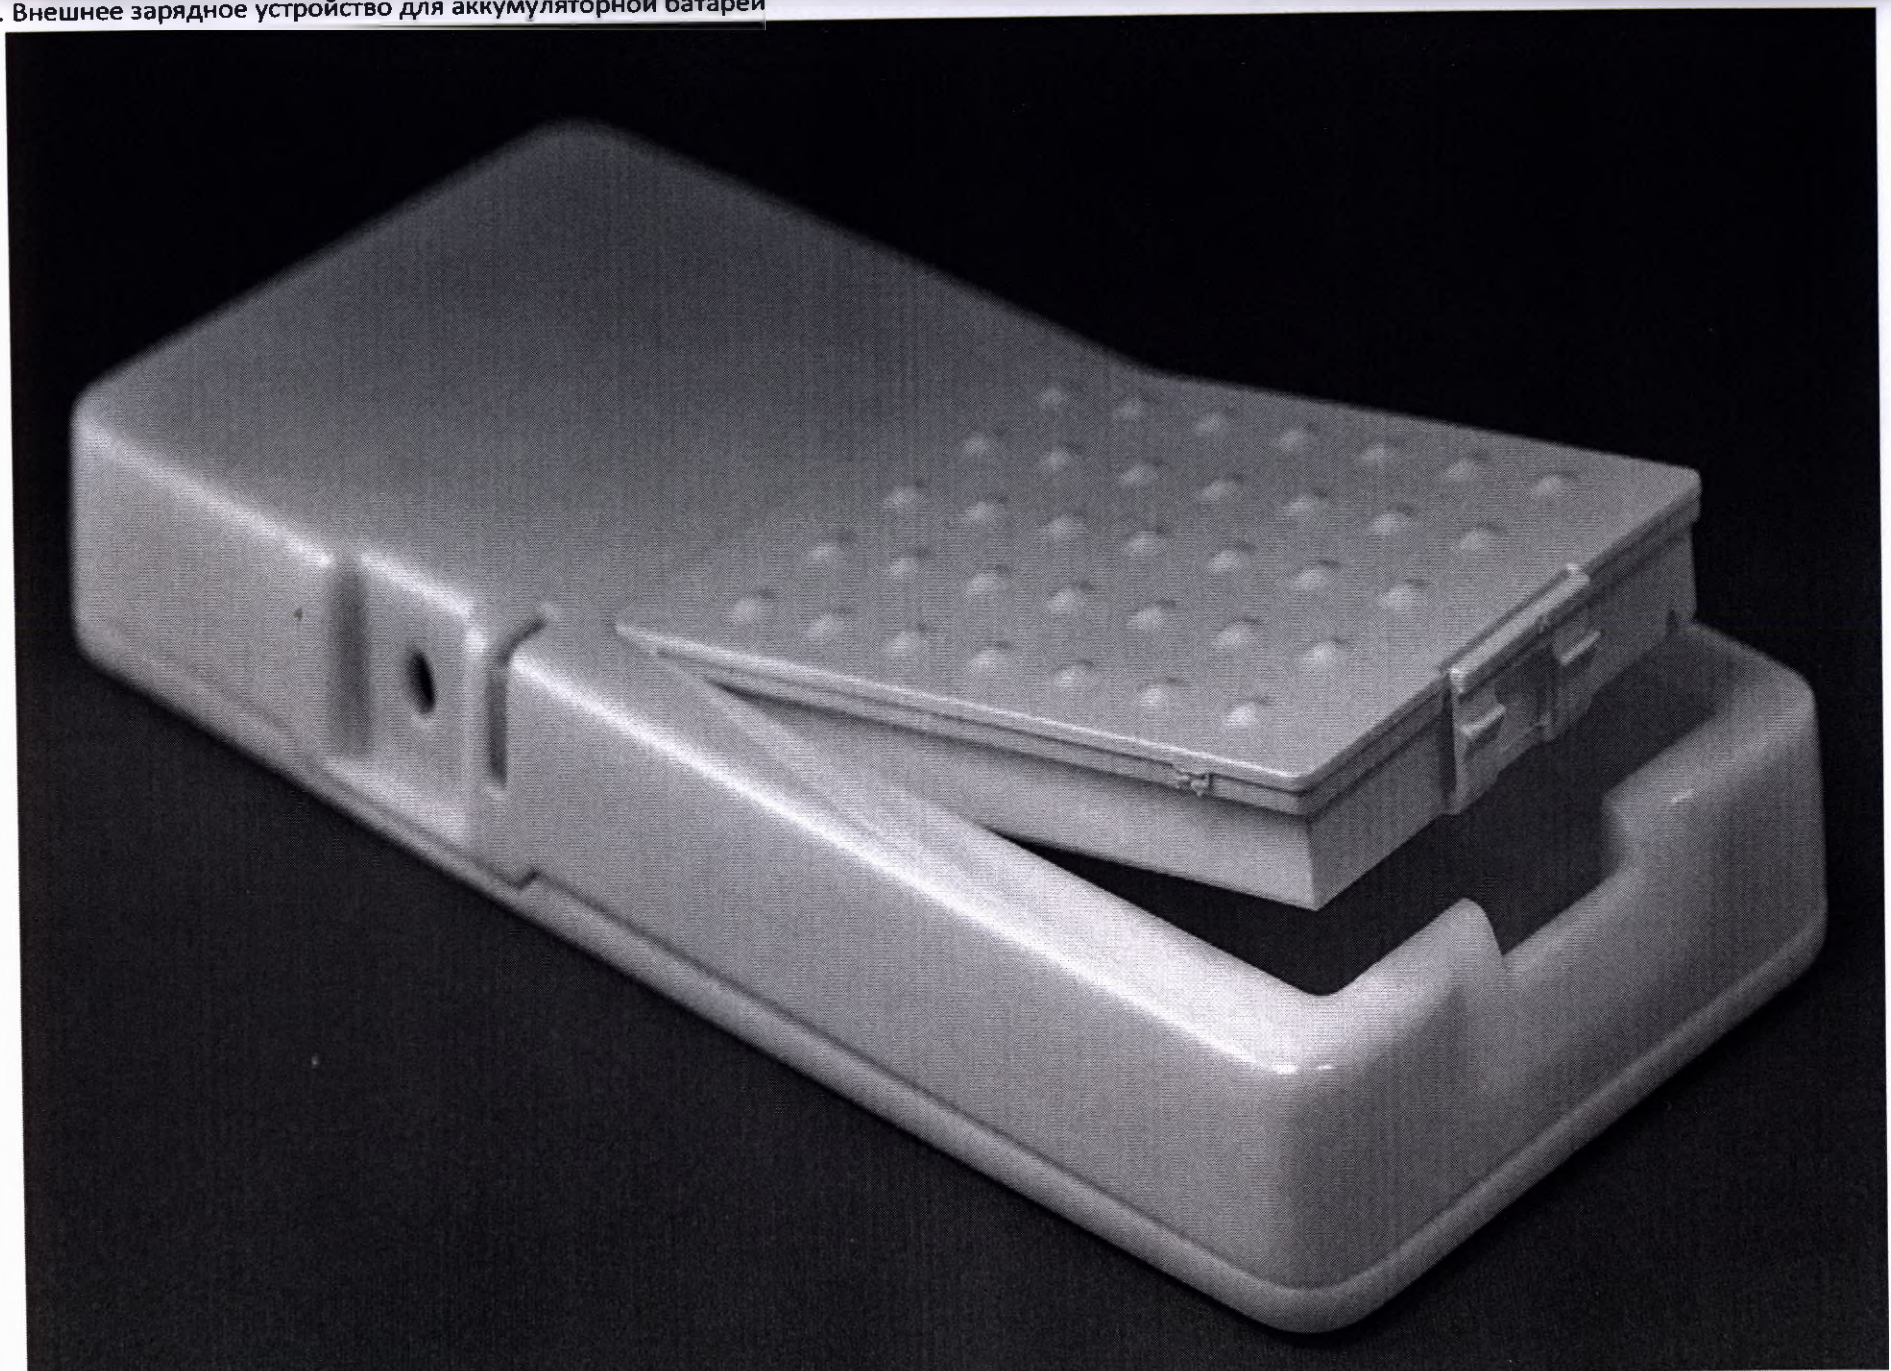



14. Программный модуль для поддержки передачи данных по интерфейсу USB с возможностью добавления передачи по беспроводному интерфейсу, активируемый электронным ключом



Configuration

View your current device setup

Enabled Modules



Ophthalmic



DICOM Configuration



Wireless Windows Share



GE Marketplace

Enter a key

15. Программный модуль для передачи данных по беспроводному интерфейсу с возможностью интеграции в DICOM сеть, активируемый электронным ключом.

Add

Add Image Server

Name

Enter a memorable name

Type

Dicom image server



Name/IP Address

IP Address or Server name

Port

Verify

Add



6. Программный модуль для передачи данных по интерфейсу USB с возможностью интеграции в DICOM сеть, активируемый электронным ключом.



Vscan Extend


Connected to PC. Please wait .

≡ Storage

10.17 GB (91.45 % free)

7. Программный модуль для автоматического определения границы левой стенки миокарда и вычисления выбросов левого желудочка и фракции выброса, активируемый электронным ключом.



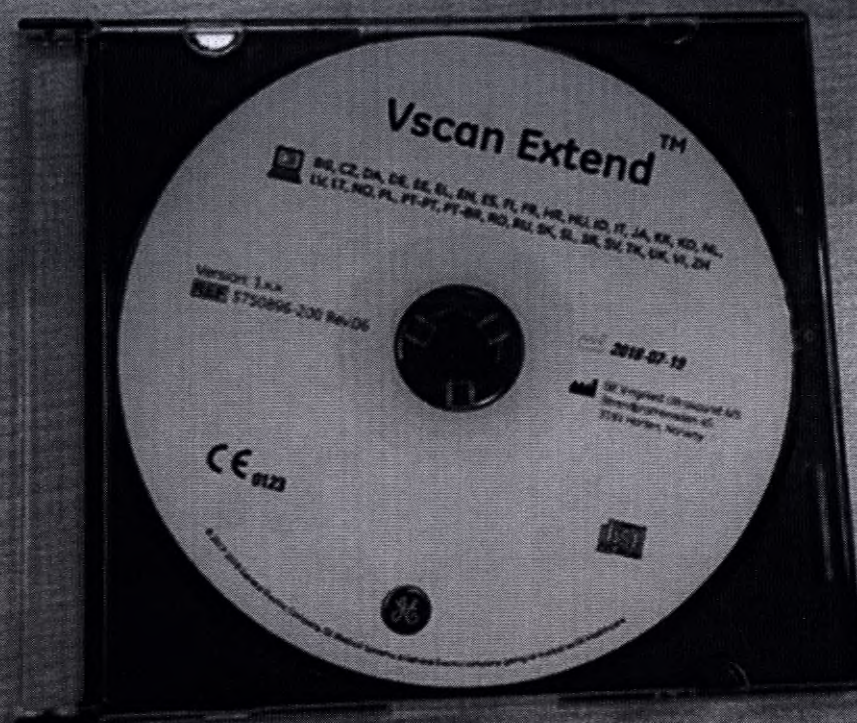

Report information

The file already exists.



00006524.PDF

Open

Do you want to overwrite it?

Yes

No

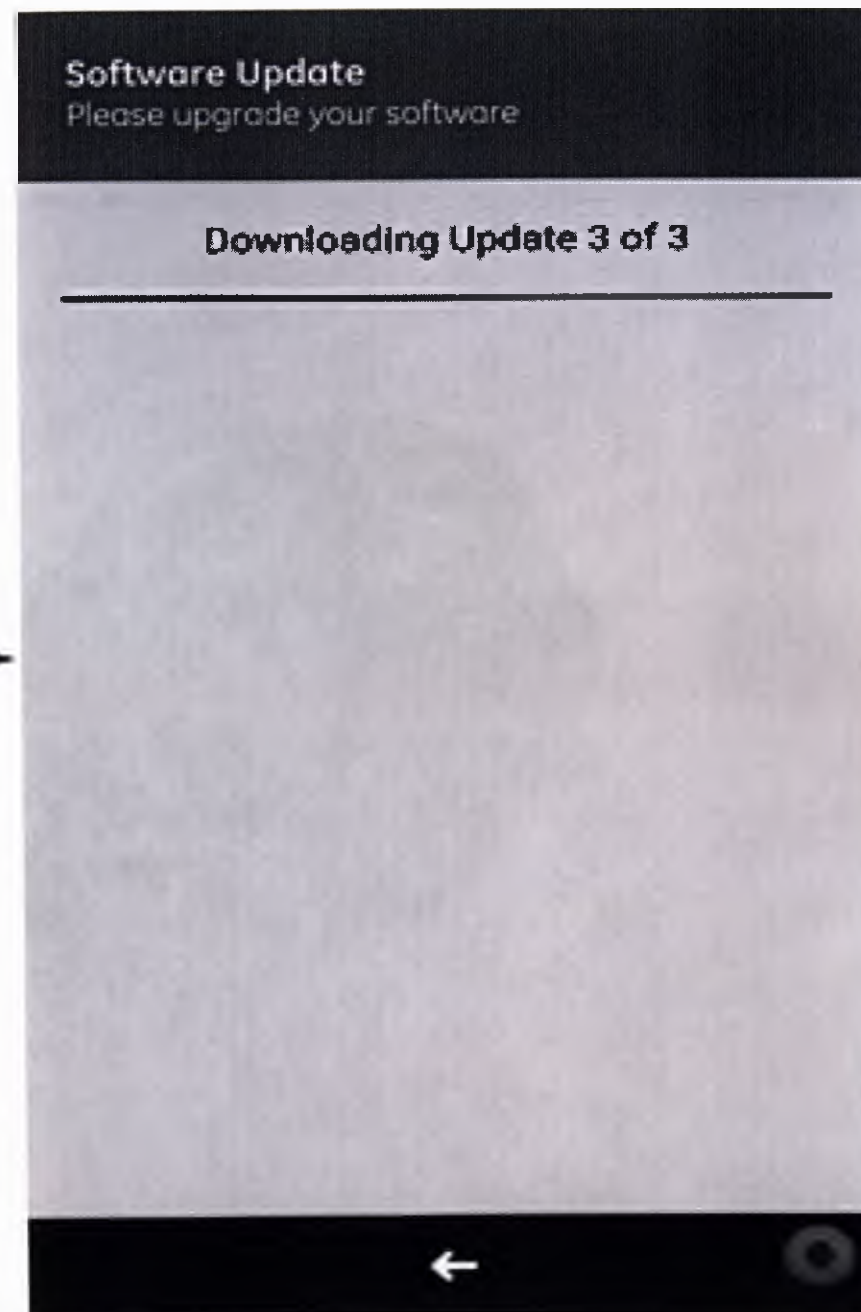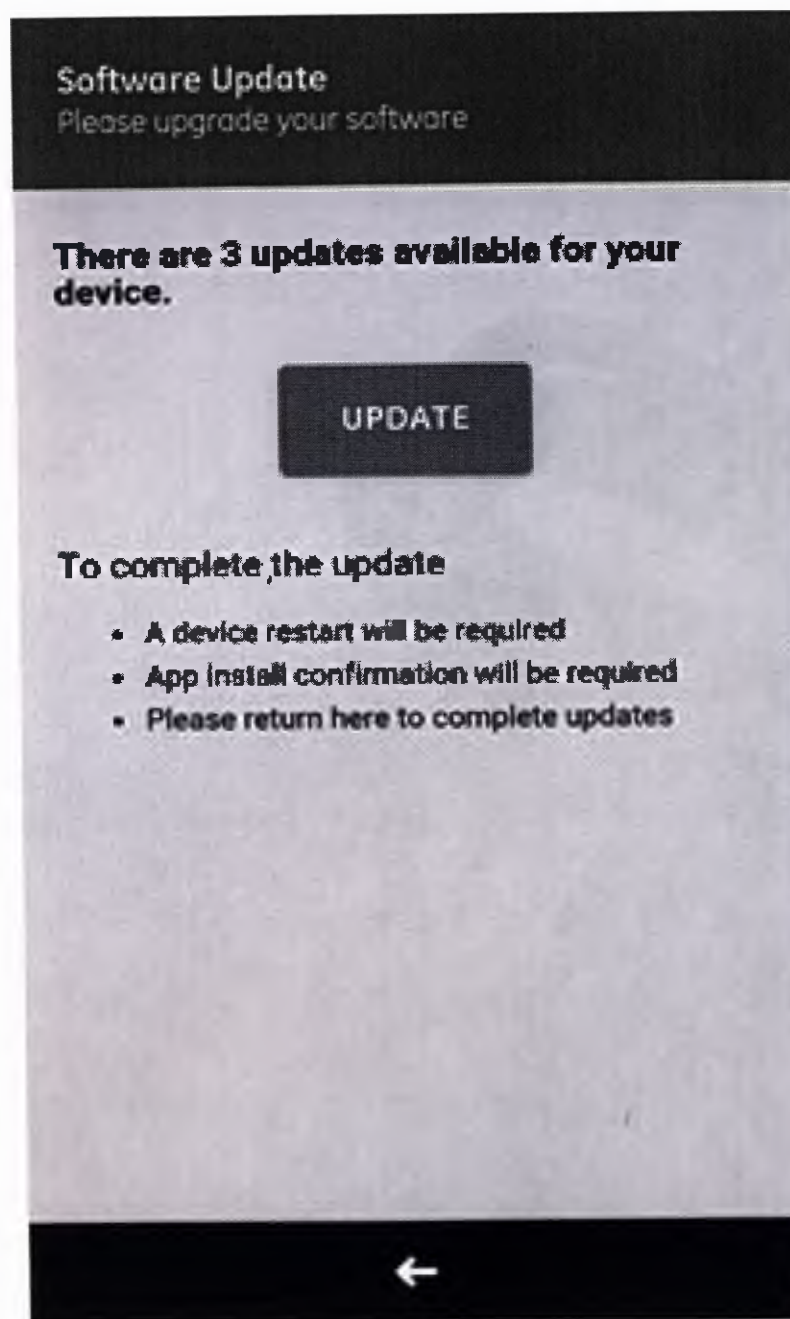

21. Кабель интерфейсный для подключения к планшету (не более 3 шт.)





Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ (листок)
Руководитель департамента регистрации
и сертификации России и СНГ
ООО «Джи Хэлскеа» _____
Парахина С.Б.

