

*Артсиф
69854*



Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения прогестерона на анализаторах иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Progesterone (Atellica IM PRGE))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

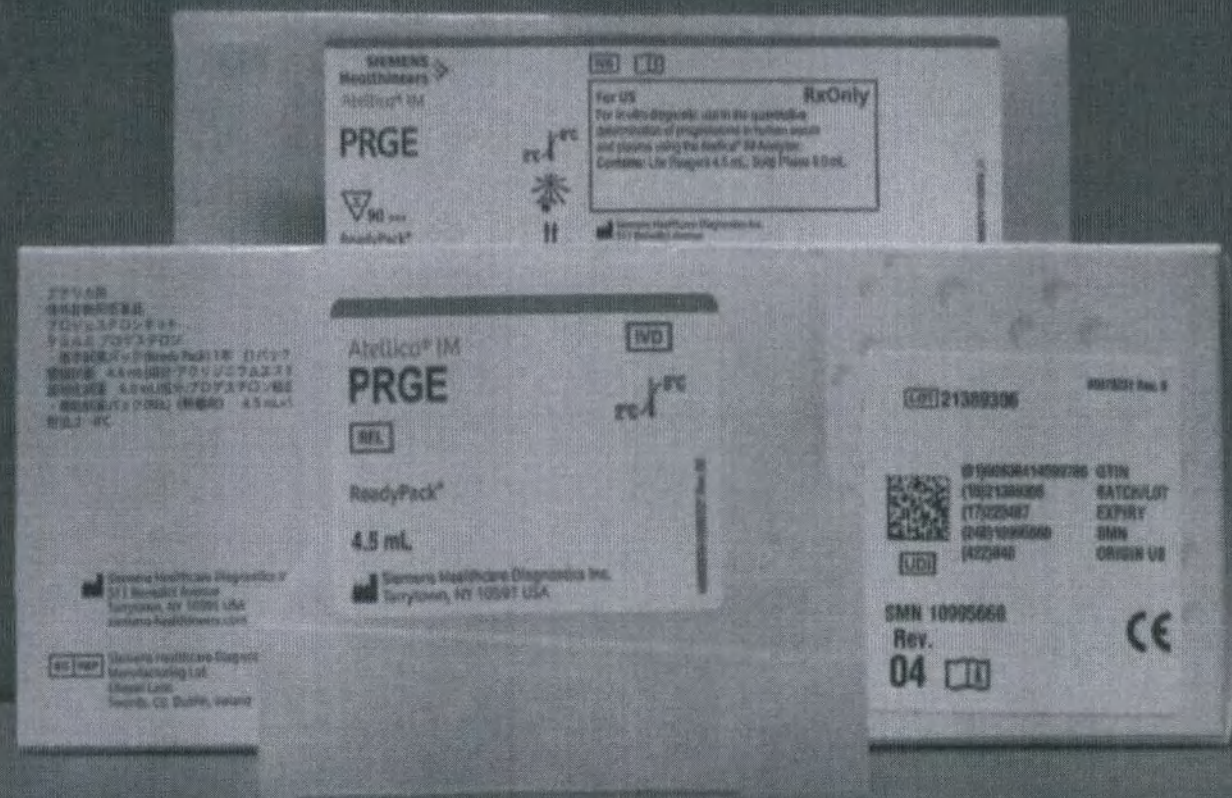


Рисунок 1. Набор реагентов для определения прогестерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Progesterone (Atellica IM PRGE)): Фасовка 90 тестов. Общий вид

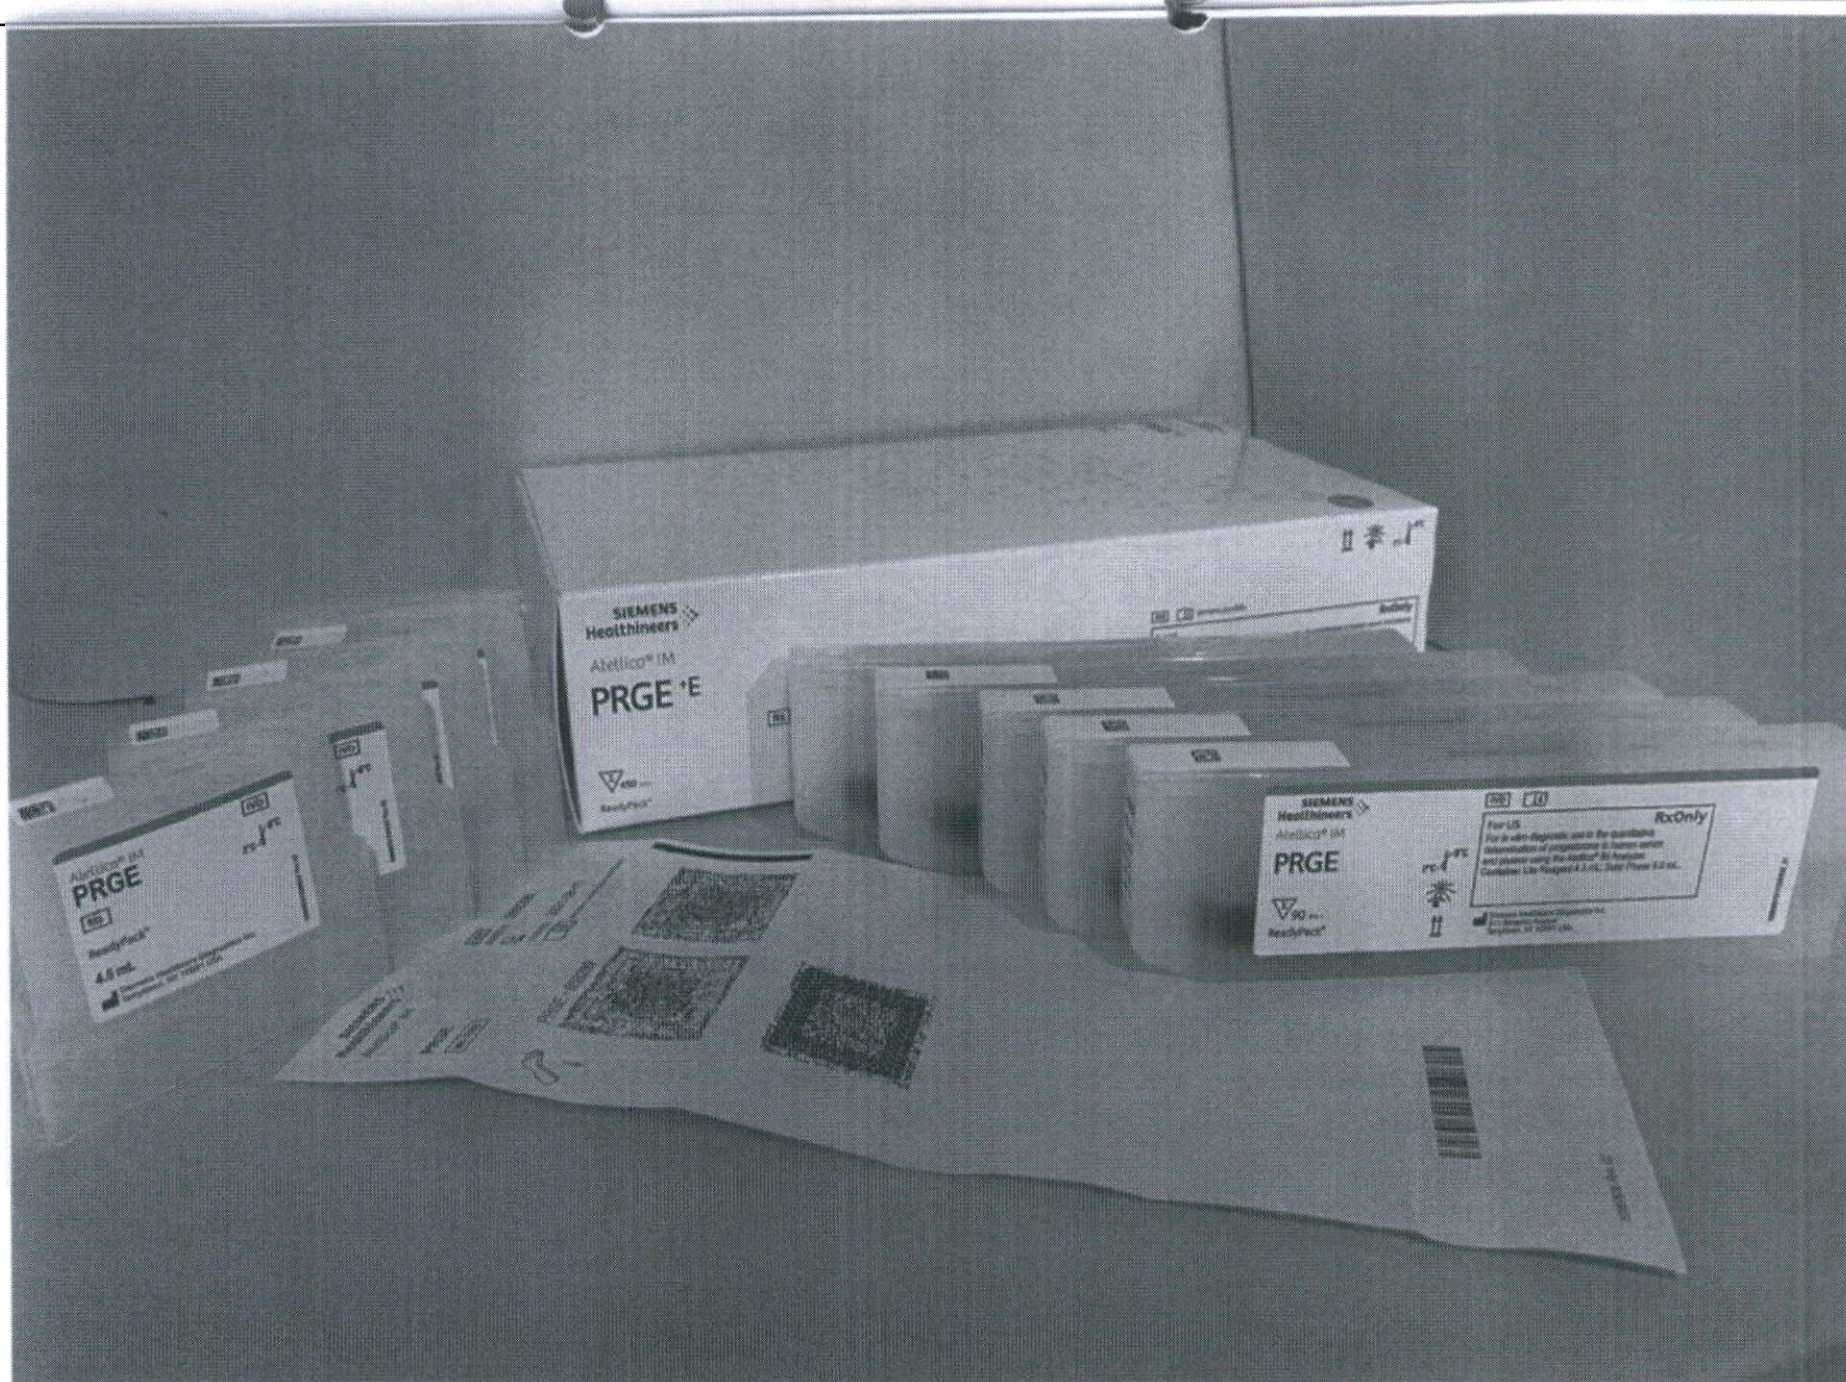


Рисунок 2. Набор реагентов для определения прогестерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Progesterone (Atellica IM PRGE)): Фасовка 450 тестов. Общий вид

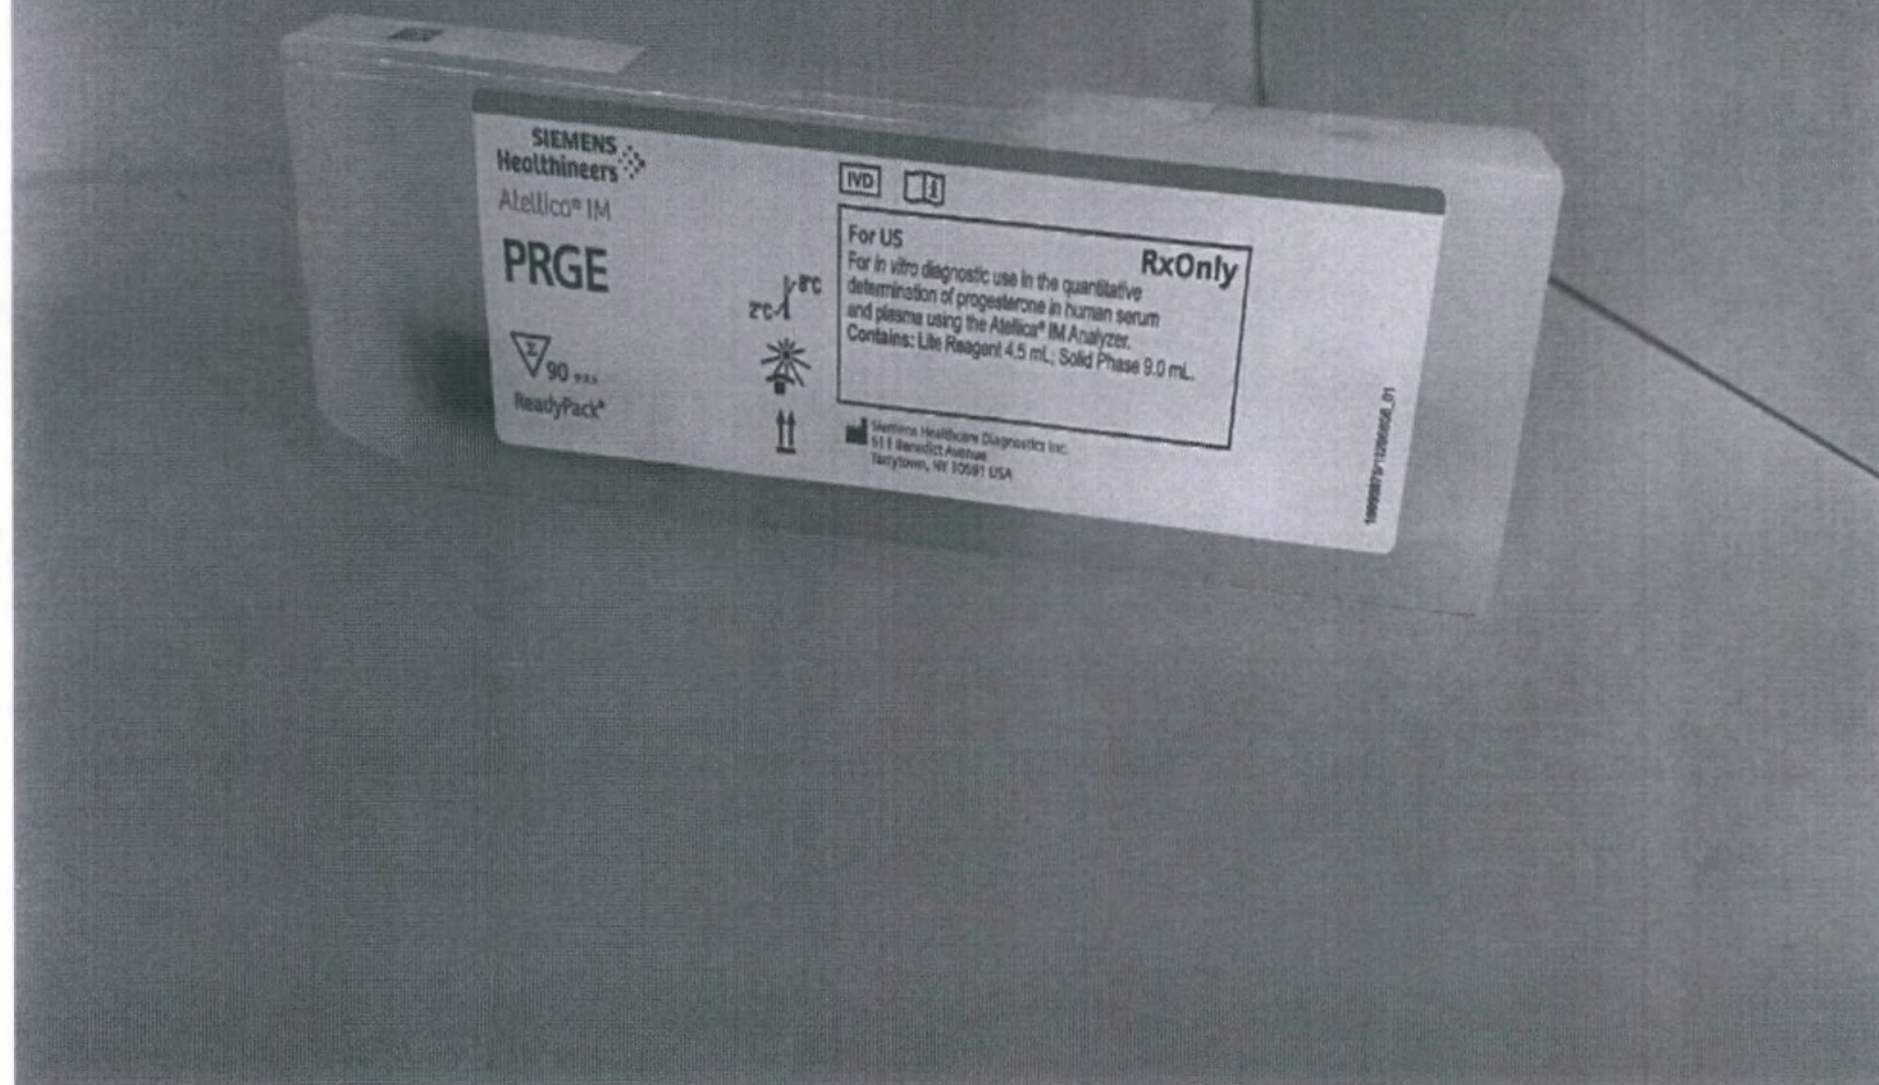


Рисунок 3. Набор реагентов для определения прогестерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Progesterone (Atellica IM PRGE)): Основной реагент Atellica IM PRGE

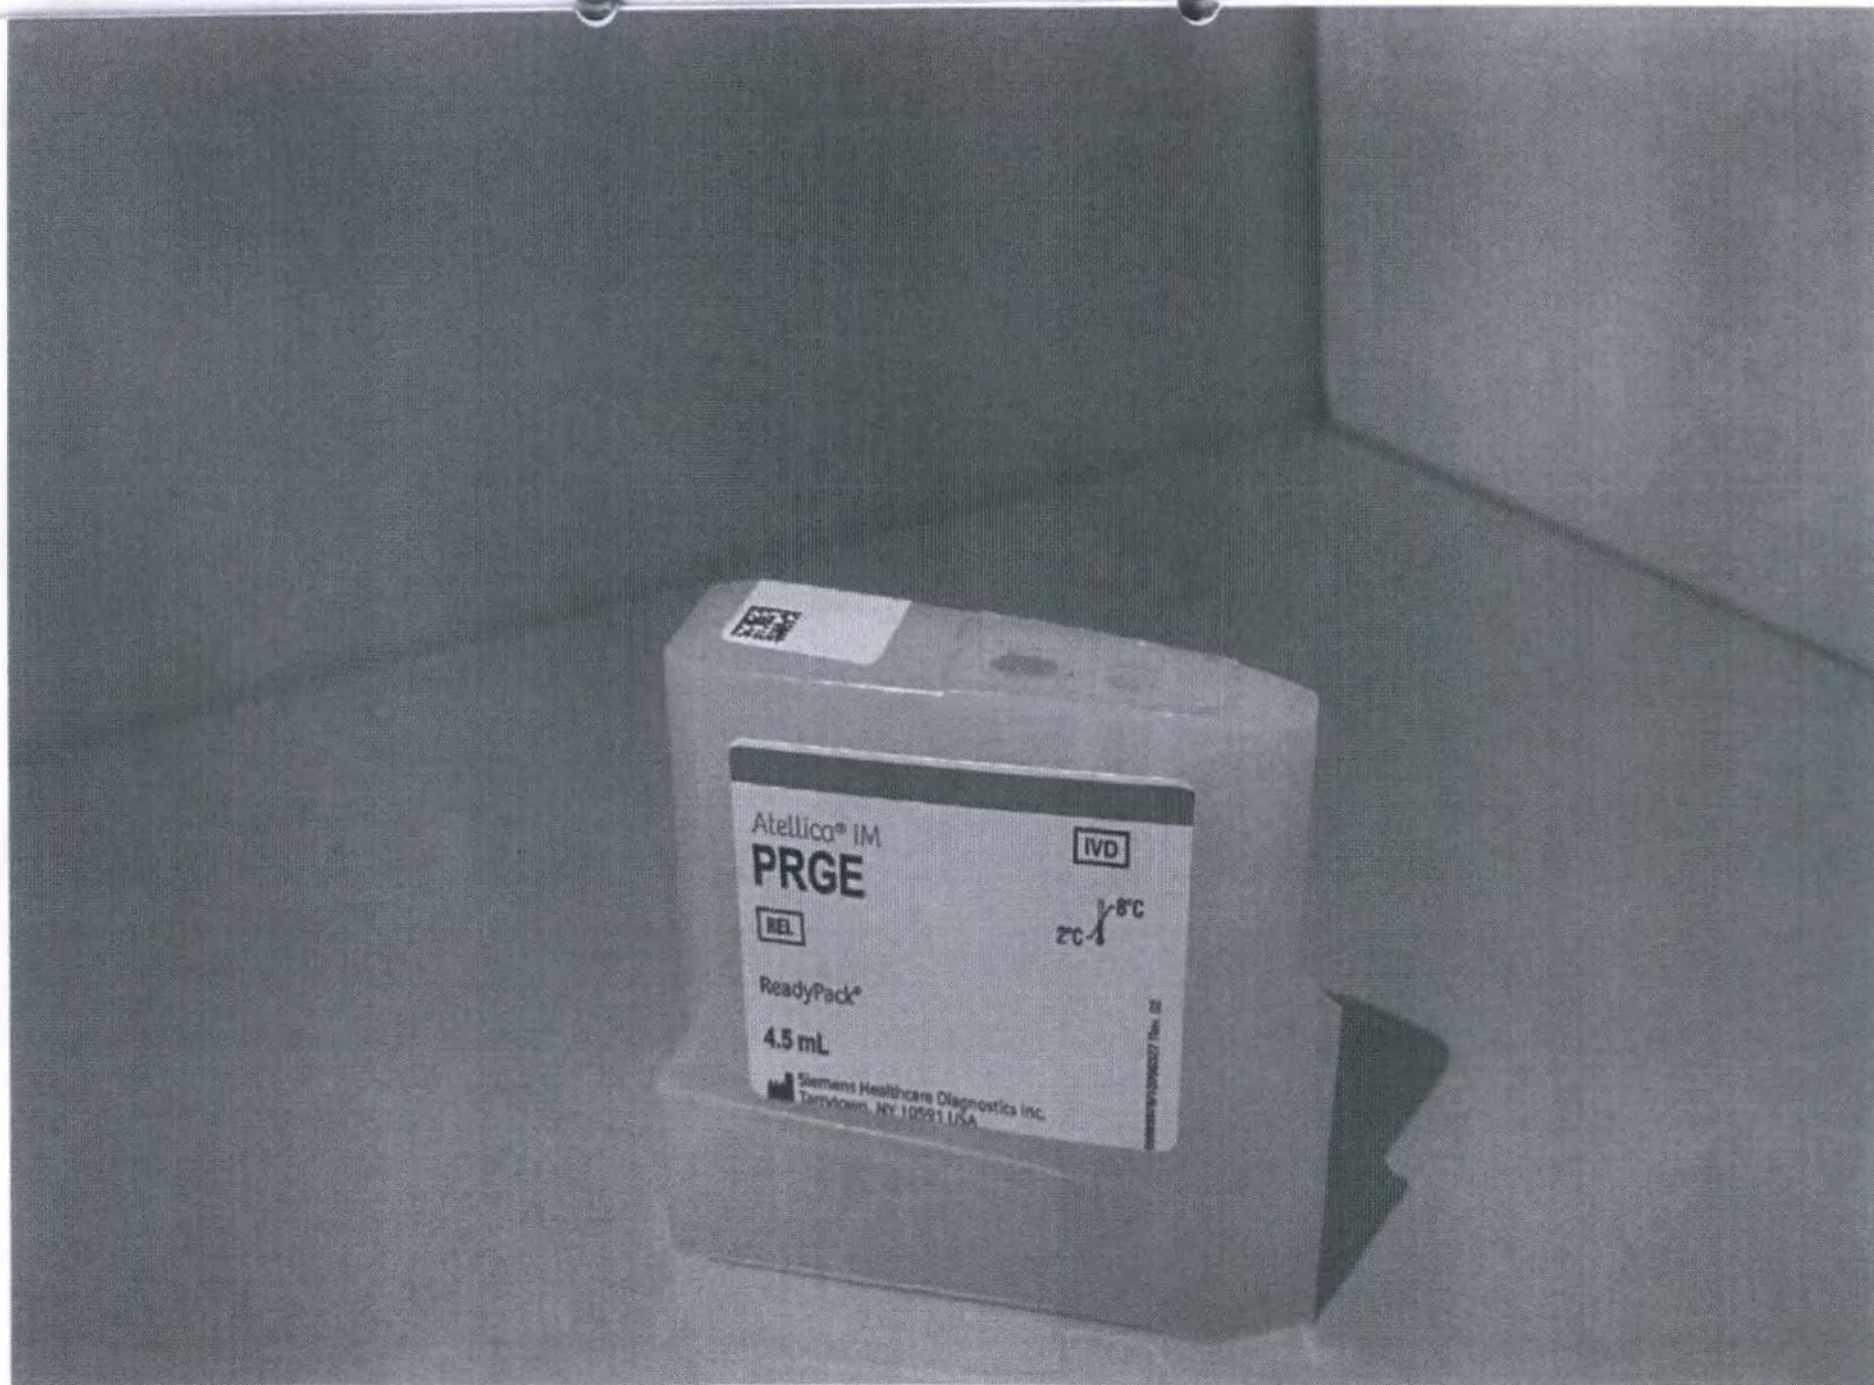


Рисунок 4. Набор реагентов для определения прогестерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Progesterone (Atellica IM PRGE)): Дополнительный реагент Atellica IM PRGE

SIEMENS
Healthineers
Atellica® IM

LOT

059299

製造番号

使用期限

2021-08-11

PRGE

MC TDEF

1

siemens.com/document-library

PRGE • 059299



50997638 Rev. 02

Рисунок 5. Набор реагентов для определения прогестерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Progesterone (Atellica IM PRGE)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM PRGE