

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по ТГН - директор

Касимовского приборного завода


В.М. Караваев

2020г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением
циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой
принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-ПЗ
по ТУ 9451-007-07505566-99

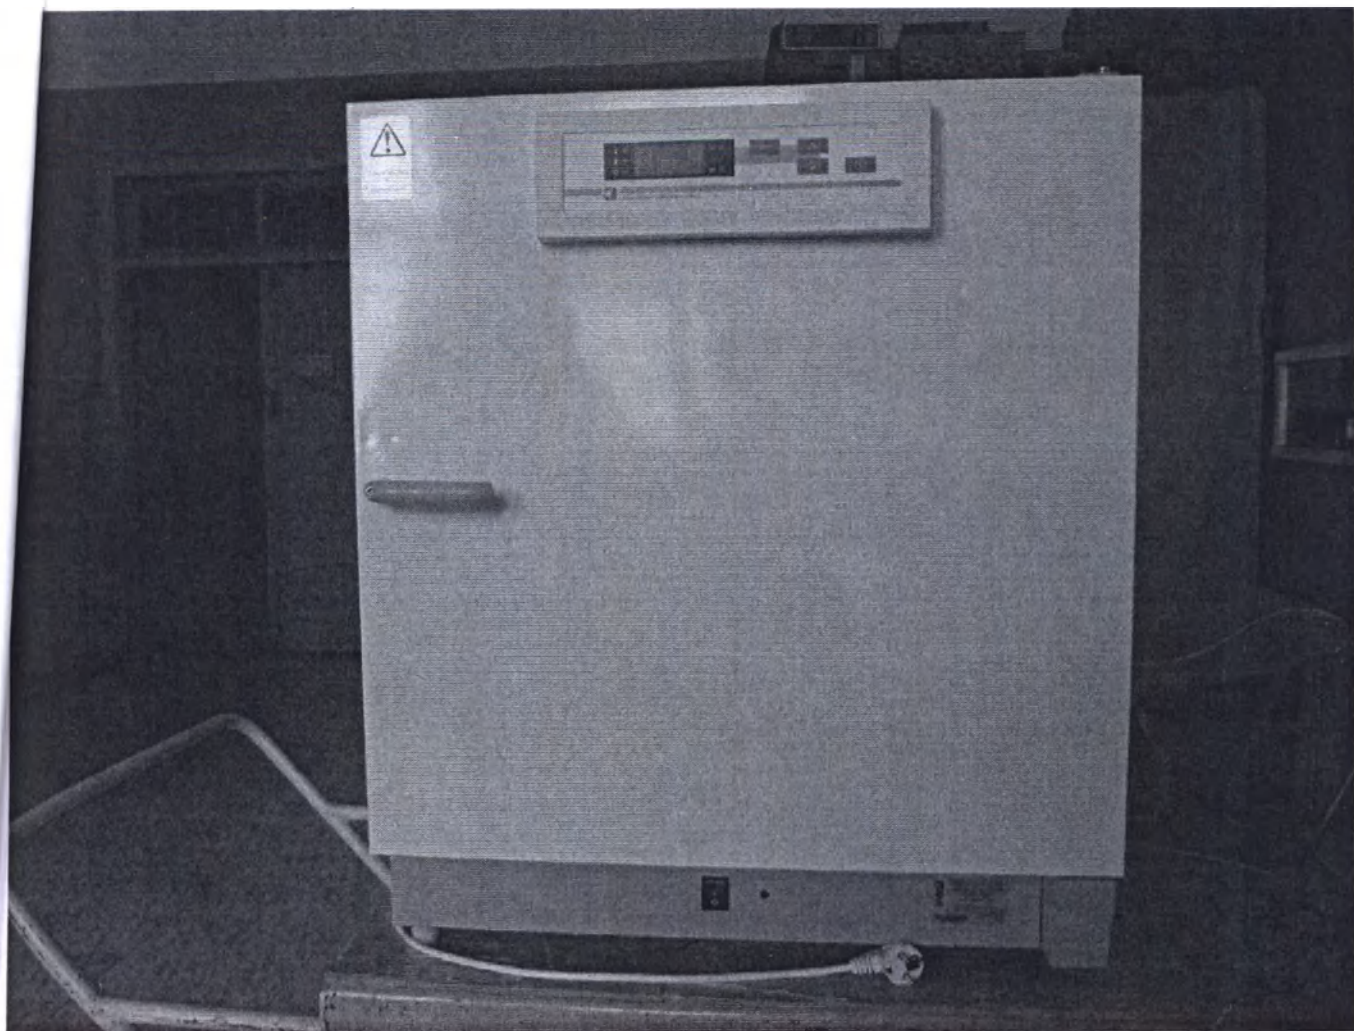

Фотографическое изображение 1.

Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-ПЗ.


Вид спереди.




Фотографическое изображение 2.

Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-ПЗ.


Маркировка.

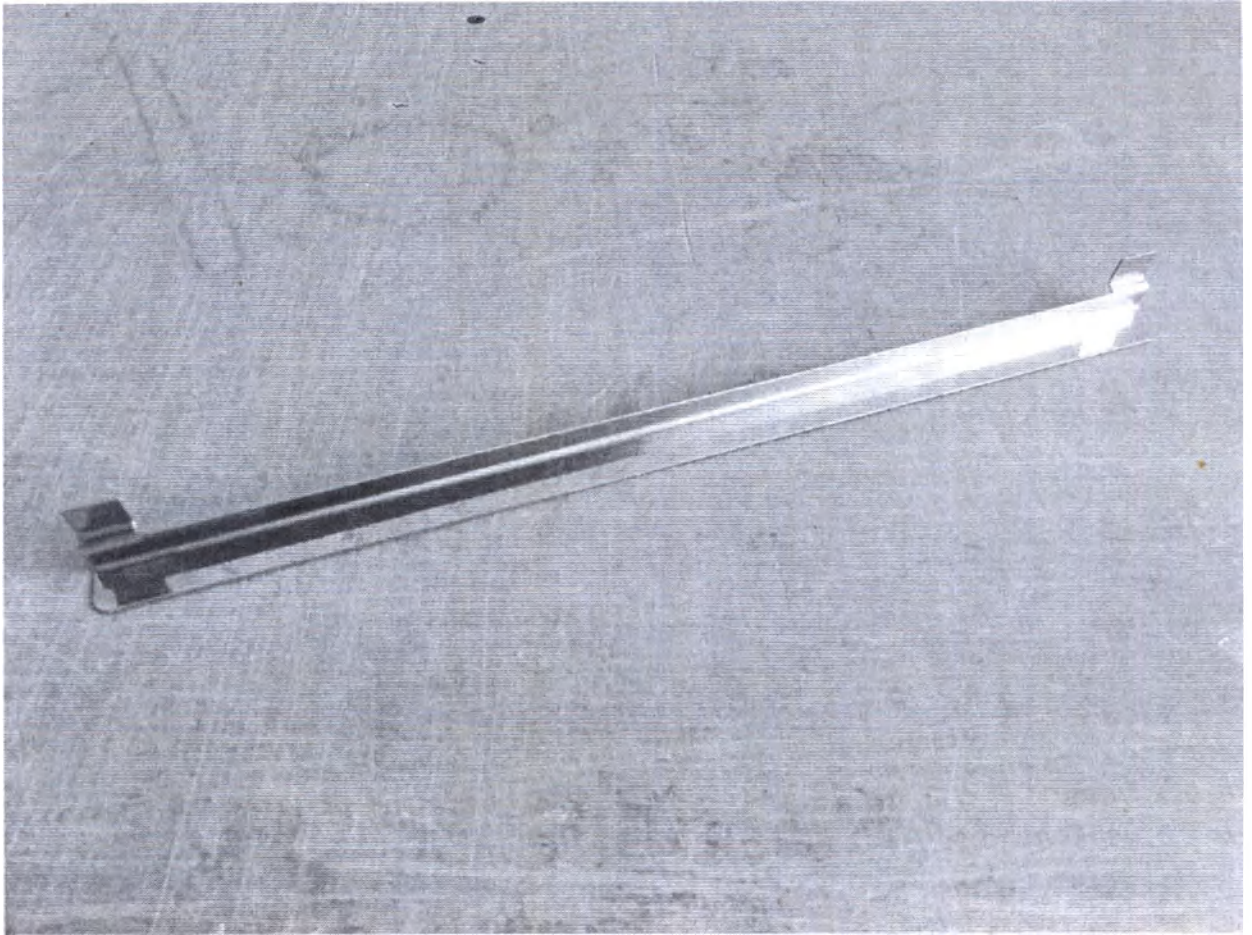


Фотографическое изображение 3.
Уголок.

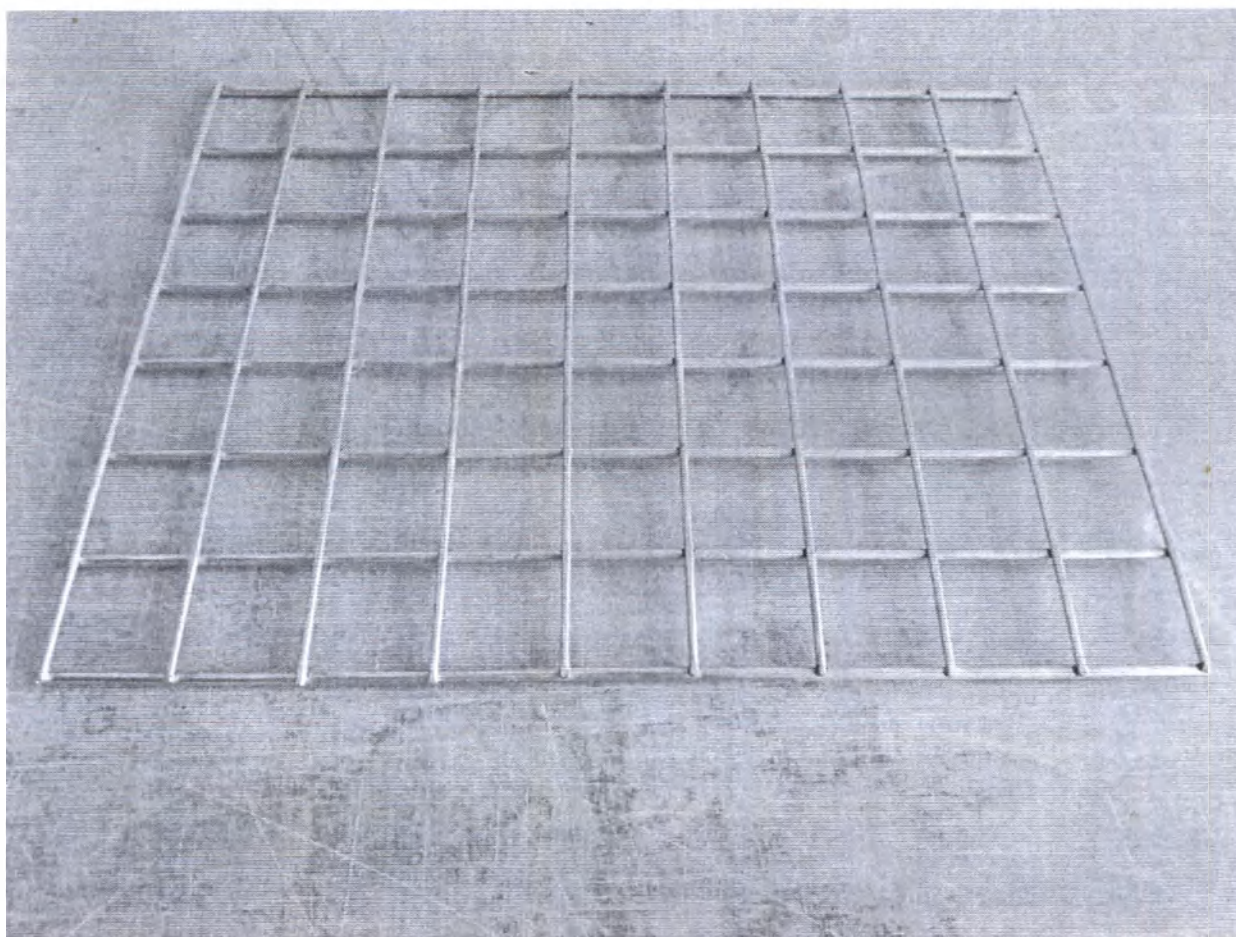


Фотографическое изображение 4.
Кассета.

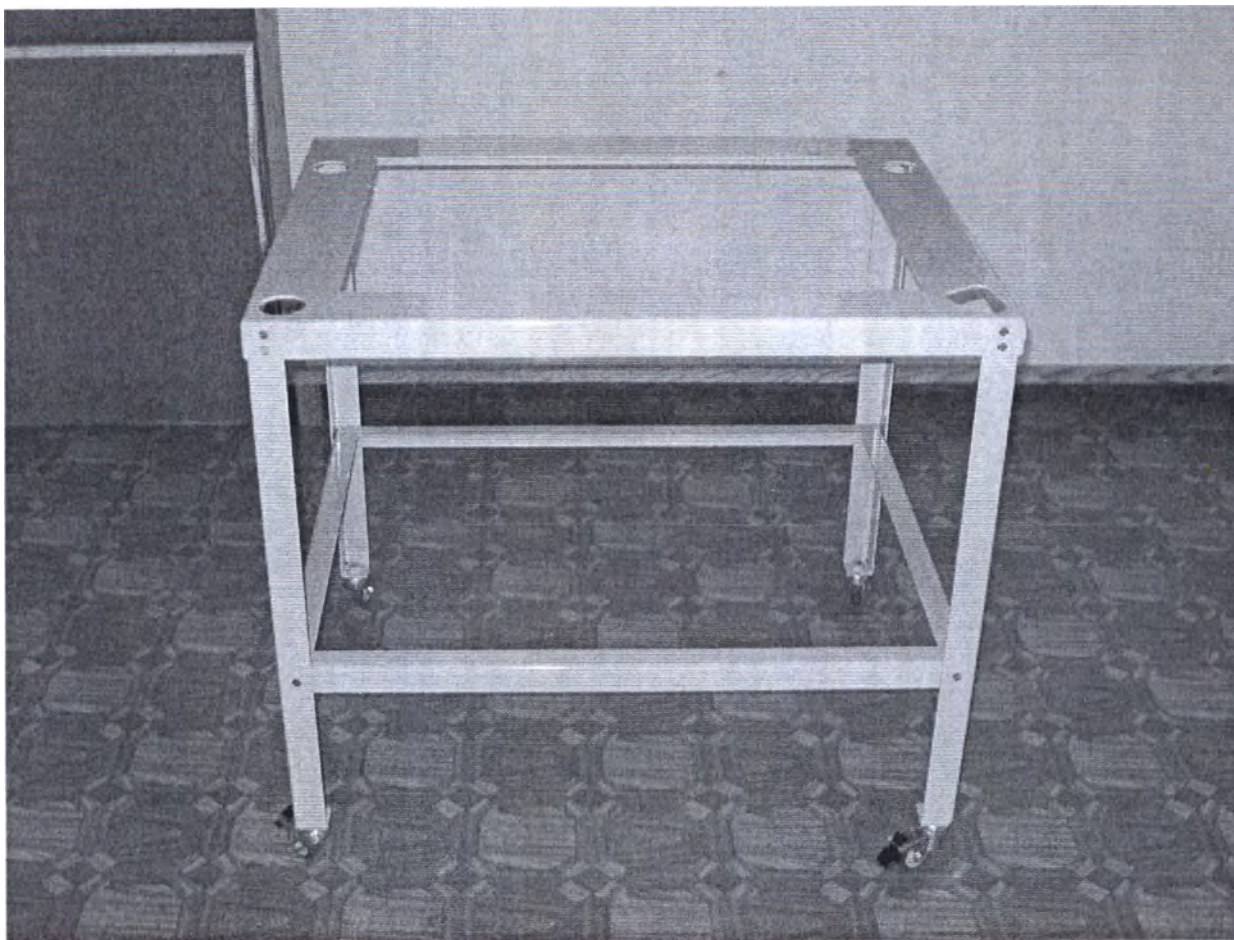

Фотографическое изображение 5.
Подставка.

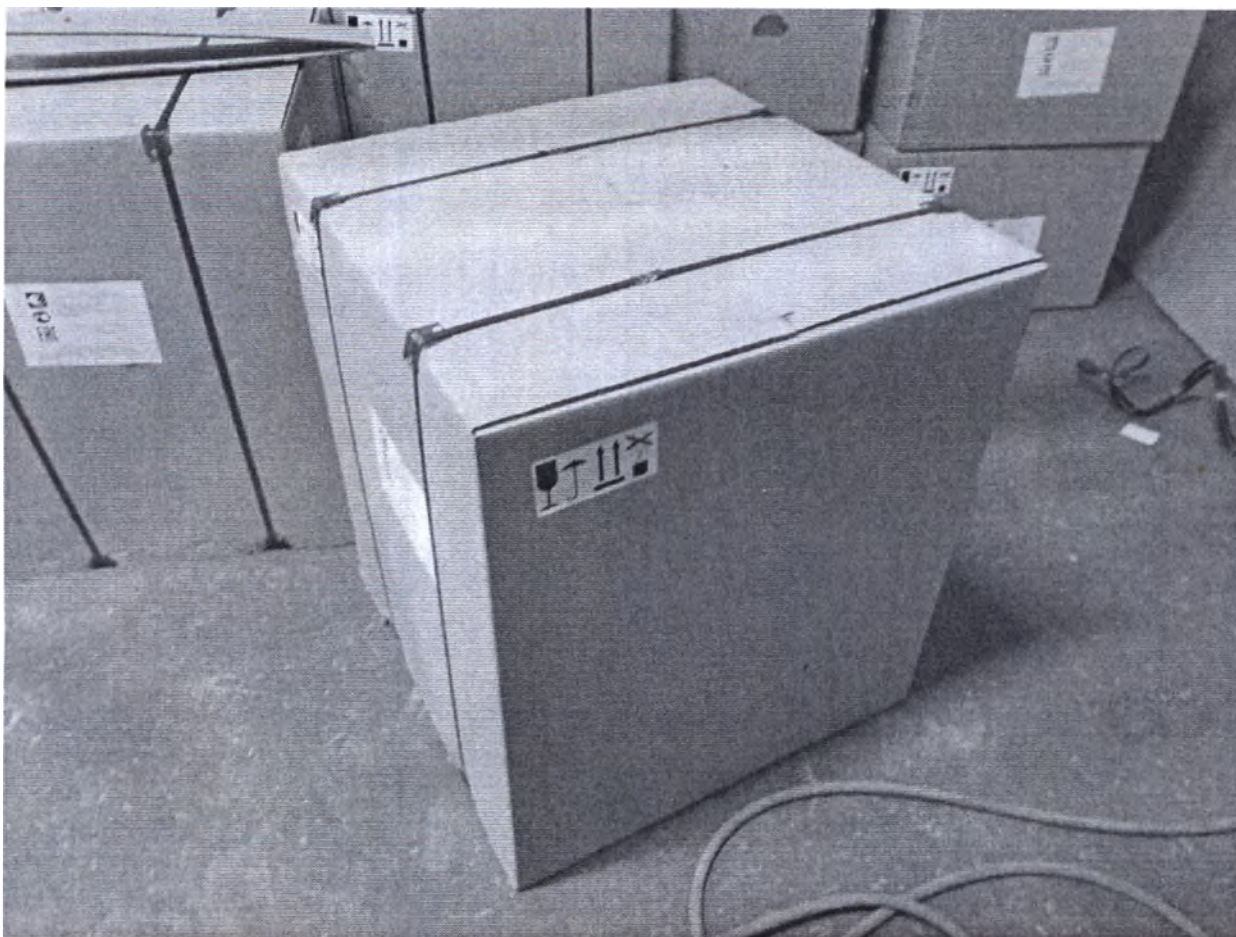

Фотографическое изображение 6.
Упаковка.

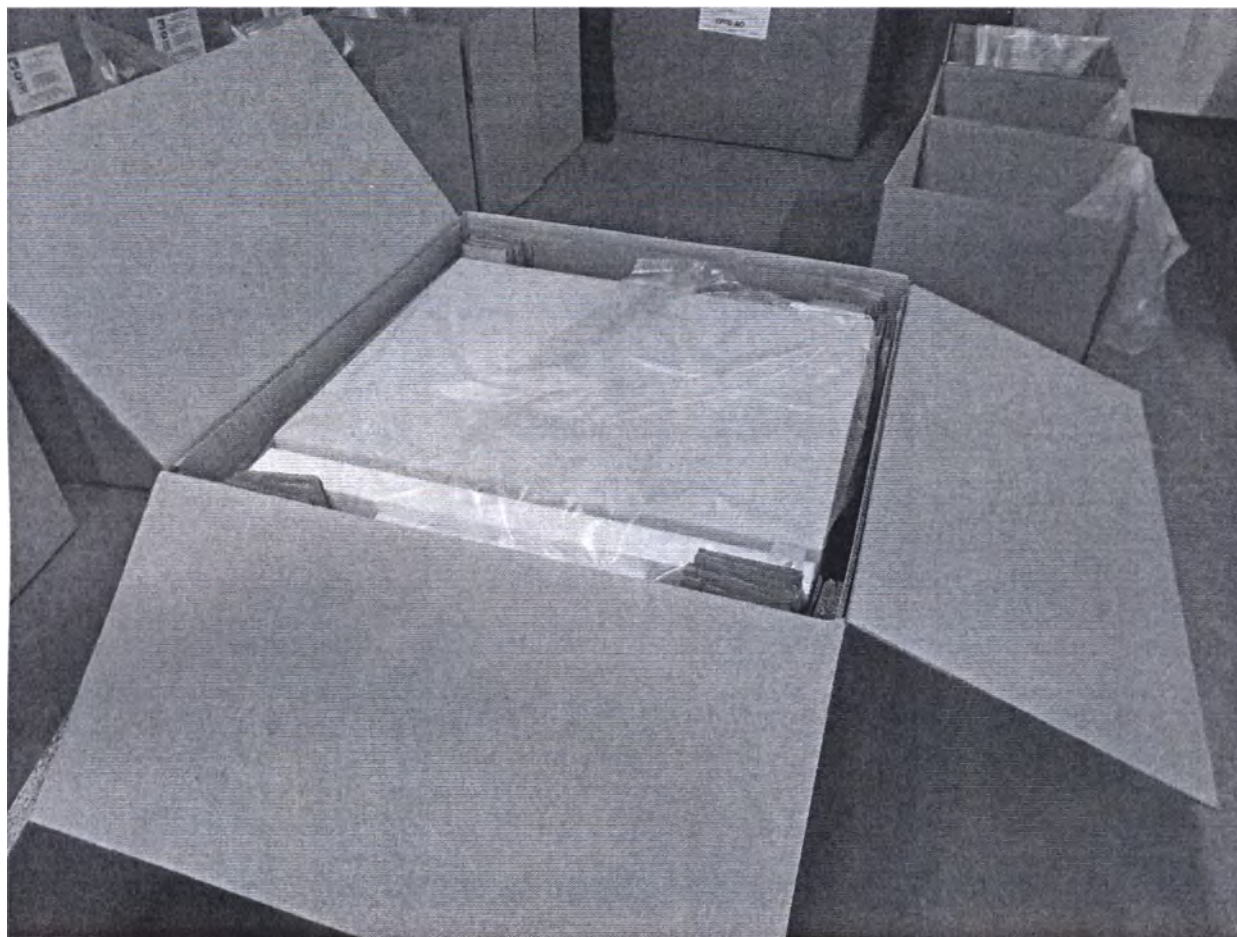

Фотографическое изображение 7.
Упаковка.



Фотографическое изображение 8.
Ремень крепежный с пружинным замком

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

9

листов(а)

Девять

Директор по ТГН -
директор Касимовского приборного
завода

В.М. Караваев

