

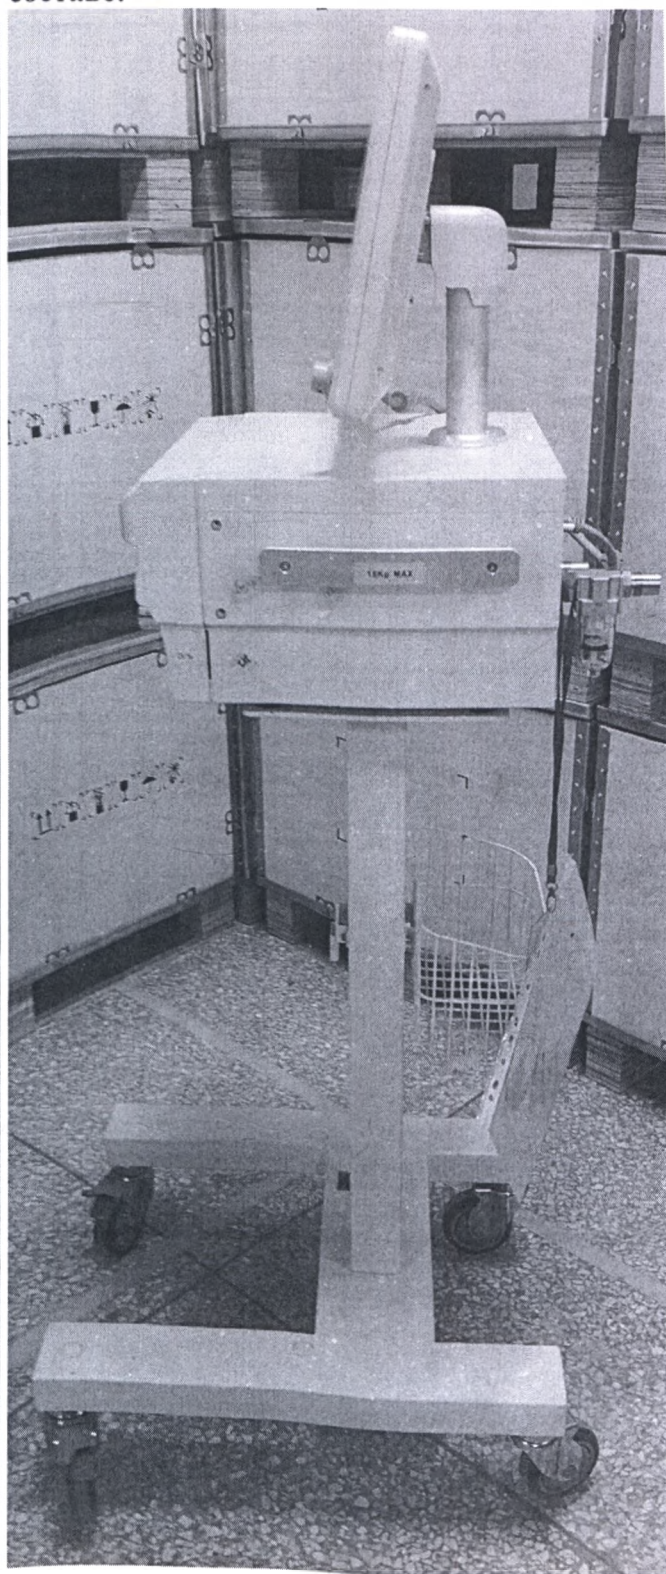



Фотографические изображения на медицинское изделие:


**«Аппарат искусственной вентиляции легких Boaray 5000D Серийные номера:
от DORNRU07/0001 до DORNRU07/1000;
от DORNRU08/0001 до DORNRU08/1000;
от DORNRU09/0001 до DORNRU09/1000 в составе»**



Аппарат искусственной вентиляции легких Boaray 5000D Серийные номера: от DORNRU07/0001 до DORNRU07/1000; от DORNRU08/0001 до DORNRU08/1000; от DORNRU09/0001 до DORNRU09/1000 в составе:

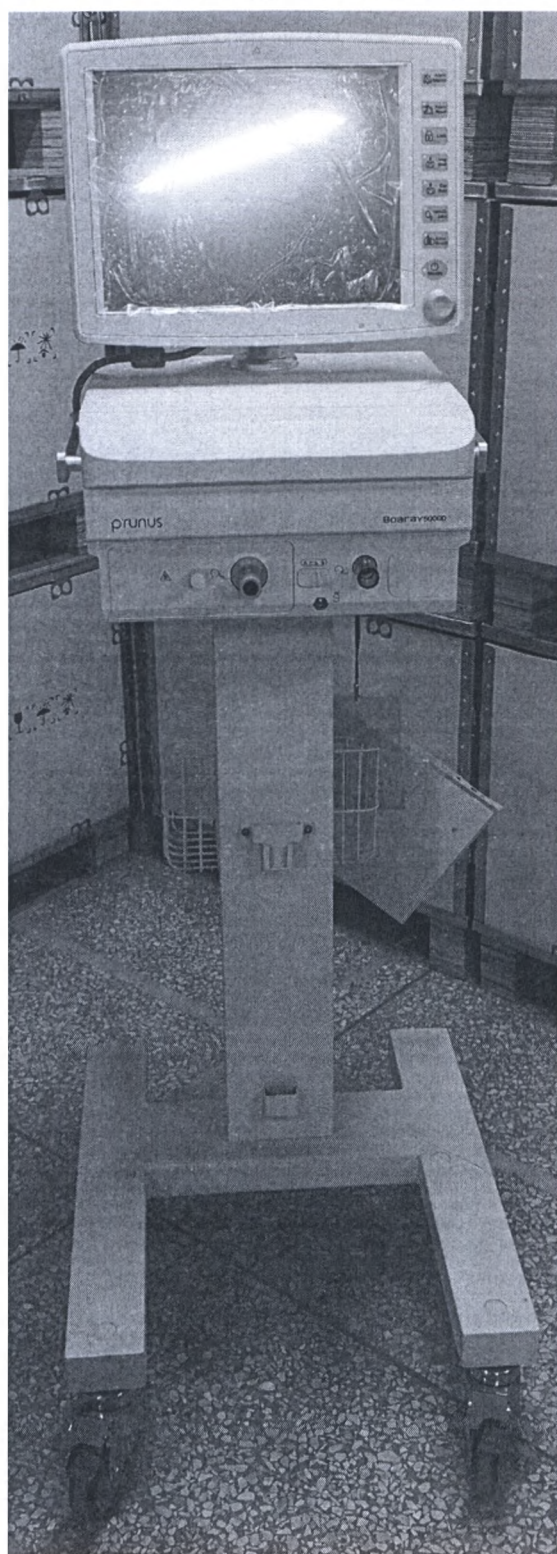

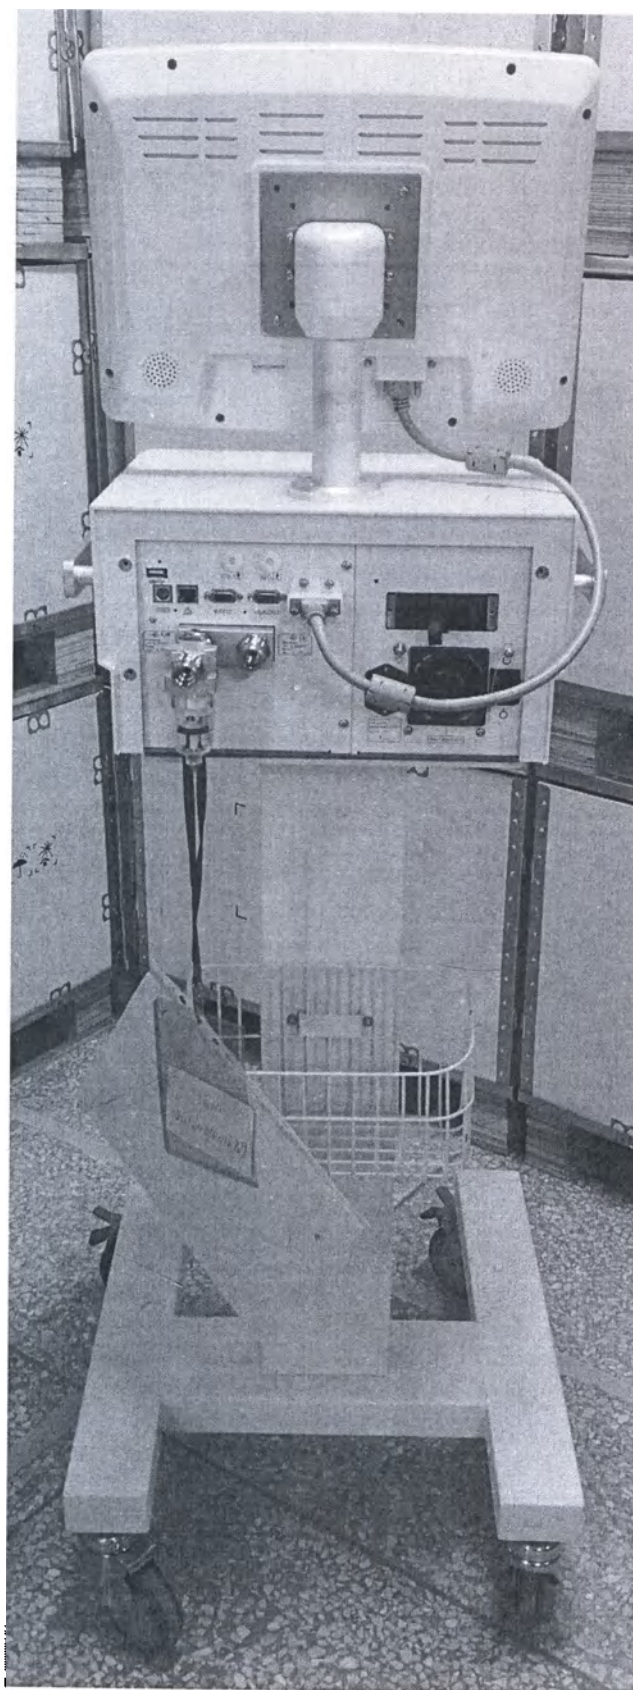

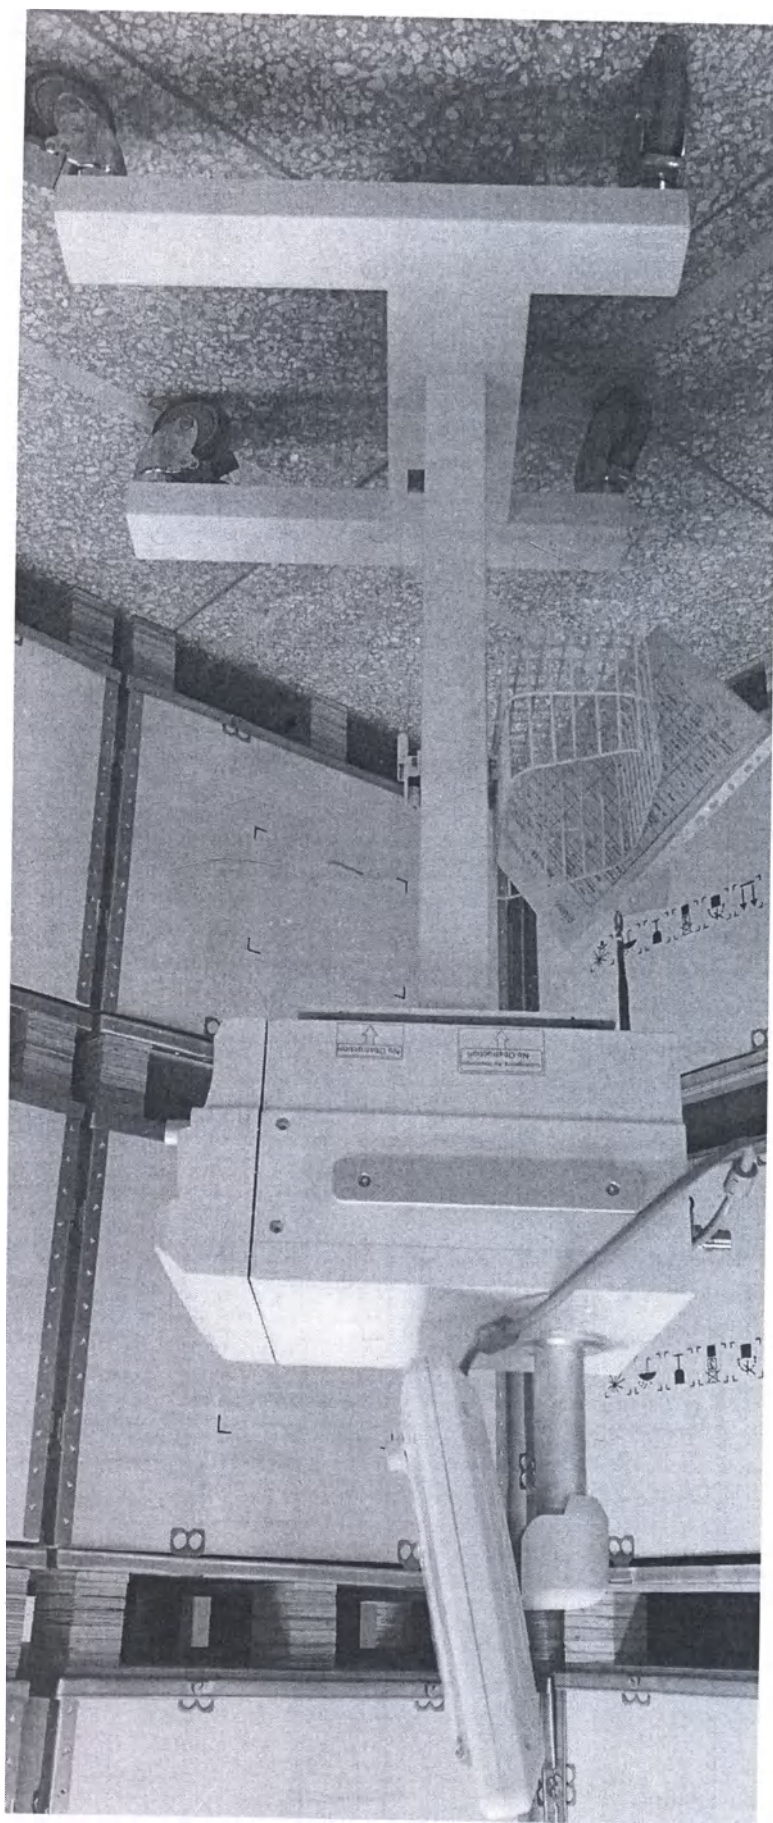

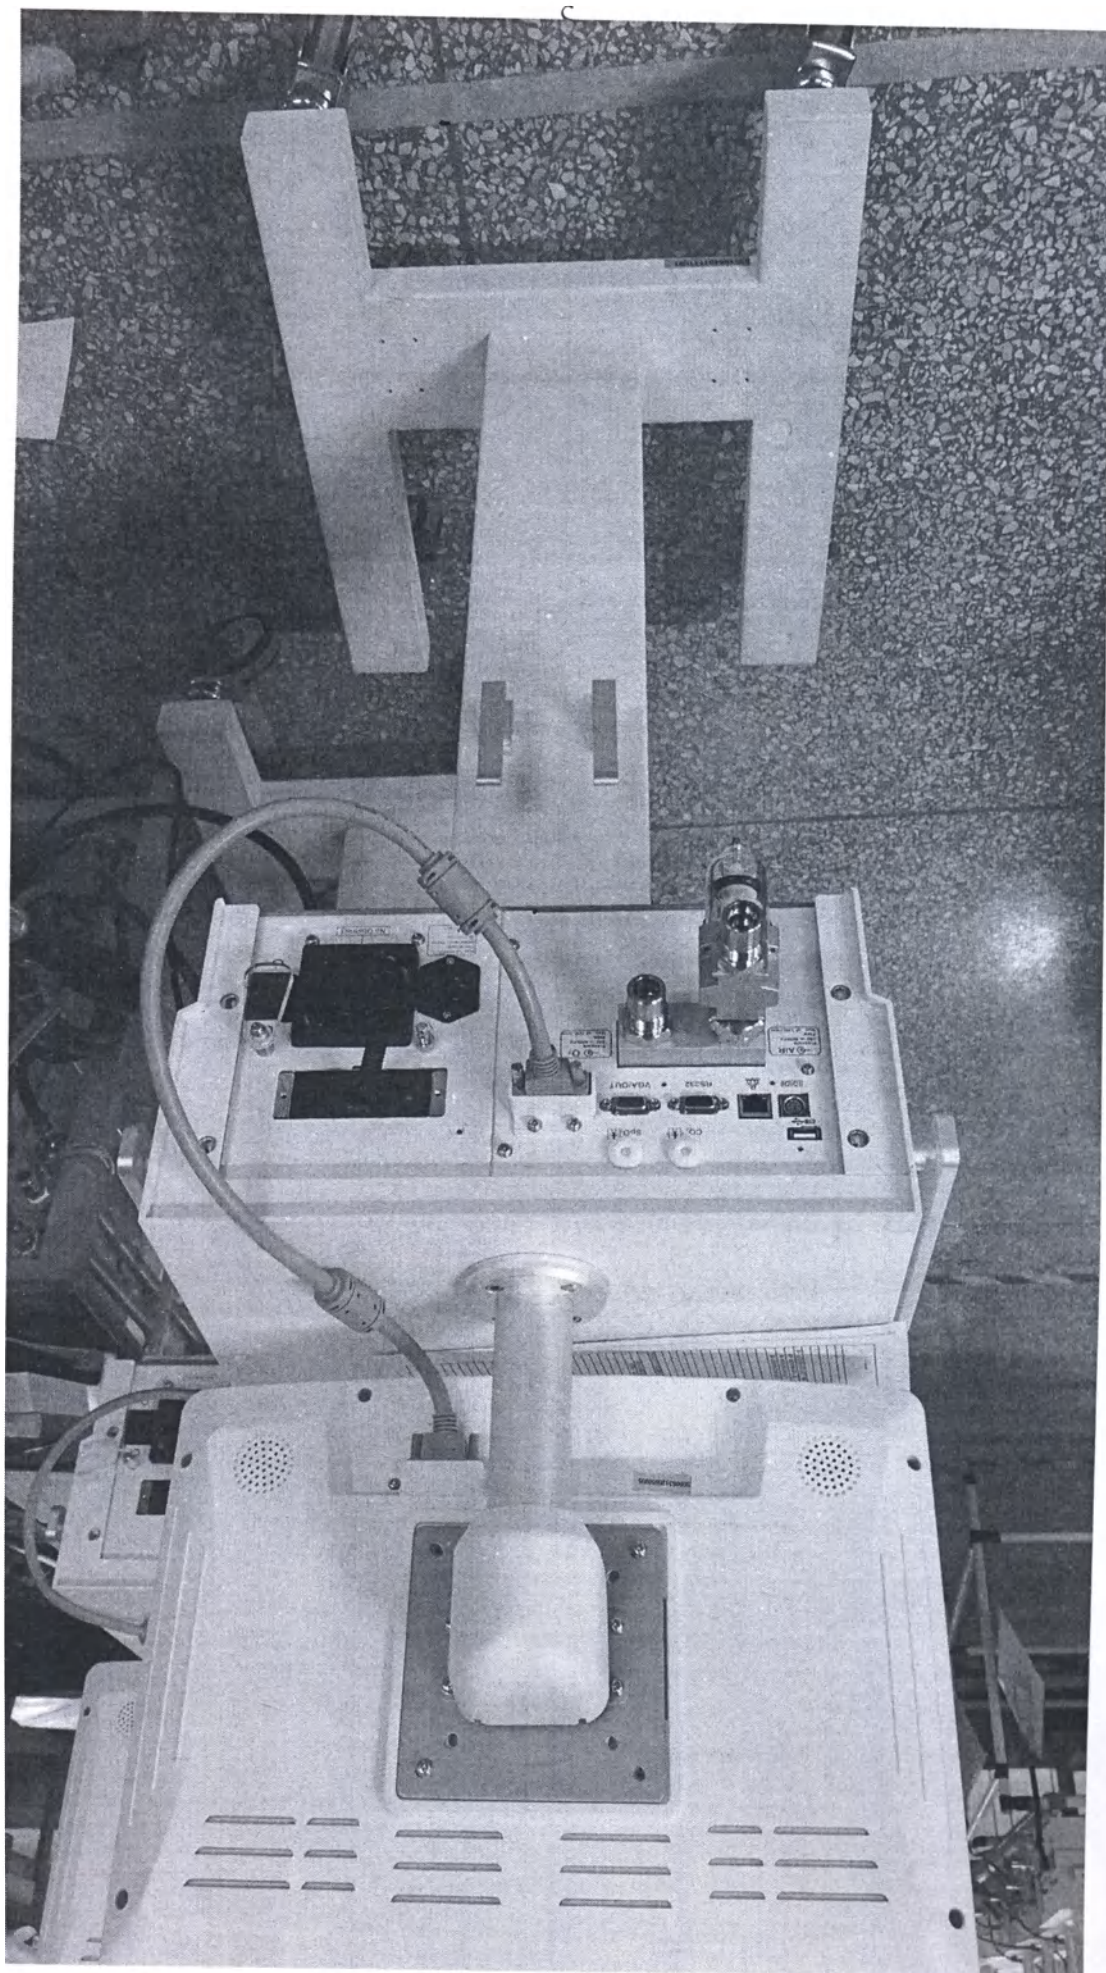

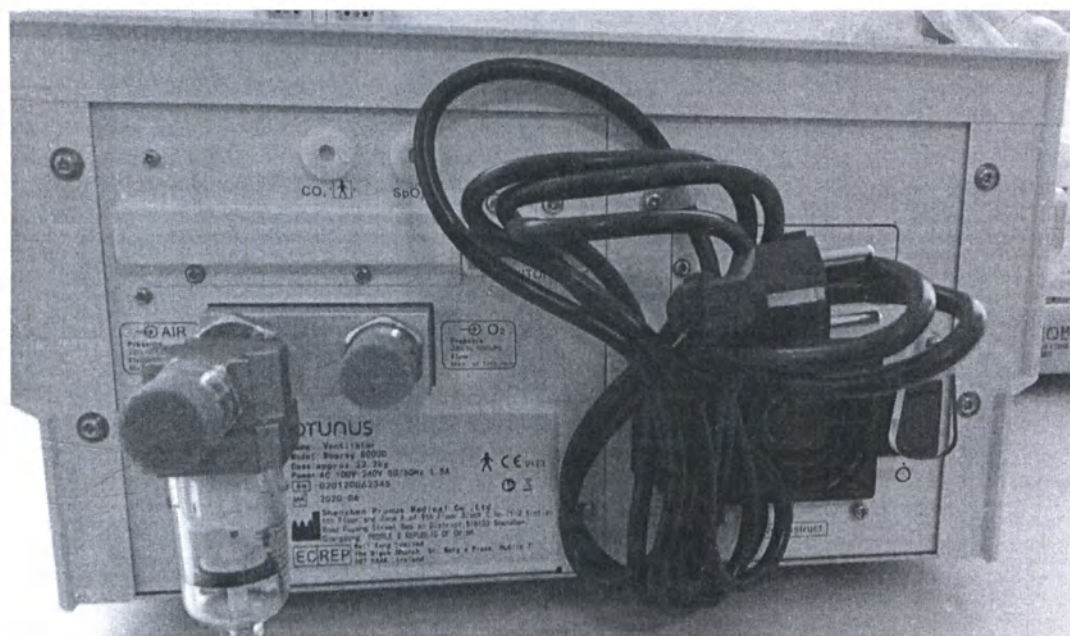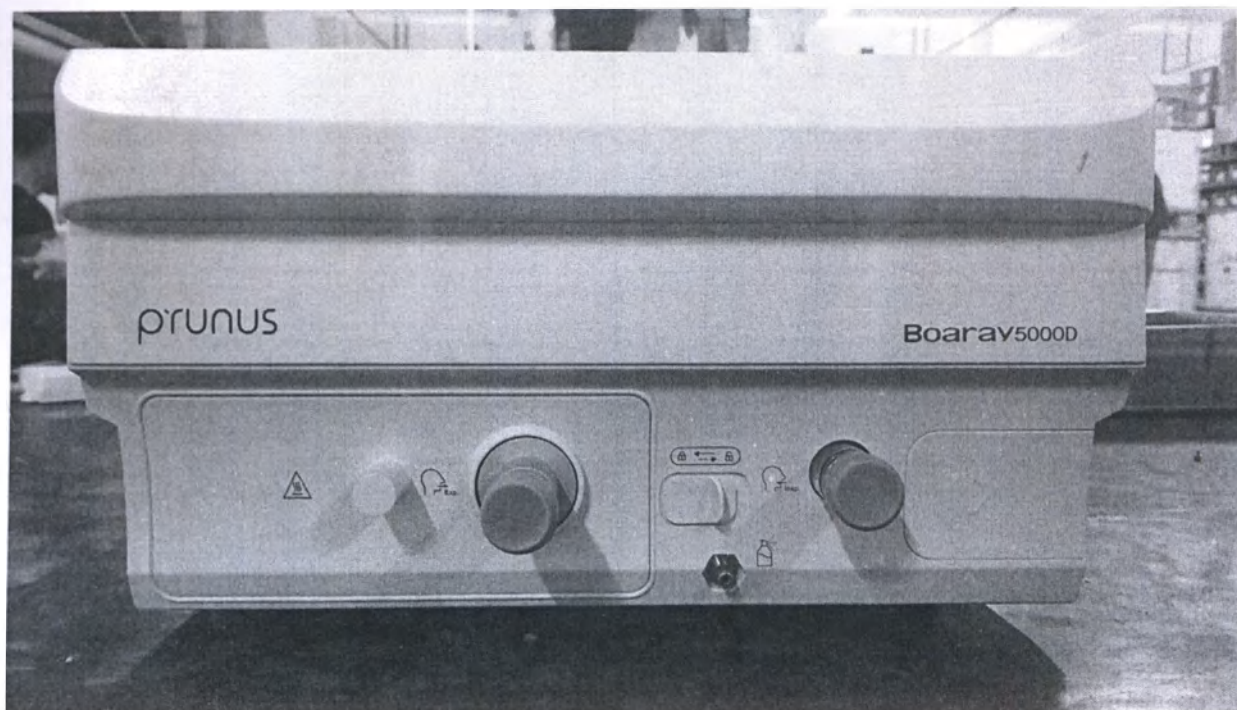

prunus

Name: Ventilator
 Model: Boaray 5000D
 Cass: approx. 23.2kg
 Power: AC 100V-240V 50/60Hz 1.5A
 SN : 020120062345
 M : 2020-06


IP21

 **CE** 0123


 



 **Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd.**
 6th Floor and Zone A of 9th Floor Block C, No. 71-3 Xintian
 Road, Fuyong Street, Bao'an District, 518103 Shenzhen,
 Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ECREP Well Kang Limited
 The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7.
 D07 P4AX, Ireland

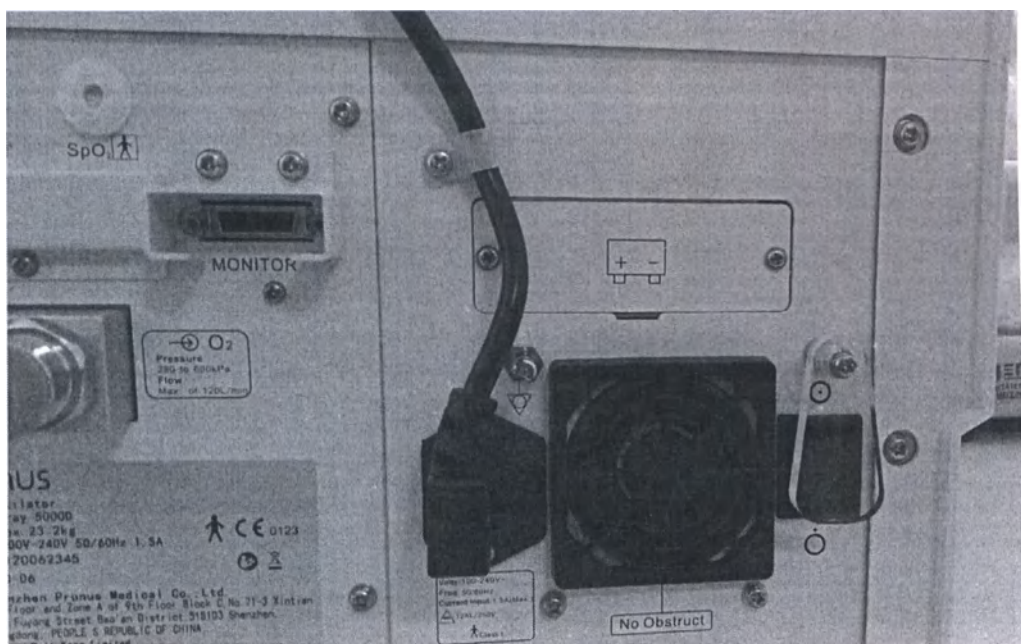



1. Дисплей аппарата ИВЛ – 1 шт.

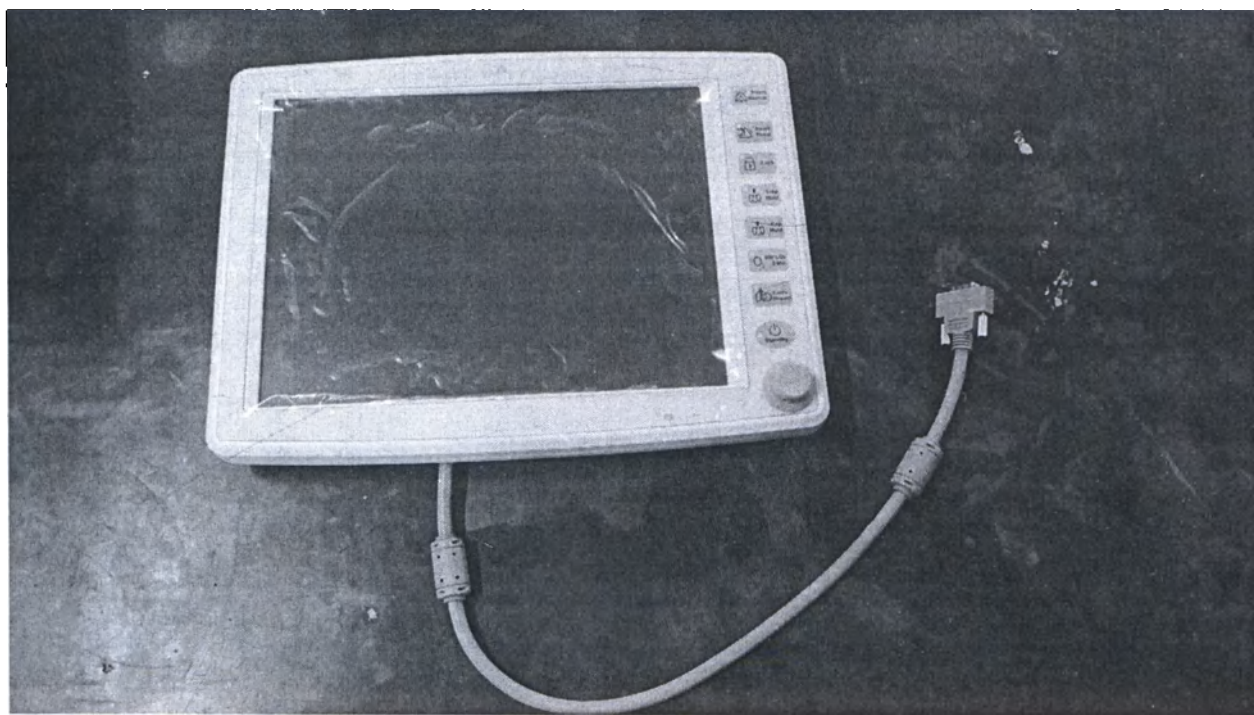

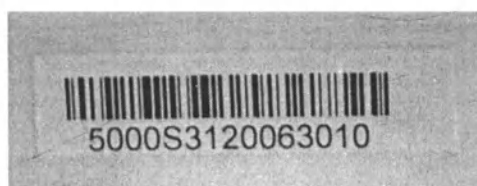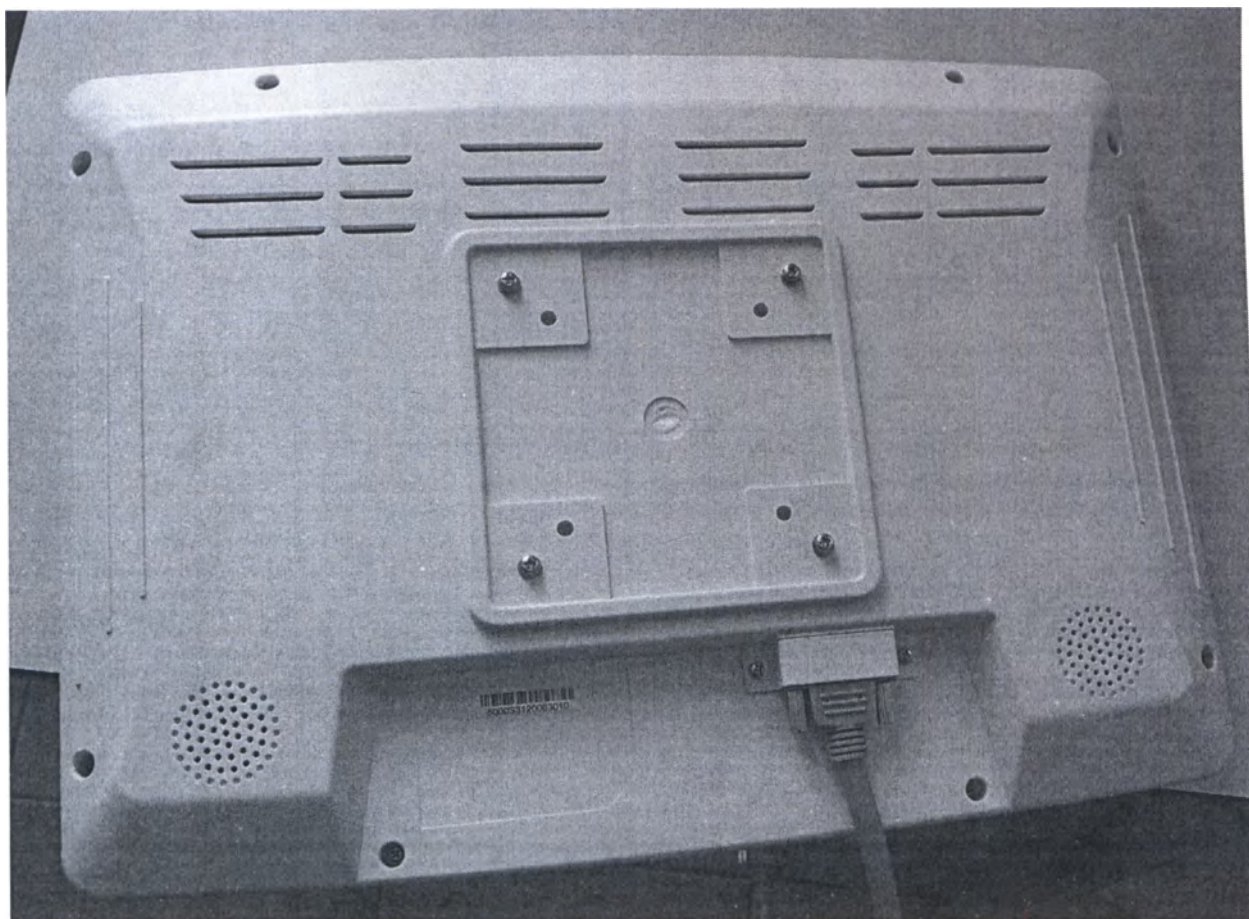




2. Крепление дисплея аппарата ИВЛ – 1 шт.

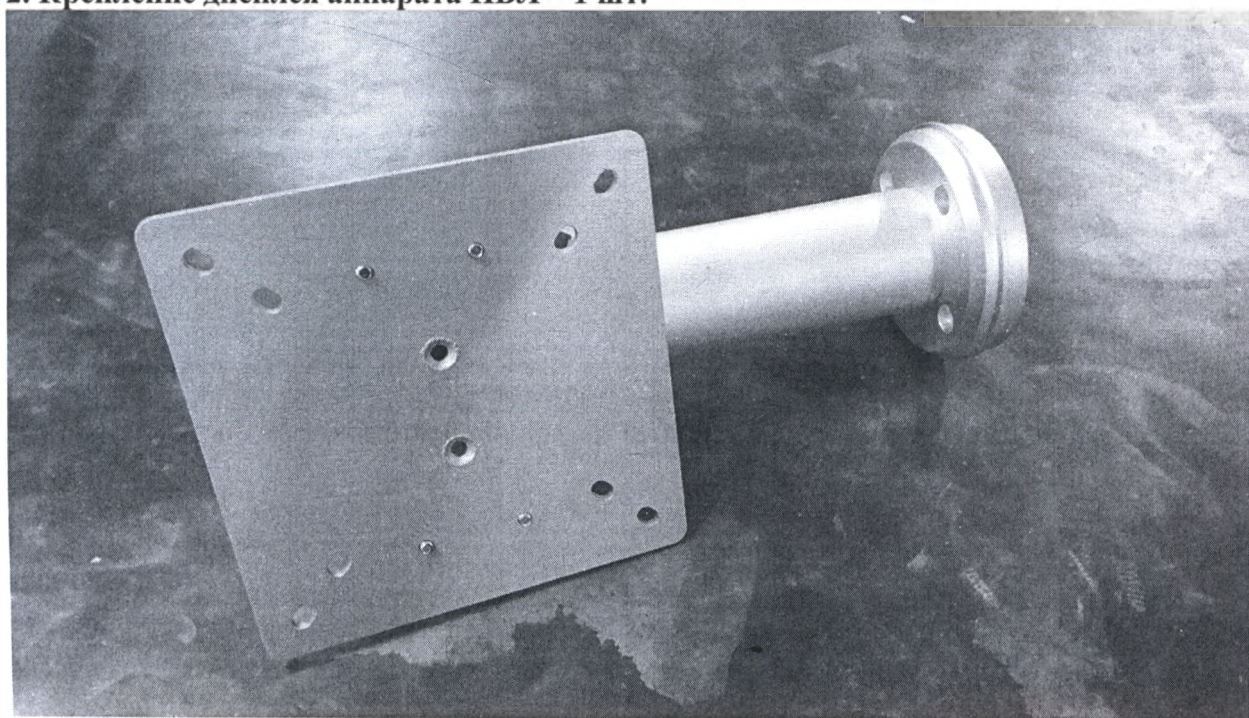

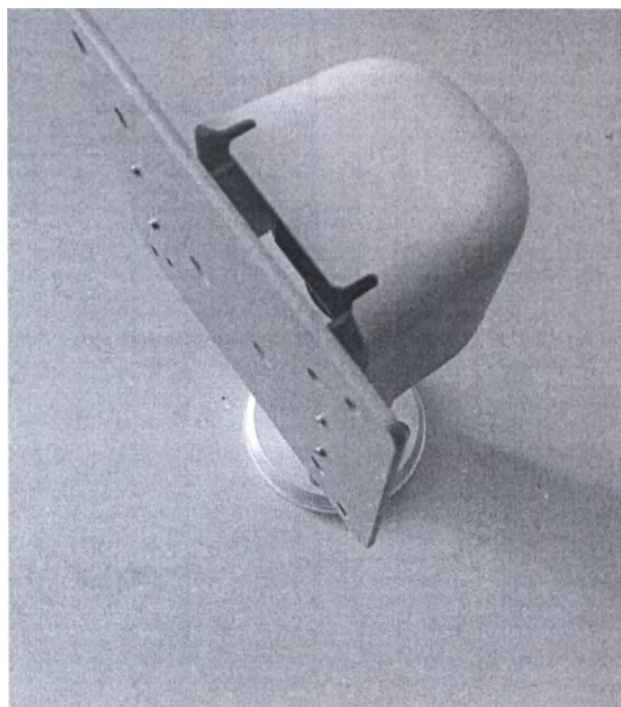



3. Дисплей внешний для аппарата ИВЛ – 1 шт.

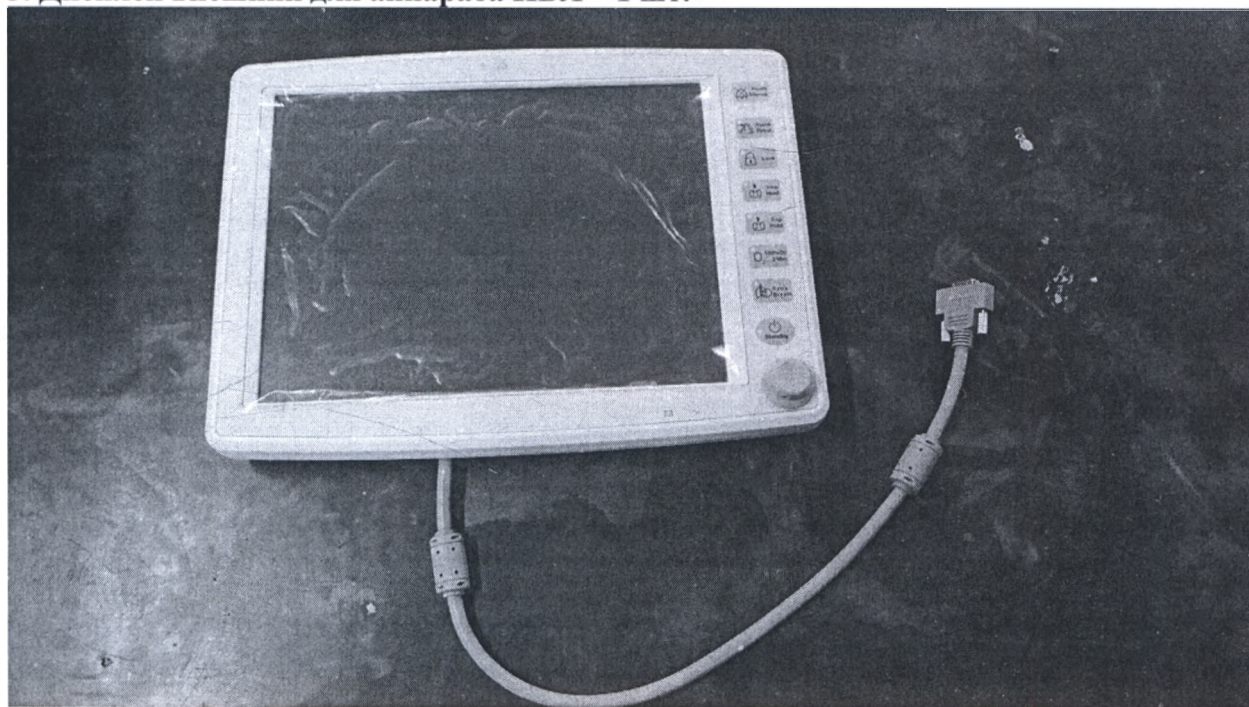

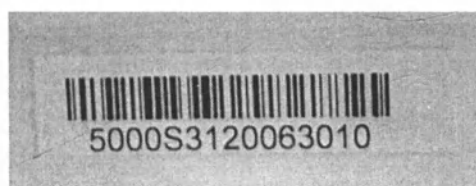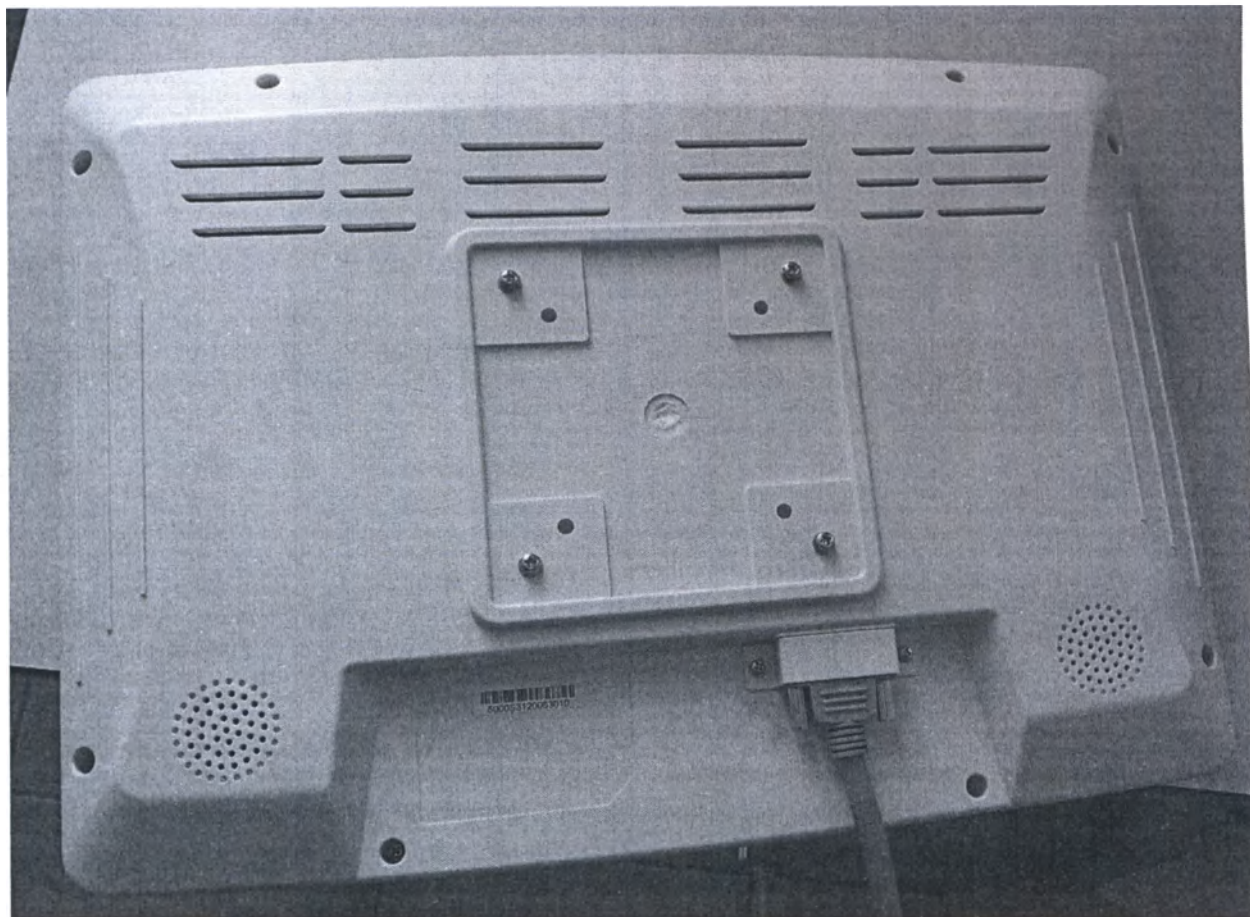




4. Крепление внешнего дисплея аппарата ИВЛ – 1 шт.

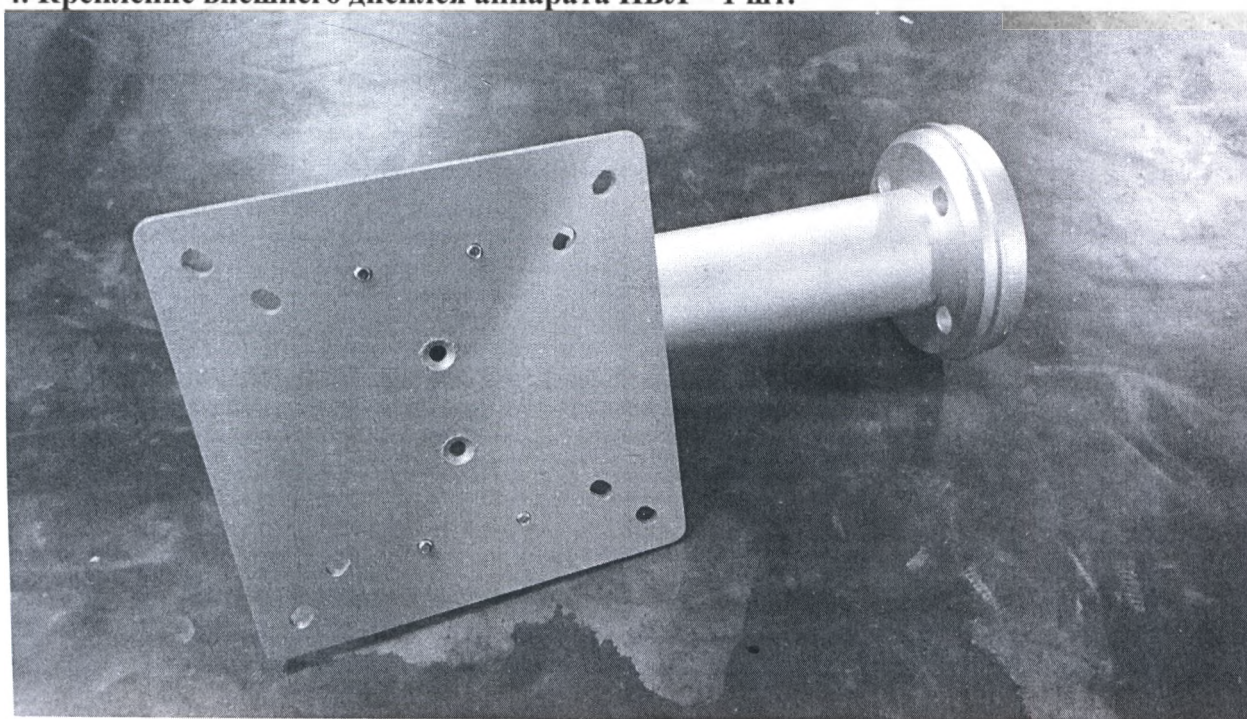

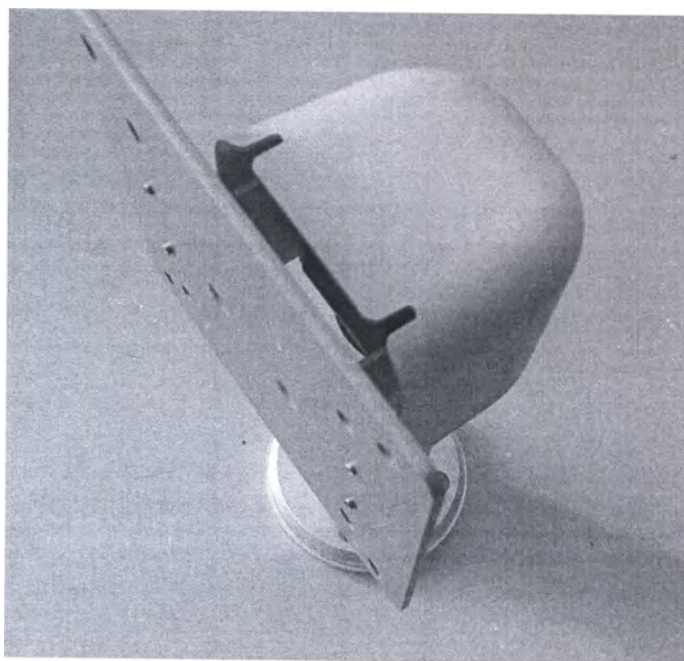

5. Увлажнитель дыхательной смеси – 1 шт.

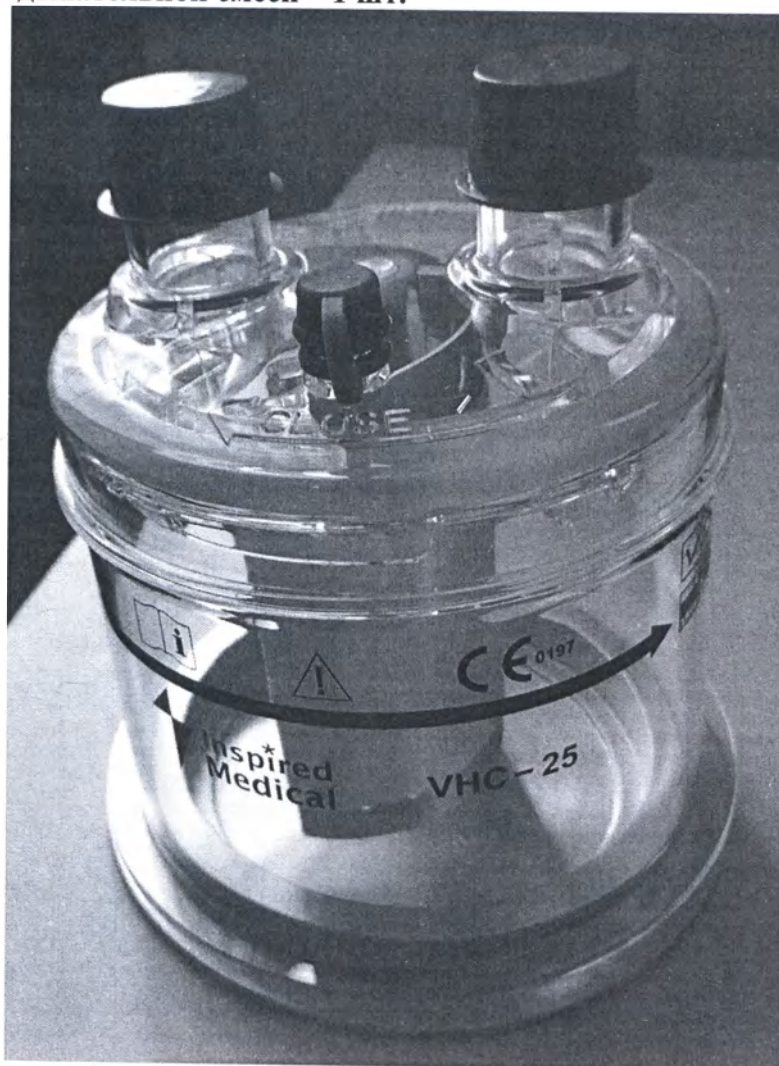


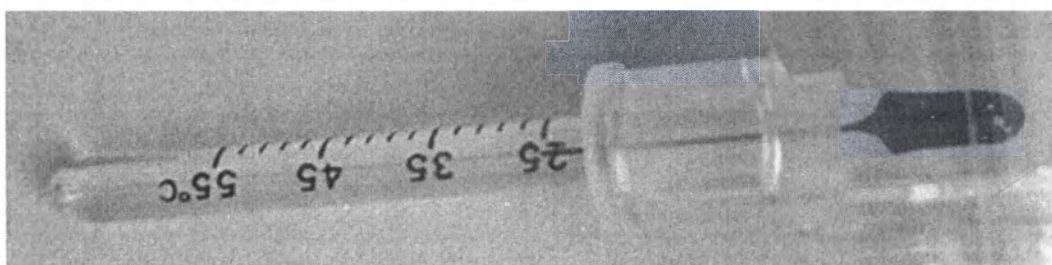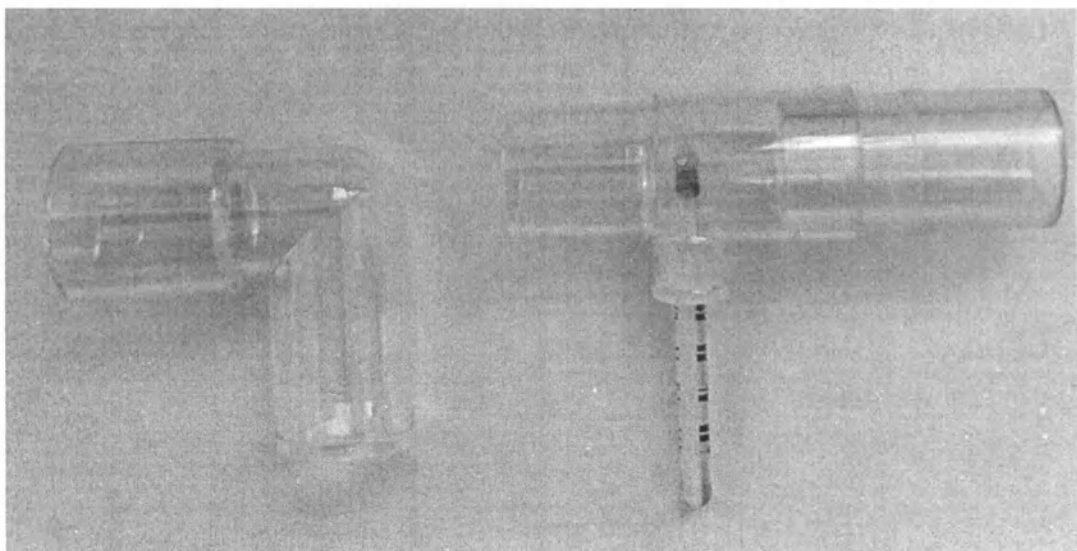


6. Крепление увлажнителя – 1 шт.





7. Камера увлажнителя однократного применения (для взрослых) – не более 10 шт.

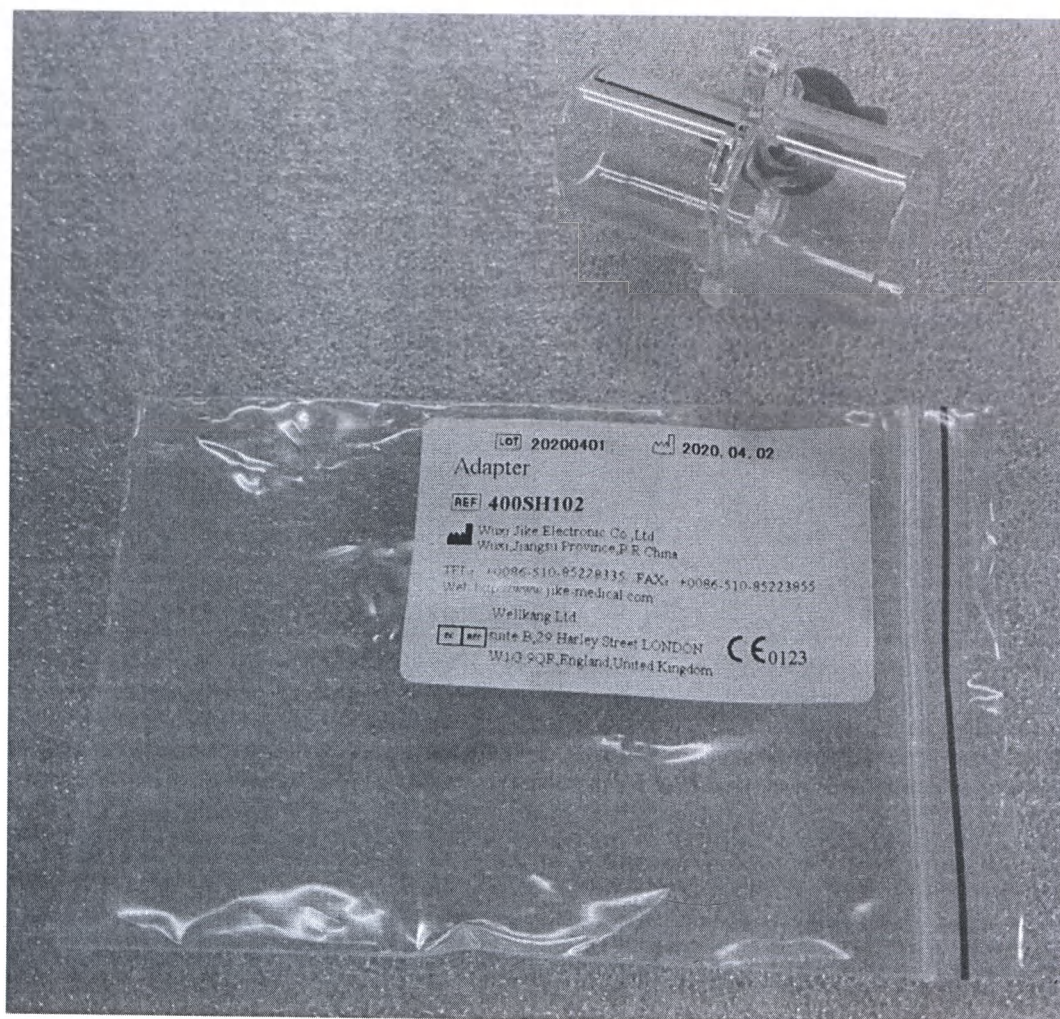

8. Камера увлажнителя многоразового использования (для взрослых) – 1 шт.

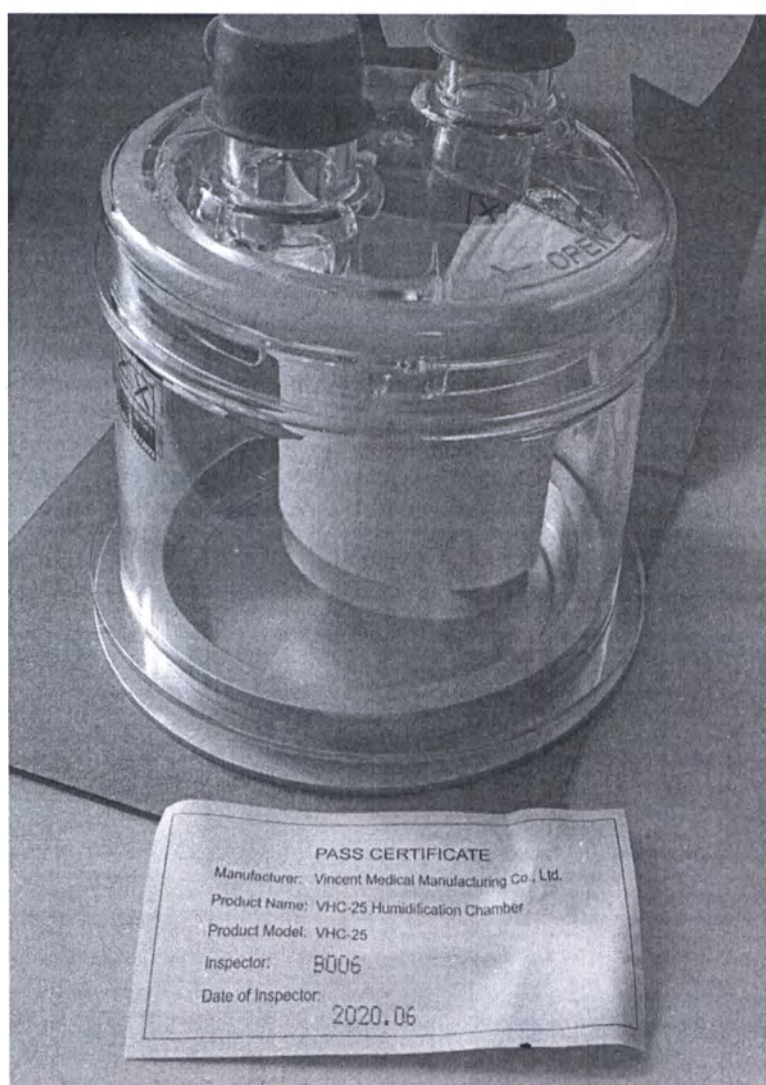



9. Датчик потока газовой смеси – не более 10 шт.

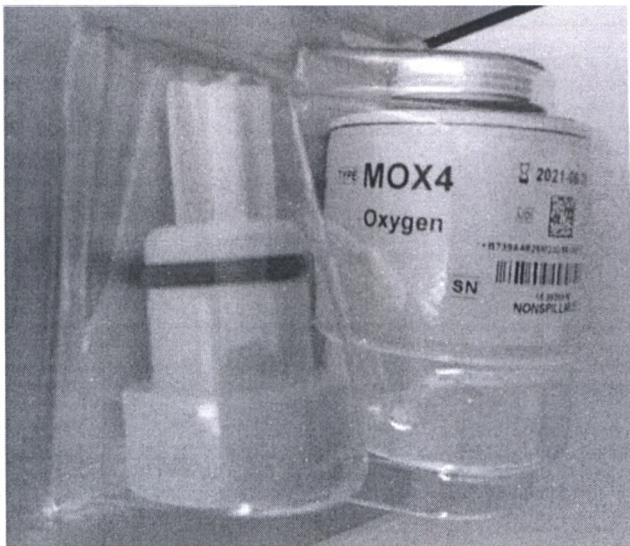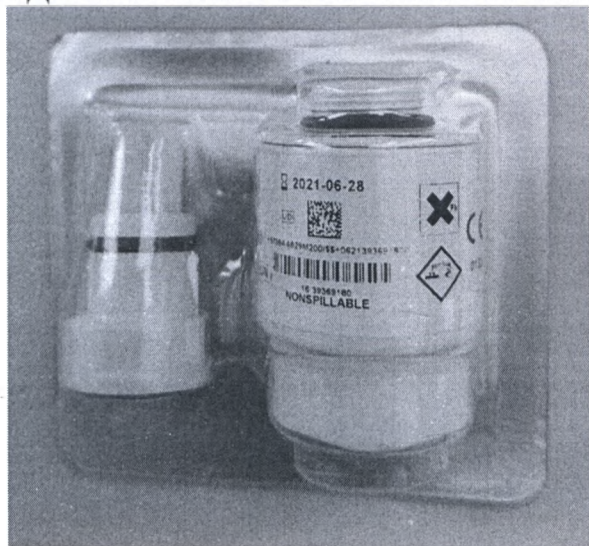


10. Линия отбора проб датчика потока газовой смеси – не более 10 шт.



11. Датчик кислородный – 1 шт.

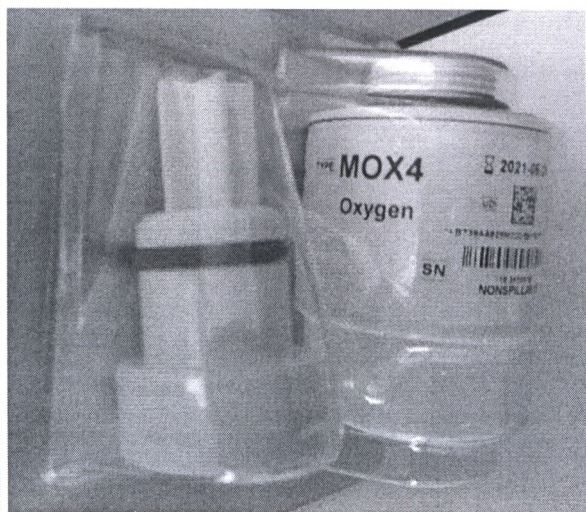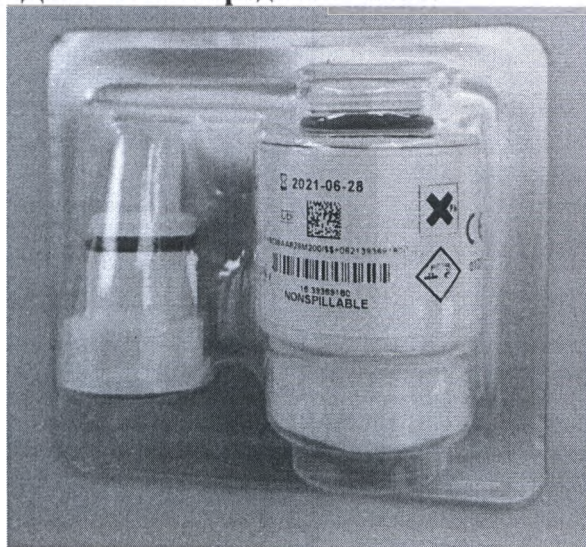



12. Кабель интерфейсный для датчика кислородного – 1 шт.

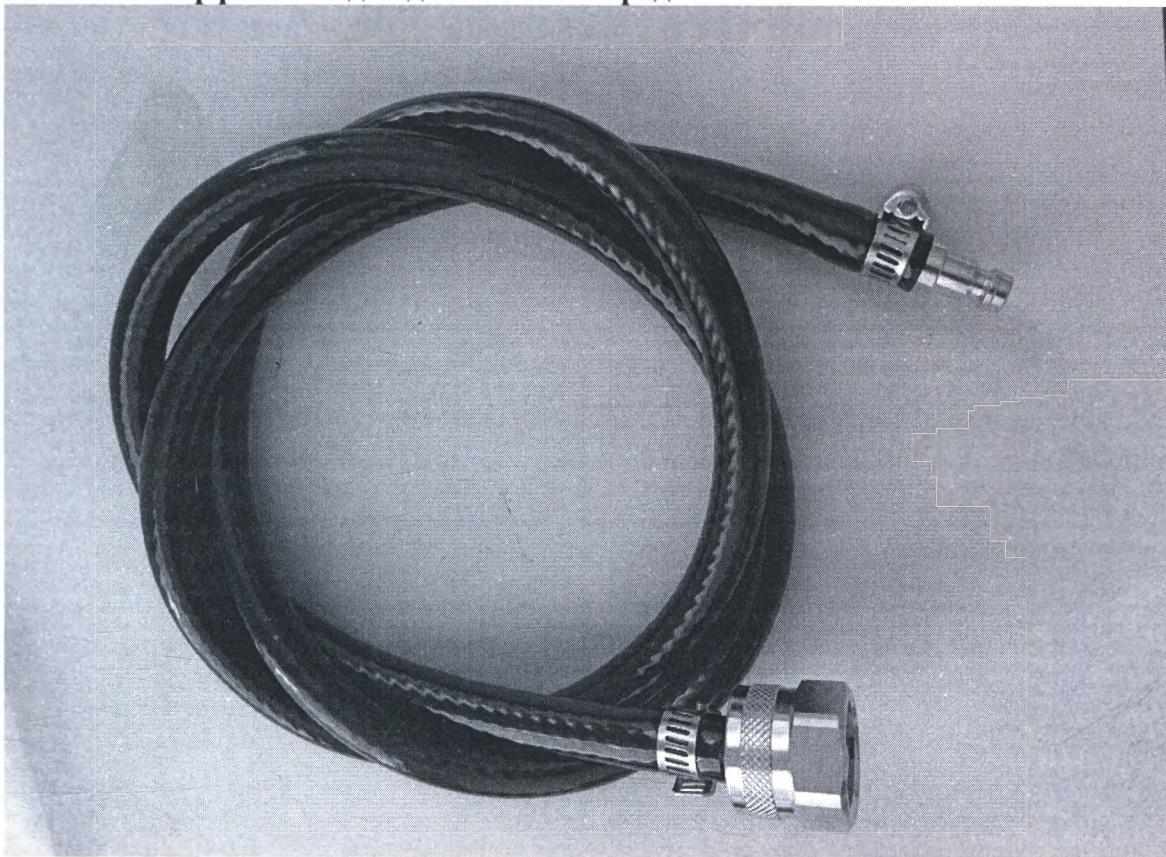

13. Контур пациента одноразовый для взрослых, в наборе – не более 50 наборов.






14. Контур пациента многоразовый, для взрослых, в наборе – не более 10 наборов.

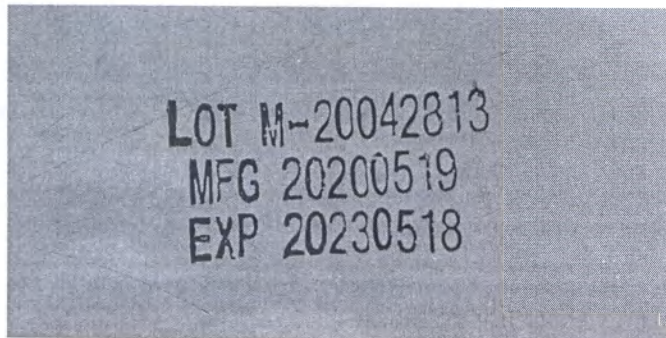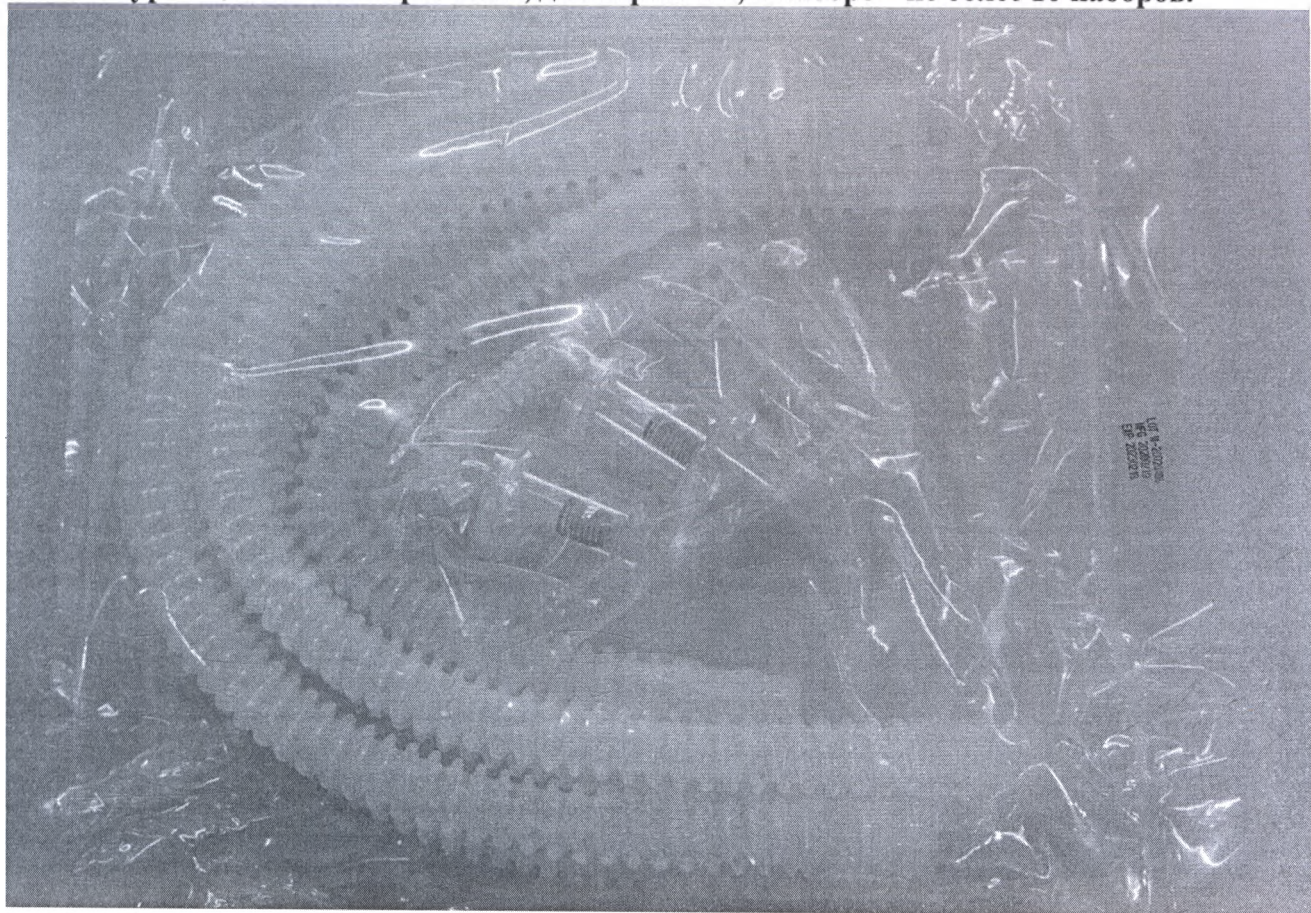


LOT M-20042813
MFG 20200519
EXP 20230518

15. Компрессор воздуха медицинский – 1 шт.

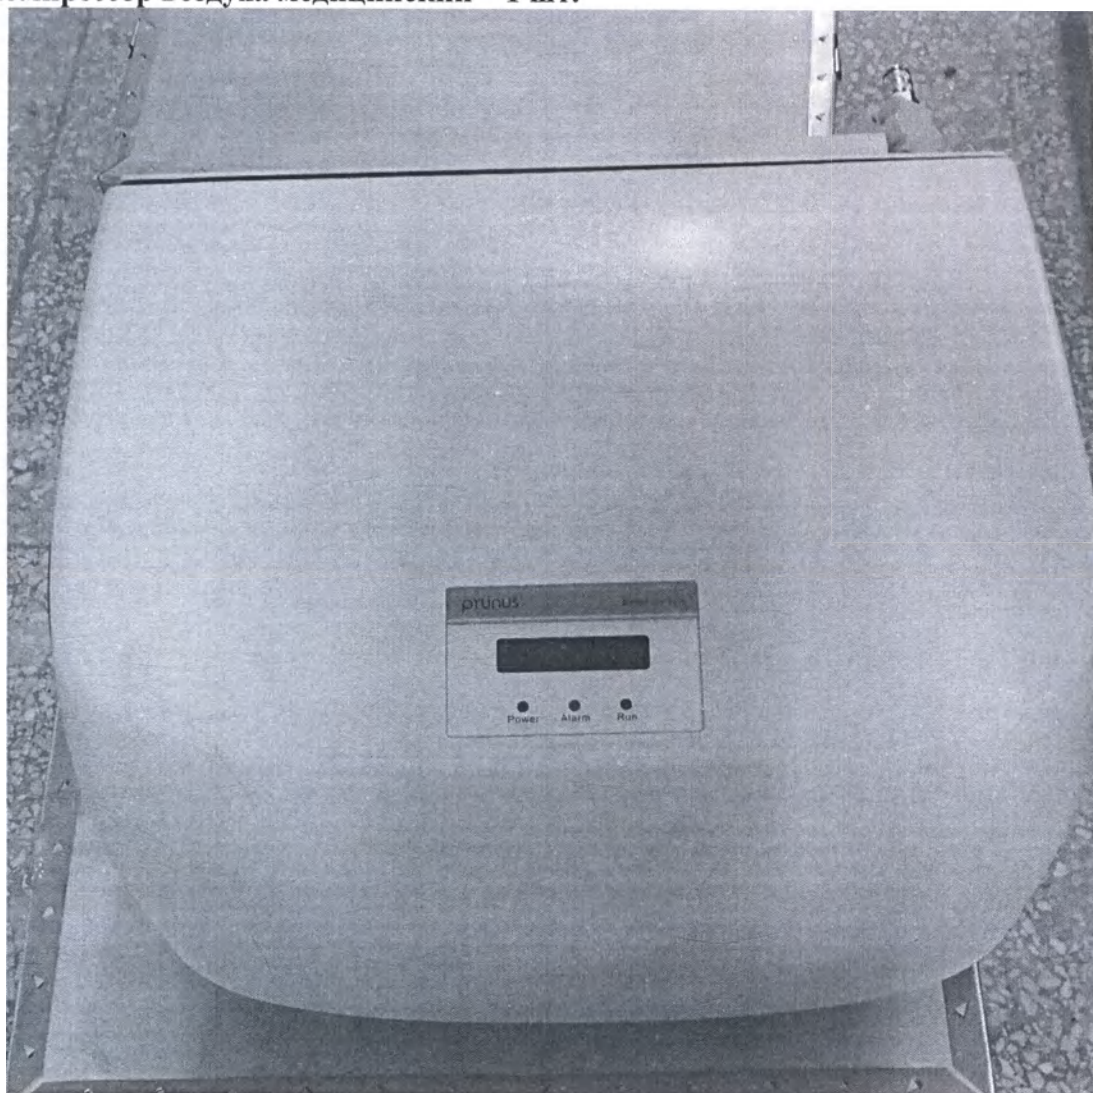


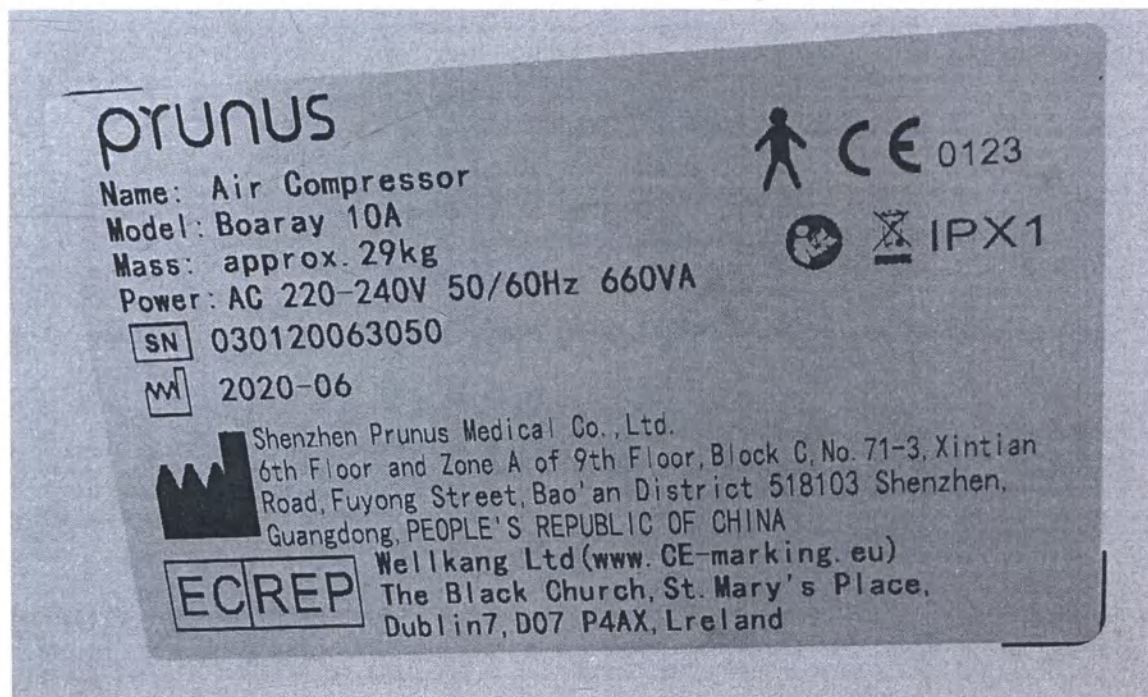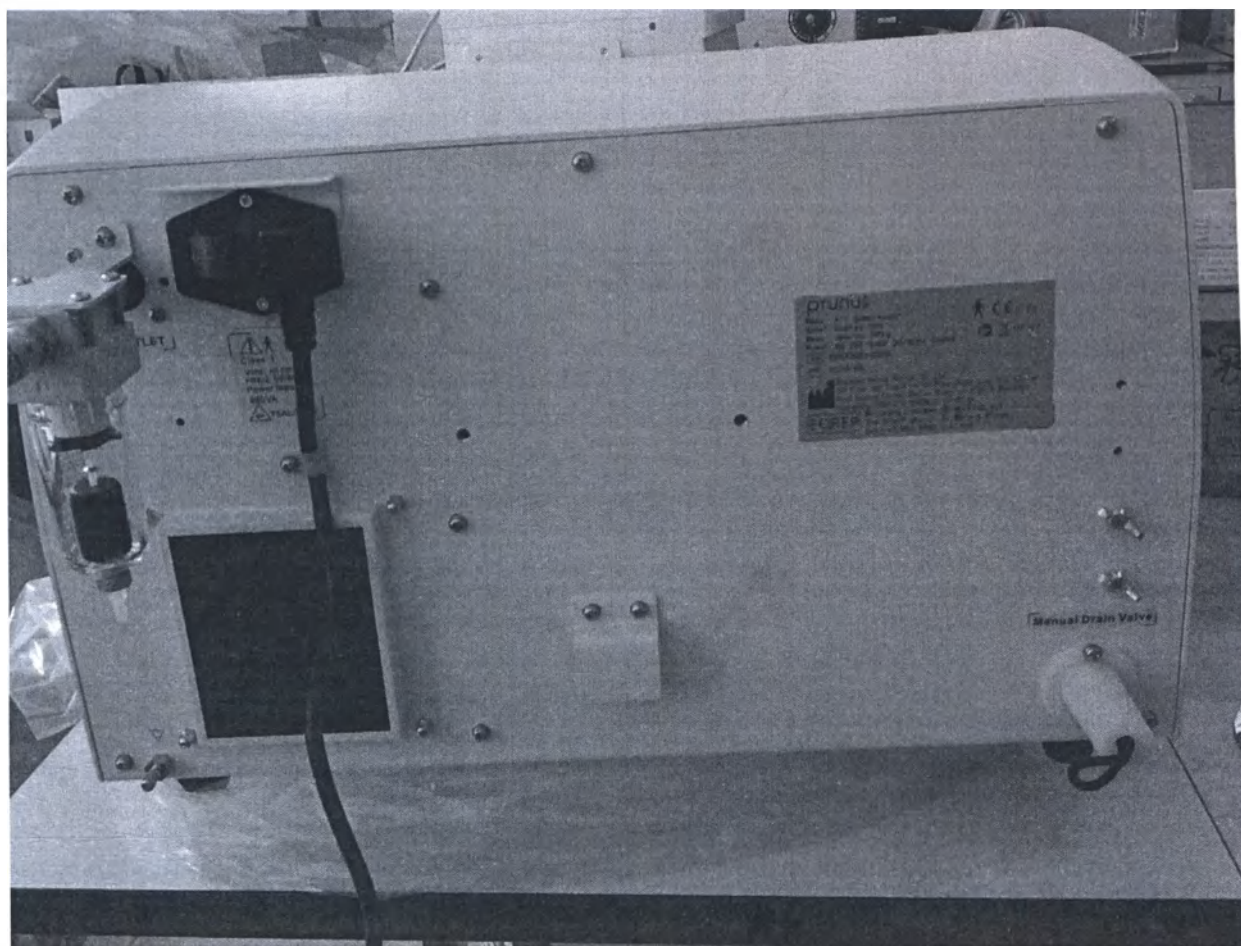


16. Шланг высокого давления для кислорода – 1 шт.

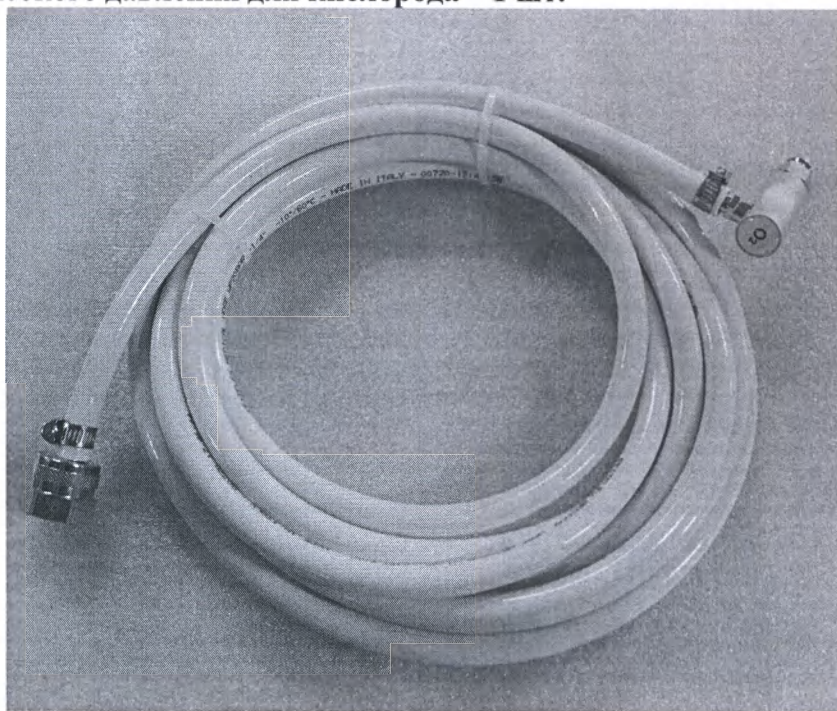


17. Шланг высокого давления для воздуха – 1 шт.


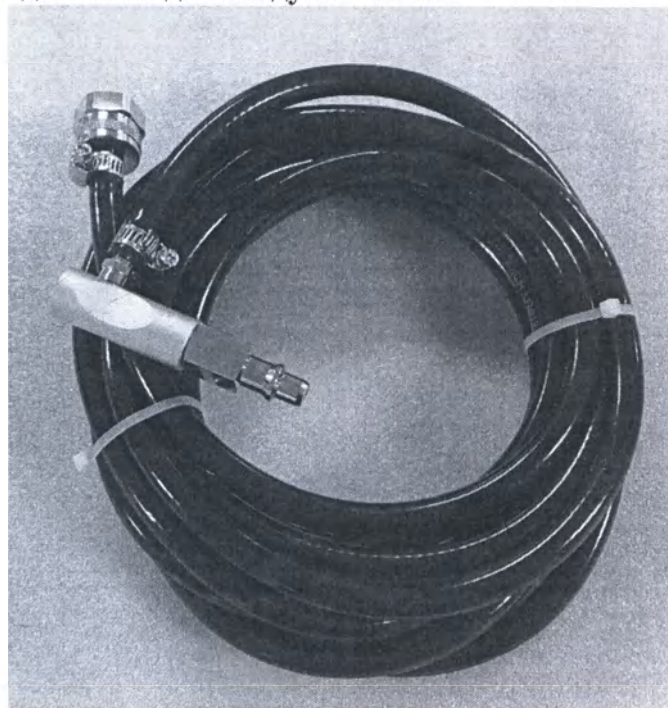


18. Шланг высокого давления для подачи воздуха от компрессора – 1 шт.

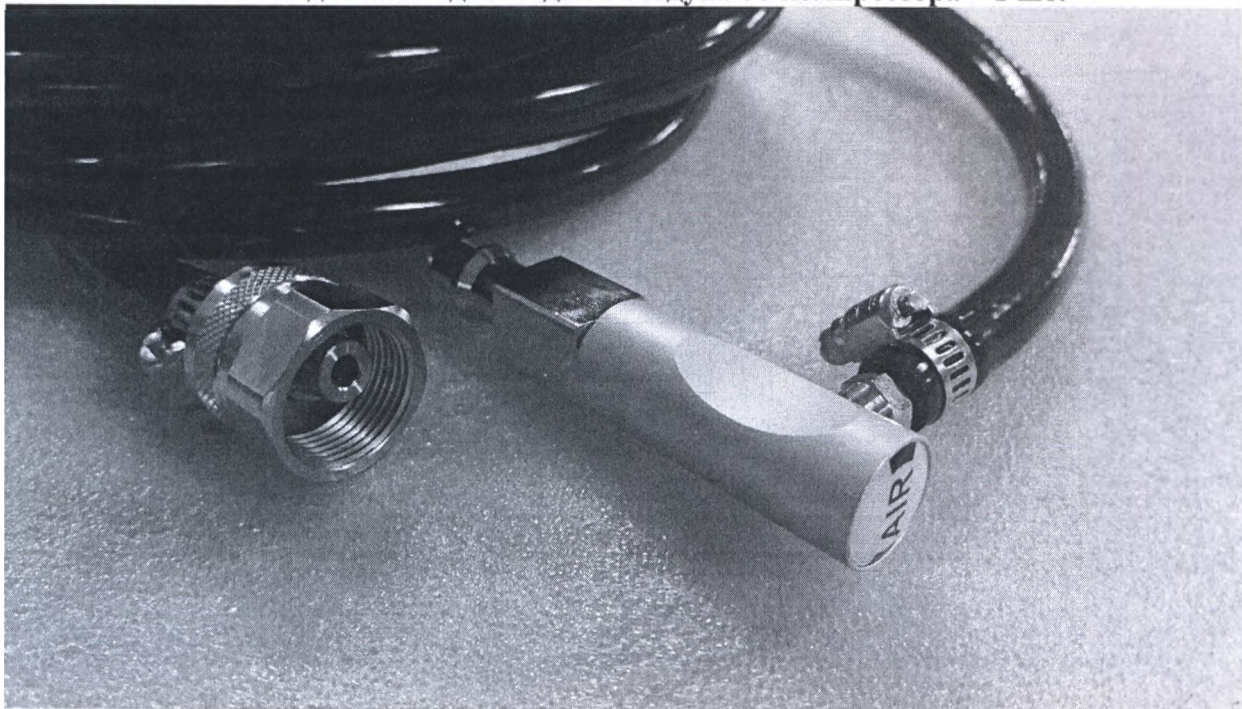


19. Тестовое легкое взрослое – 1 шт.

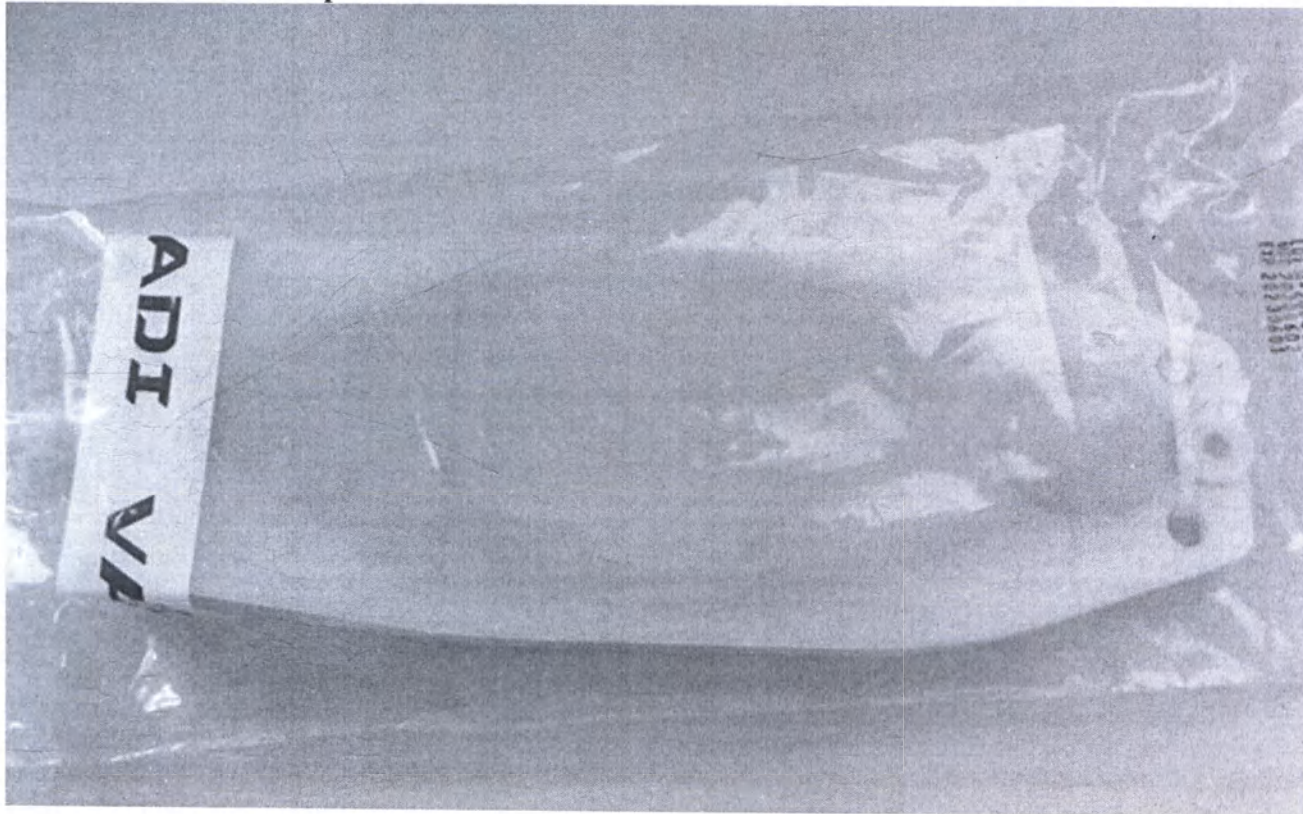


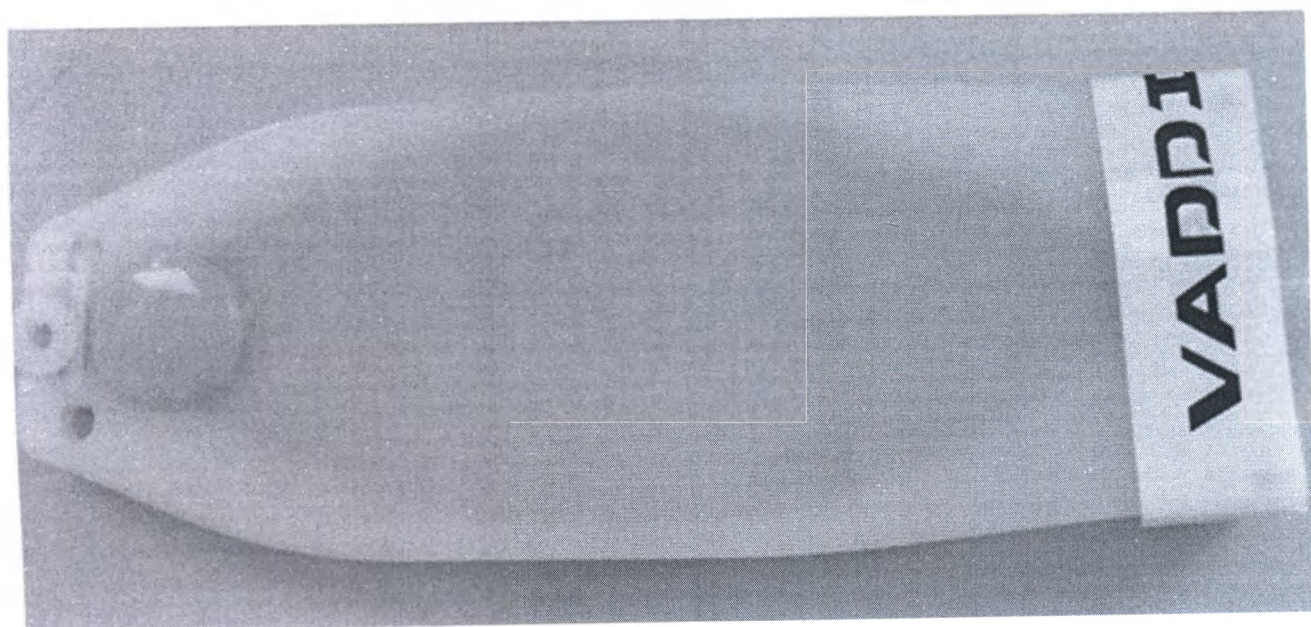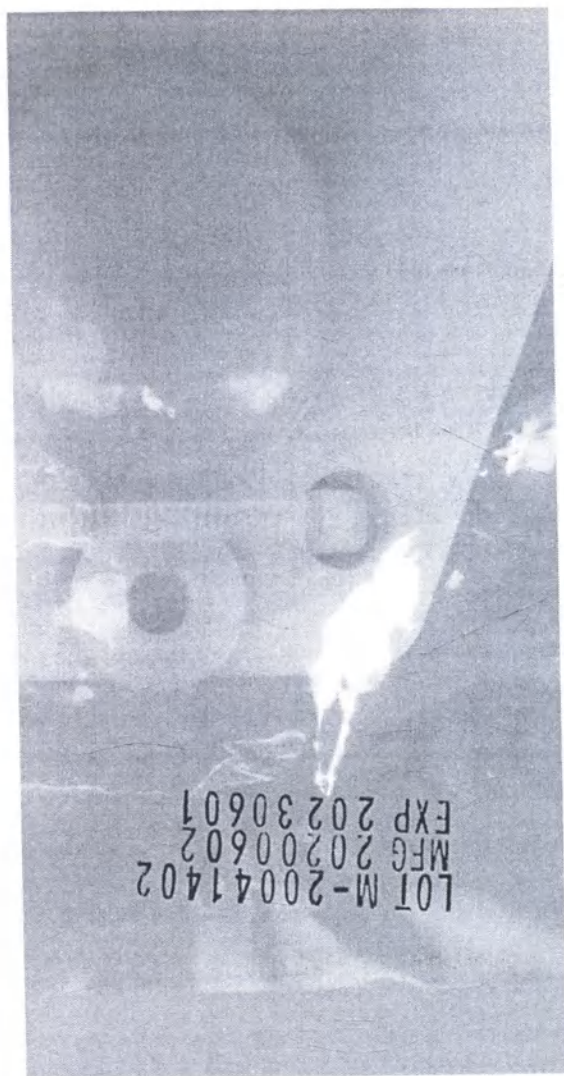


20. Мешок дыхательный резервуарный (объем 3000 мл) – не более 2 шт.

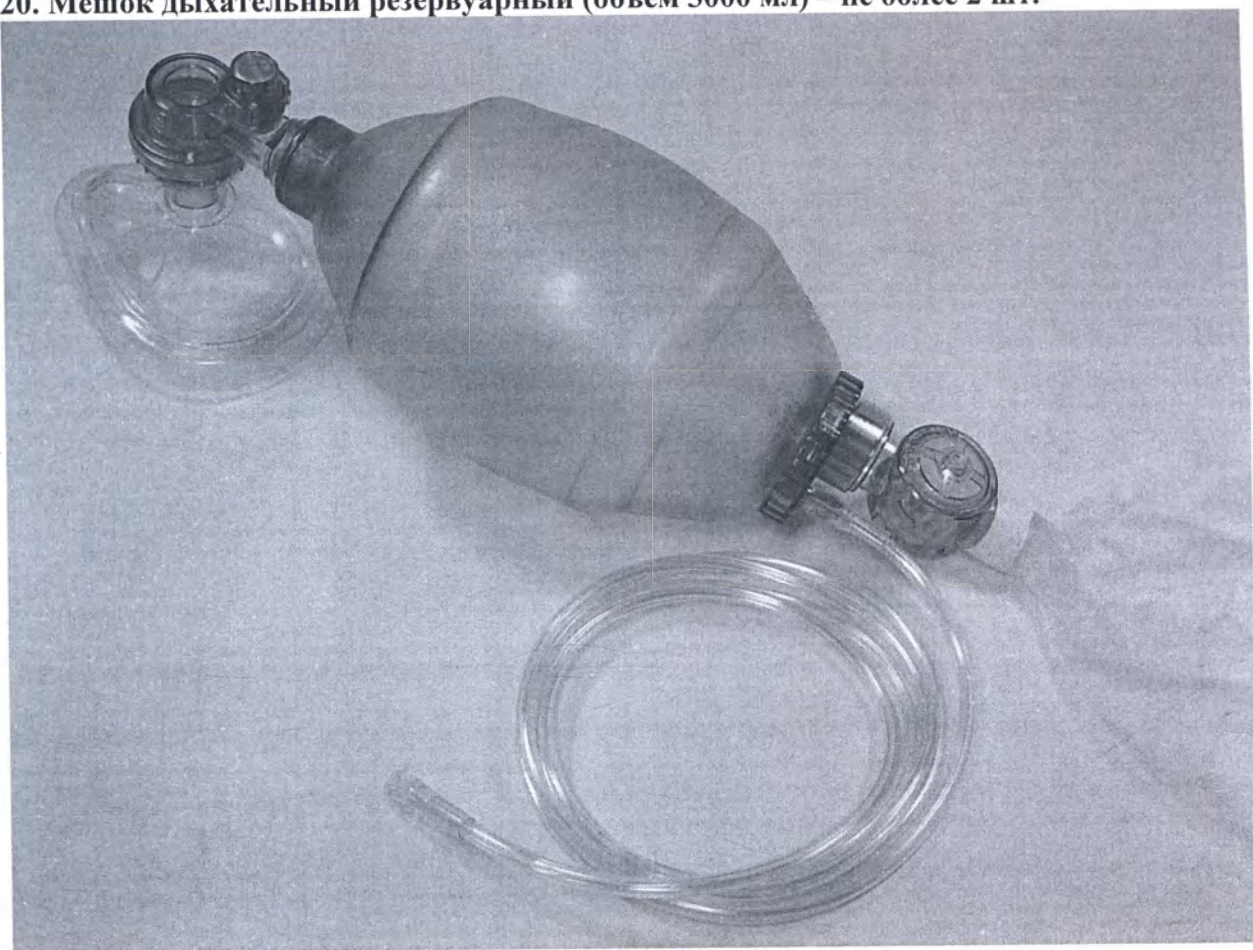


21. Влагосборник вентилятора (воздух) – 1 шт.

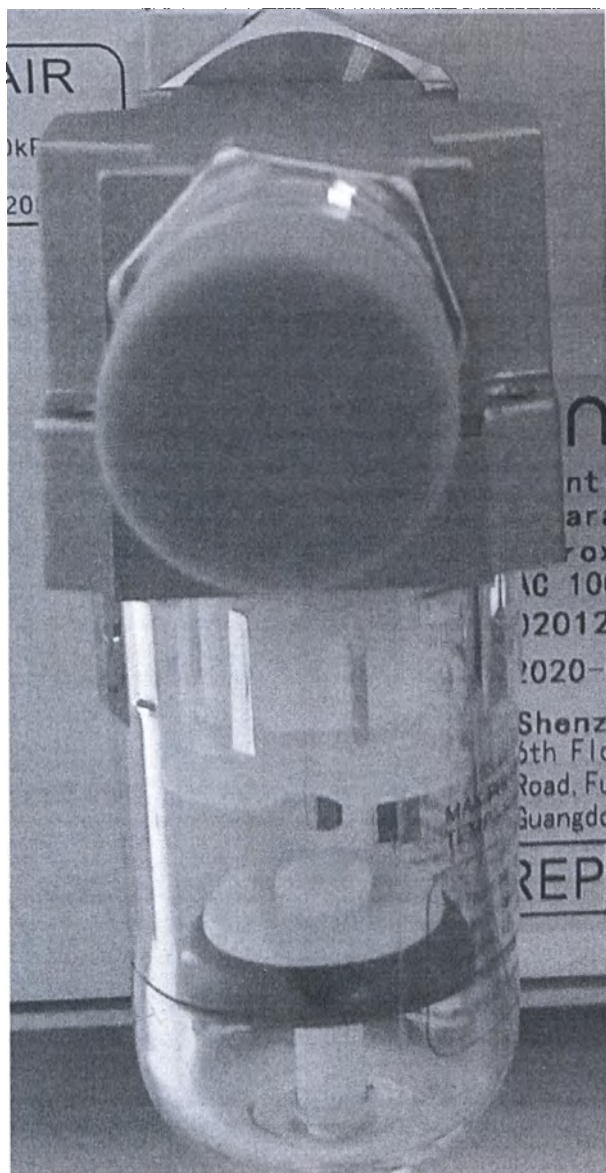


22. Влагосборник вентилятора (кислород) – 1 шт.

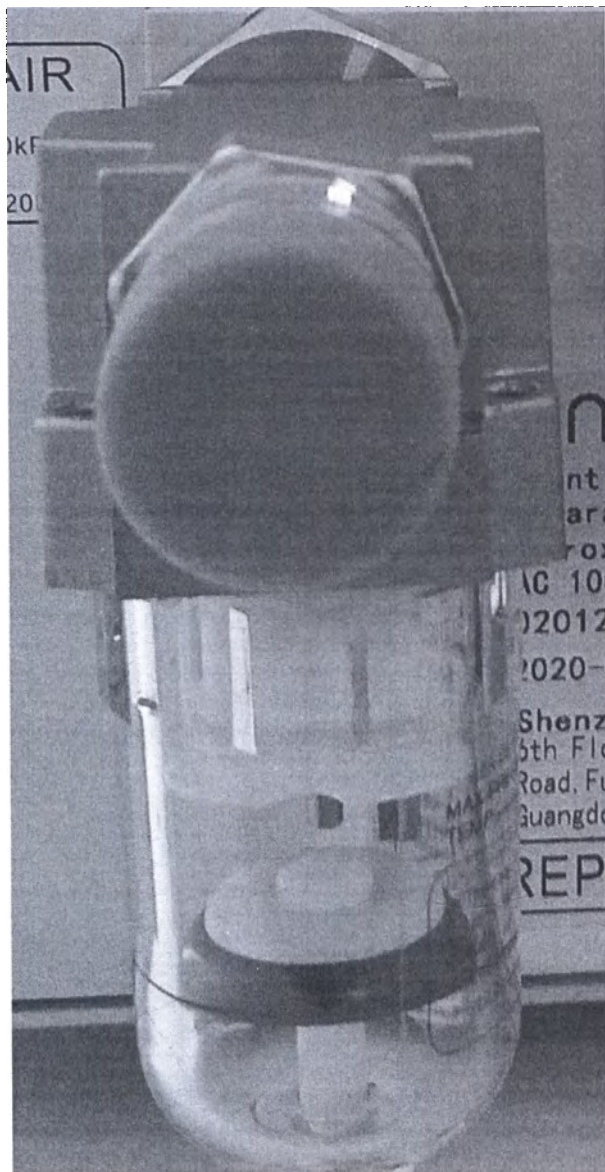


23. Маска лицевая взрослая (большая) – 1 шт.

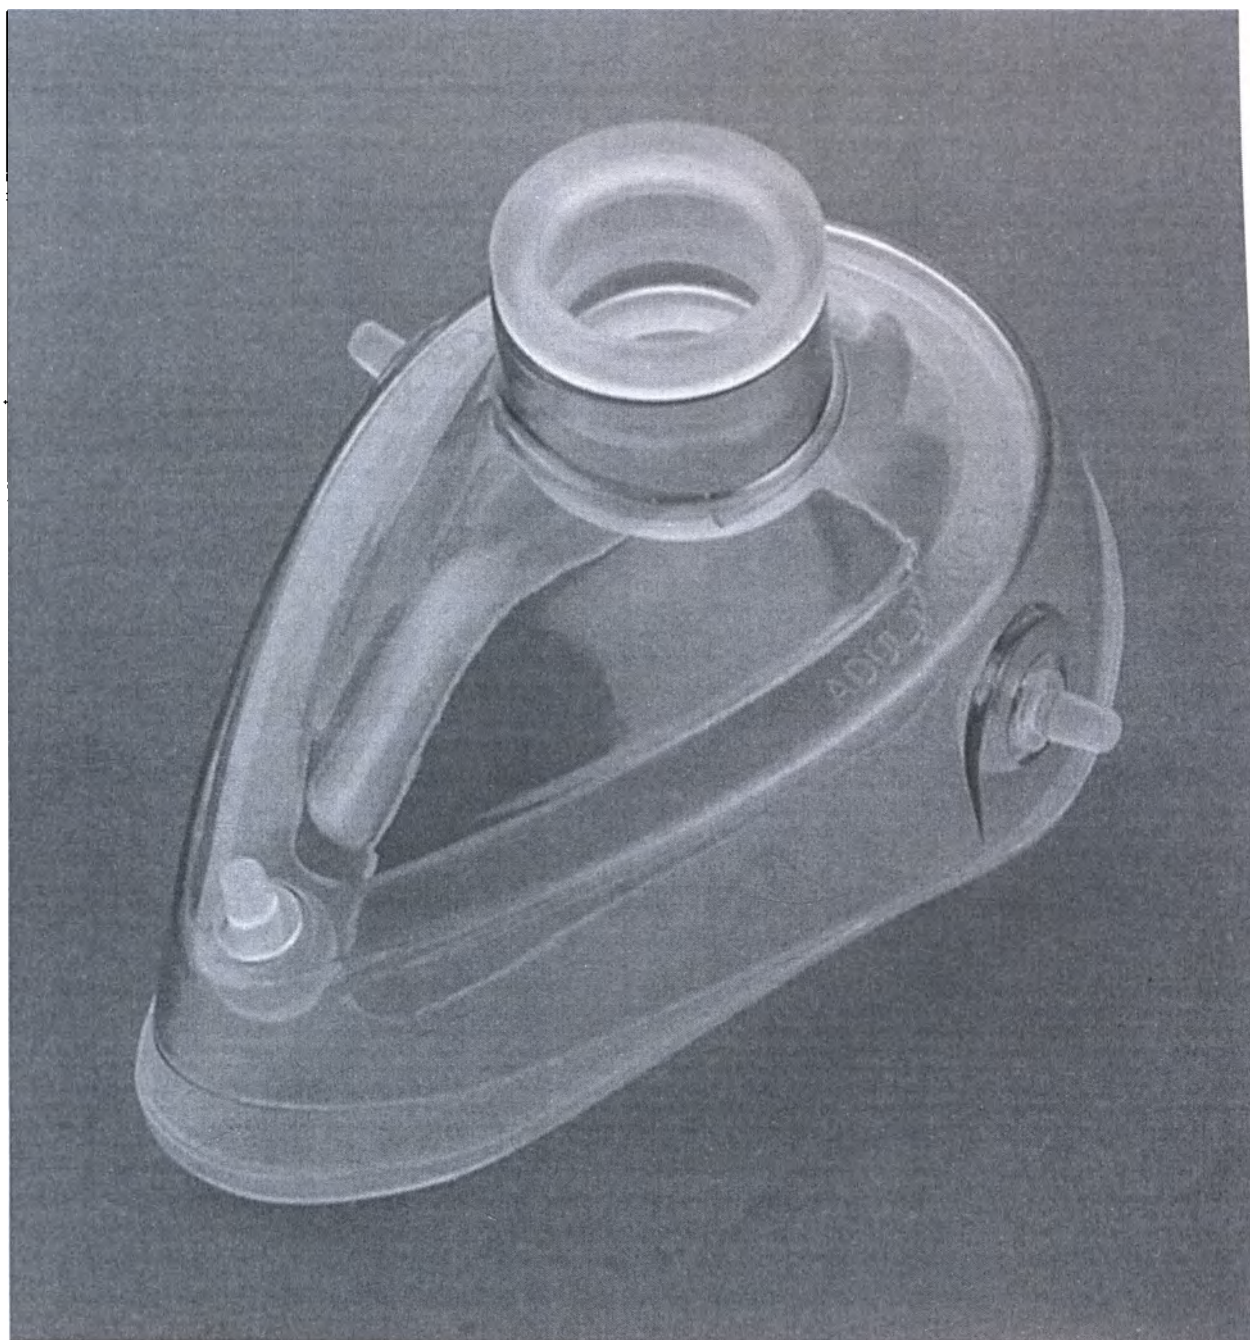

24. Шарнирный держатель дыхательного контура – 1 шт.

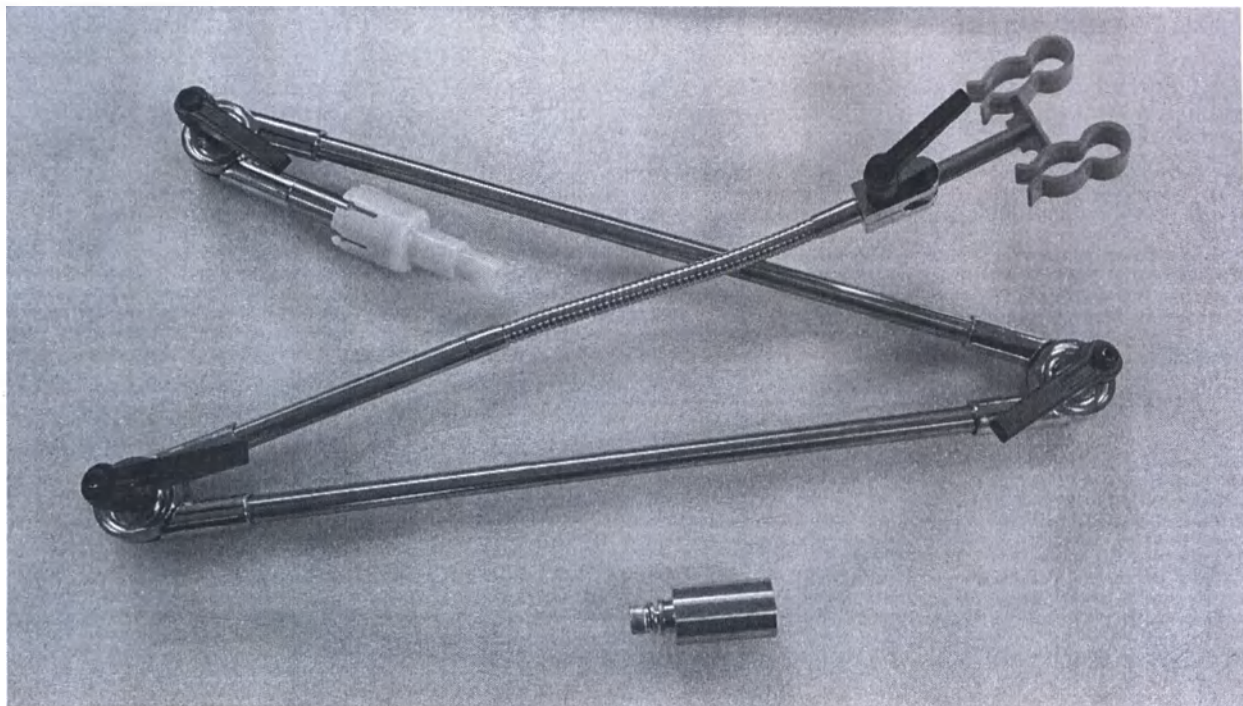


25. Батарея аккумуляторная – 1 шт.

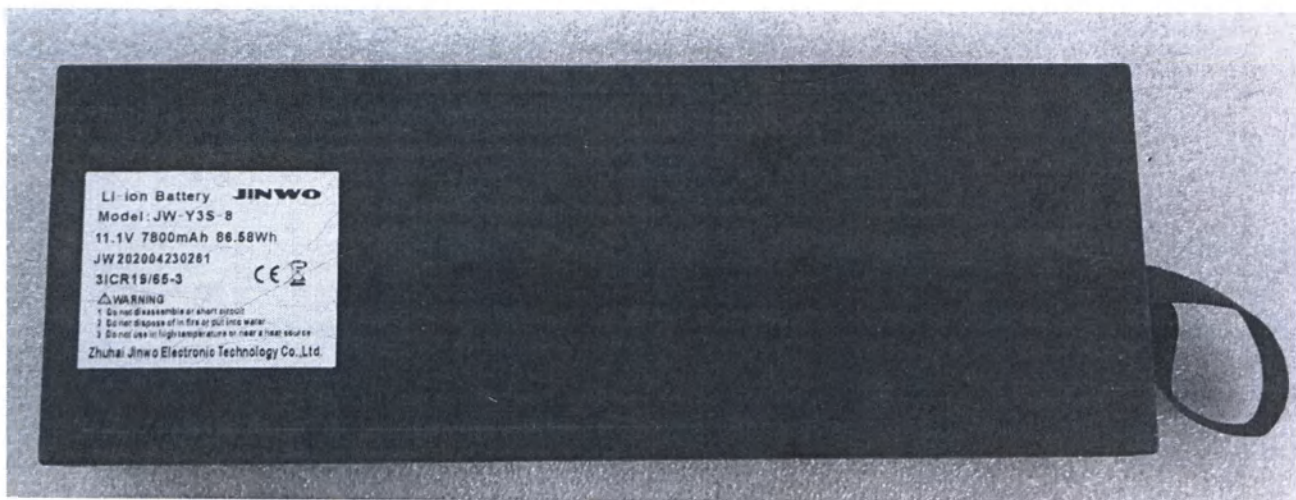





26. Кабель сетевой для аппарата ИВЛ – 1 шт.

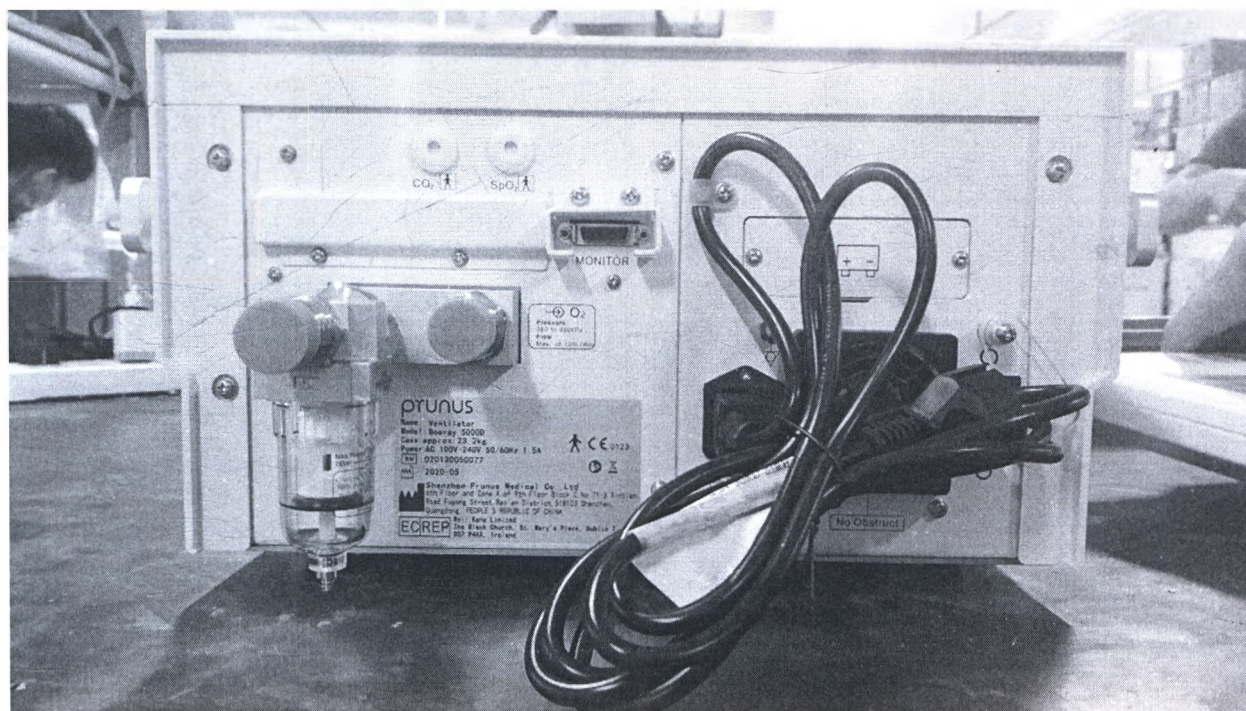

27. Кабель сетевой для монитора – 1 шт.

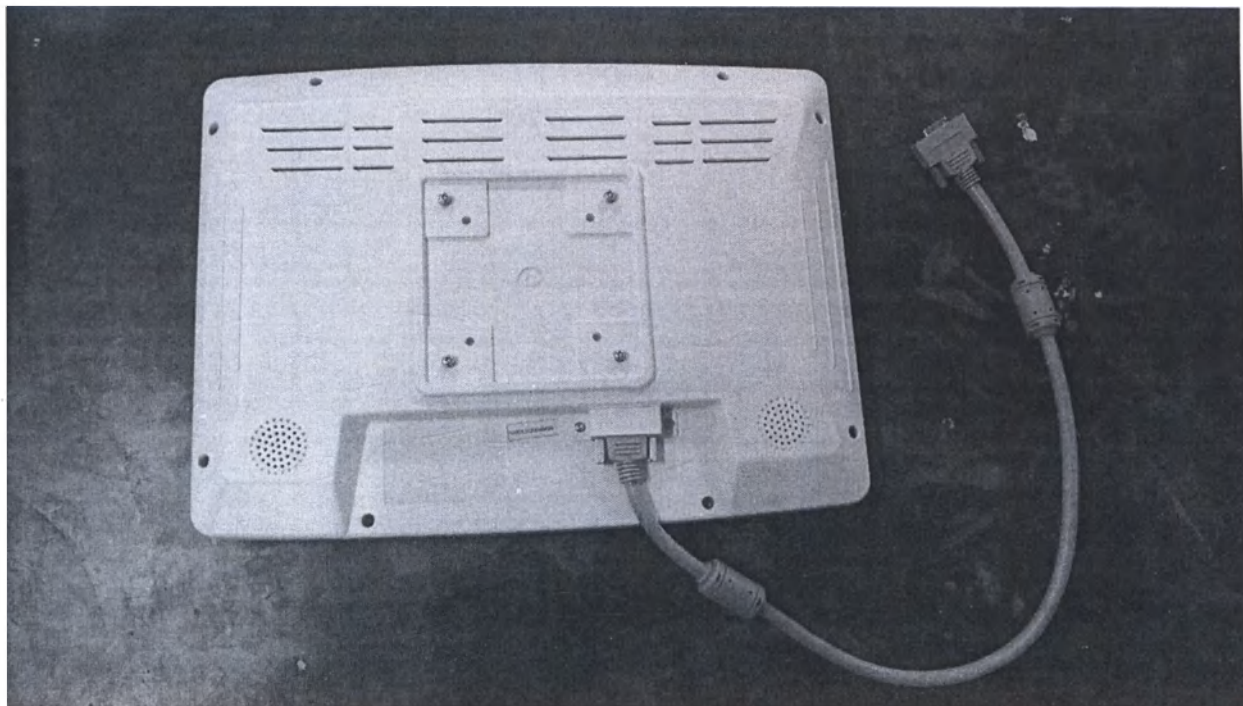


28. Кабель сетевой увлажнителя дыхательной смеси – 1 шт.

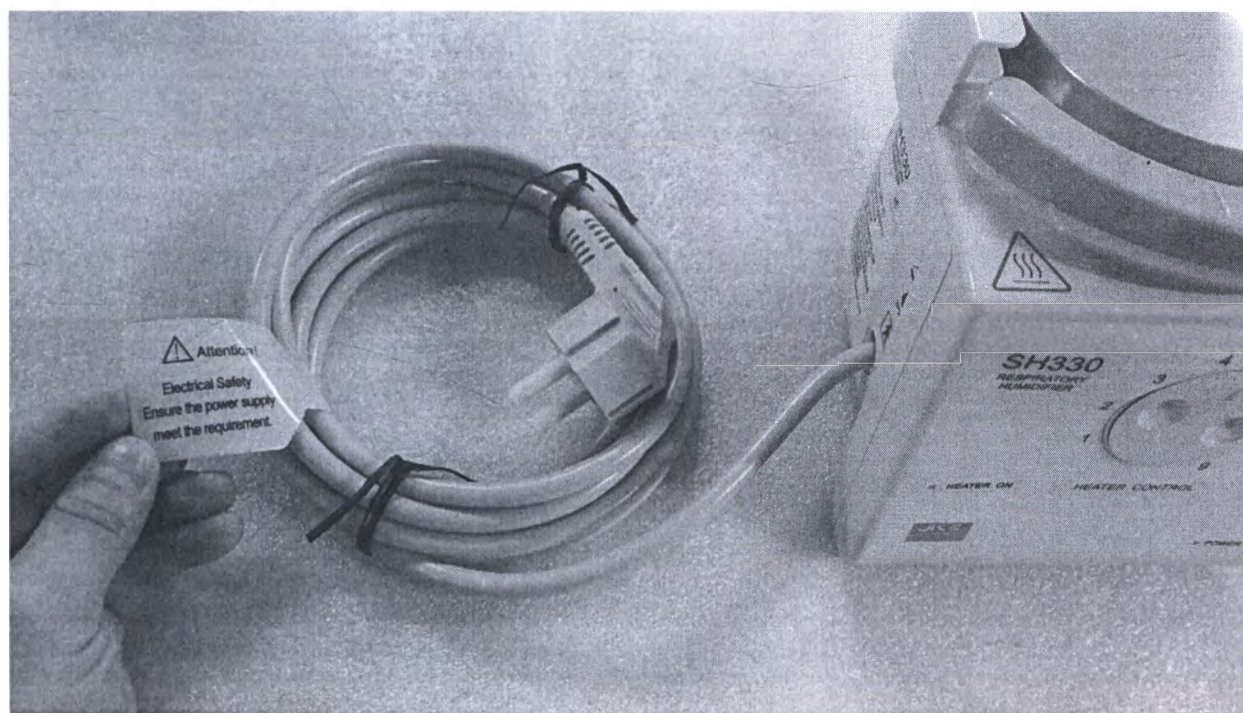

29. Кабель сетевой для компрессора – 1 шт.




30. Кабель заземления для аппарата ИВЛ – 1 шт.


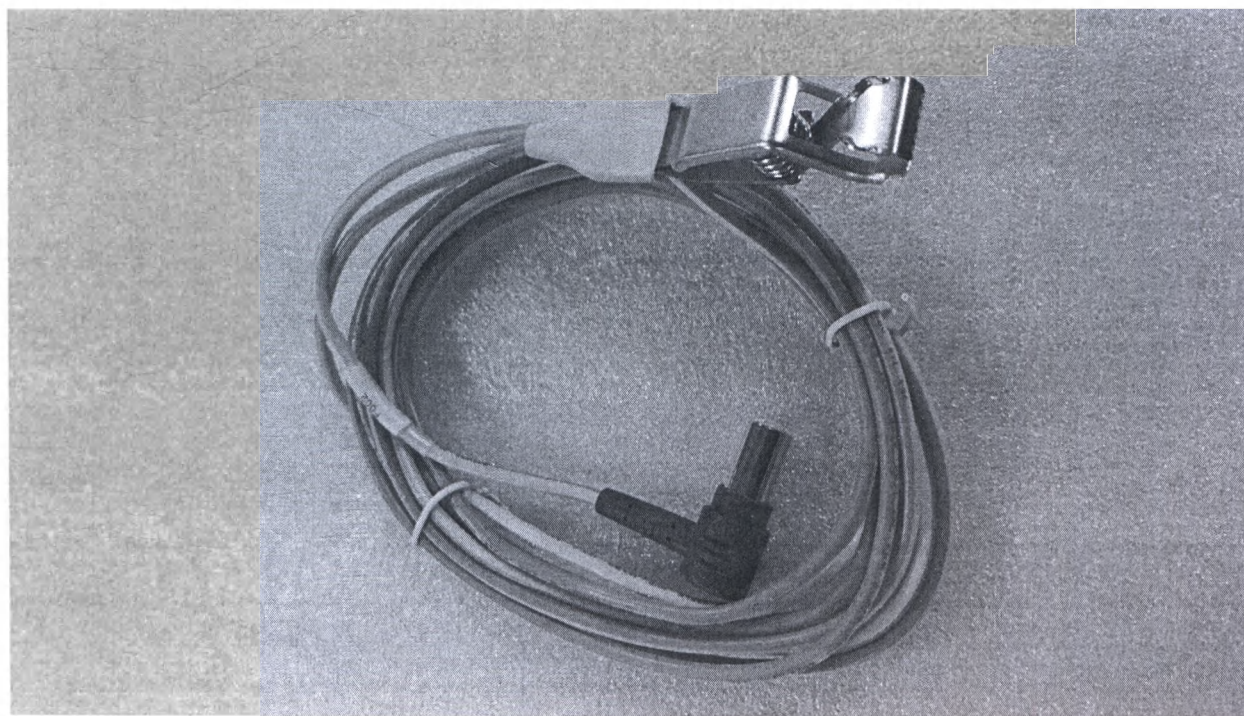


31. Кабель заземления для компрессора – 1 шт.






32. Тележка для аппарата ИВЛ – 1 шт.

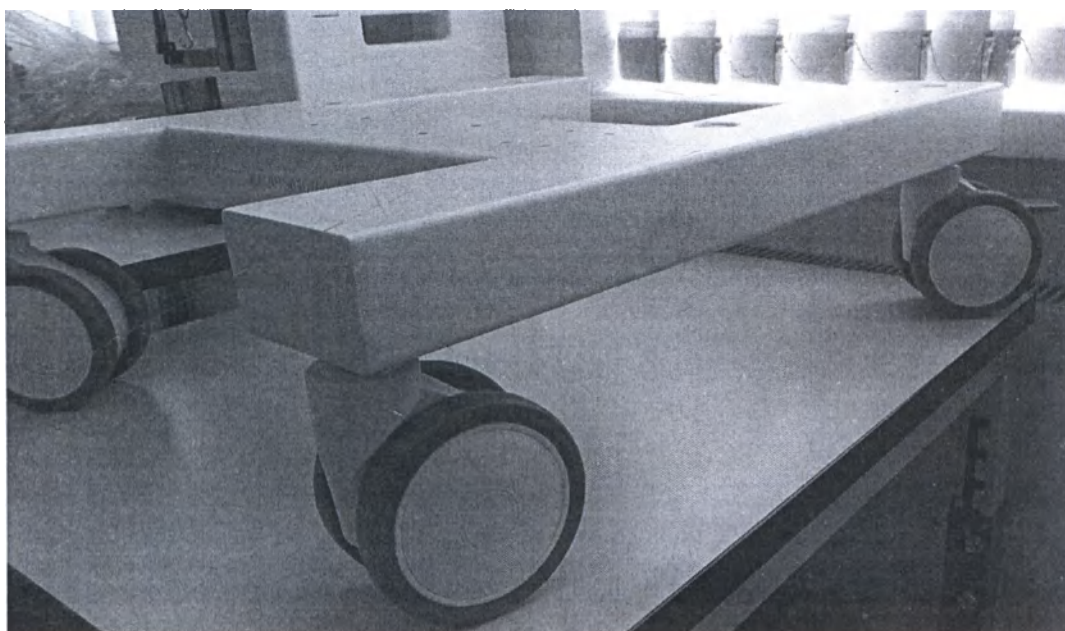

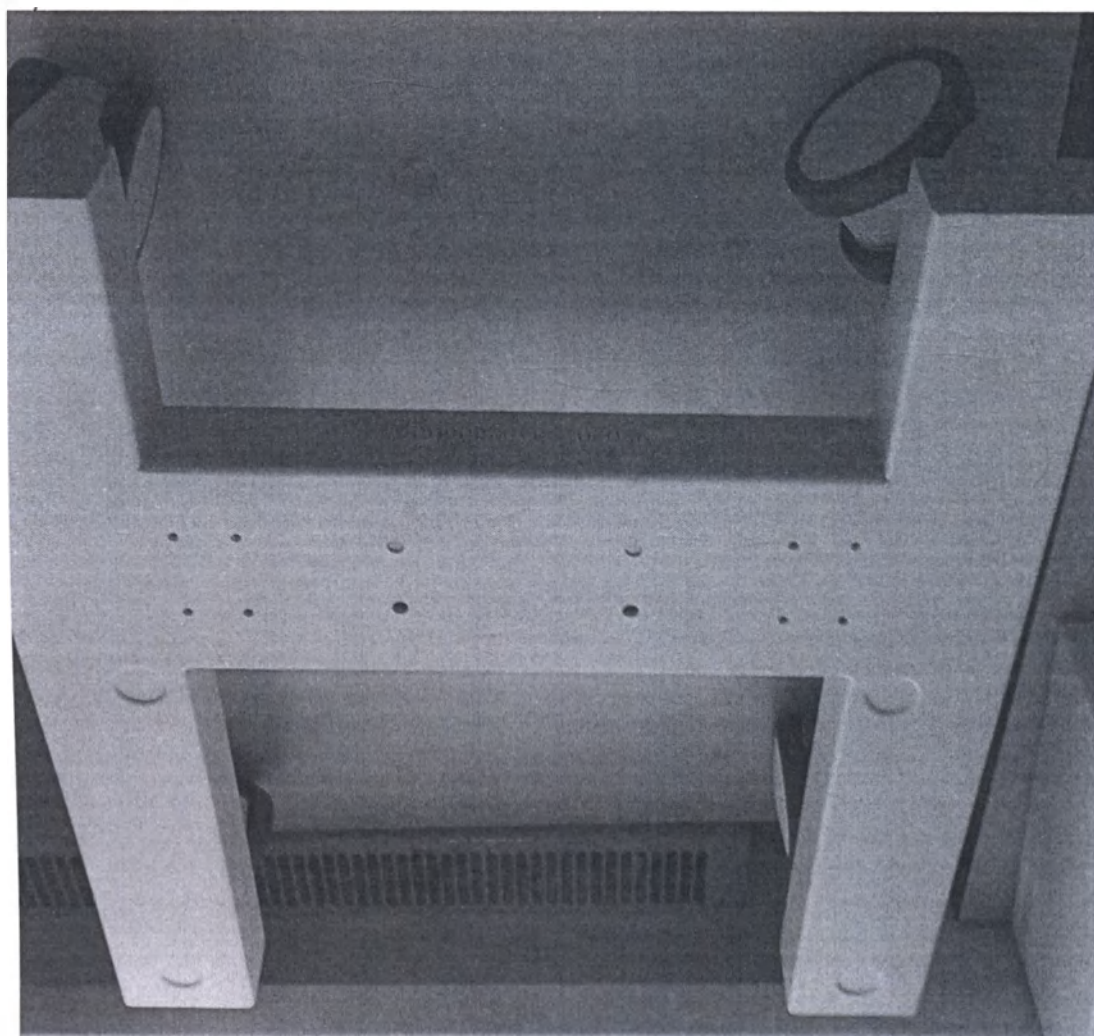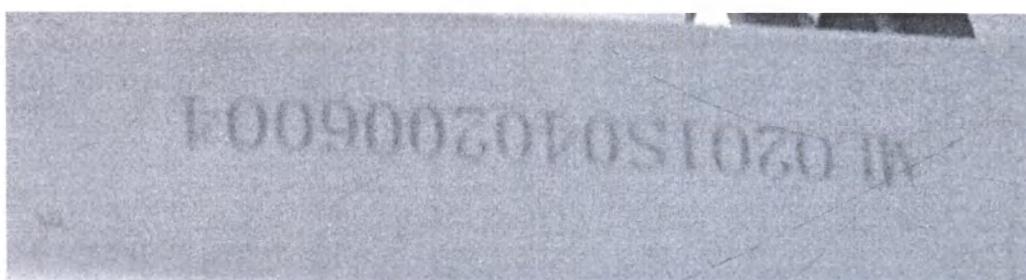


33. Тележка для аппарата ИВЛ с компрессором – 1 шт.

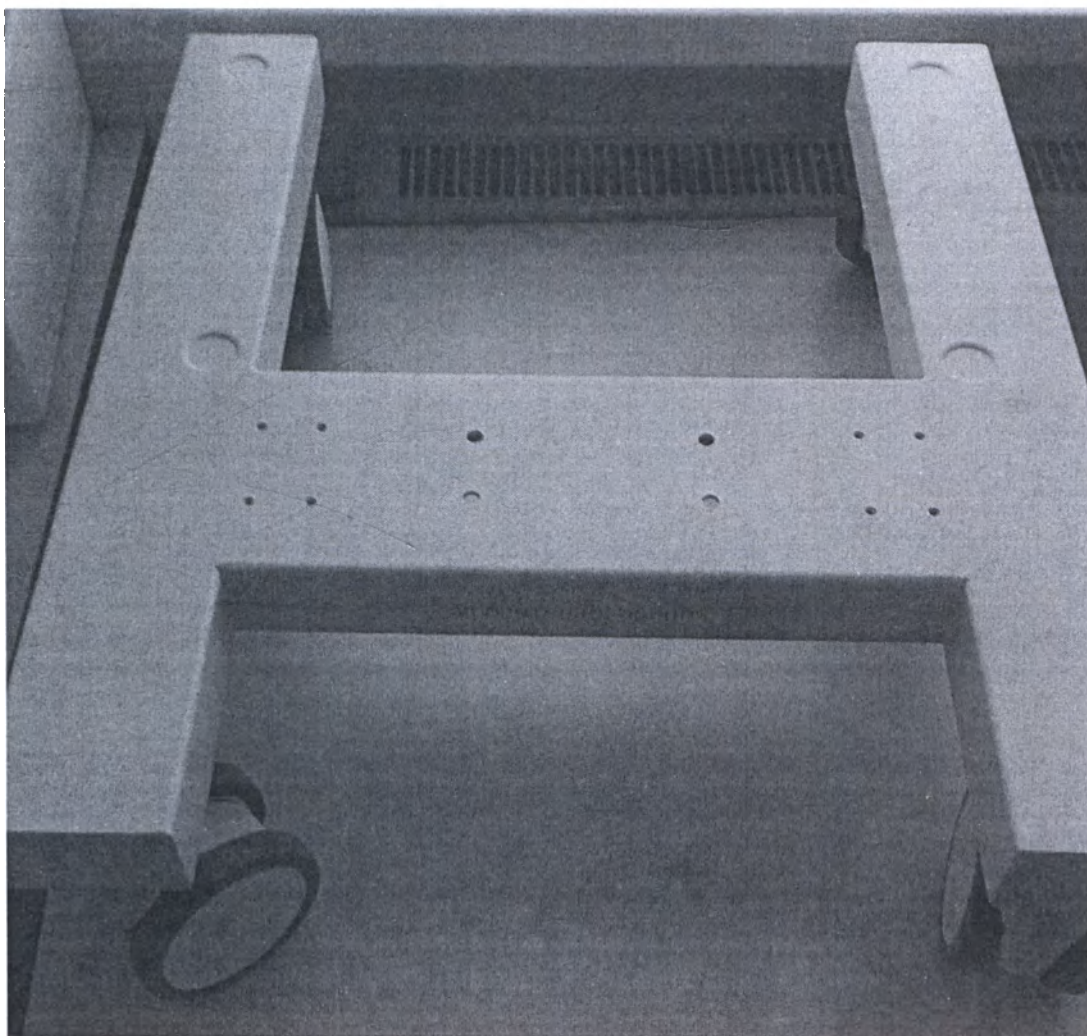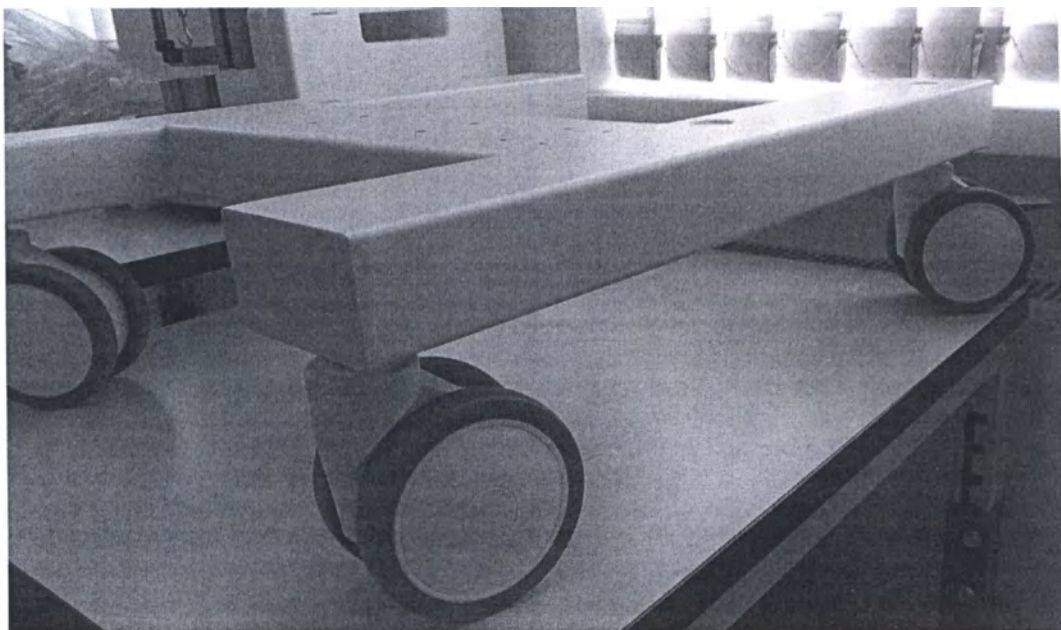

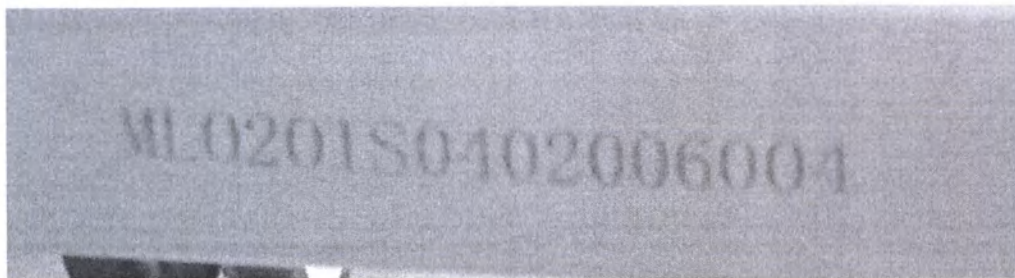


34. Крепление установочное – 1 шт.

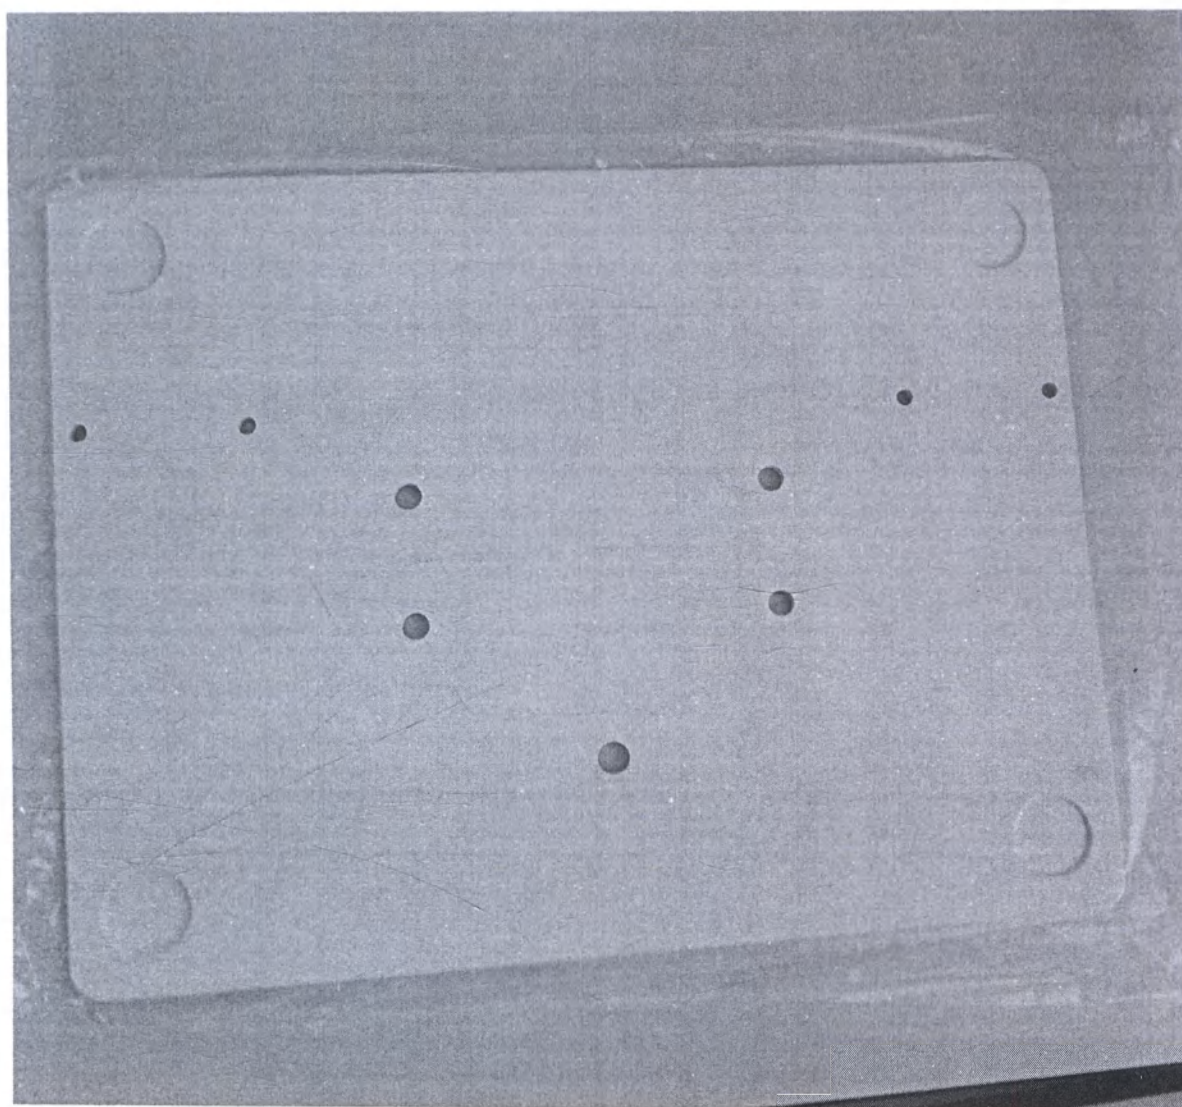

35. Программное обеспечение – 1 шт.

36. Руководство по эксплуатации аппарата ИВЛ – 1 шт.

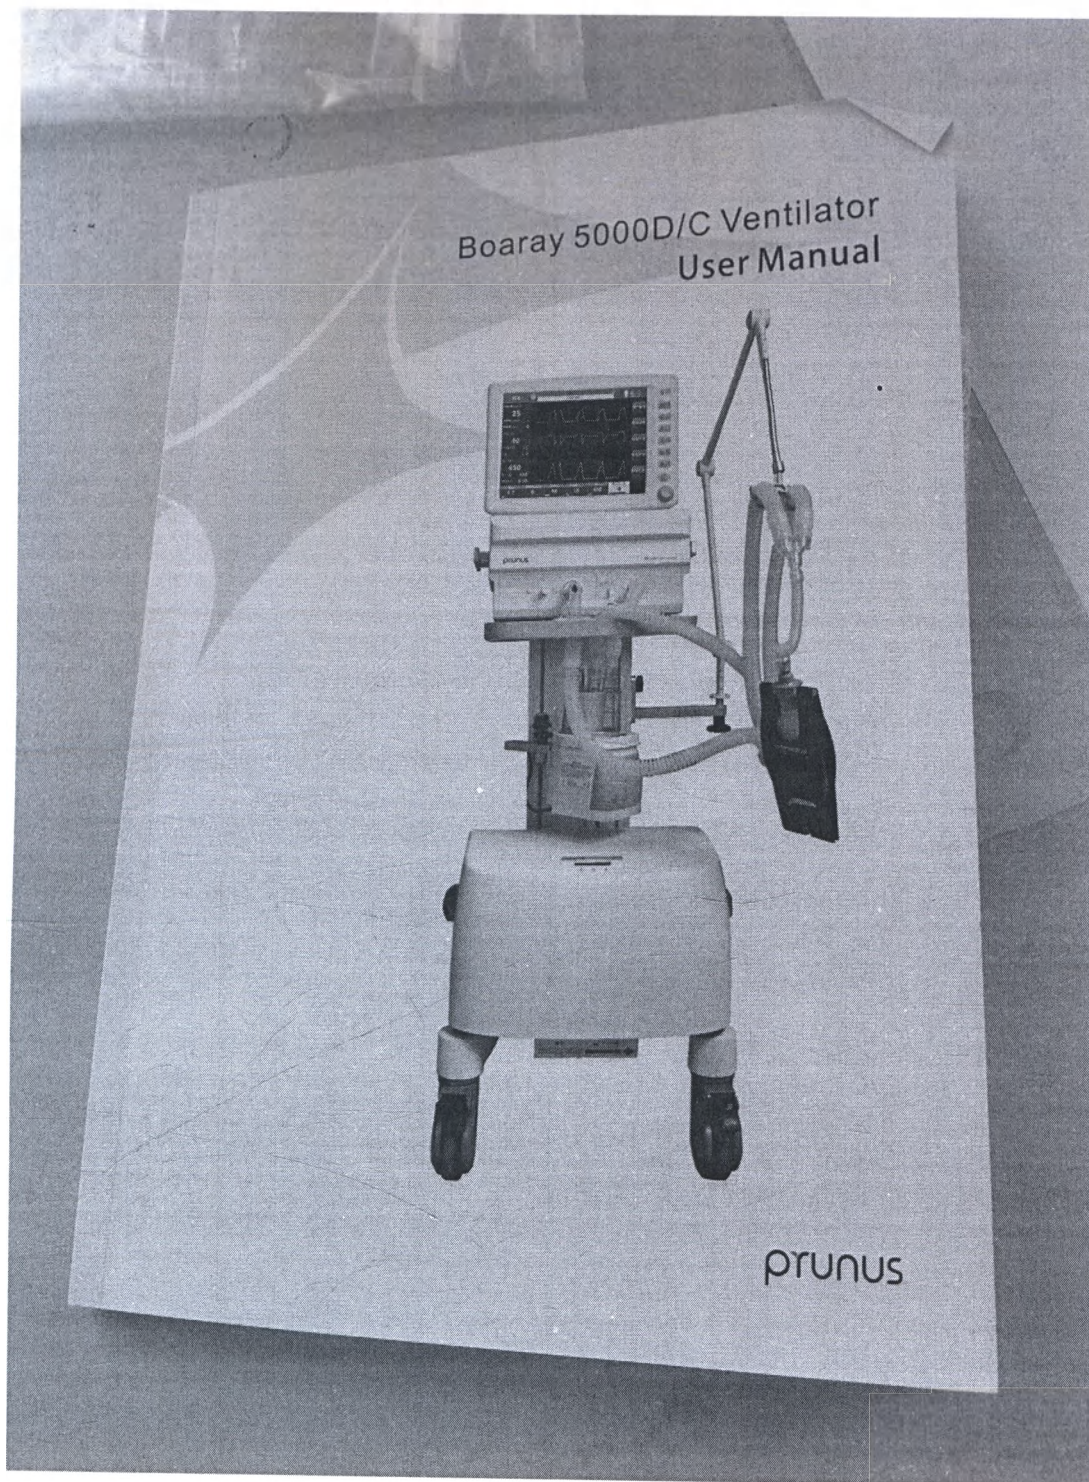

37. Руководство по эксплуатации увлажнителя дыхательной смеси – 1 шт.

9.2 Disassemble the O-ring from the slot of the aluminum base.



Base O-ring

9.3 Install a new O-ring to the slot of the aluminum base.

9.4 Use the hand to press the O-ring evenly into the slot.

9.5 Assemble the aluminum base back to the chamber body.

⚠ Avoid using nail or sharp tool to scratch or damage the seal-ring.

10. Product Specification

	VHC-25 Adult Male/ Male	VHC-25 Adult Male/ Female
Inlet	22mm Male	22mm Female
Outlet	22mm Male	22mm Male
Compressible Volume (Empty)	640 ml	640ml
Compressible Volume (Filled)	140ml	140ml
Maximum Water Level	500ml	500ml
Compliance (Empty)	0.85 ml/cmH2O	0.85 ml/cmH2O
Compliance (Filled)	0.4 ml/cmH2O	0.4 ml/cmH2O
Maximum Flowrate	90LPM	90LPM
Maximum Operation Pressure	165cmH2O	165cmH2O
Gas leakage rate under maximum operation pressure	<5ml / min	<5ml / min

11. Explanation of Symbols

Caution	Consult instructions for use	Manufacturer	Date of manufacture	Use-by date	Authorized representative in the European Community
Batch code	Catalogue number	Fragile, handle with care	This way up	Caution: Federal law restricts this device to use by or on the order of a licensed physician.	

12. Customer Service Contact Information

Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd.

Flat/RM B2, 7/F., Hang Fung Industrial Building, Phase 2, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 2365 5688

Fax: +852 2765 8428

Website: www.inspired-medical.com



Rx ONLY

CE 0197



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd.

Flat/RM B2, 7/F., Hang Fung Industrial Building, Phase 2, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

EC REP

Obelis s.a

Bd Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 732 59 54

Fax: +32 2 732 60 03

E-Mail: mail@obelis.net

US Agent:

MAX SIDNER

MAX SIDNER

22 talega

rancho santa margarita, CA

92688

Phone: 949 8880395 ext

Fax: 949 7130818

Email: MAXSIDNER@COX.NET

A10012778 Rev.G

4/4

Release Date: 2019-07-02

38. Руководство по эксплуатации компрессора – 1 шт.

