



 Главный директор
 ООО «ИИЗБИТ-Лаборатория»
 Шестаков А.Я.
 2019 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Калибраторы Access HCV Ab V3 Calibrators для качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа для анализаторов иммунохимических серии ACCESS system

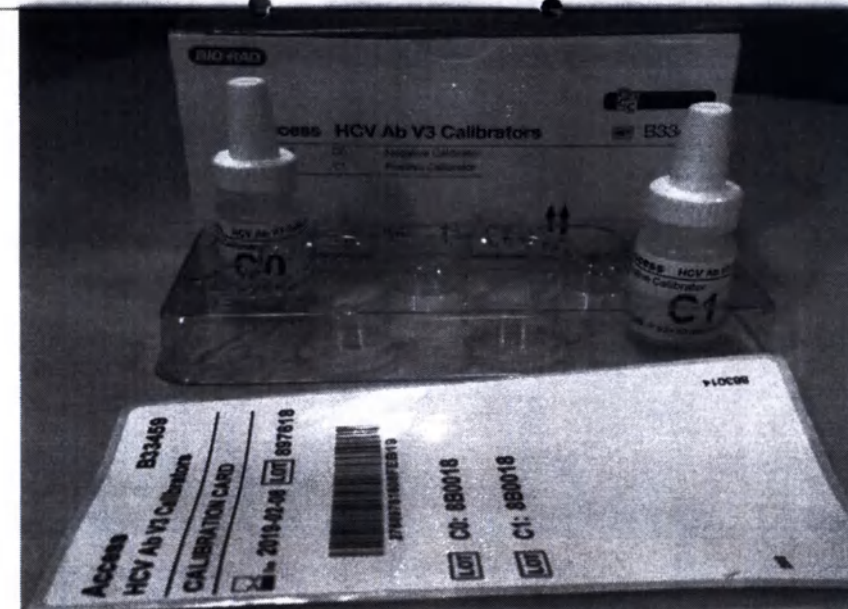


Калибраторы Access HCV Ab V3 Calibrators для качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа для анализаторов иммунохимических серии ACCESS system, в составе:

1. C0: Отрицательный калибратор (Negative Calibrator) - 1 x 1 мл;
2. C1: Положительный калибратор (Positive Calibrator) - 1 x 1 мл;
3. Карта калибровки (Calibration card) - 1 шт.

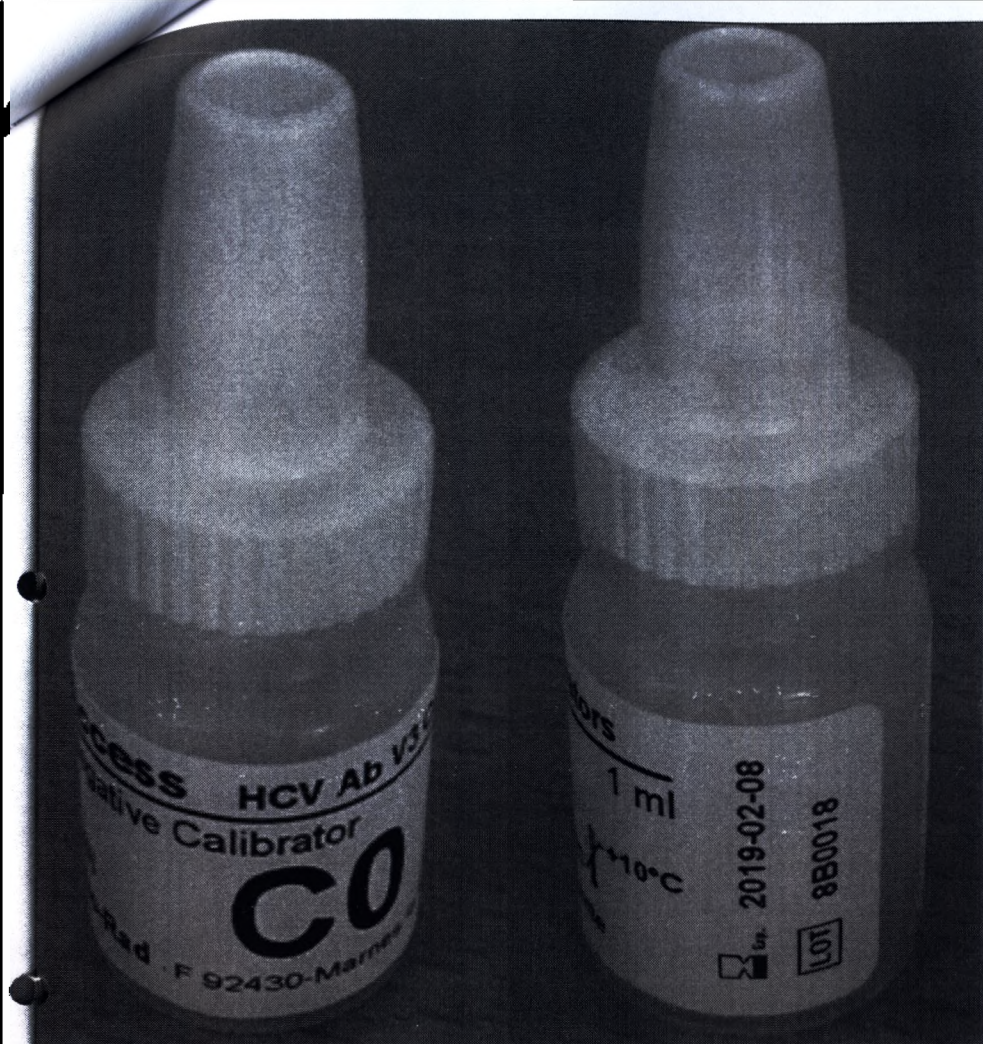

Отрицательный калибратор (Negative Calibrator) - 1 x мл;

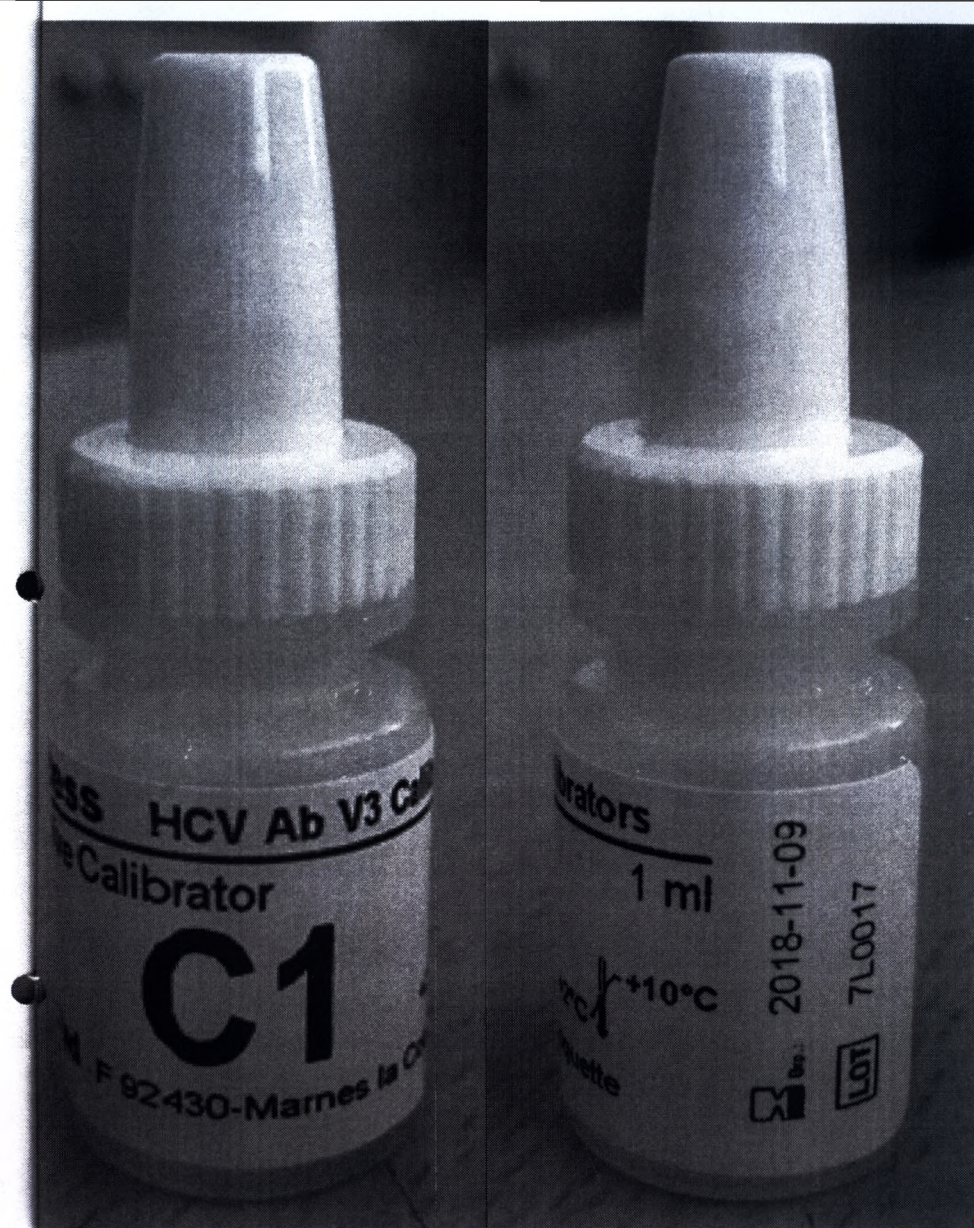

C1: Положительный калибратор (Positive Calibrator) - 1 x мл;

Access B33459
HCV Ab V3 Calibrators

CALIBRATION CARD

Exp. 2018-11-09 LOT 797617



27679761709NOV18


LOT C0: 7L0017

LOT C1: 7L0017

663

883014

Карта калибровки (Calibration card) – 1 шт.

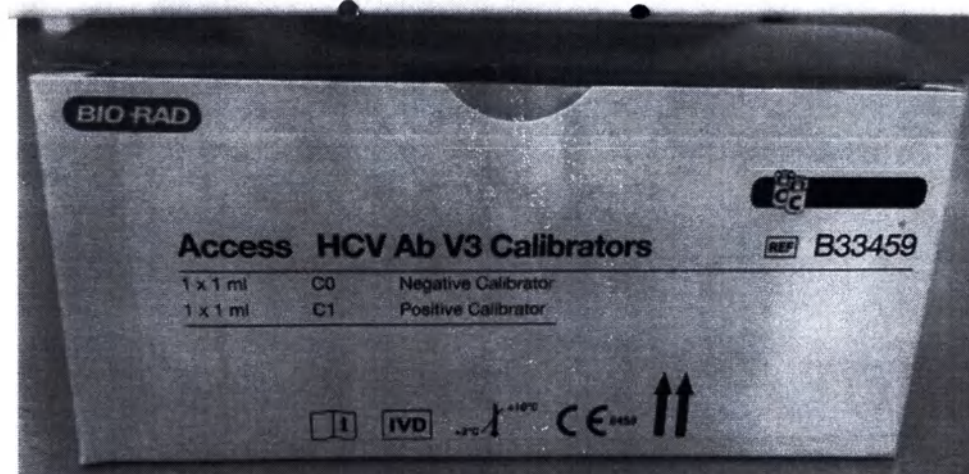

Упаковка медицинского изделия