




Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® ФастКликс».

Комплектация: 1 устройство для прокалывания; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.

* Тип шрифта на макете может быть изменен.

* Данные на финальной маркировке могут отличаться в рамках регуляторной информации, указанной в досье и регистрационном удостоверении

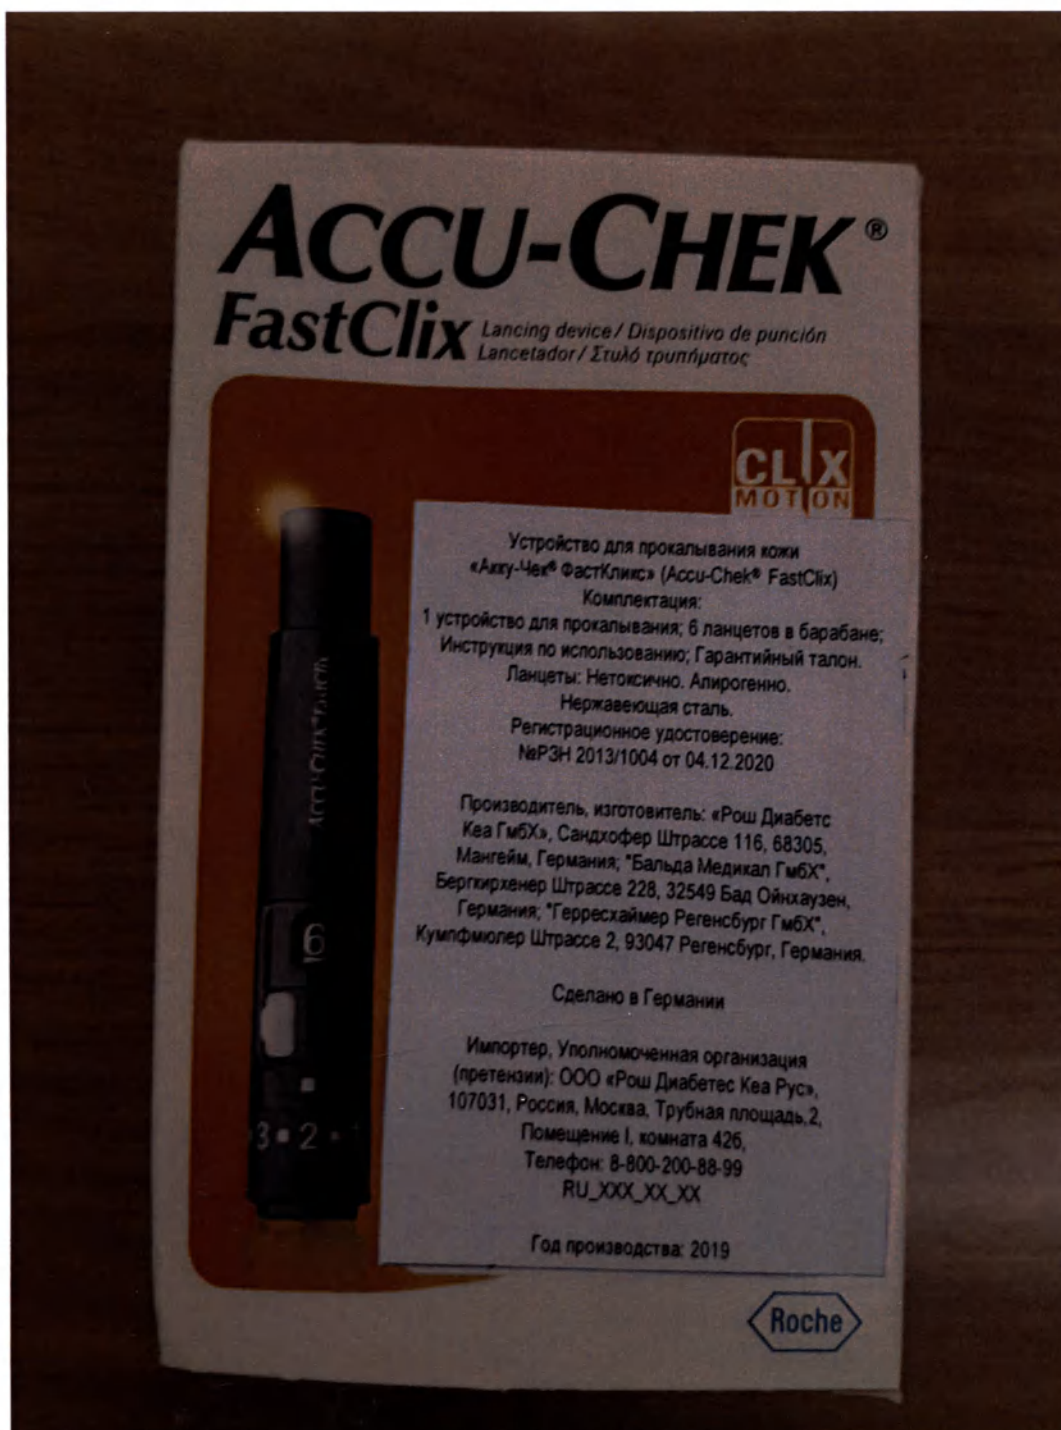

Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® ФастКликс» (Accu-Chek® FastClix)

Комплектация: Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 6 ланцетов в барабане;
 Инструкция по использованию; Гарантийный талон.

* Тип шрифта на макете может быть изменен.

* Данные на финальной маркировке могут отличаться в рамках регуляторной
 информации, указанной в досье и регистрационном удостоверении



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® ФастКликс» (Accu-Chek® FastClix)

Комплектация: Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 6 ланцетов в барабане;
Инструкция по использованию; Гарантийный талон.



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® ФастКликс» (Accu-Chek® FastClix)

Комплектация: Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 6 ланцетов в барабане;
Инструкция по использованию; Гарантийный талон.



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® ФастКликс» (Accu-Chek® FastClix)

Комплектация: Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 1 насадка для получения капли крови; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.

* Тип шрифта на макете может быть изменен.

* Данные на финальной маркировке могут отличаться в рамках регуляторной информации, указанной в досье и регистрационном удостоверении



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® Софткликс» (Accu-Chek® Softclix).

Комплектация: 1 устройство для прокалывания; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.

* Тип шрифта на макете может быть изменен.

* Данные на финальной маркировке могут отличаться в рамках регуляторной информации, указанной в досье и регистрационном удостоверении

ACCU-CHEK®

Softclix

Stechhilfe / Autopiqueur
Pungidito / Dispositivo de punción
Dispositivo de punção / Priksen



Устройство для прокалывания кожи
«Акку-Чек® Софткликс» (Accu-Chek® Softclix)

Комплектация:

1 устройство для прокалывания; 25 ланцетов;
Инструкция по использованию; Гарантийный талон.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Не предназначено для профессионального
использования.

Ланцеты: Нетоксично. Алирогенно.
Нержавеющая сталь.

Регистрационное удостоверение:
№РЗН 2013/1004 от 04.12.2020

Производитель, изготовитель: «Рош Диабетс
Кеа ГмбХ», Сандхофер Штрассе 116, 68305,
Мангейм, Германия; *Эйч Ти Эль-Стрефа Эс. Эй*,
улица Адамовек 7, 95-035, Озорков, Польша,
Бальда Медикал ГмбХ,
Бергхирхенер Штрассе 228, 32549 Бад Ойнхаузен,
Германия.

Сделано в Германии

Импортёр, Уполномоченная организация
(претензии): ООО «Рош Диабетс Кеа Рус»,
107031, Россия, Москва, Трубная площадь, 2,
Помещение I, комната 426,
Телефон: 8-800-200-88-99
RU_XXX_XX_XX

Год производства: 2020

Roche

Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® Софткликс» (Accu-Chek® Softclix).

Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 25 ланцетов; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.

* Тип шрифта на макете может быть изменен.

* Данные на финальной маркировке могут отличаться в рамках регуляторной информации, указанной в досье и регистрационном удостоверении



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® Софткликс» (Accu-Chek® Softclix).

Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 25 ланцетов; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® Софткликс» (Accu-Chek® Softclix).

Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 25 ланцетов; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.



Устройство для прокалывания кожи «Акку-Чек® Софткликс» (Accu-Chek® Softclix).

Комплектация: 1 устройство для прокалывания; 1 насадка для получения капли крови; Инструкция по использованию; Гарантийный талон.

* Тип шрифта на макете может быть изменен.

* Данные на финальной маркировке могут отличаться в рамках регуляторной информации, указанной в досье и регистрационном удостоверении



По зав.
№ 1375-20
от 17.08.20