


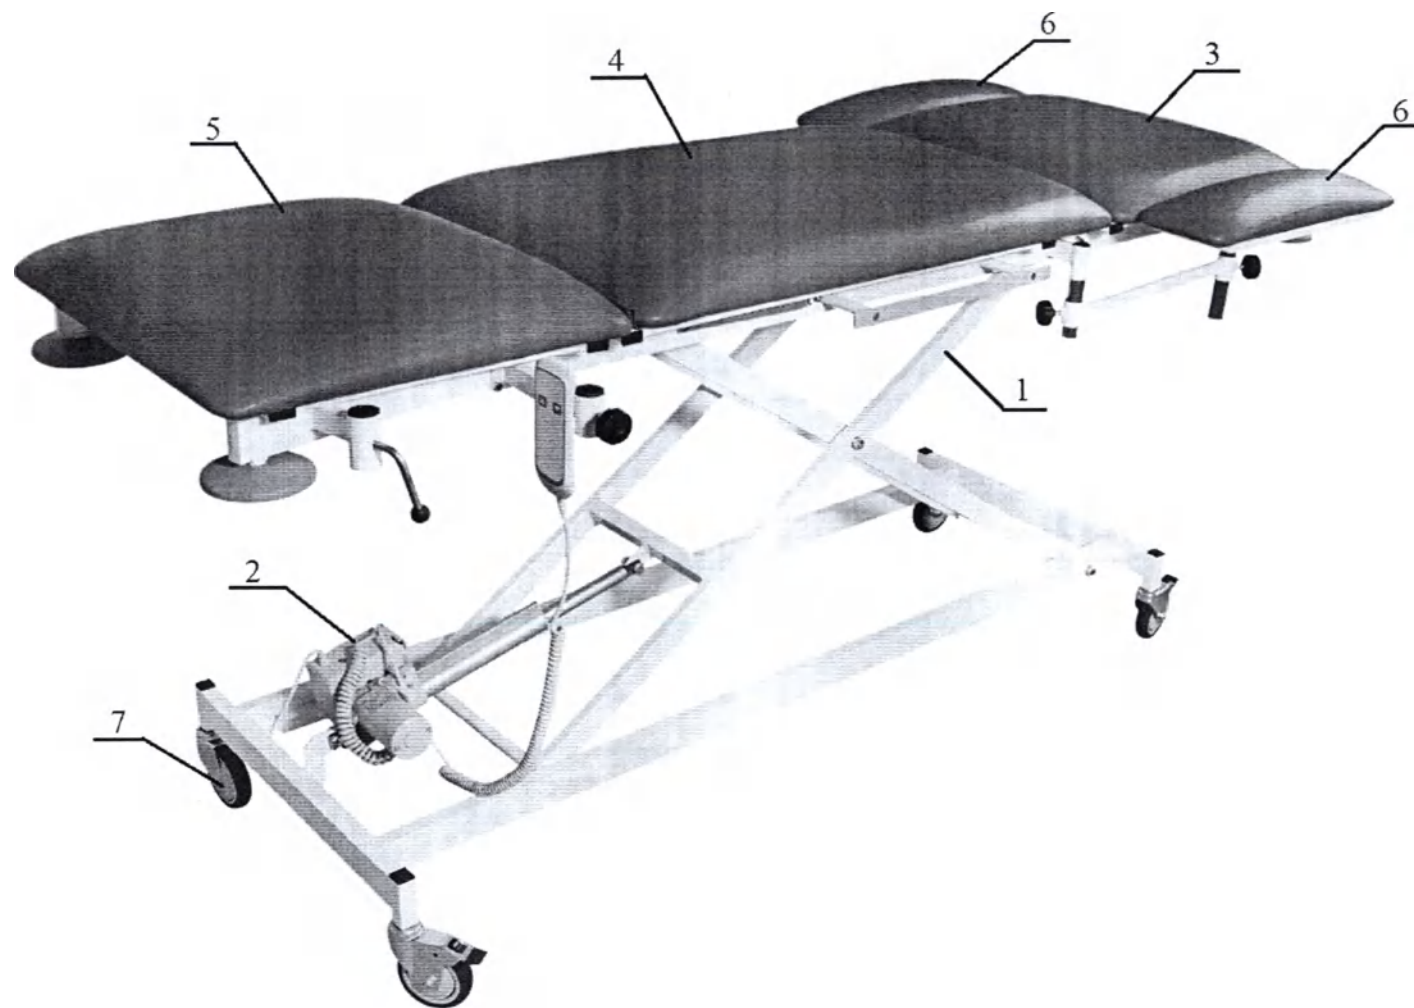


1 – стол; 2 – электропривод; 3 – подголовник; 4 – спинная секция; 5 – ножная секция; 6 – подлокотник; 7 – колесо

Рисунок 1 – Стол для перевязок и процедур СППэ VLANA



Рисунок 2 – Штатив для вливаний

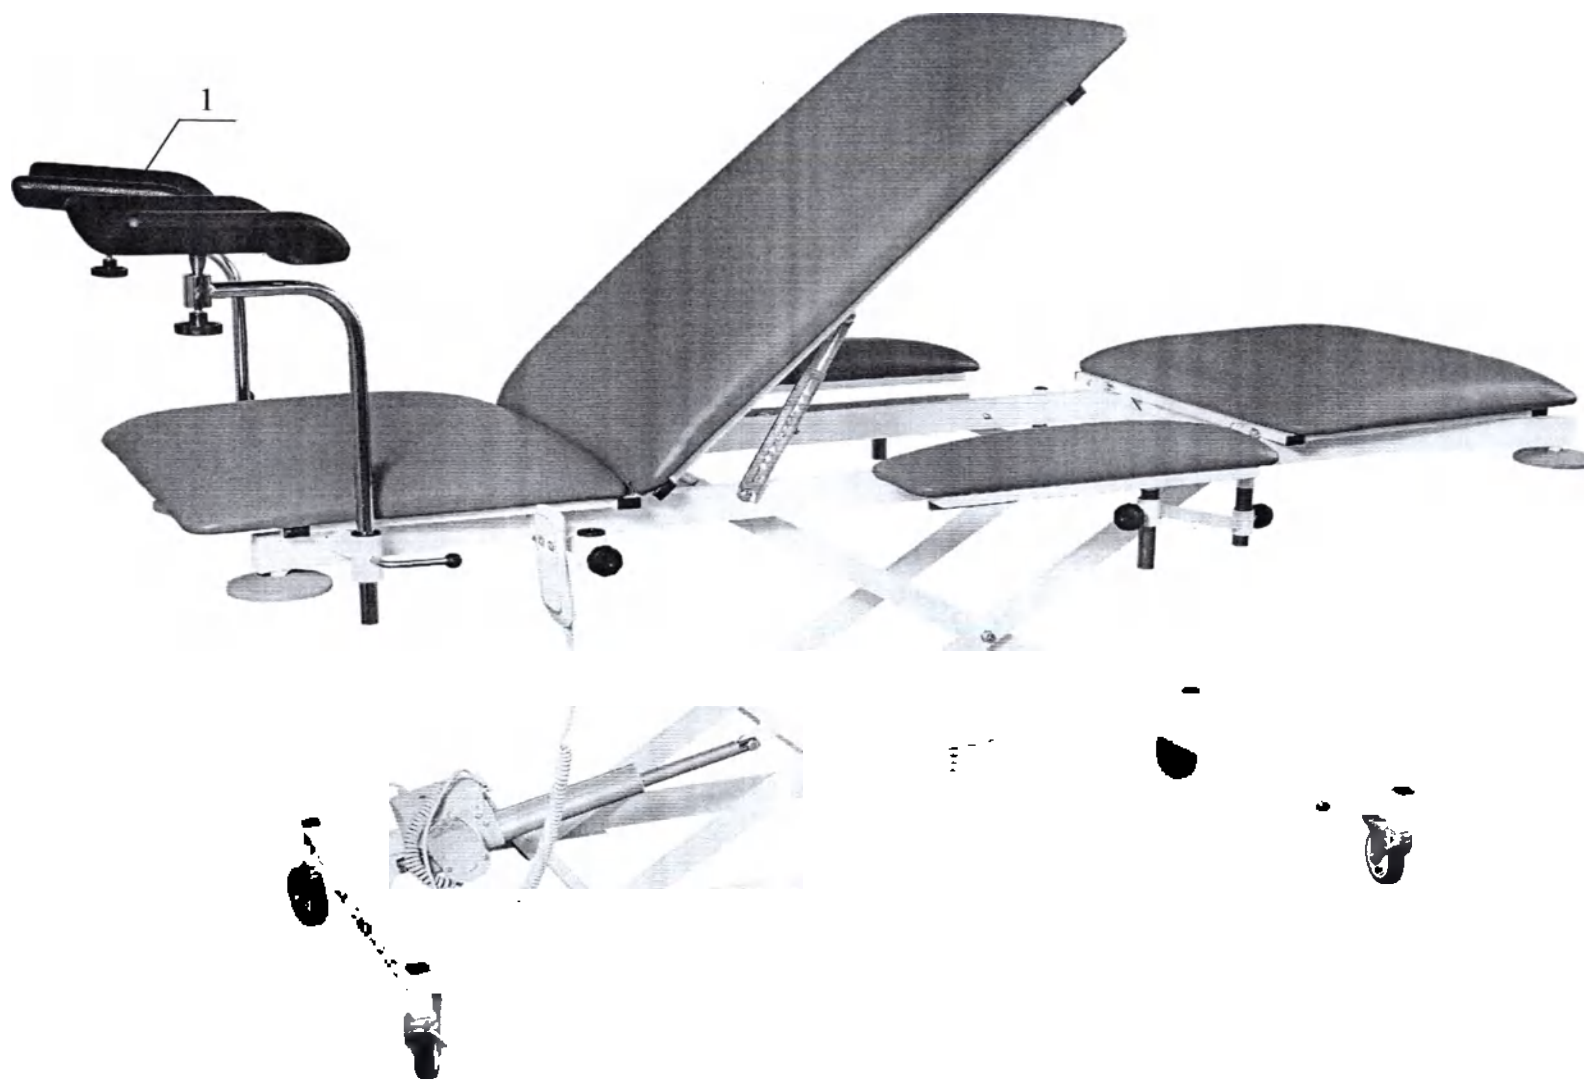

1 – подколенные упоры

Рисунок 3 – Подколенные упоры, установленные на столе СППэ VLANA

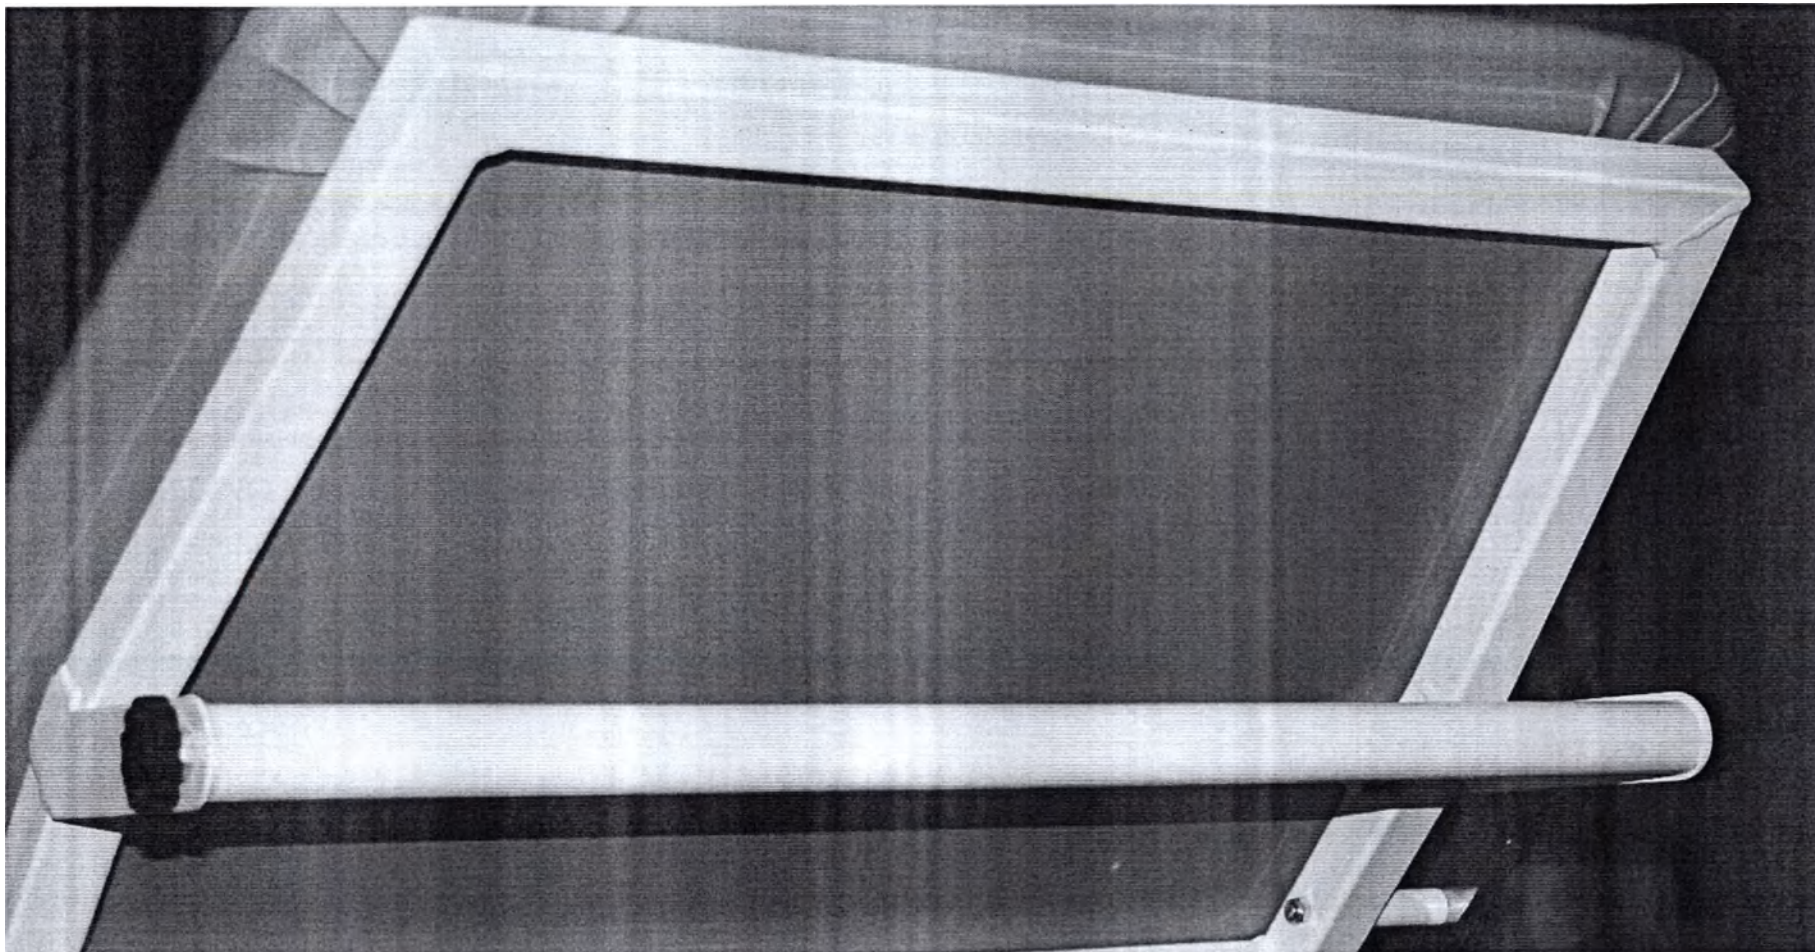


Рисунок 4 – Держатель рулонных полотенец

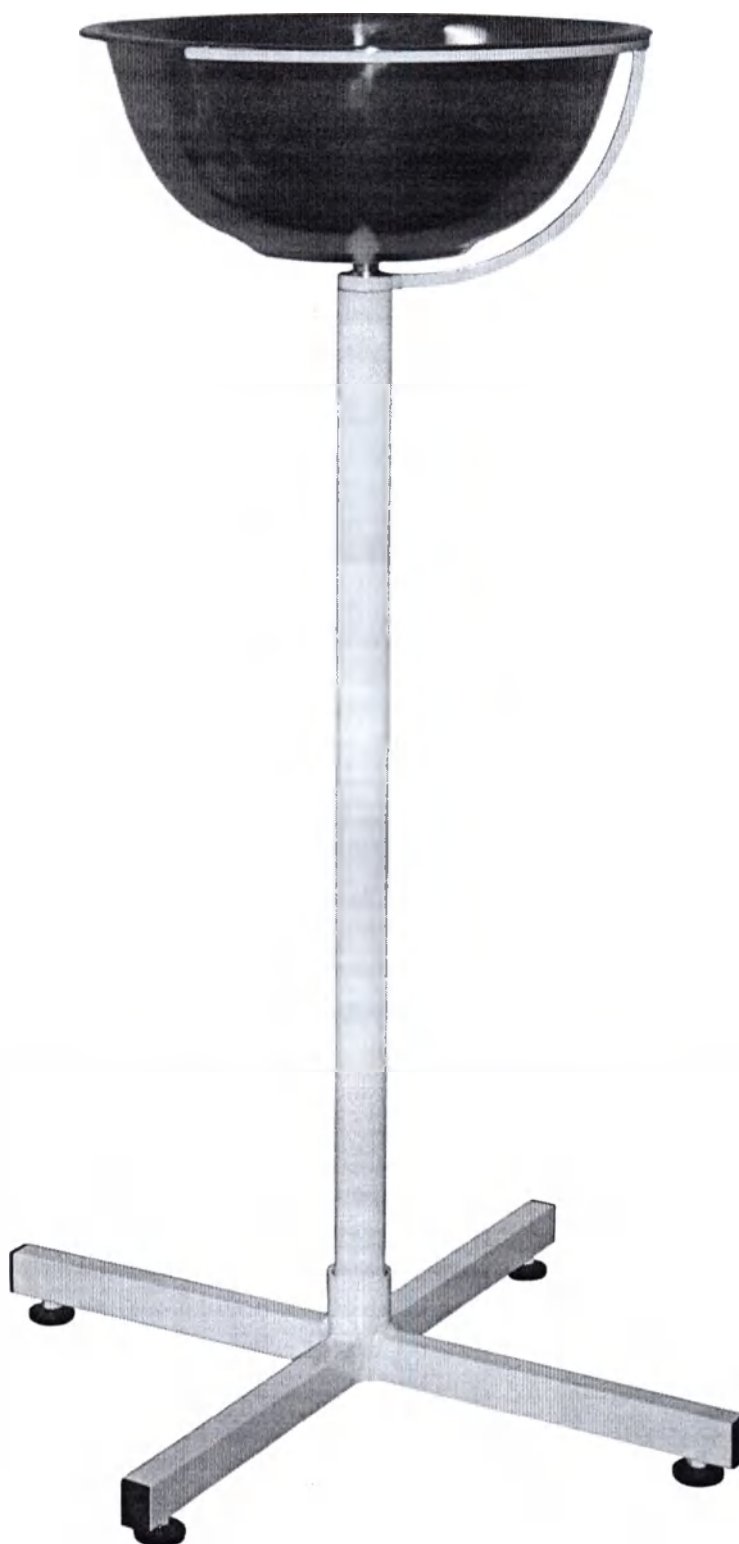


Рисунок 5 – Подставка под таз в комплекте с тазом



Рисунок 6 – Подставка под таз в комплекте с двумя тазами



Рисунок 7 – Табурет врача



Рисунок 8 – Стул врача

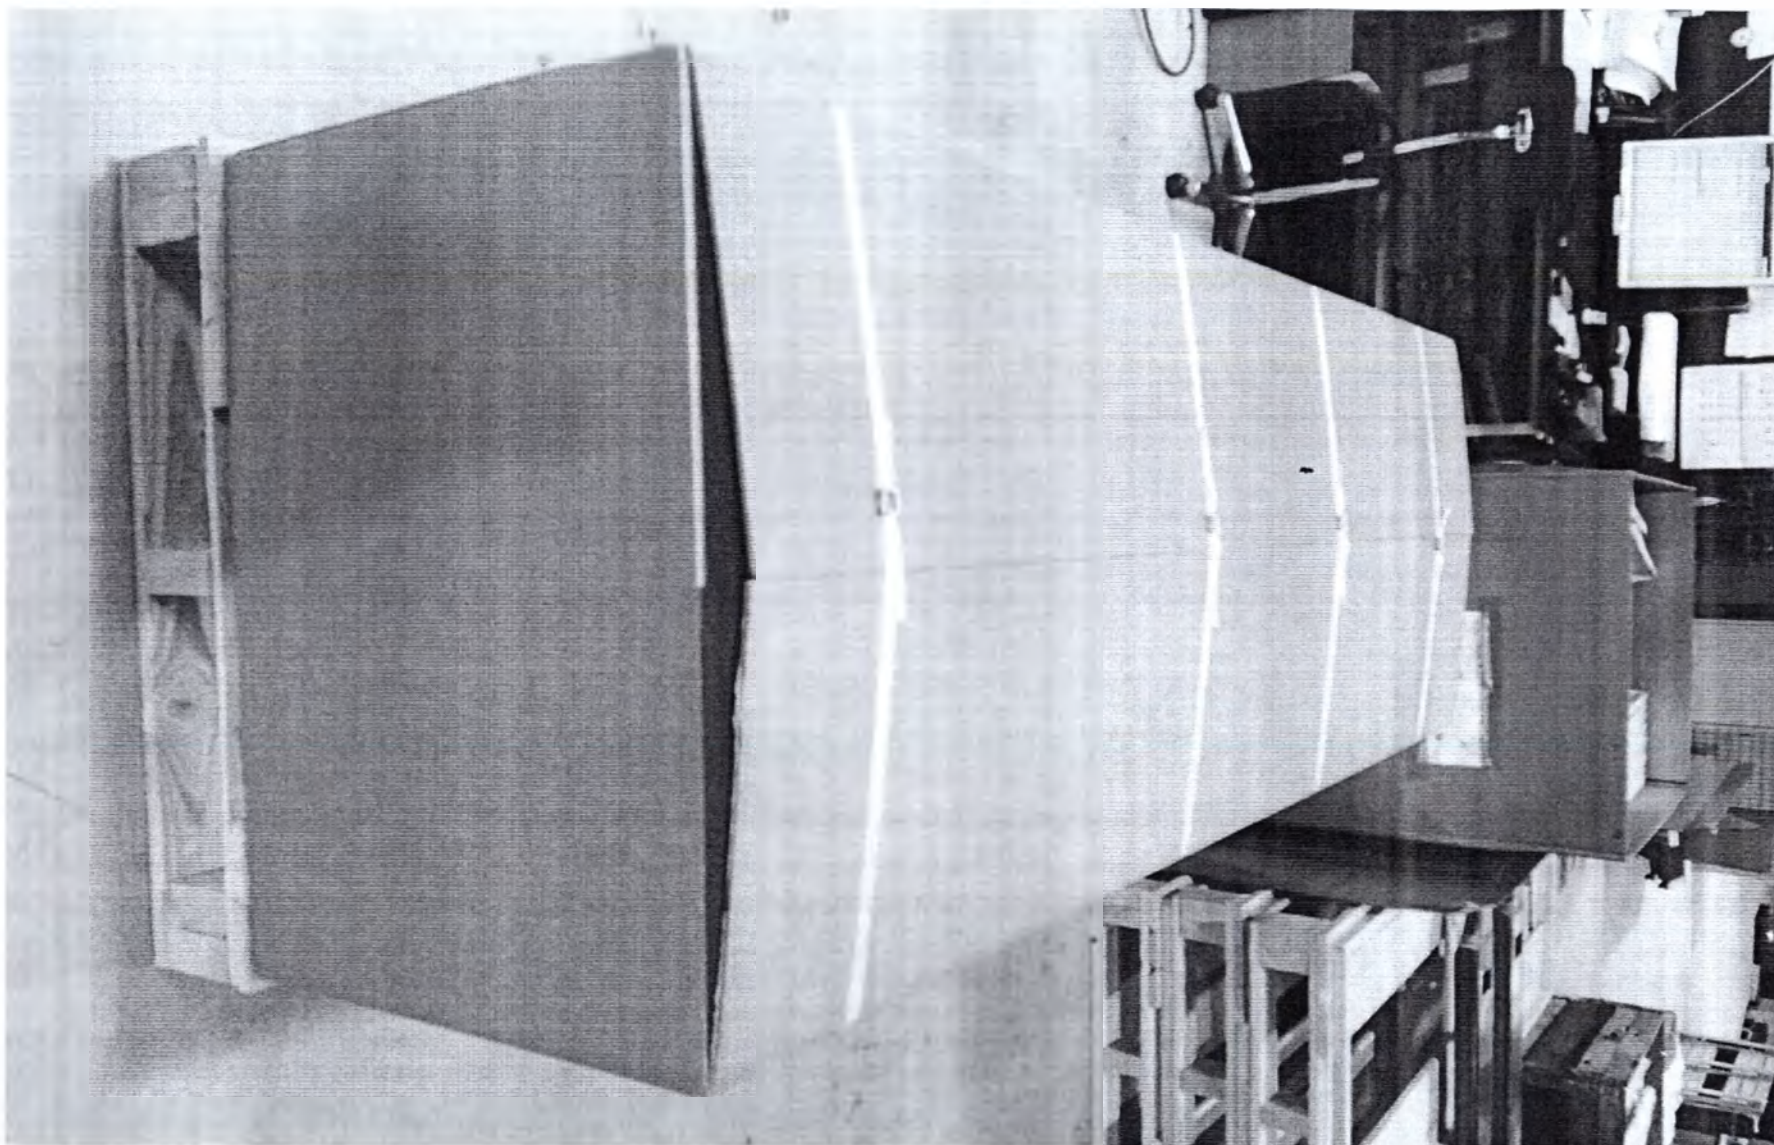


Рисунок 9 – Фото упаковки стола СПП VLANA

Стол для перевязок и процедур СППэ VLANA

ТУ 32.50.50-003-91587838-2017

Зав. № 010/18

Потребляемая мощность: 300 ВА

Номинальное напряжение, частота питающей сети: 220 В, 50 Гц

Режим работы: повторно-кратковременный, 2 мин/18 мин

Класс защиты: IP 43

Производитель: ООО «Горское»

127055 г. Москва, Порядковый пер., д. 19, стр. 2, оф. 23

Год выпуска: 2017



Рисунок 10 – Фото макета маркировки стола для перевязок и процедур СППэ VLANA