





Генеральный директор
Лукин А.Е.




Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДСТОР» в вариантах исполнения по ту 32.50.50-002-05772658-2020 (Шнур питания)

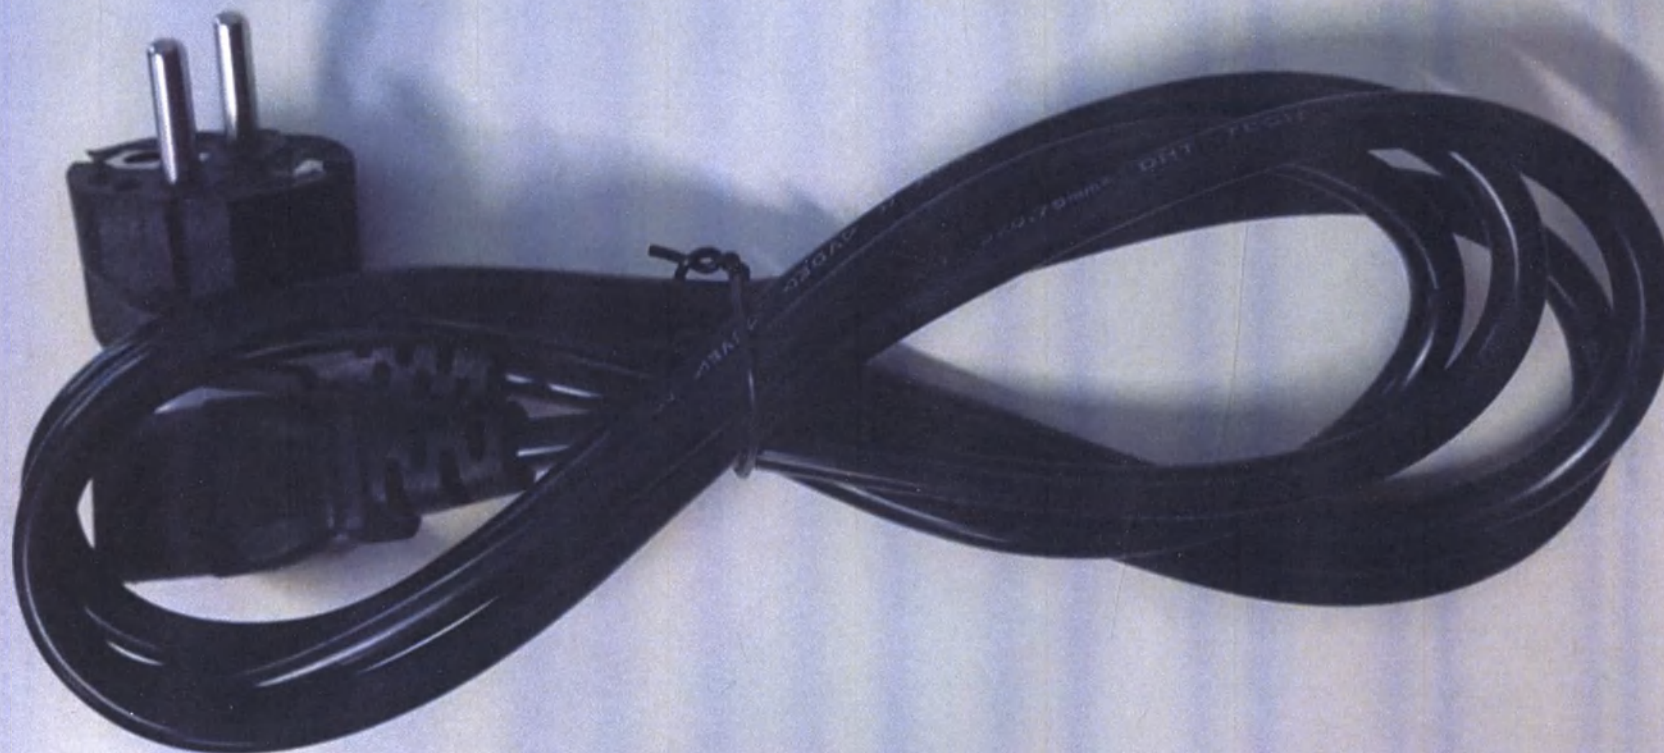

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДСТОП» в вариантах исполнения по ту 32.50.50-002-05772658-2020 (Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДСТОП» артикулы: MEDSTORE-2 PLUS/ MEDSTORE-1 PLUS/ MEDSTORE)

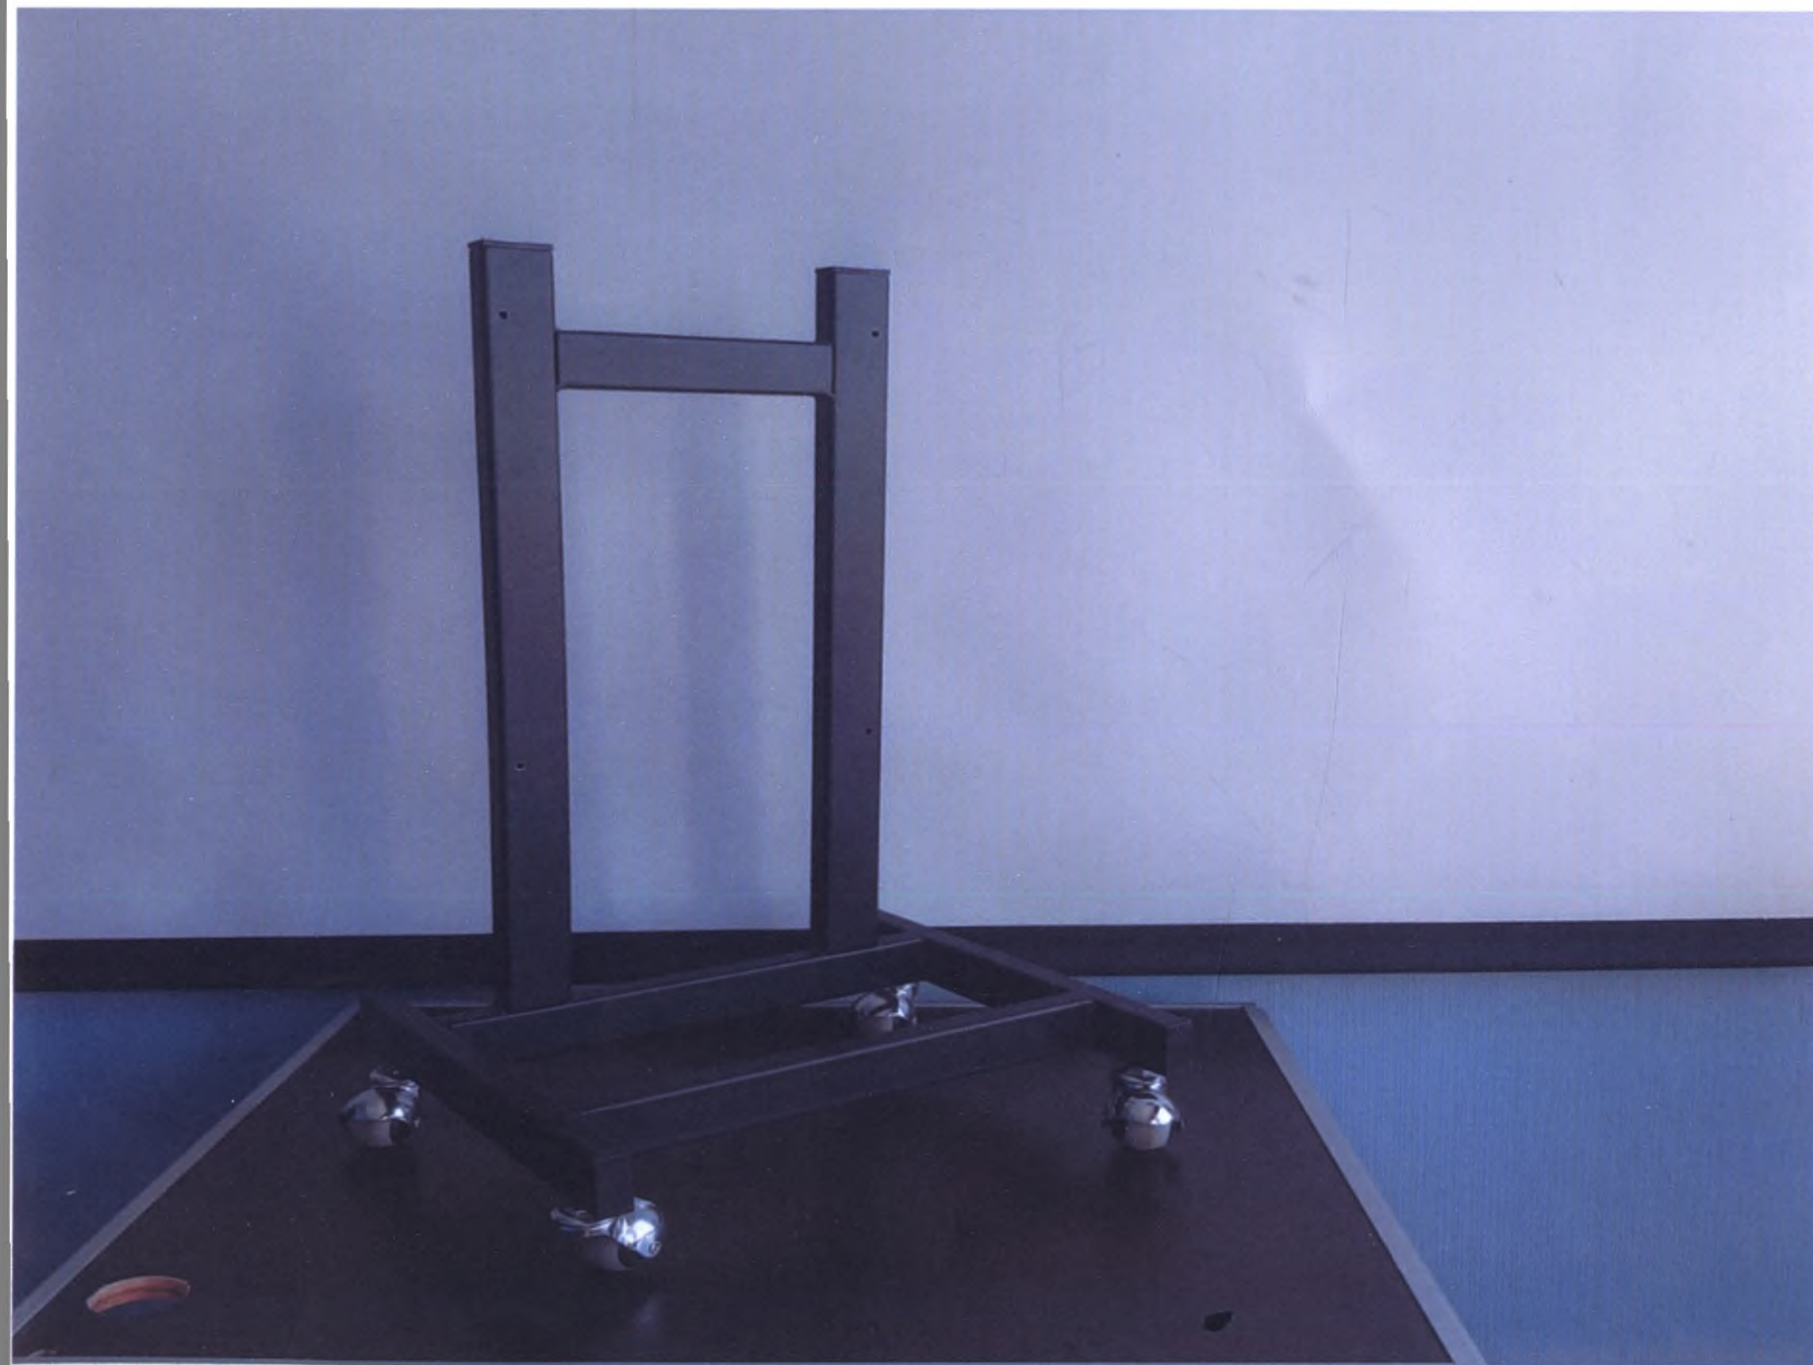

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДСТОП» в вариантах исполнения по ту 32.50.50-002-05772658-2020 (Держатель напольный)

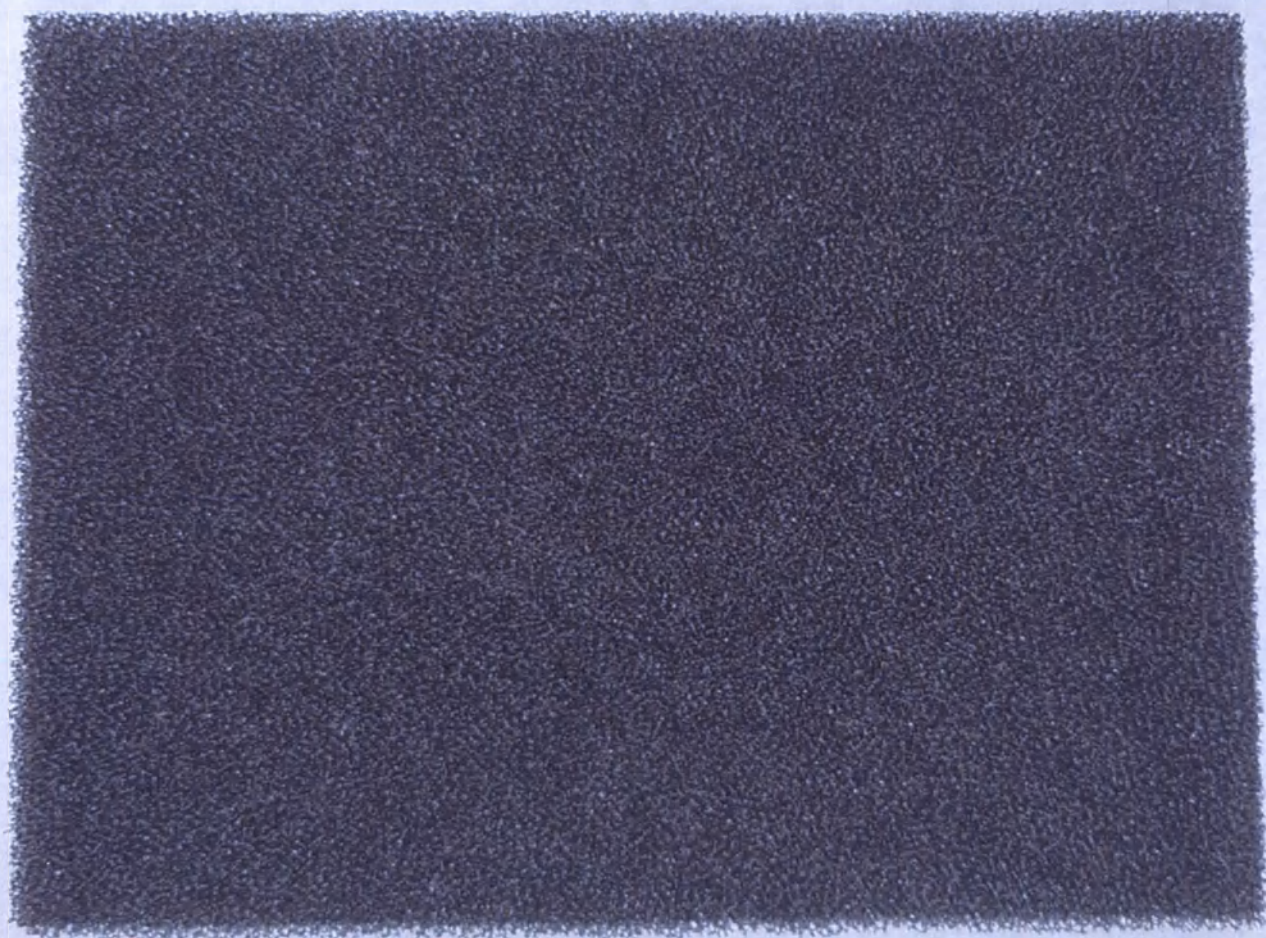

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДСТОП» в вариантах исполнения по ту 32.50.50-002-05772658-2020 (Сменный фильтр)

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ MEDSTORE-2 PLUS

ТУ 32.50.50-002-05772658-2020



MEDSTORE-2 PLUS

Потребляемая мощность: 110ВА



10042020-03

Напряжение питания: 220±22В

Частота: 50 Гц



2020-04



ООО «Медстор»

194044, Санкт-Петербург г,
Выборгская наб, дом № 29, литера А,
помещение 12-Н:20-24, офис 507

Тел: +7-812-309-92-26

e-mail: zakaz@medstore.pro



MEDSTORE.PRO

во всемирном оборудовании

Прошито и пронумеровано

Исх. № 4 (четыре) листа

Генеральный директор

ООО «МЕДСТОР»

А.Е.Лукин

