



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной рамой Ziehm
Vision RFD 3D

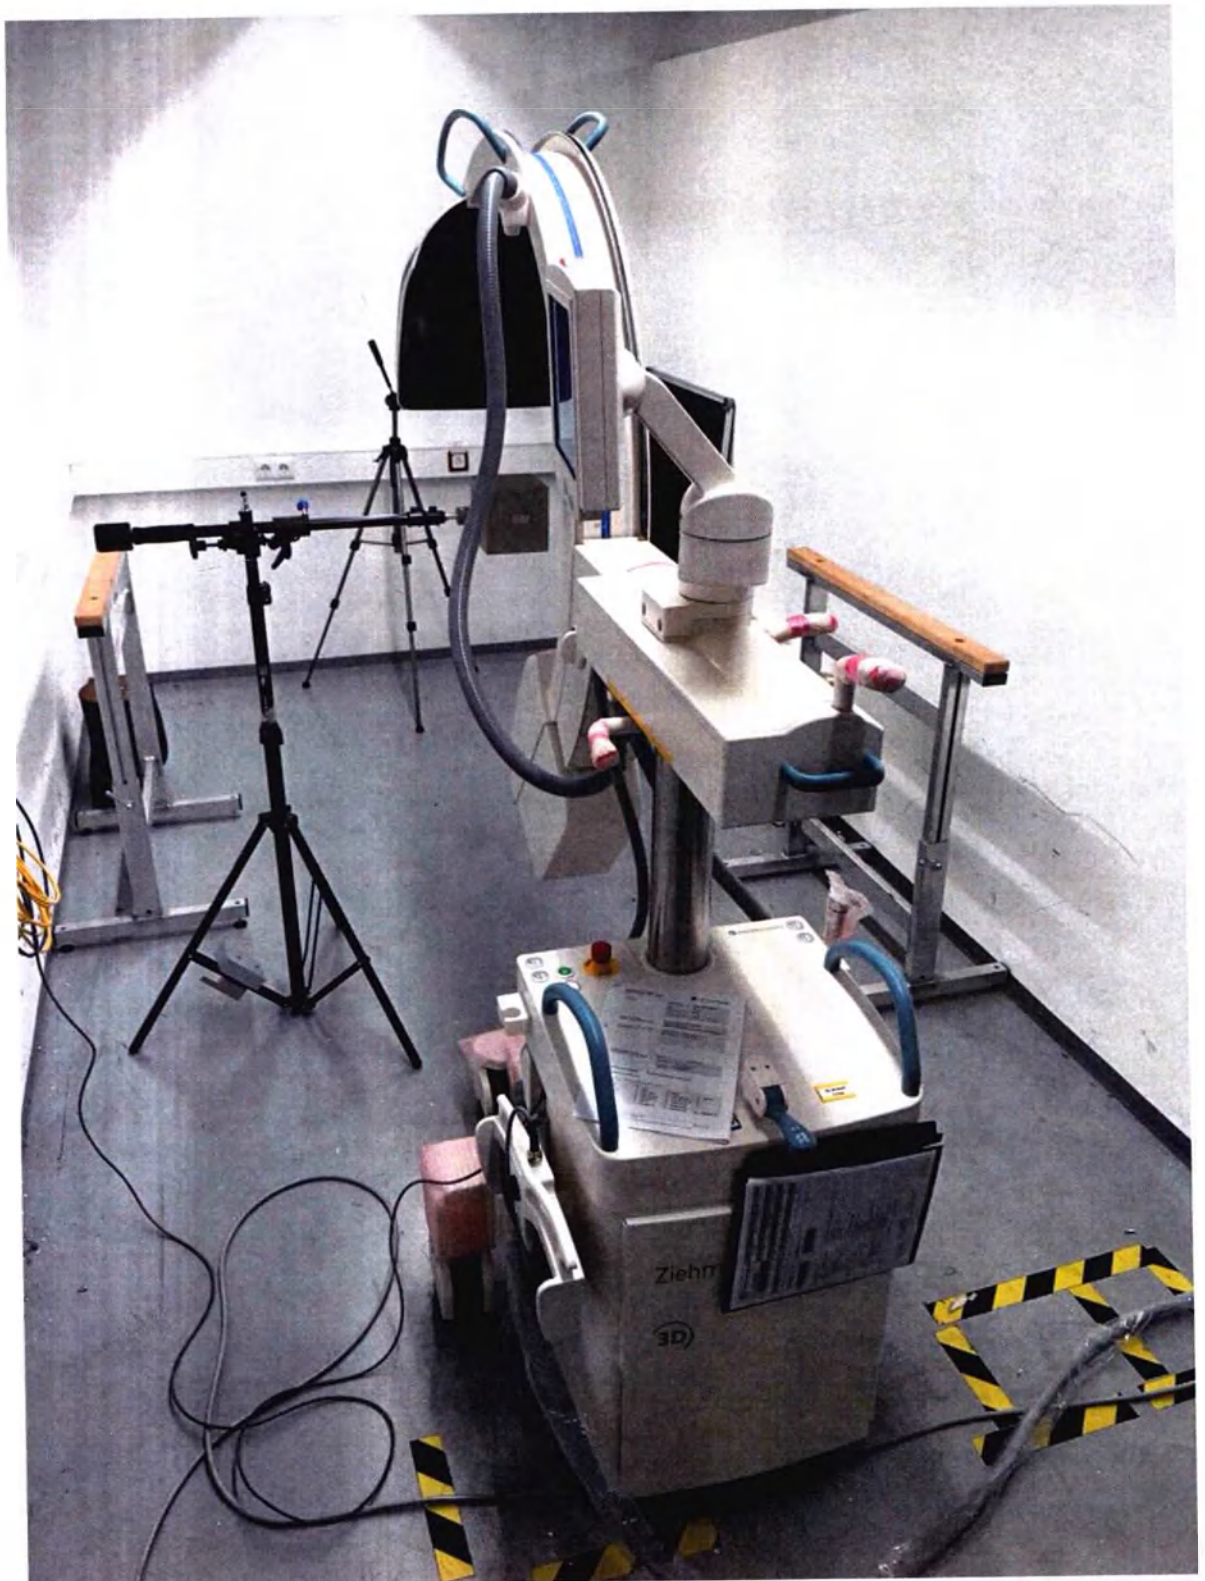

Мобильная рентгенодиагностическая установка с С-образной рамой

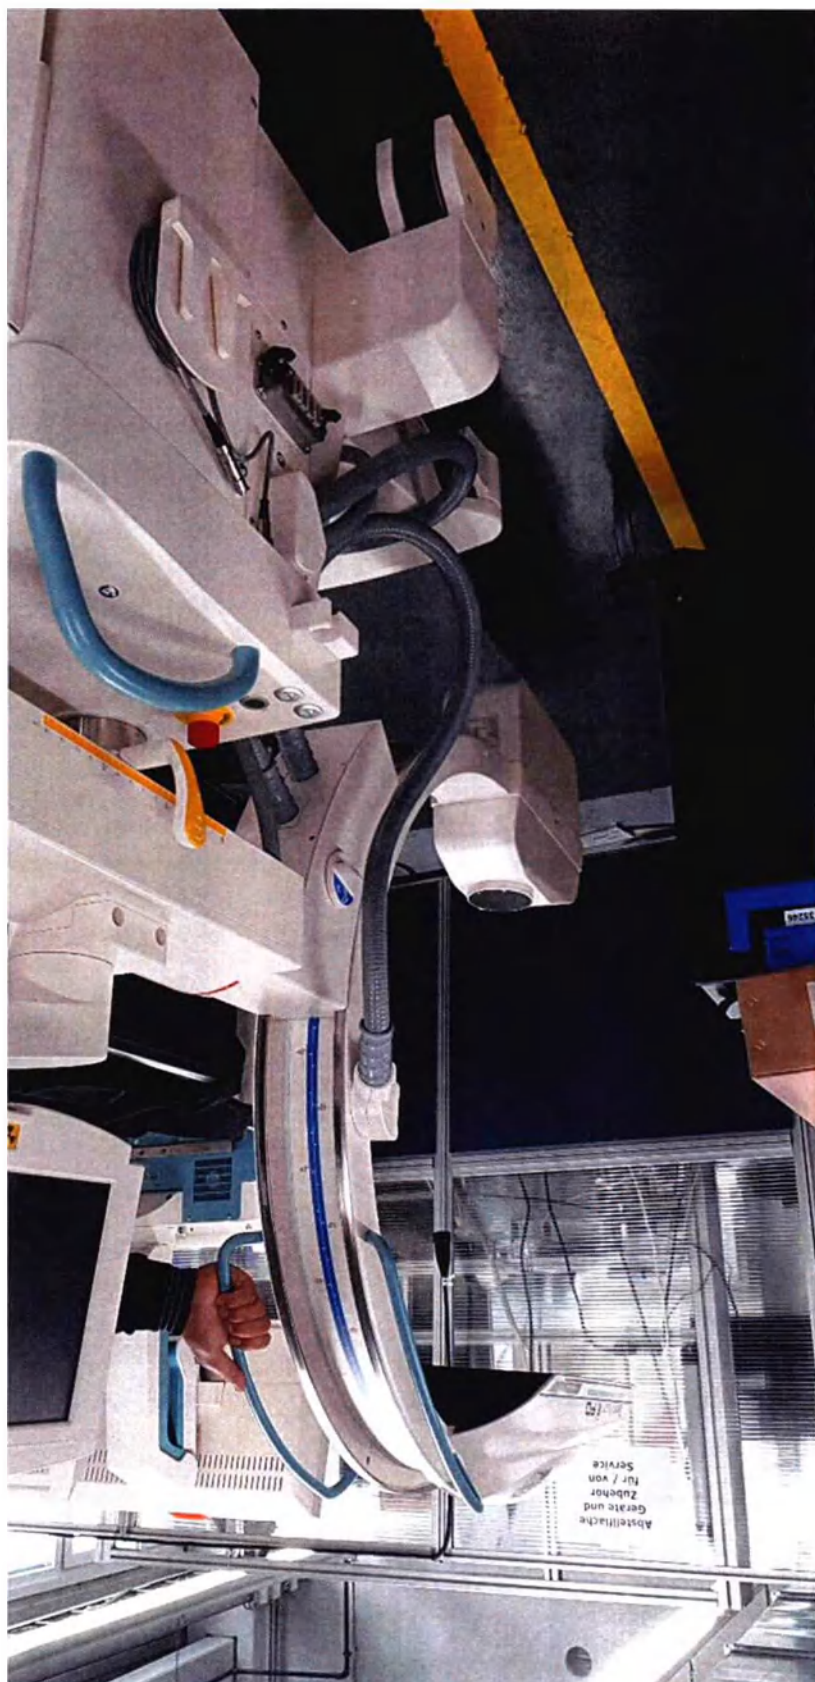


Упаковка




Мониторная тележка с системой обработки изображения



Соединительные кабели

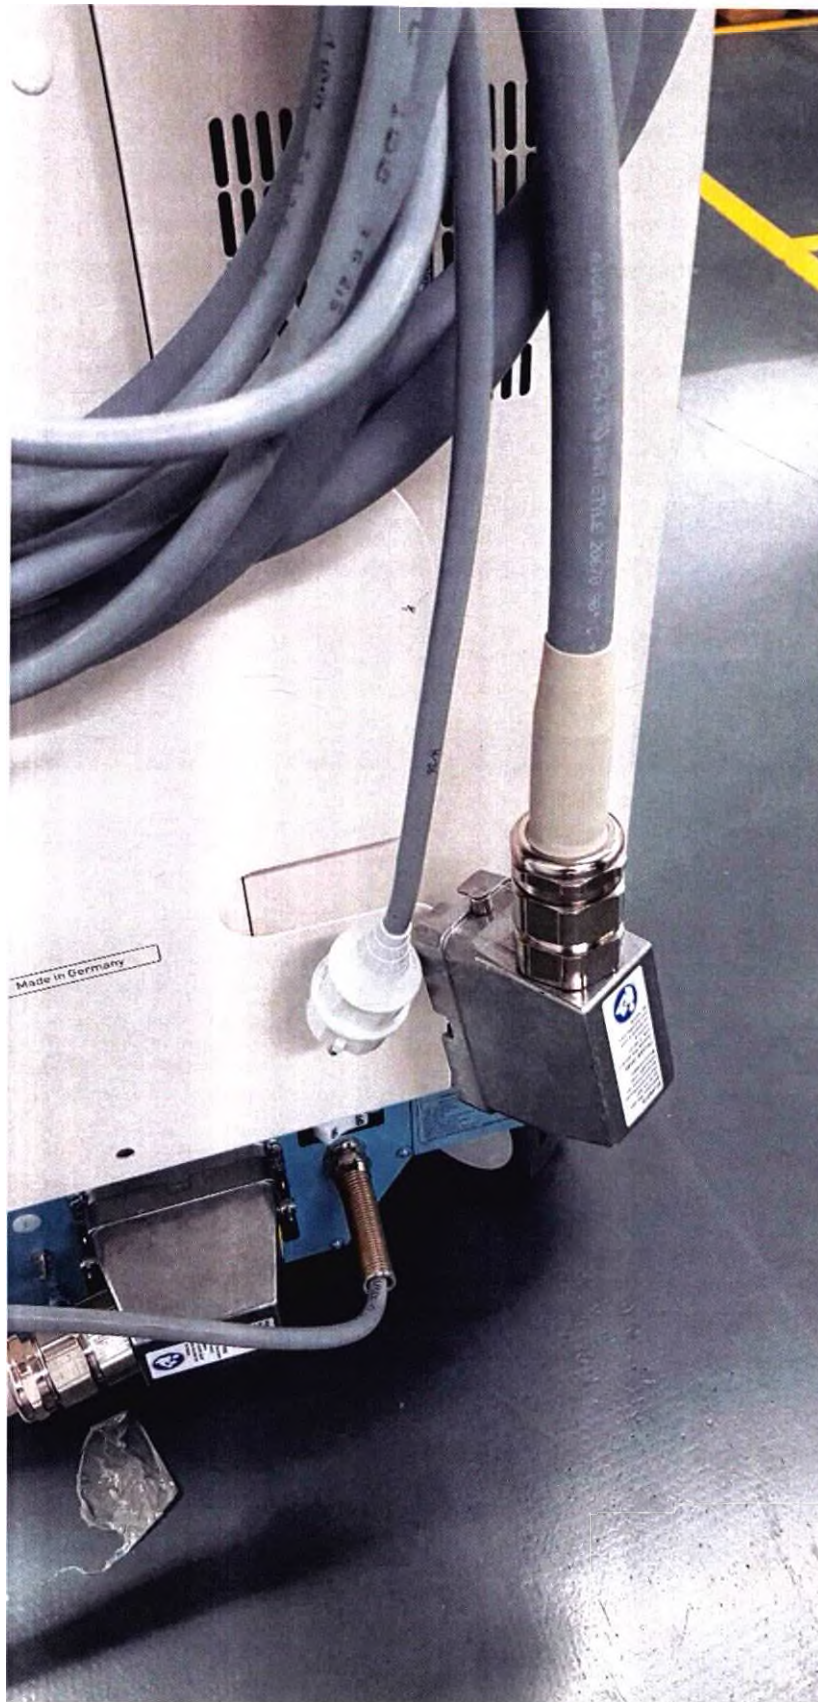


Кабель питания 220 В

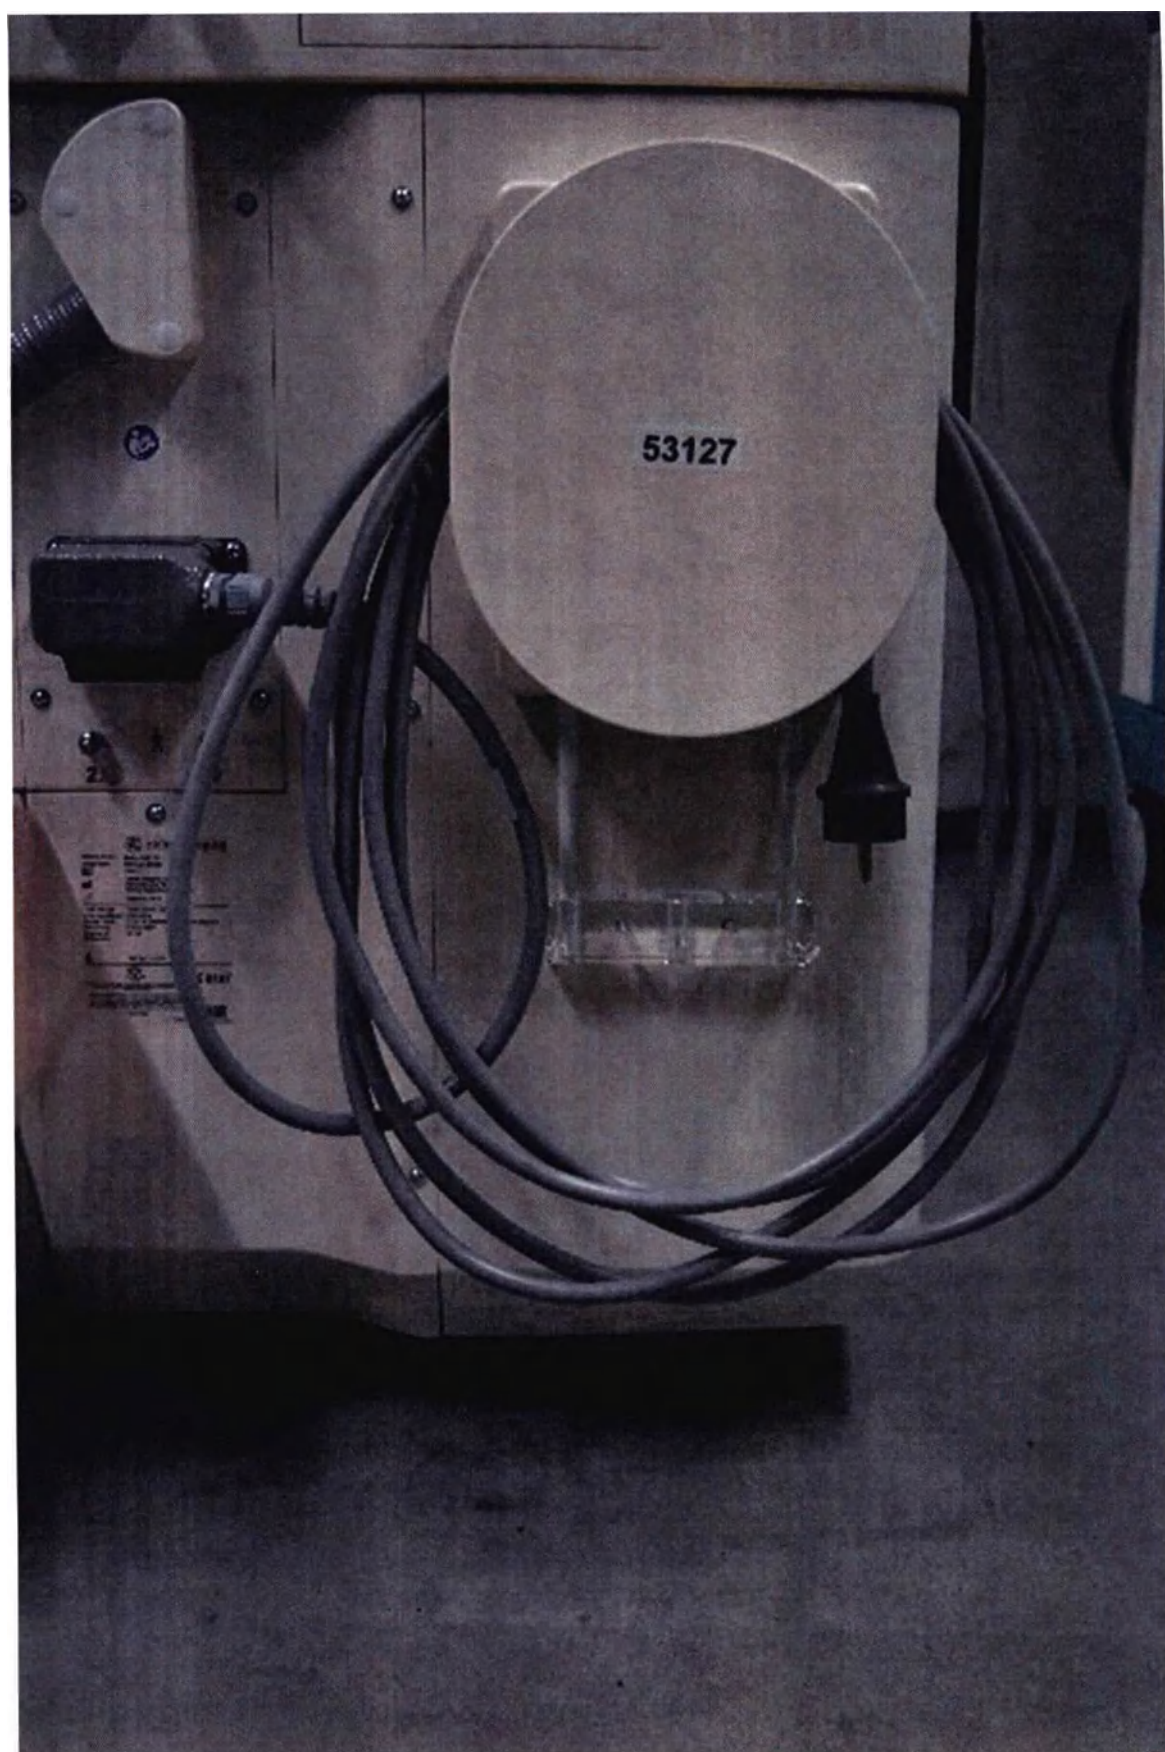

Монитор 19" DUO, 27" Монитор



Монитор управления

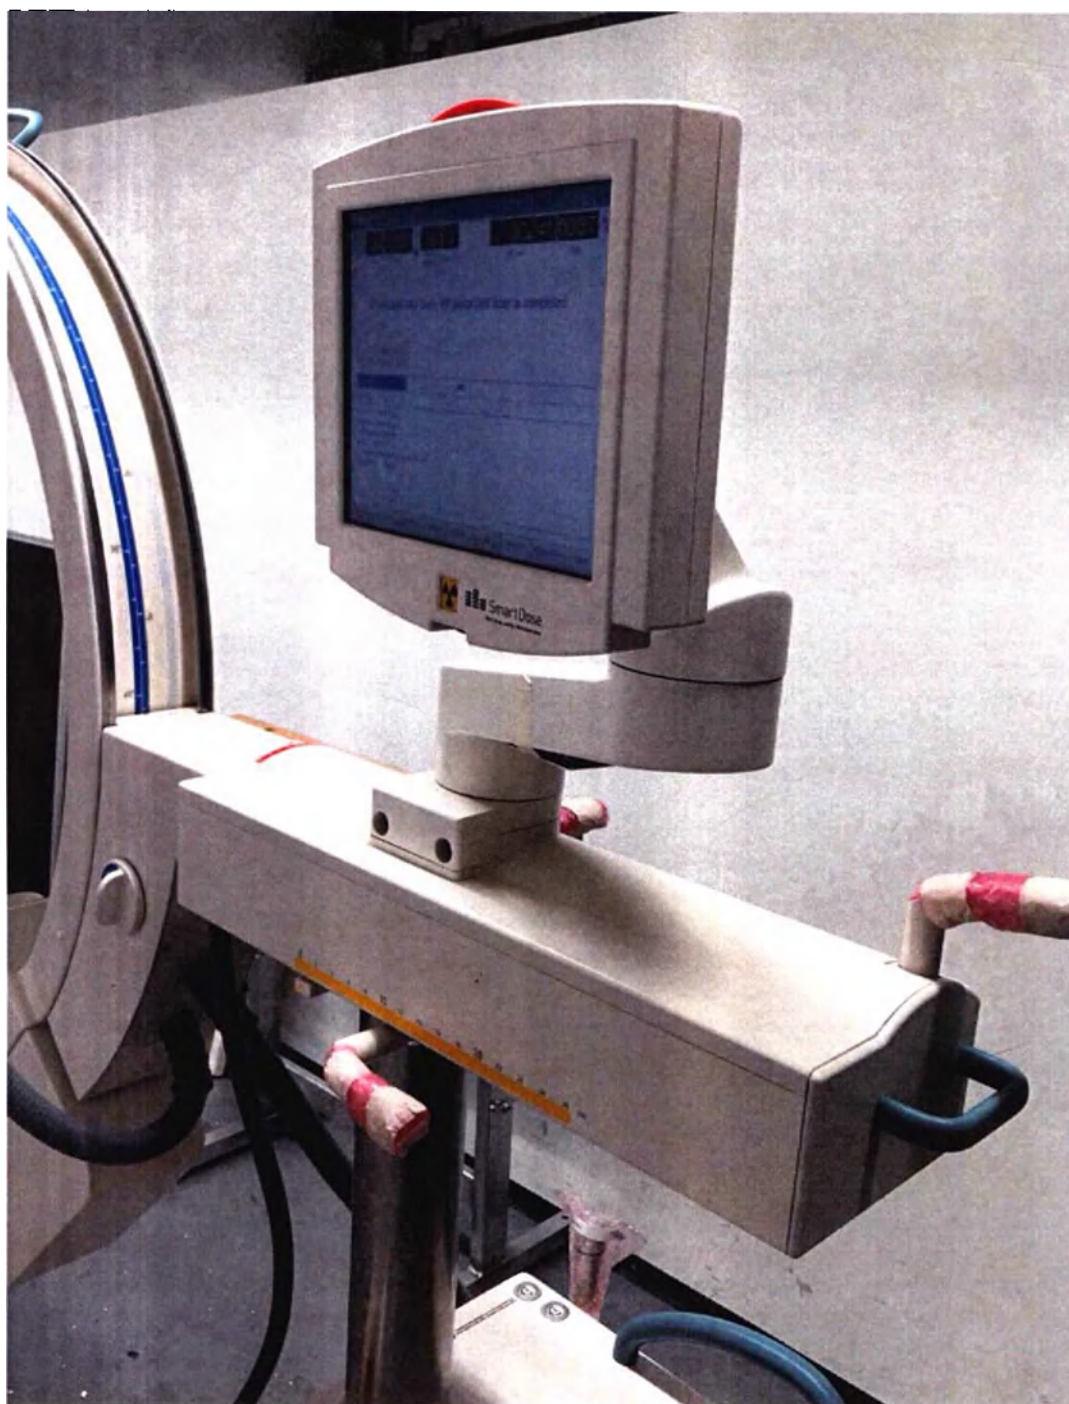

Встраиваемый принтер




Выносная педаль управления (при необходимости может быть беспроводной)



Выносная ручная кнопка включения/выключения излучения




Устройство записи на компакт диск -DVD-RW

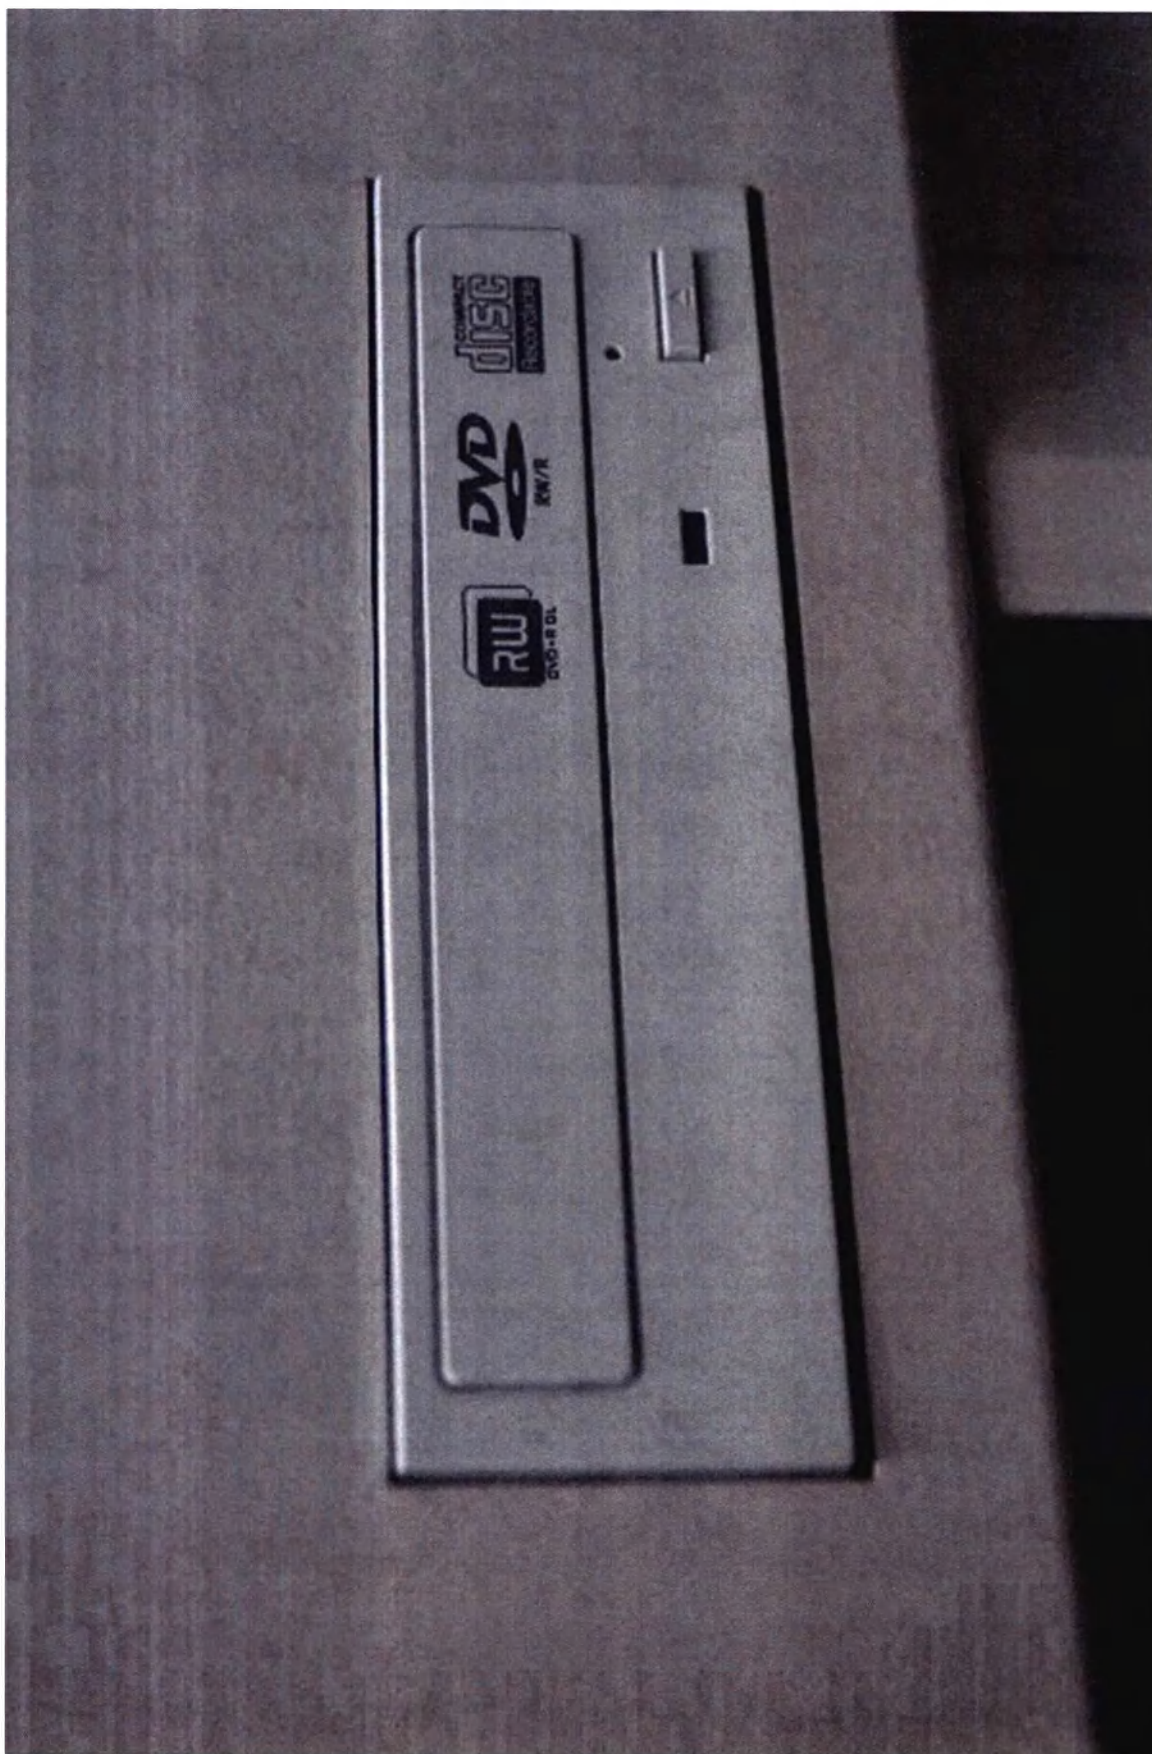


Излучатель рентгеновский




Плоскопанельный детектор (CMOS)

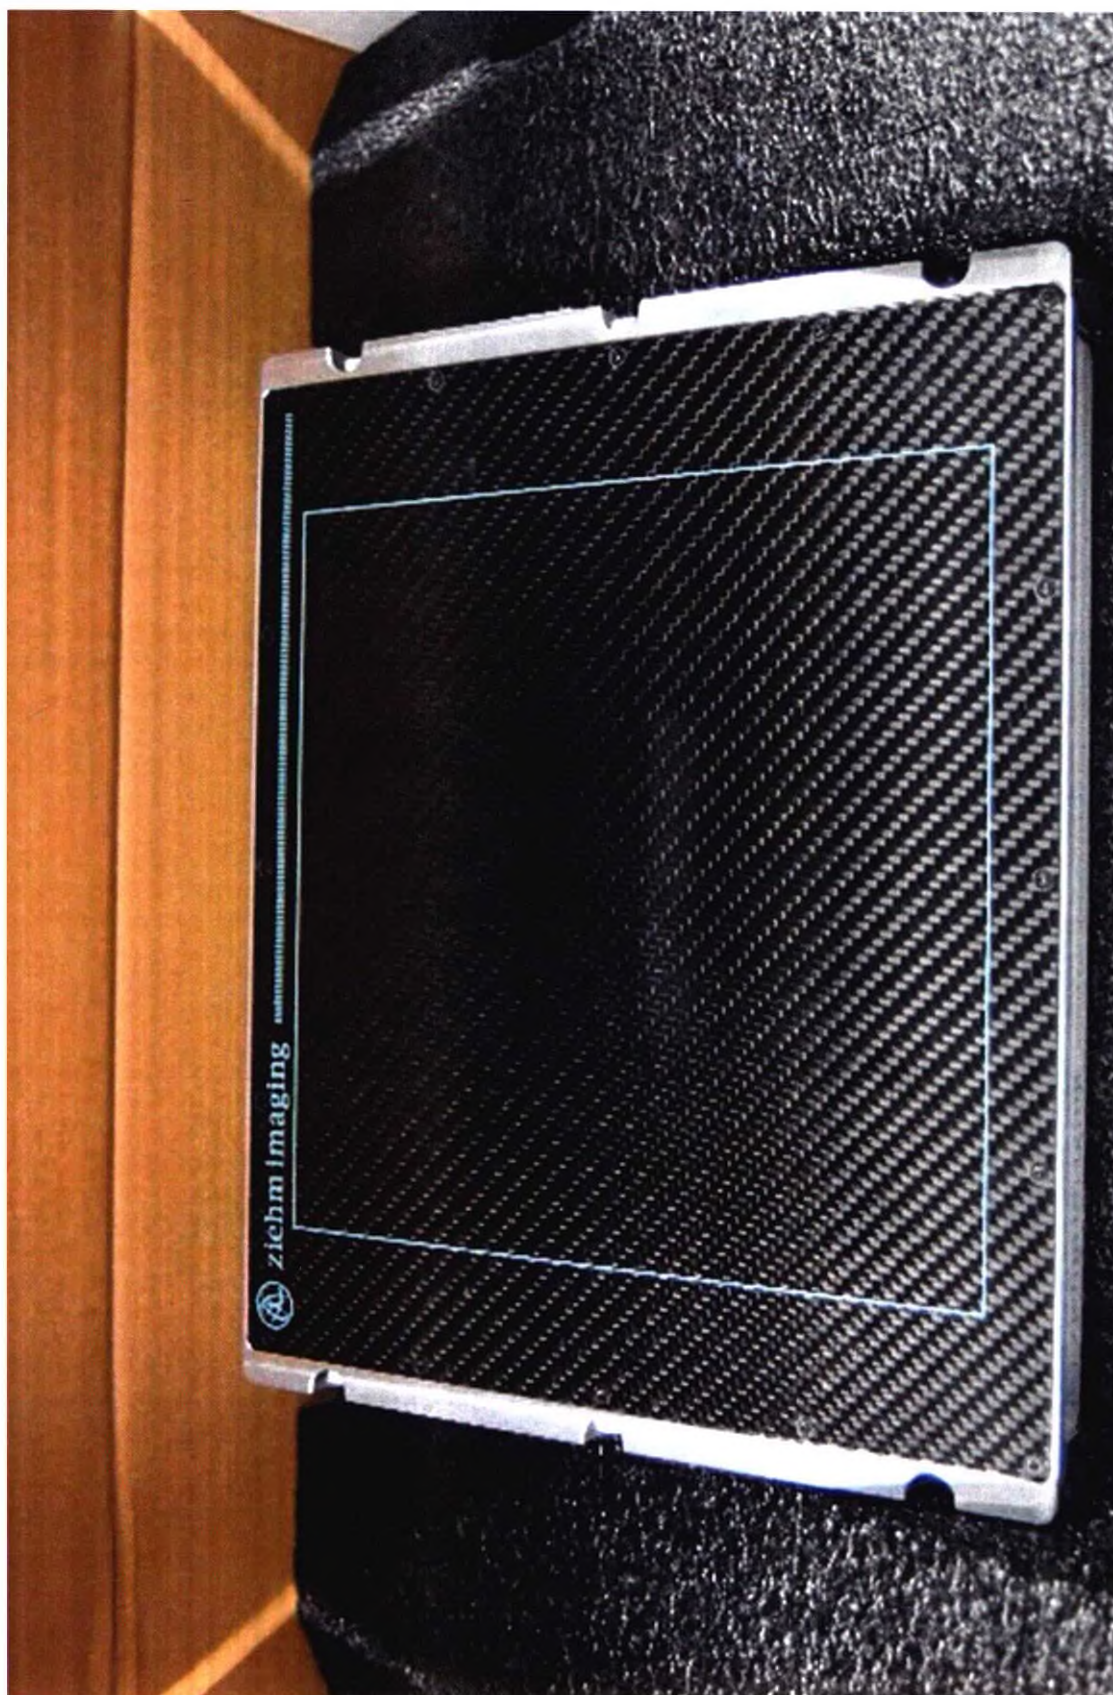

Плоскопанельный детектор (aSi)

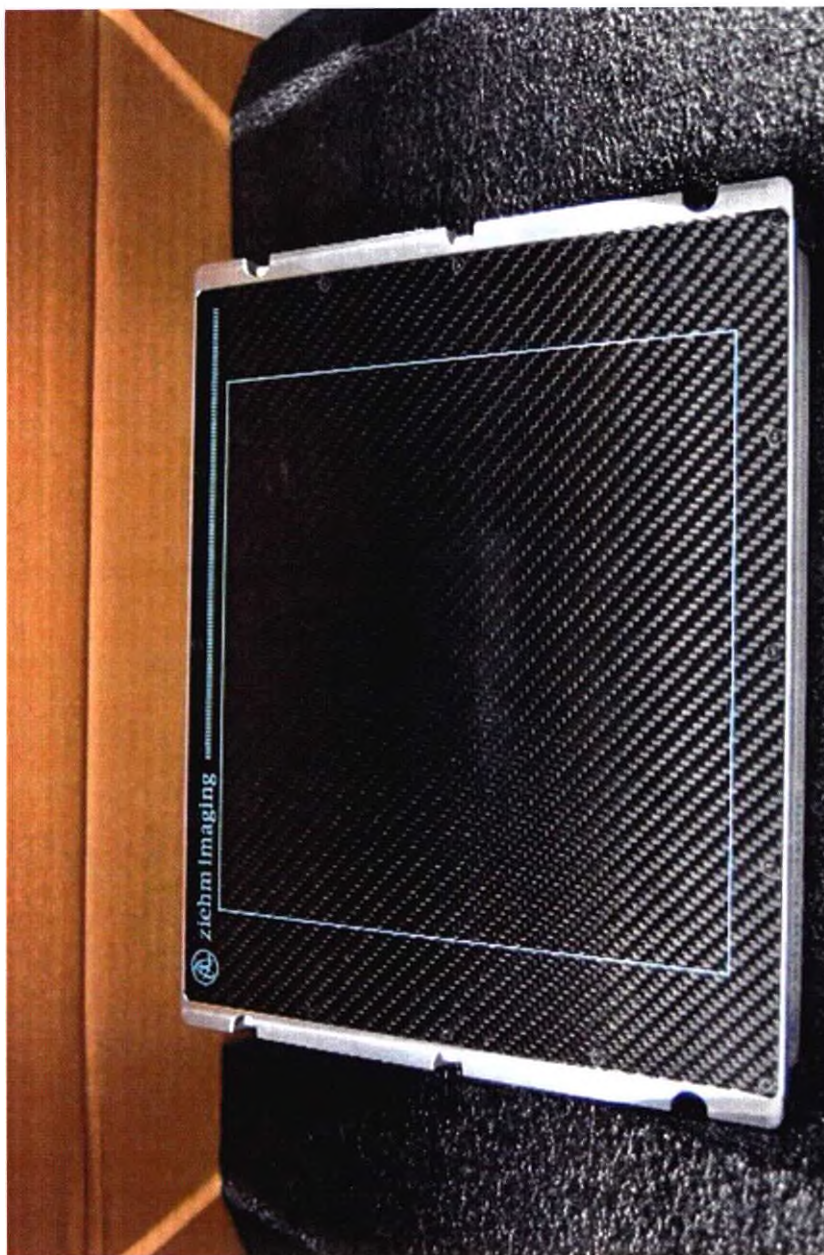


Коллиматор

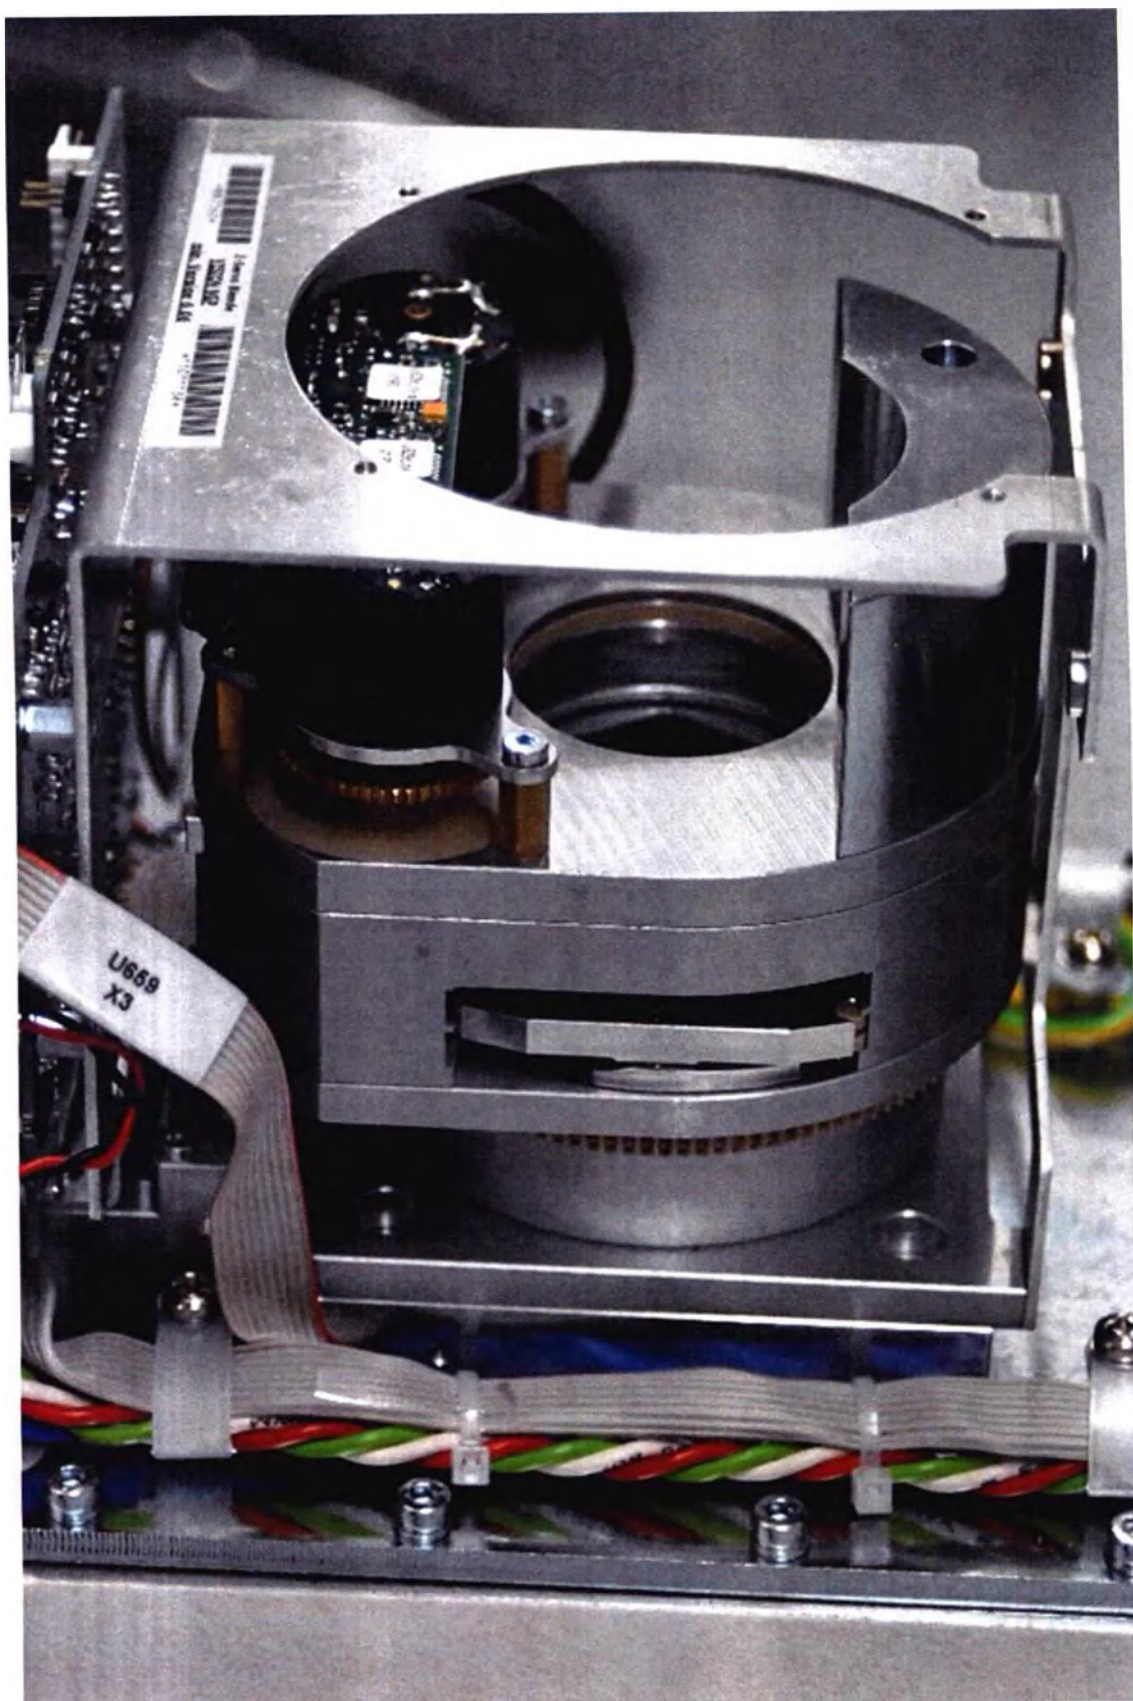

Встраиваемая система лазерного наведения на приемнике/излучателе




Клавиатура управления

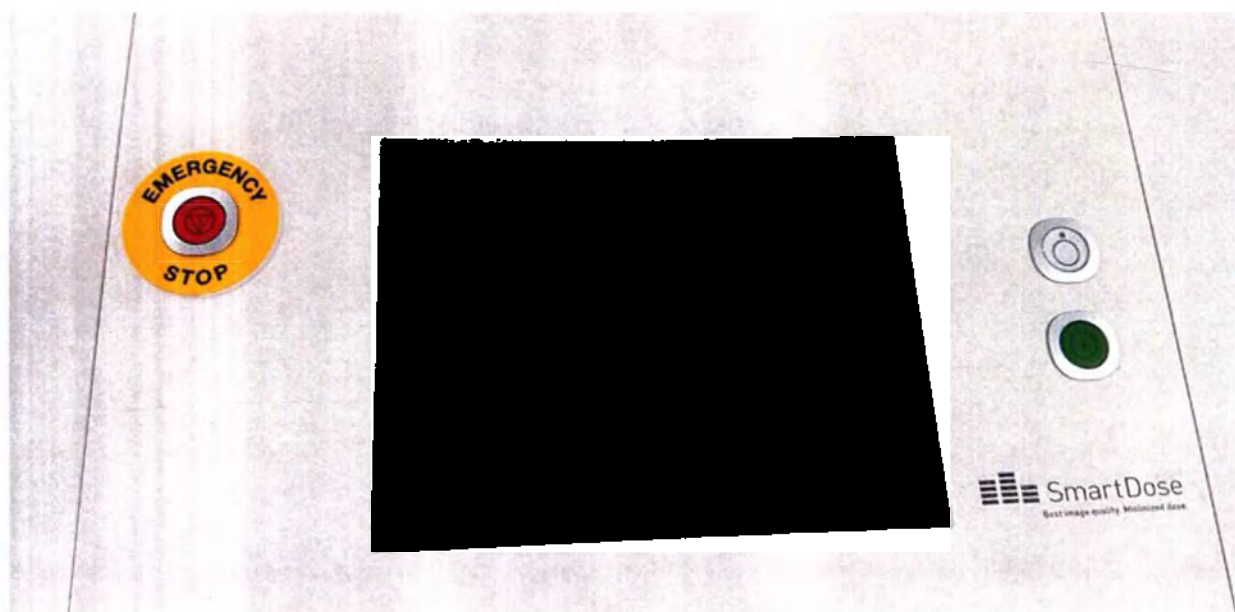


Дополнительный монитор управления




Центр удаленного позиционирования (джойстик)

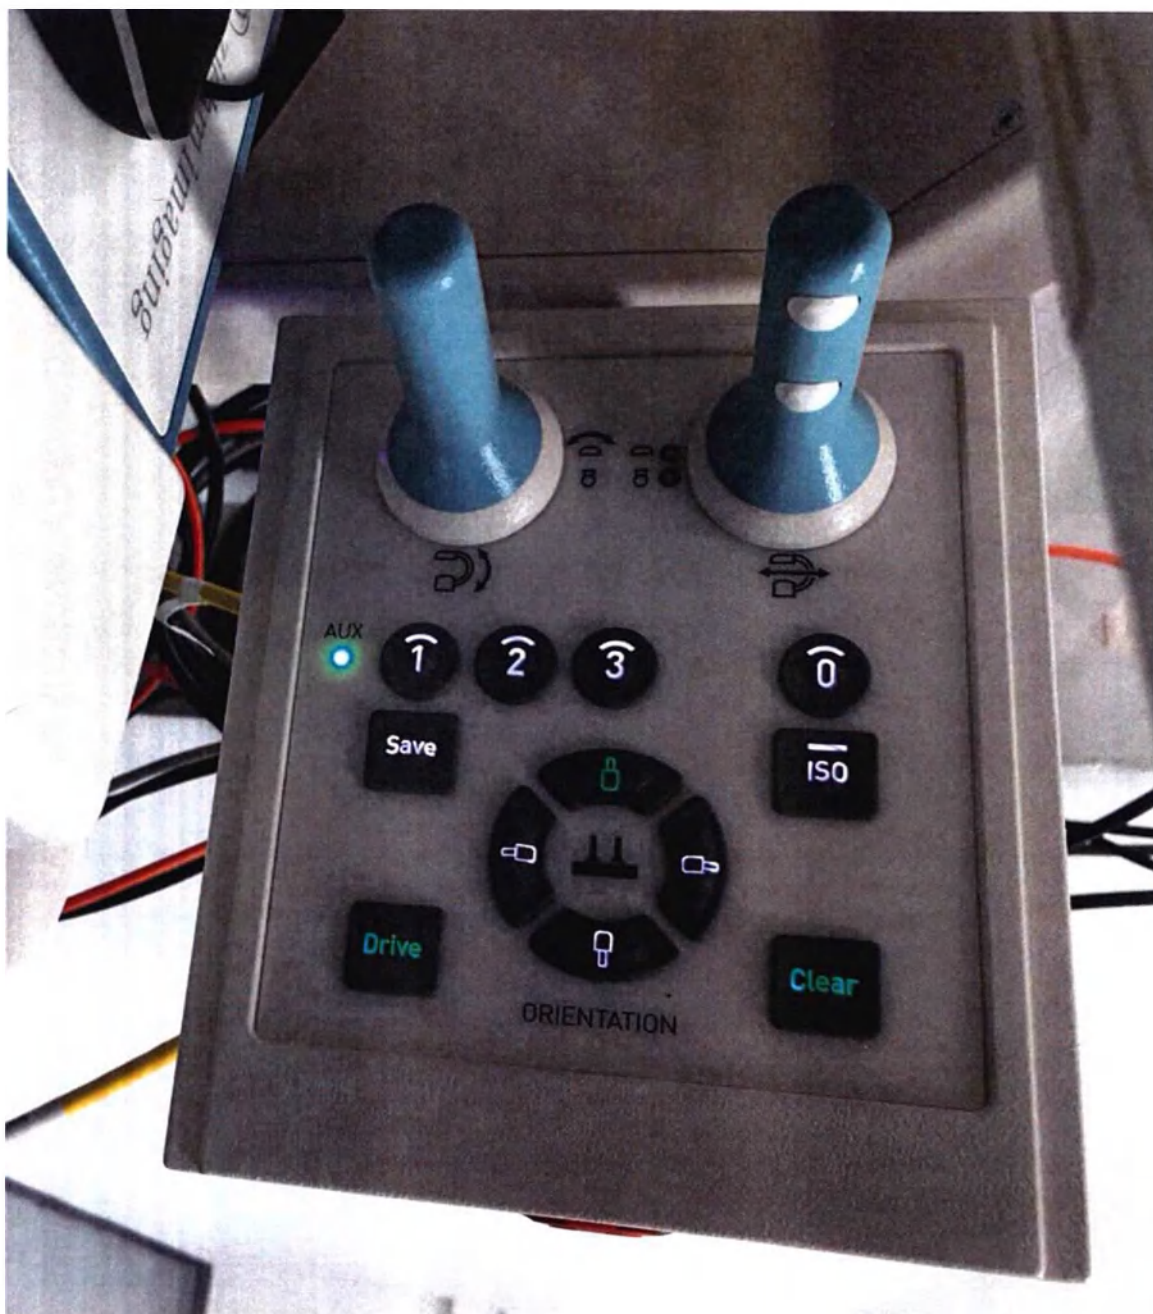

Отсеивающая решетка

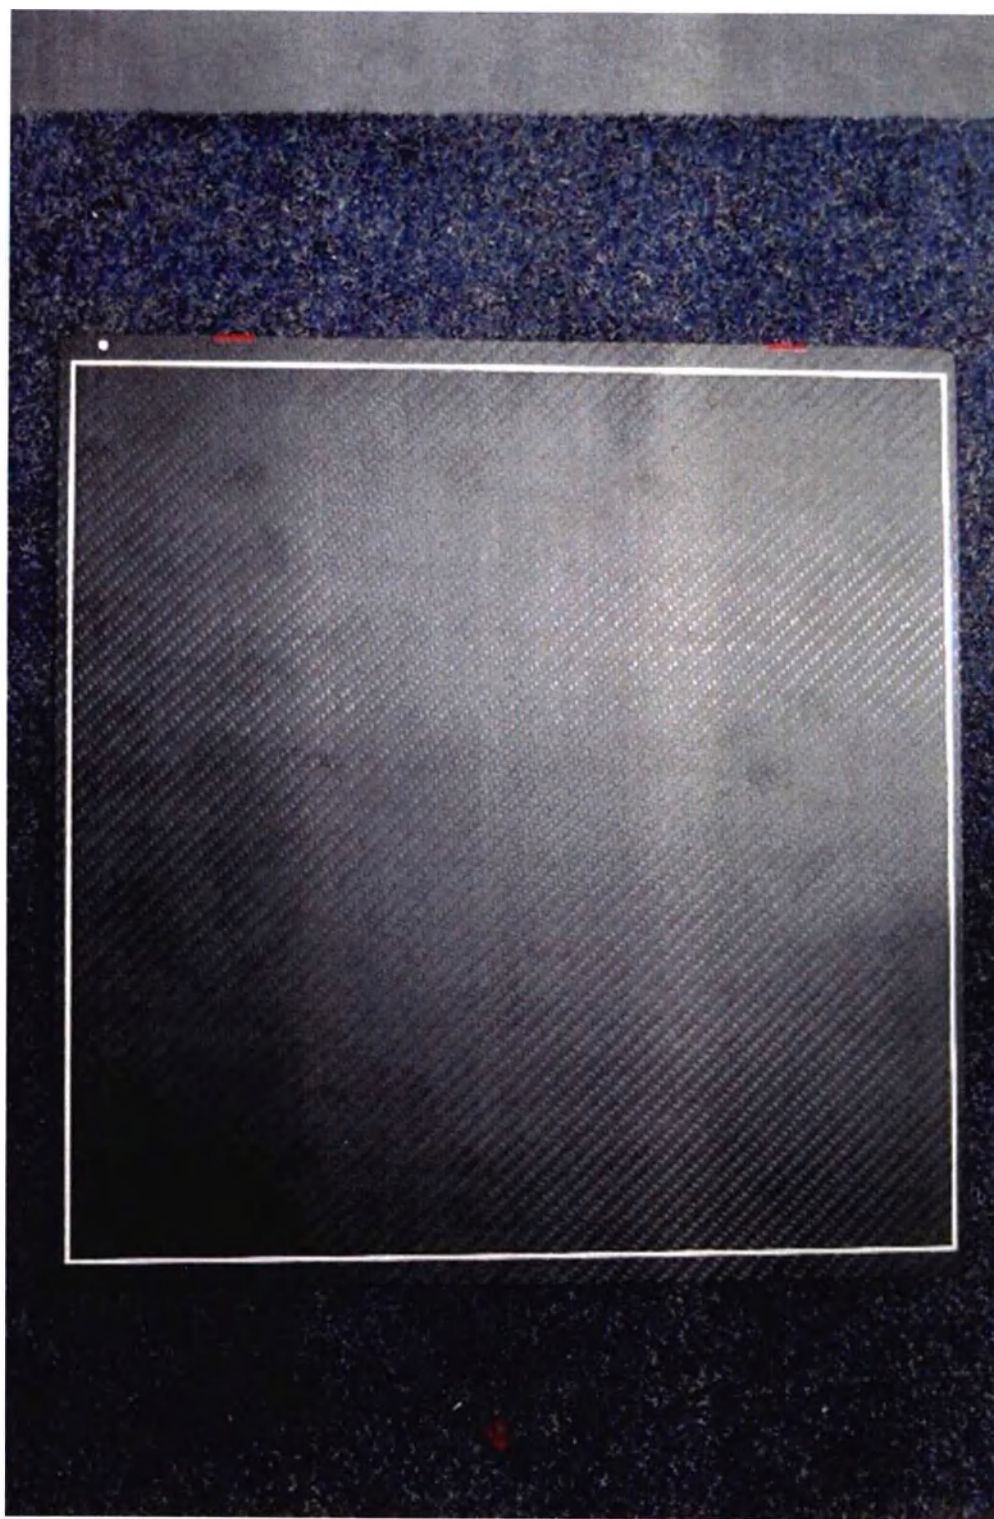

Датчик дозы для измерения произведения поглощенной дозы на площадь

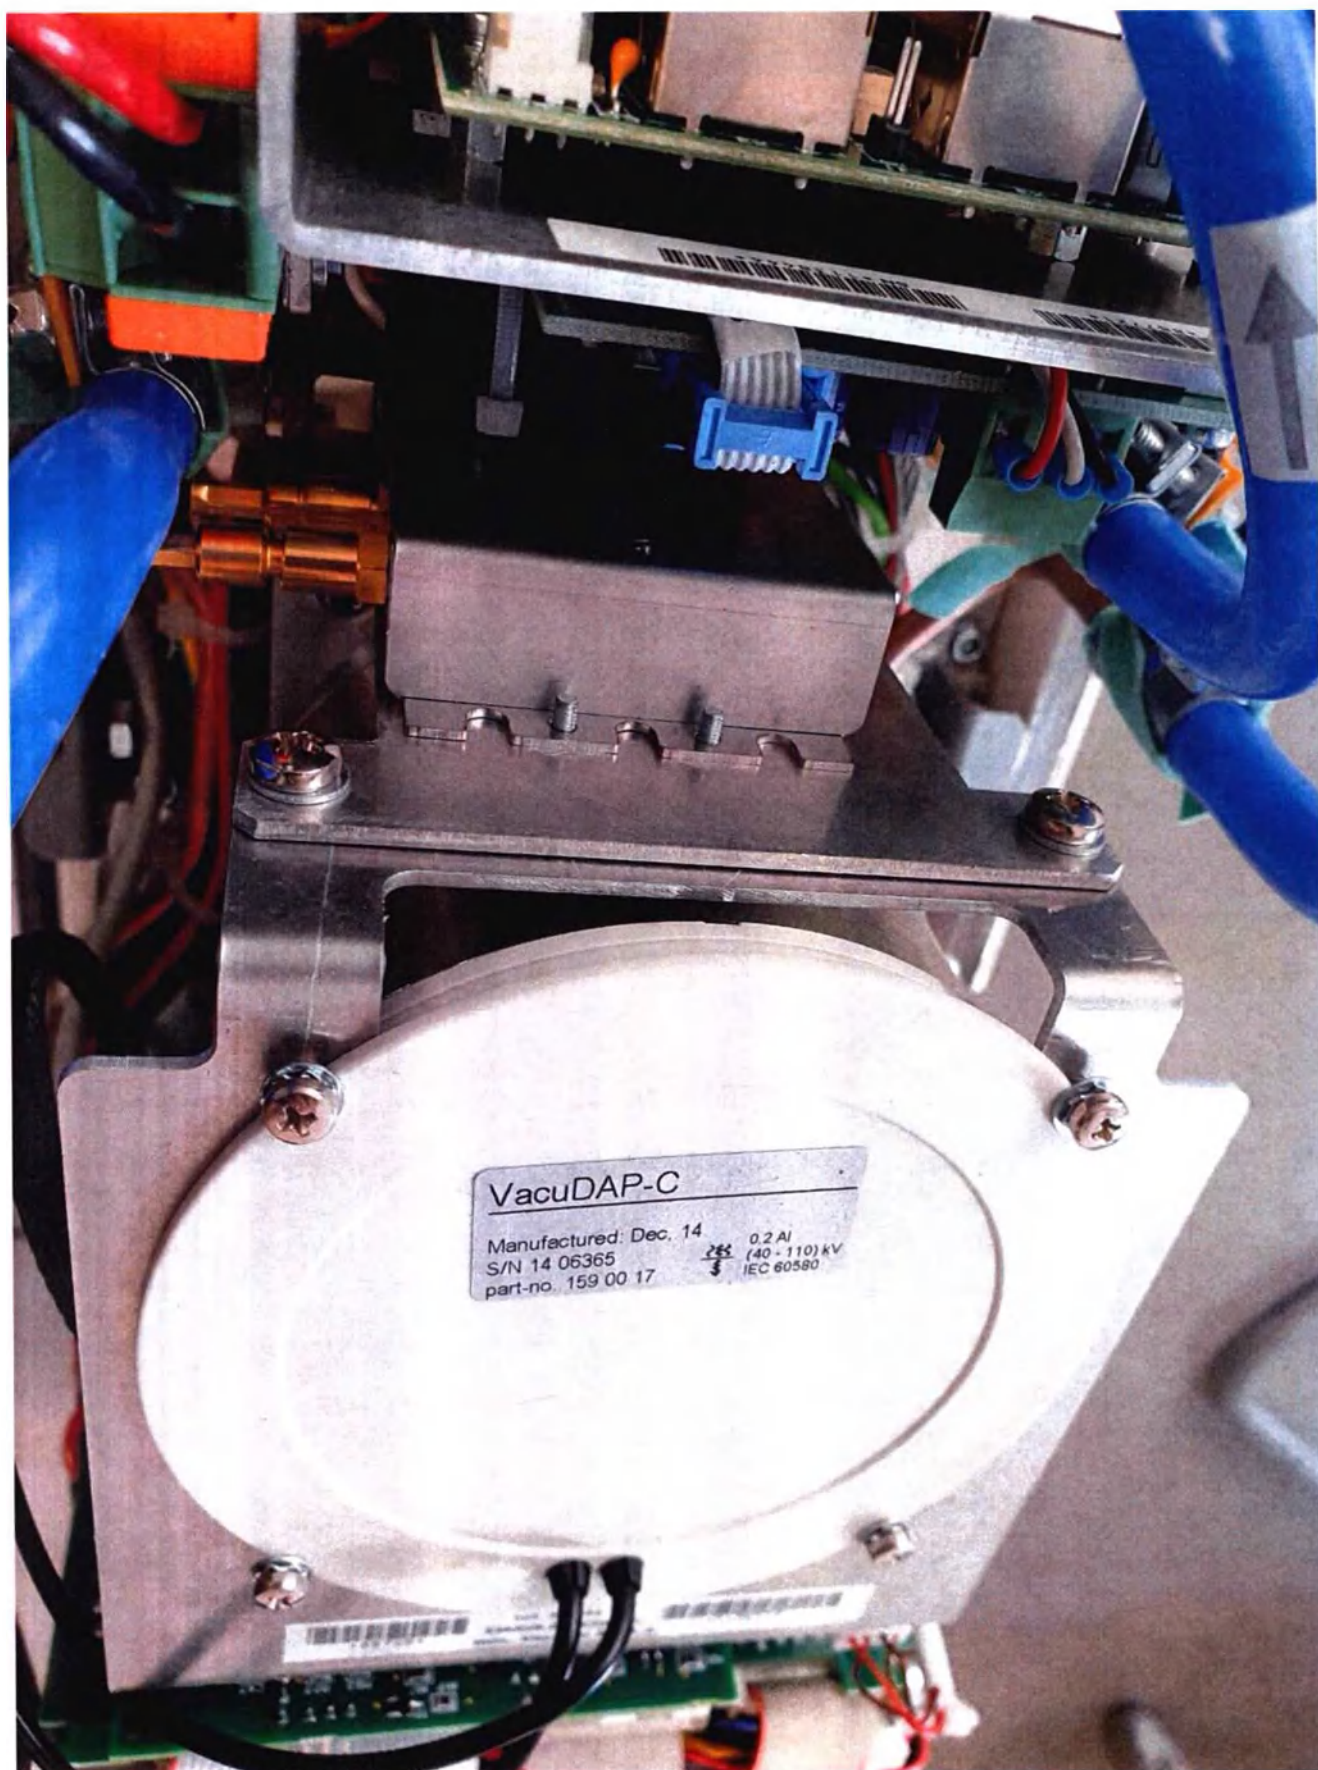

Конфигурация						Toolbar
Кино Скор. ▲ ▼ 1 Сним./с Реж.съемки ☐ Рент-скоп ☒ HQ ☒ Авт.воспр.					Раб.настройки	
DSA Скор. ▲ ▼ 8 Сним./с Реж.съемки ☐ Рент-скоп ☒ HQ ☒ Нативн.сним.DSA ☒ Авт.перенос MSA ☐ DSA CO2 Пред. значение кумулят. возд. кермы: 250 mGy Отмена Применить					Осн.настройки Киноряд / DSA / Доза Носит.инф-и Принадлежности Серв.настройки	
Рент-скоп	Ангиогр	3D	Пациент	Постобраб.	Архив	Конфиг.

DICOM плата с интерфейсом

Конфигурация Toolbar

DicomMedia

Client

Servers

Query

Print

Storage

2DNavigation

3DNavigation

Commitment

DoseSR

Worklist

MPPS

SNTF

Dicom Media

Class Modality

CR

Image Attributes

On + Annot.

Discard

Apply

° 1 @ ; : % < > () = ? ← DEL

\ / Q W E R T Y U I O P + = Enter

Caps Lock A S D F G H J K L ; ' ←

Shift Z X C V B N M * + # , . Alt Gr Space →

Dose **DICOM** Common Switch System 3D MDATA Kinematics Back

Система сигнализации и предотвращения доступа (идентификация
пользователя) HIPAA

Пациент

Свободная память: 23592 Снимки

Toolbar

Польз.

Пароль

Вход


Назад

Default User

Restricted

Ё	1	@	3	4	5	6<	7>	8 (	9)	0 =	?	←	DEL
\ /	Й	Ц	У	К	Е	Н	Г	Ш	Щ	З	Х	Enter	
Caps Lock	Ф	Ы	В	А	П	Р	О	Л	Д	Ж	Э	→	
Shift	Я	Ч	С	М	И	Т	Ь Ъ	Б	Ю	Alt Gr	Space	←	
Рент-скоп	Ангиогр	3D	Пациент	Постобраб.	Архив	Конфиг.							

Программный модуль Measurement functions

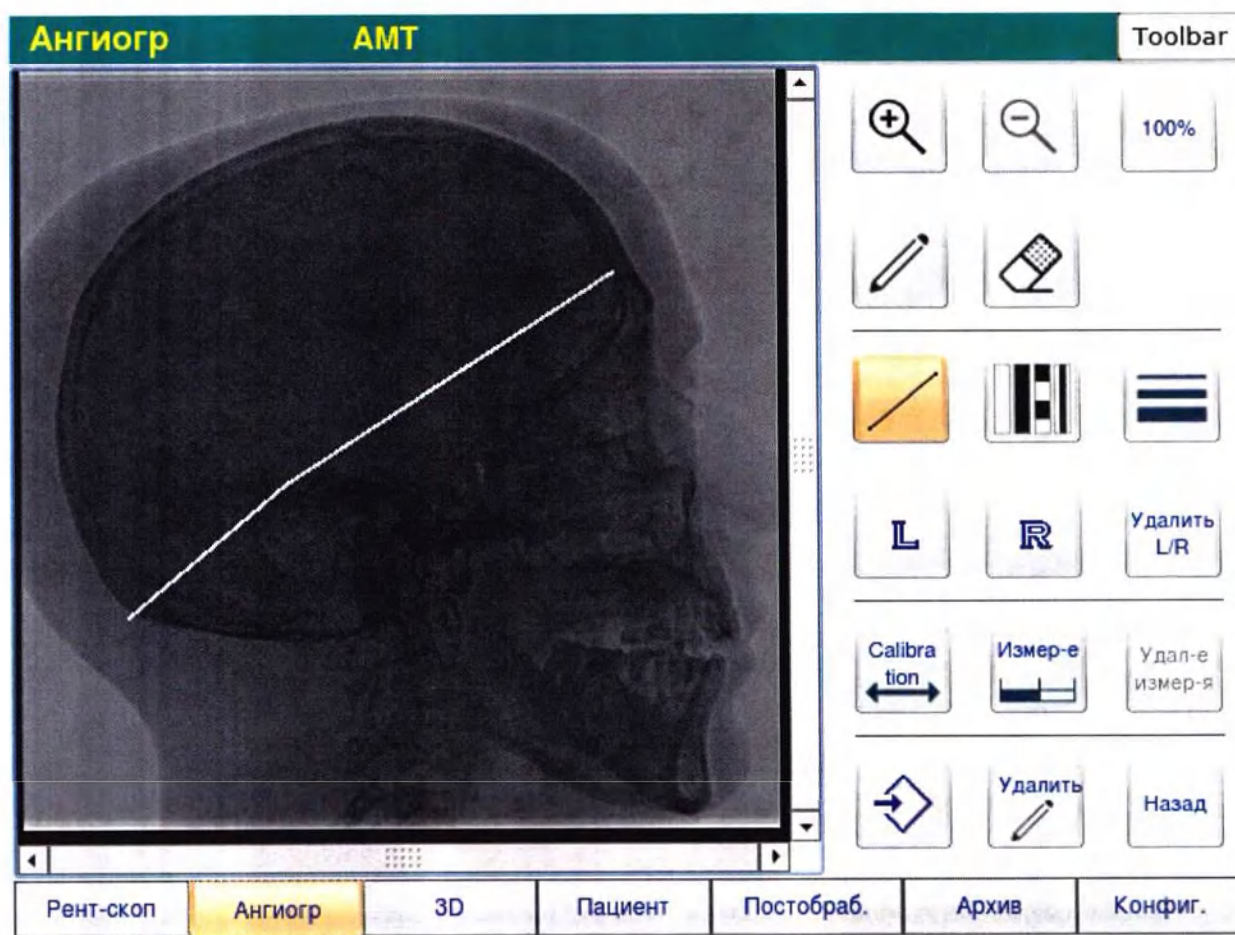

Встраиваемый блок для сосудистых исследований Vascular Advance

Ангиограф

Свободная память: 23591 Снимки

Toolbar



65

kV

6.2

mA

40

Прод.имп.
%

2

Имп./с

1.76

cGy cm²

00:01

мин.





















Лазер



Фил.



Привод

- / +

Имп./с

1

2

4

8

12.5

TRANS

2.0cm

LAO/RAO

4.5°

VERT

1.2cm

CRA/CAU

0.2°





DSA



Кино





MSA







Bolus



RSA



Рент-скоп

Ангиограф

3D

Пациент

Постобраб.

Архив

Конфиг.


 ООО ЦРМИ
 
 INFO@CIRMI.RU
 
 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Интерфейс Ziehm NaviPort 3D

Конфигурация

- DicomMedia
- Client
- Servers
 - Query
 - Print
 - Storage
 - 2DNavigation
 - 3DNavigation
 - medtronic
 - Stryker
 - Brainlab
 - Commitment
 - DoseSR

3D Navigation ☒ Server Active

Server Name

medtronic

Port

104

IP Address

172.16.72.205

AE-Title

stealth

Class Modality

CR

Attributes

Off

Image Type

1024x1024 16 bit

NaviType

Medtronic

☐ SpineMask Selectable

Clone

Discard

Test

Apply

°	!	@	;	:	%	<	>	(	)	=	?	←	DEL
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	_		
\	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	+	Enter	
/											=		
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	←	
											;		
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	*	-	Alt Gr	Space	→	
								+ #	.	,			

Dose

DICOM

Common

Switch

System


3D

MDATA


Kinematics

Back


Система водяного охлаждения установки

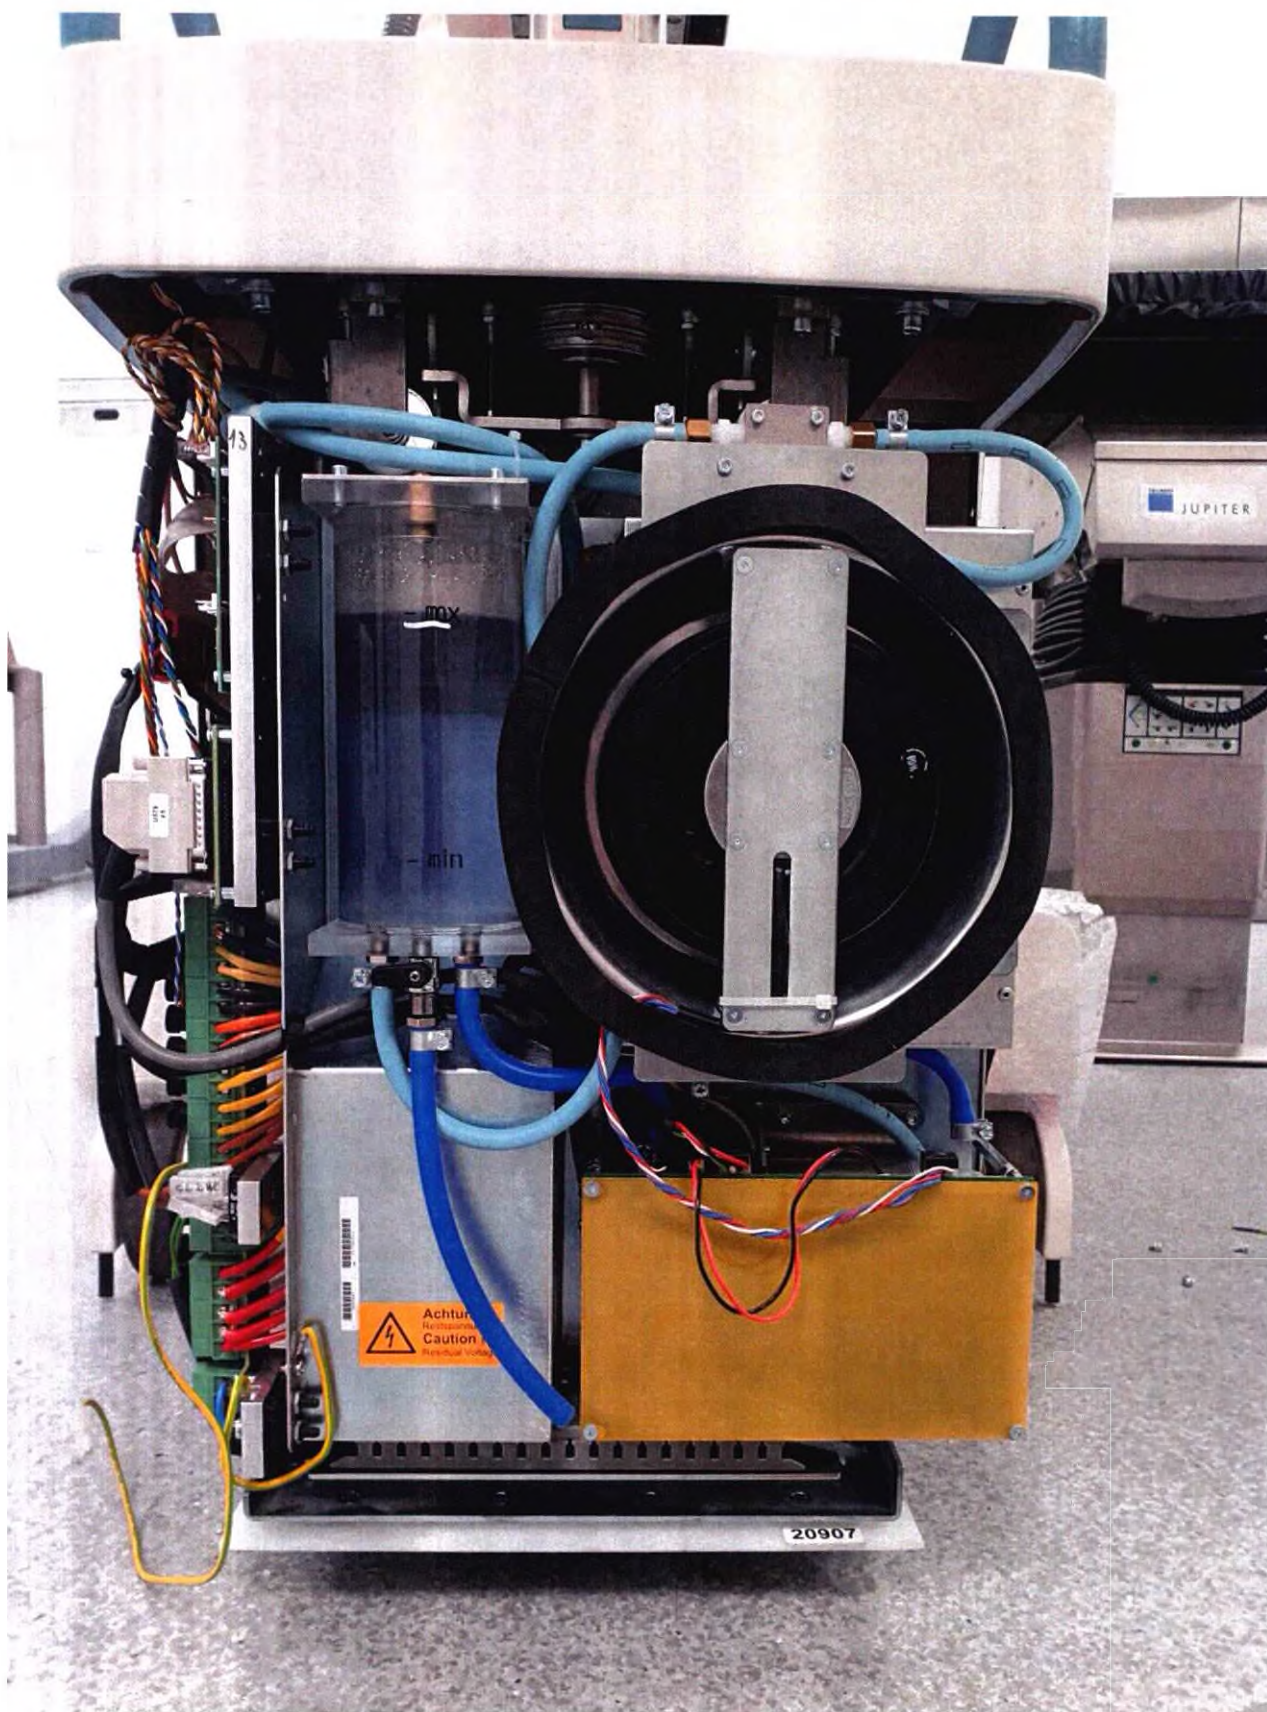


Устройство и программный модуль Distance Control

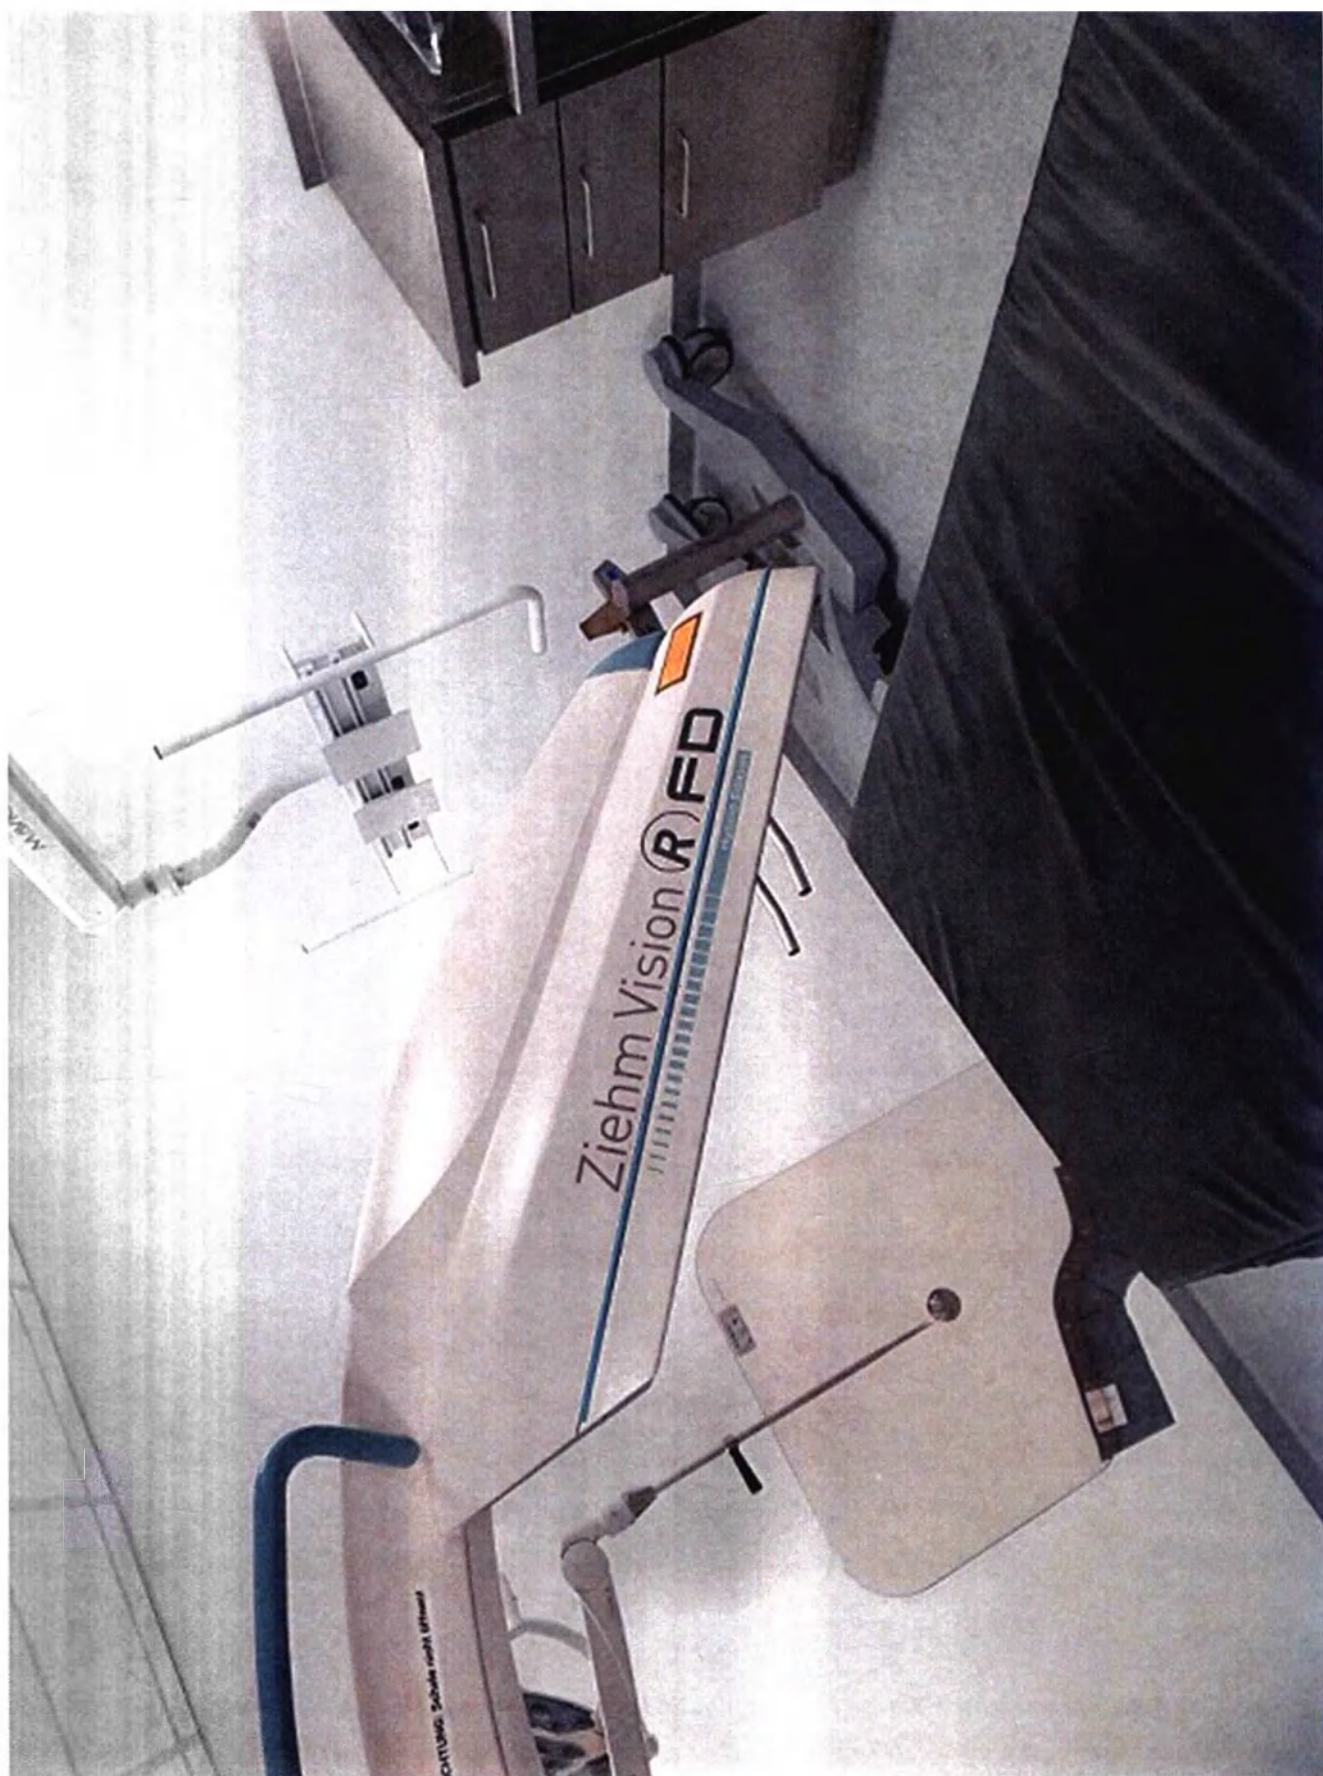


Устройство и программный модуль WLAN Package

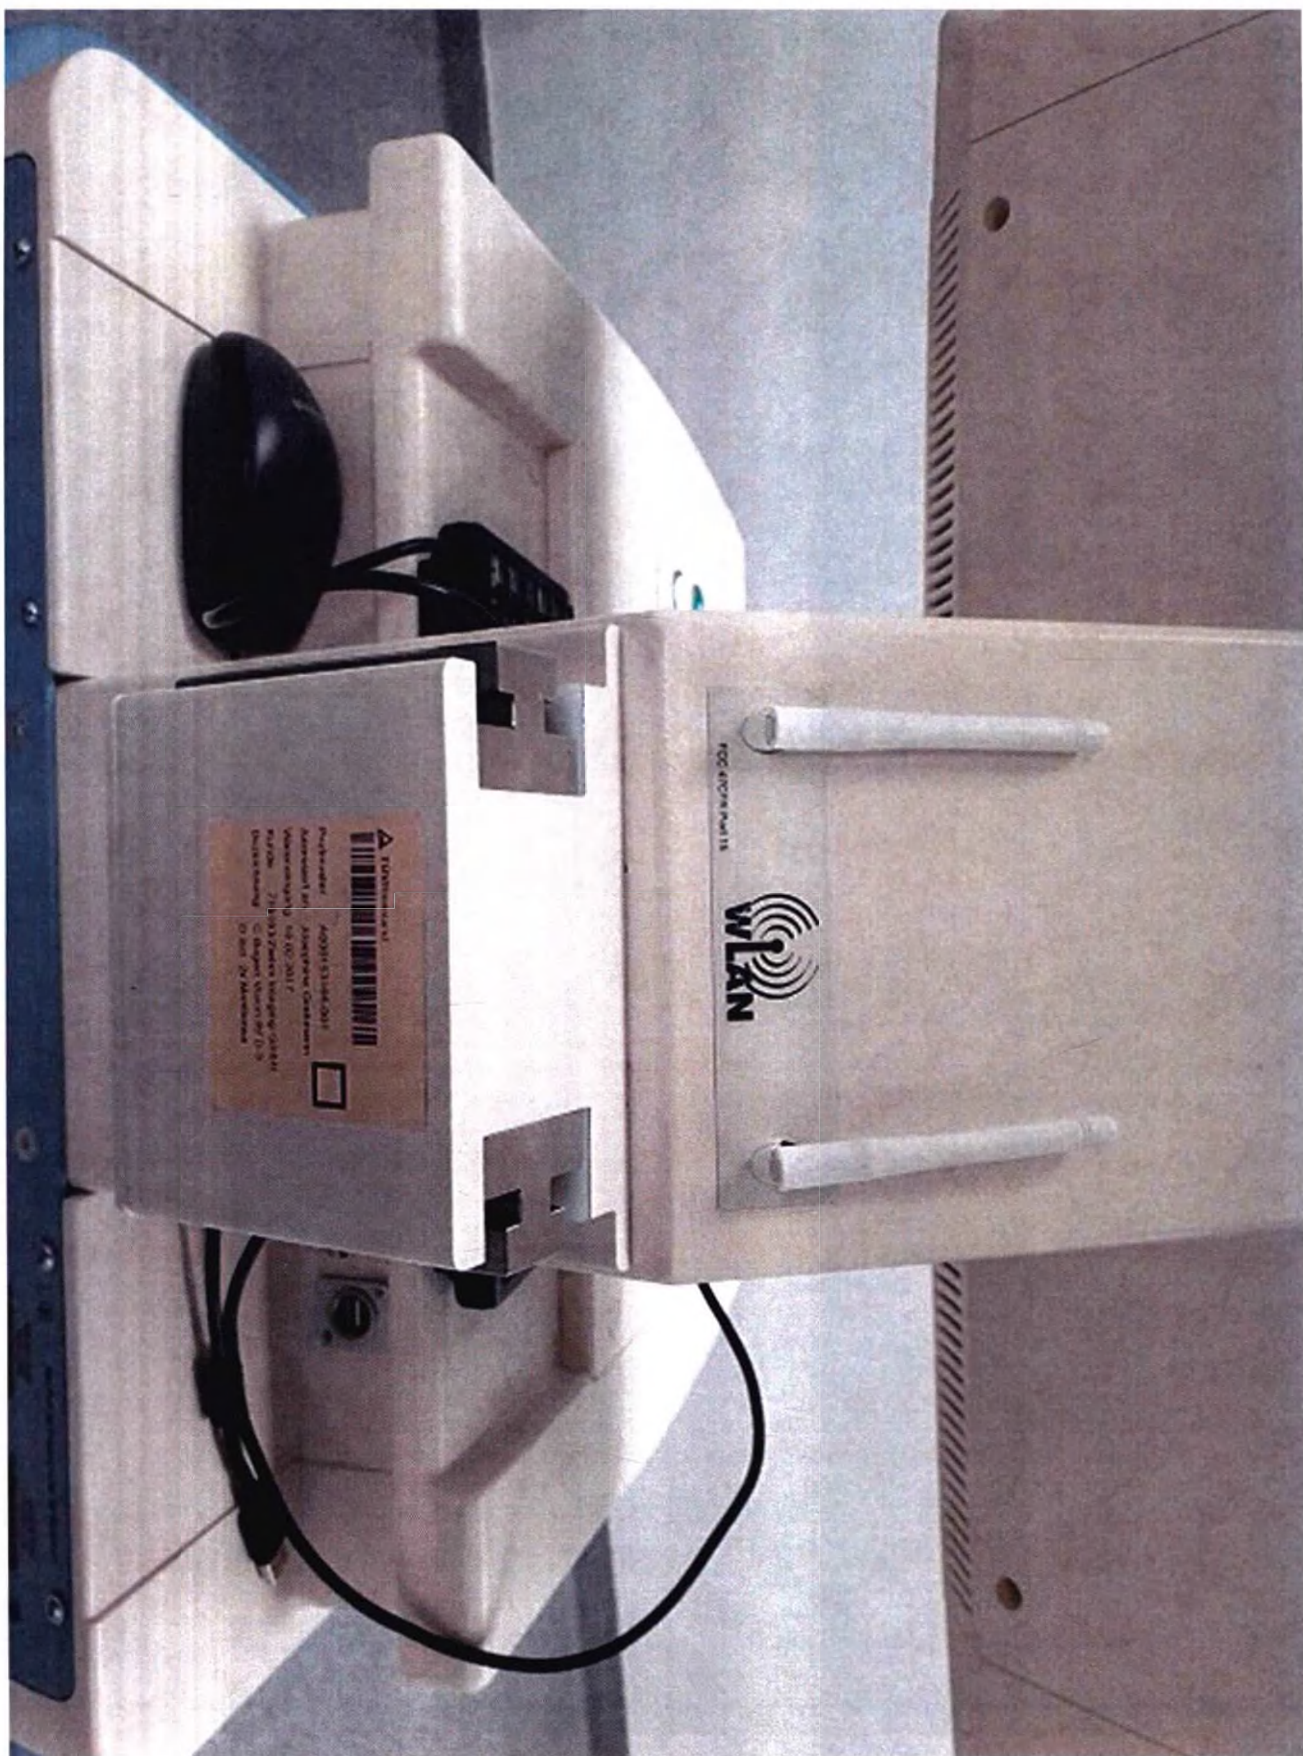


Встроенный микропроцессорный блок управления Memory

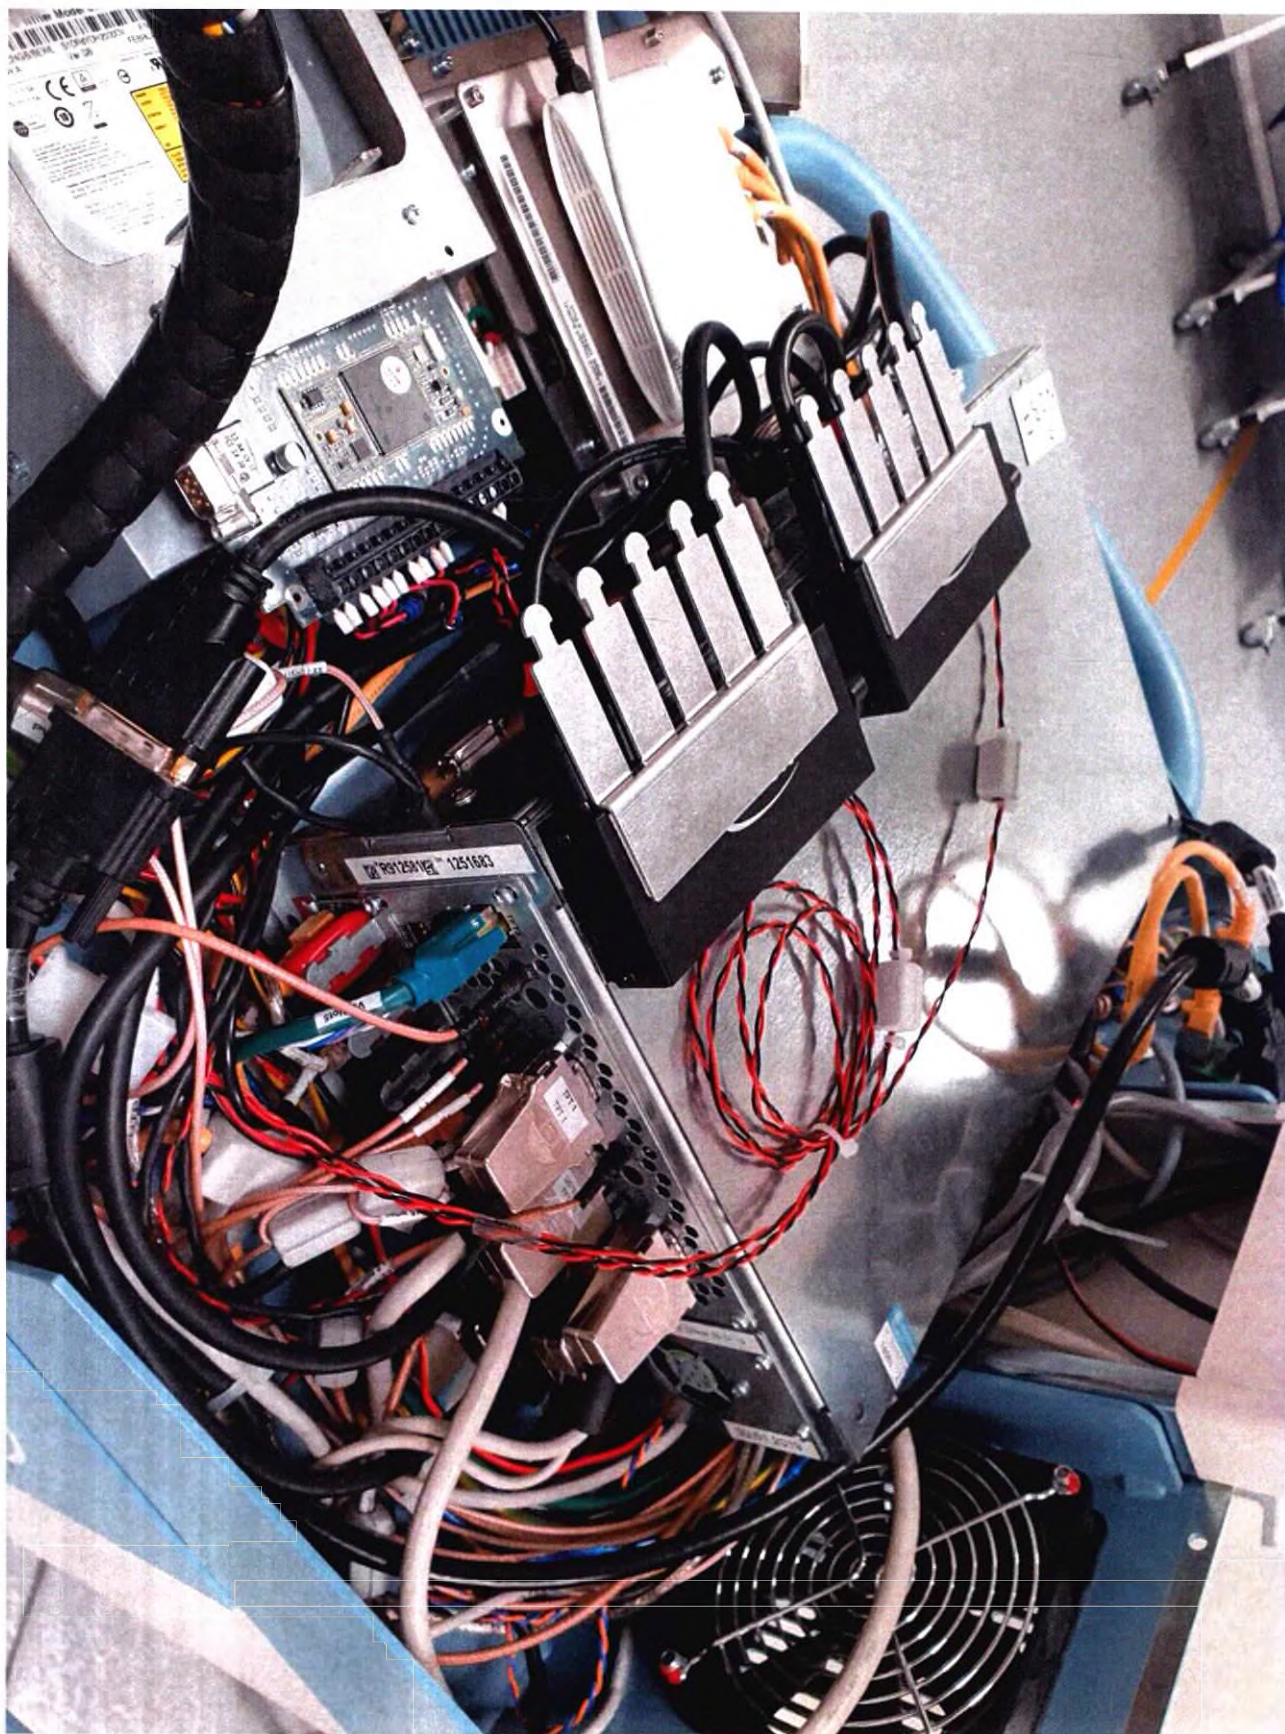

Программный модуль Measurement functions

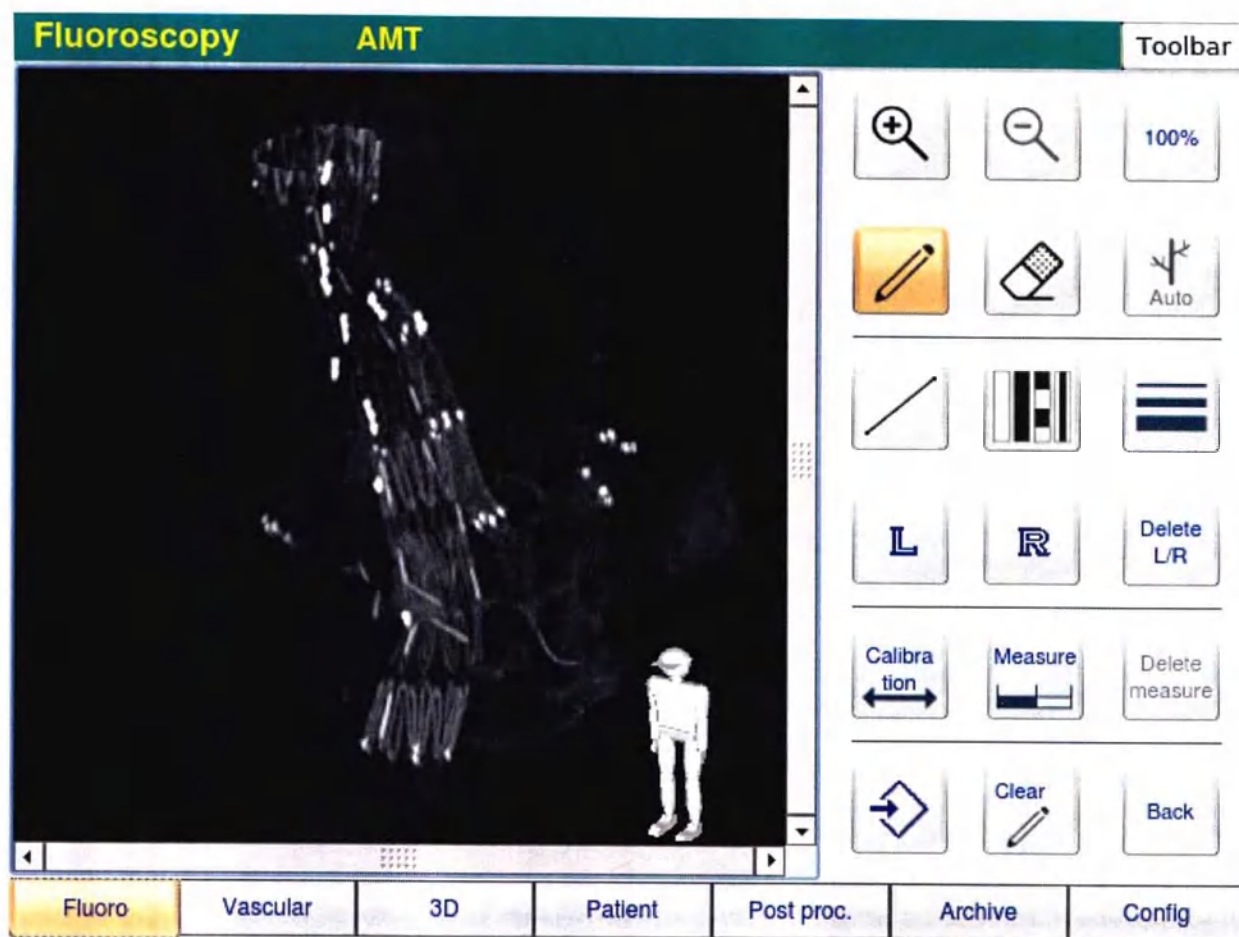

Устройство и программный модуль Injector interface Package

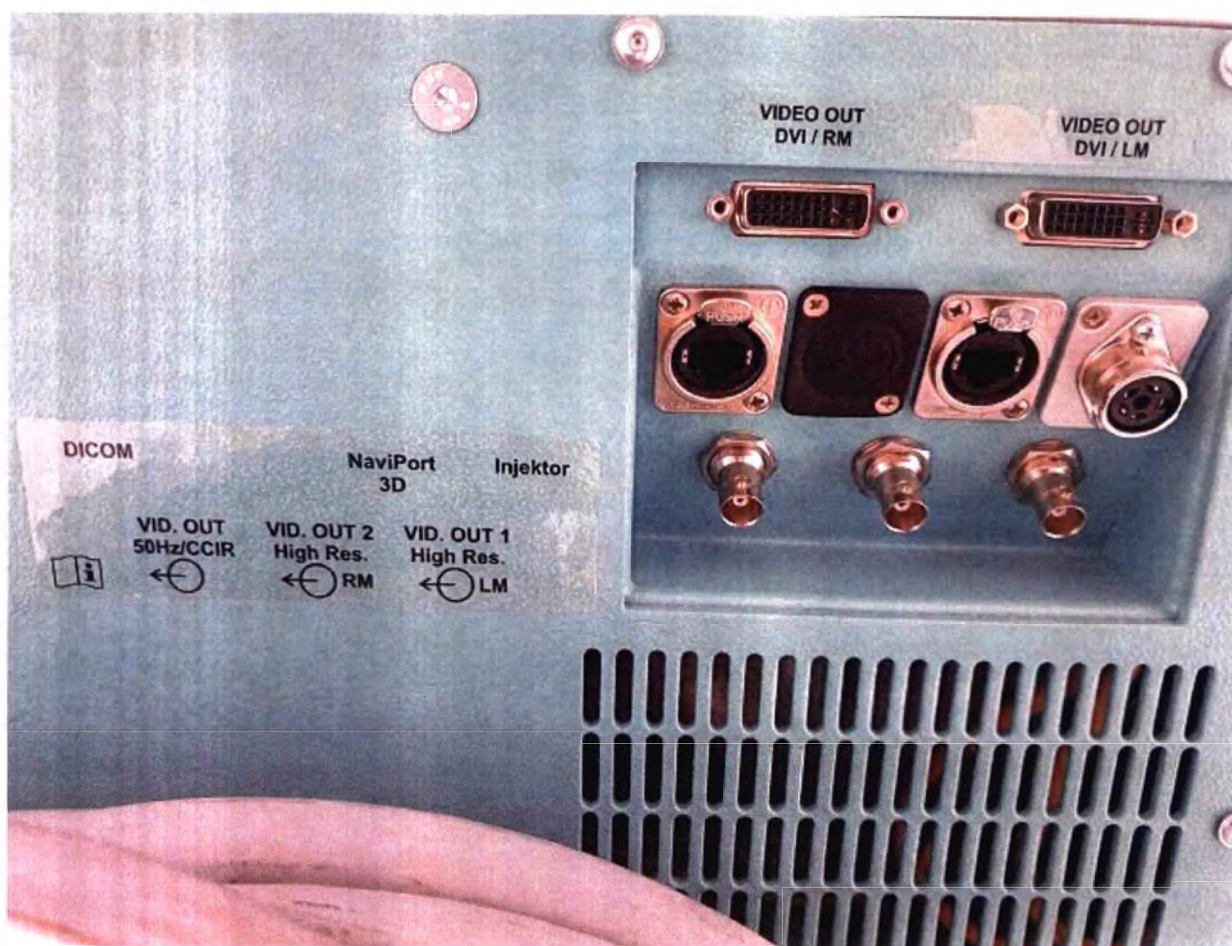

Интерфейс Ziehm NetPort

Configuration Toolbar

- DicomMedia
- Client
- Servers
 - Query
 - Print
 - Storage
 - 2DNavigation
 - 3DNavigation
 - nav_server_...
 - Commitment
 - DoseSR
 - Worklist
 - MPPS

3D Navigation

☐ Server Active

Server Name

Port

IP Address

AE-Title

Class Modality

Attributes

Image Type

NaviType

☐ SpineMask Selectable

Clone

Discard

Test

Apply

°	!	@	;	:	%	<	>	(	)	=	?	←	DEL
\	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	+	Enter	
/													
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	←	
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	*	-	Alt Gr	Space	→	
								+	,				

Dose

DICOM

Common

Switch

System

3D

MDATA

Kinematics

Back

Программный модуль CO2 contrast medium

Конфигурация

Toolbar

Кино

Скор.   Сним./с

Реж.съемки
☐ Рент-скоп
☒ HQ
☒ Авт.воспр.

DSA

Скор.   Сним./с

Реж.съемки
☐ Рент-скоп
☒ HQ

☒ Нативн.сним.DSA ☒ Авт.перенос MSA
☒ DSA CO2

Пред. значение кумулят. возд. кермы:

Отмена

Применить

Раб.настройки

Осн.настройки

Киноряд / DSA / Доза

Носит.инф-и

Принадлежности

Серв.настройки

Рент-скоп

Ангиогр

3D

Пациент

Постобраб.

Архив

Конфиг.

Программный модуль: DSA, MSA, RSA

Ангиограф

Свободная память: 23591 Снимки

Toolbar

45

10.0

40

2

kV
mA
Прод.имп. %
Имп./с

930.55

10:21

cGy cm²
мин.

1x1
2x2
4x4

C1/146
C DSA
C2/212
C DSA

287
289

Лазер
Фил.
Привод - / +

Сним./с
1 2 4 8 12.5 25
Кино

Play
Выкл. маску
Прав.
P-Sh LM

DSA

Кино

MSA

Bolus
RSA

Рент-скоп
Ангиограф
3D
Пациент
Постобраб.
Архив
Конфиг.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 37 (тридцать семь) листов
Подпись _____

