

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДИМПОРТ»

«МЕДИМПОРТ» / А.М. Леонтьев /

«14» сентября 2020 г.





**Матрас противопротезный «Armed»  
с компрессором**


**Фотографические изображения**


Варианты исполнения:


I. DGC420

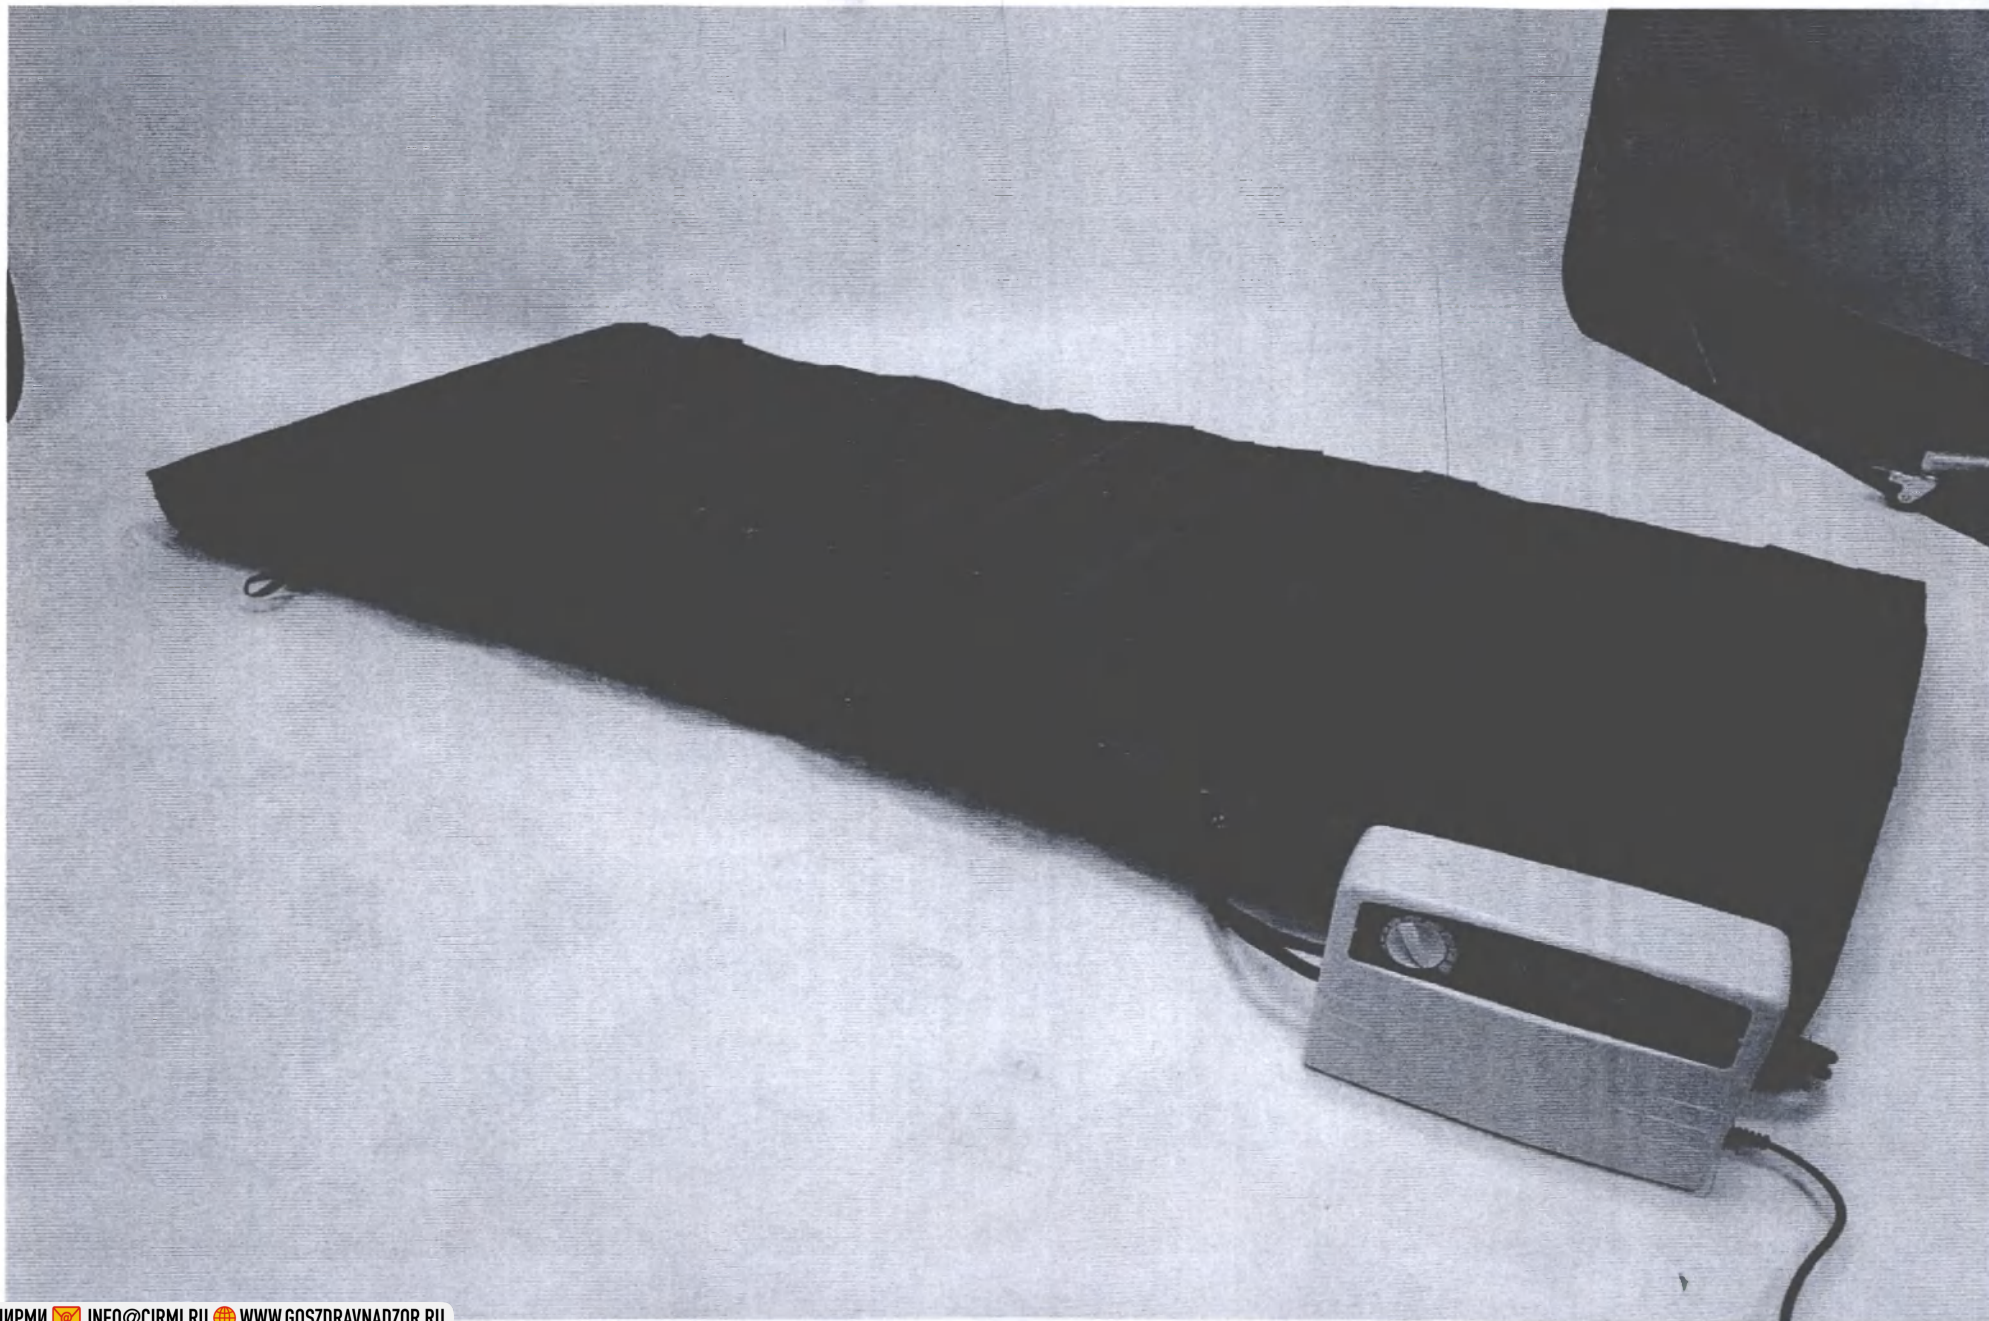

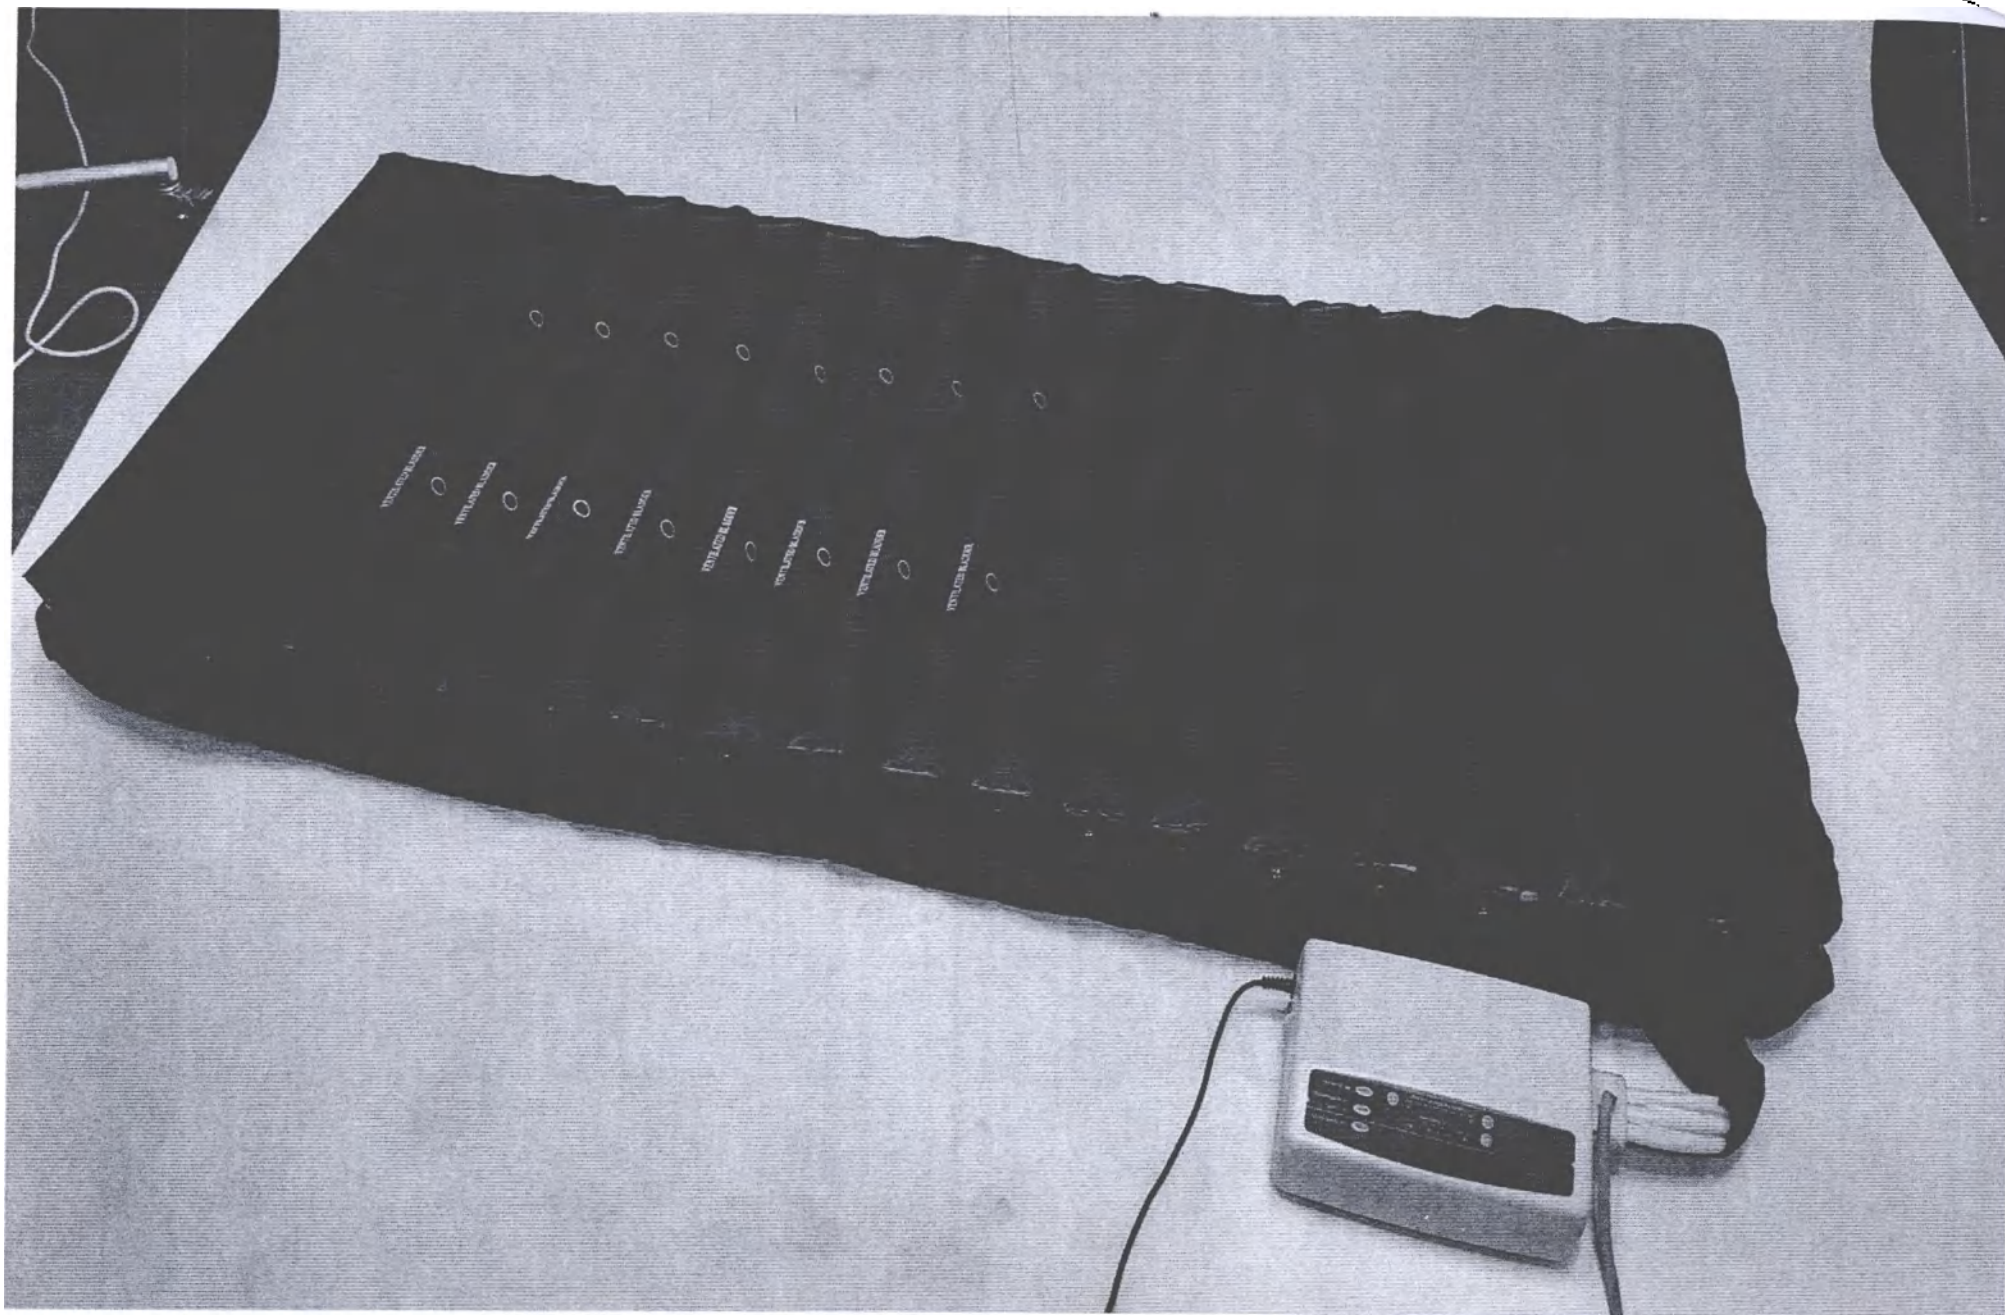


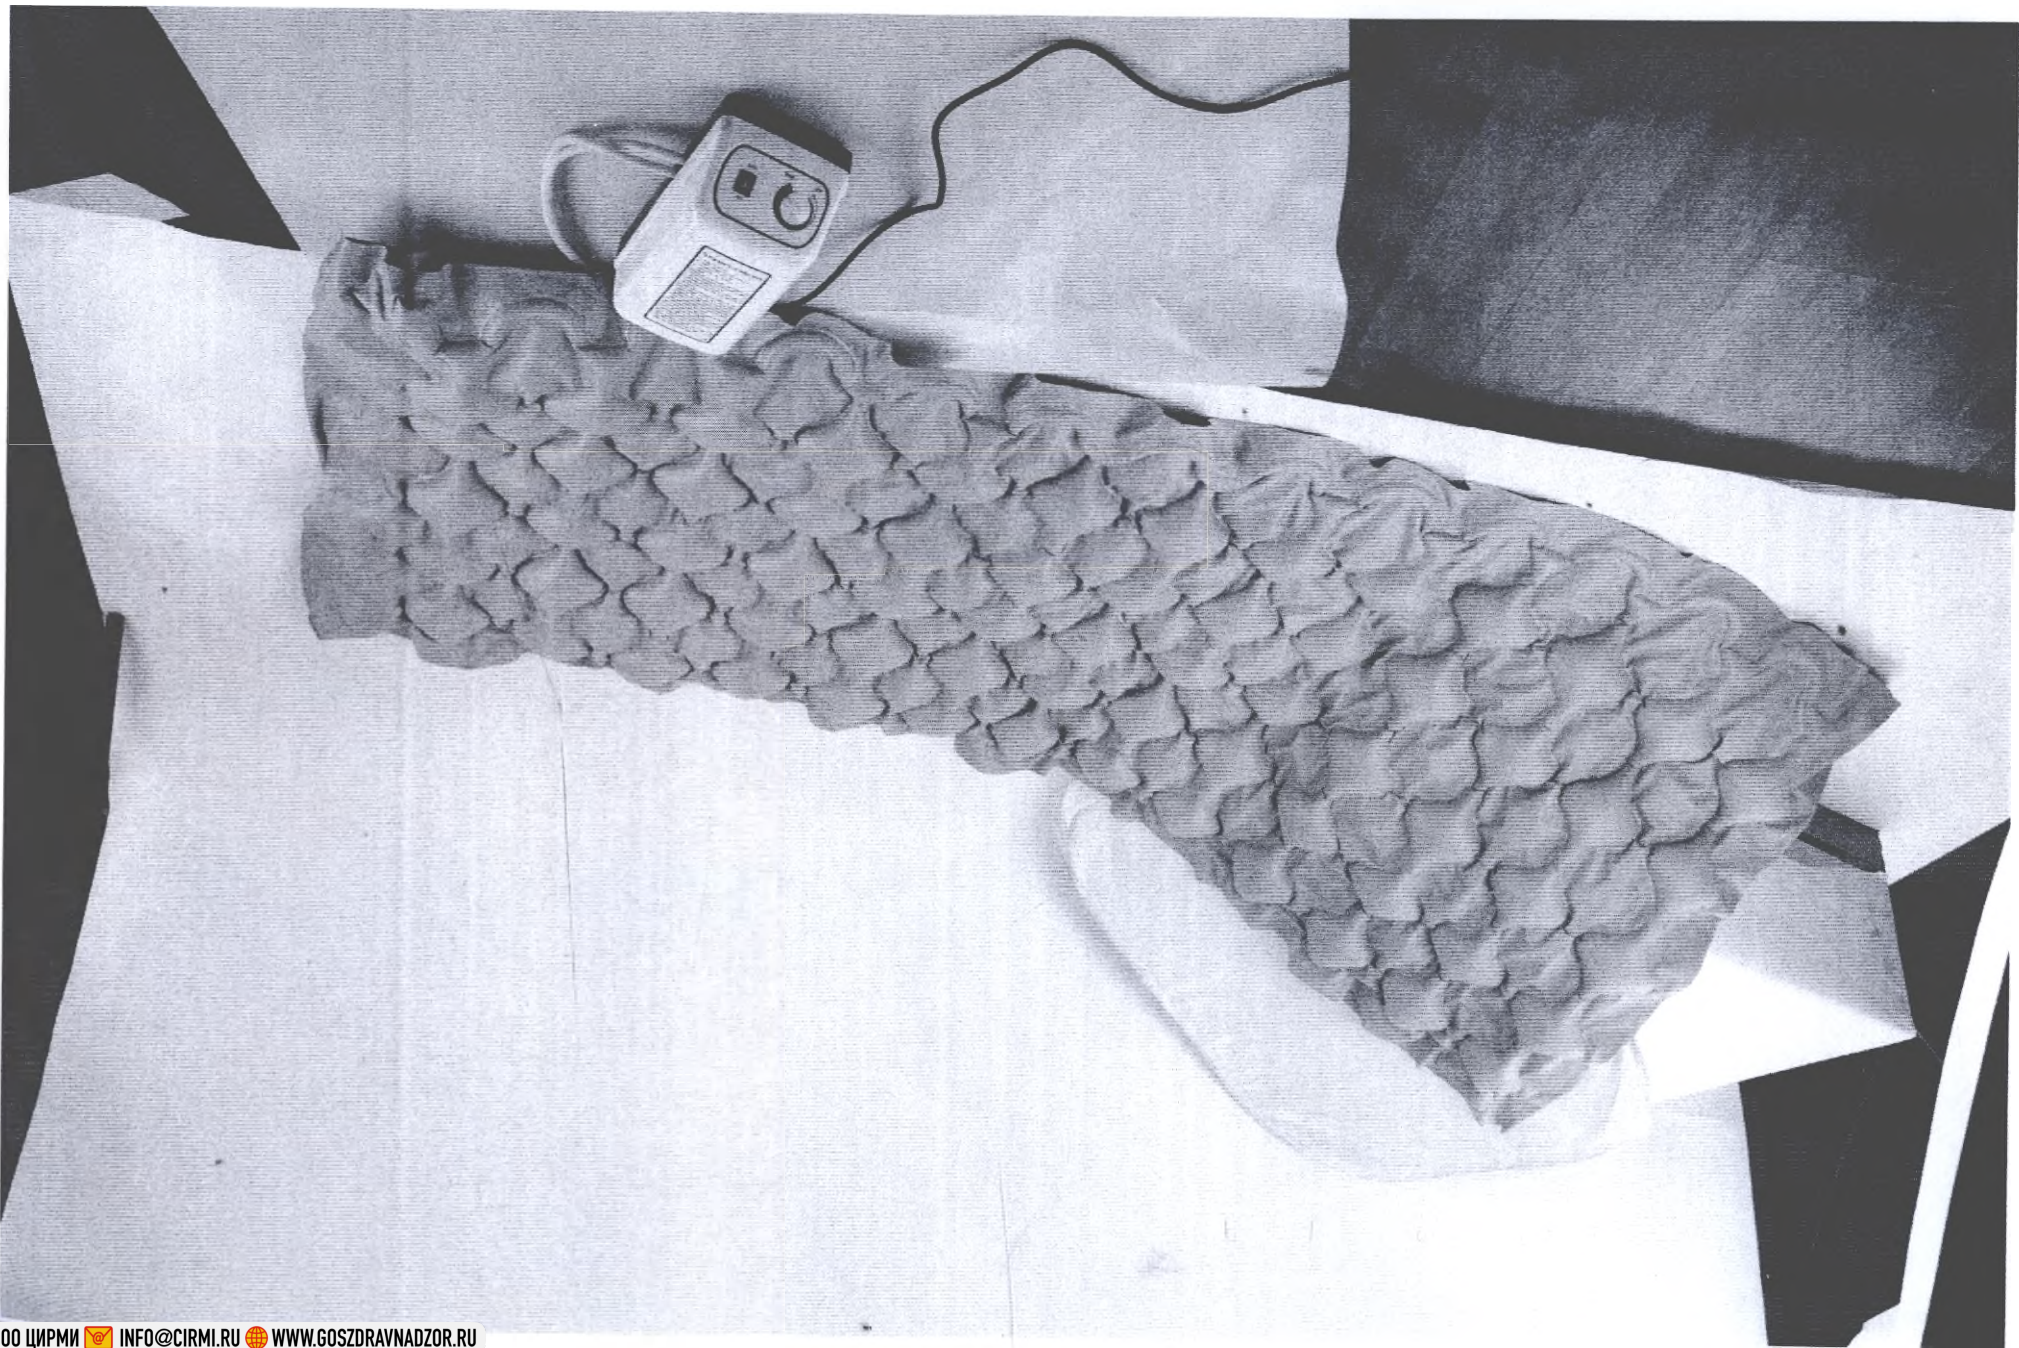

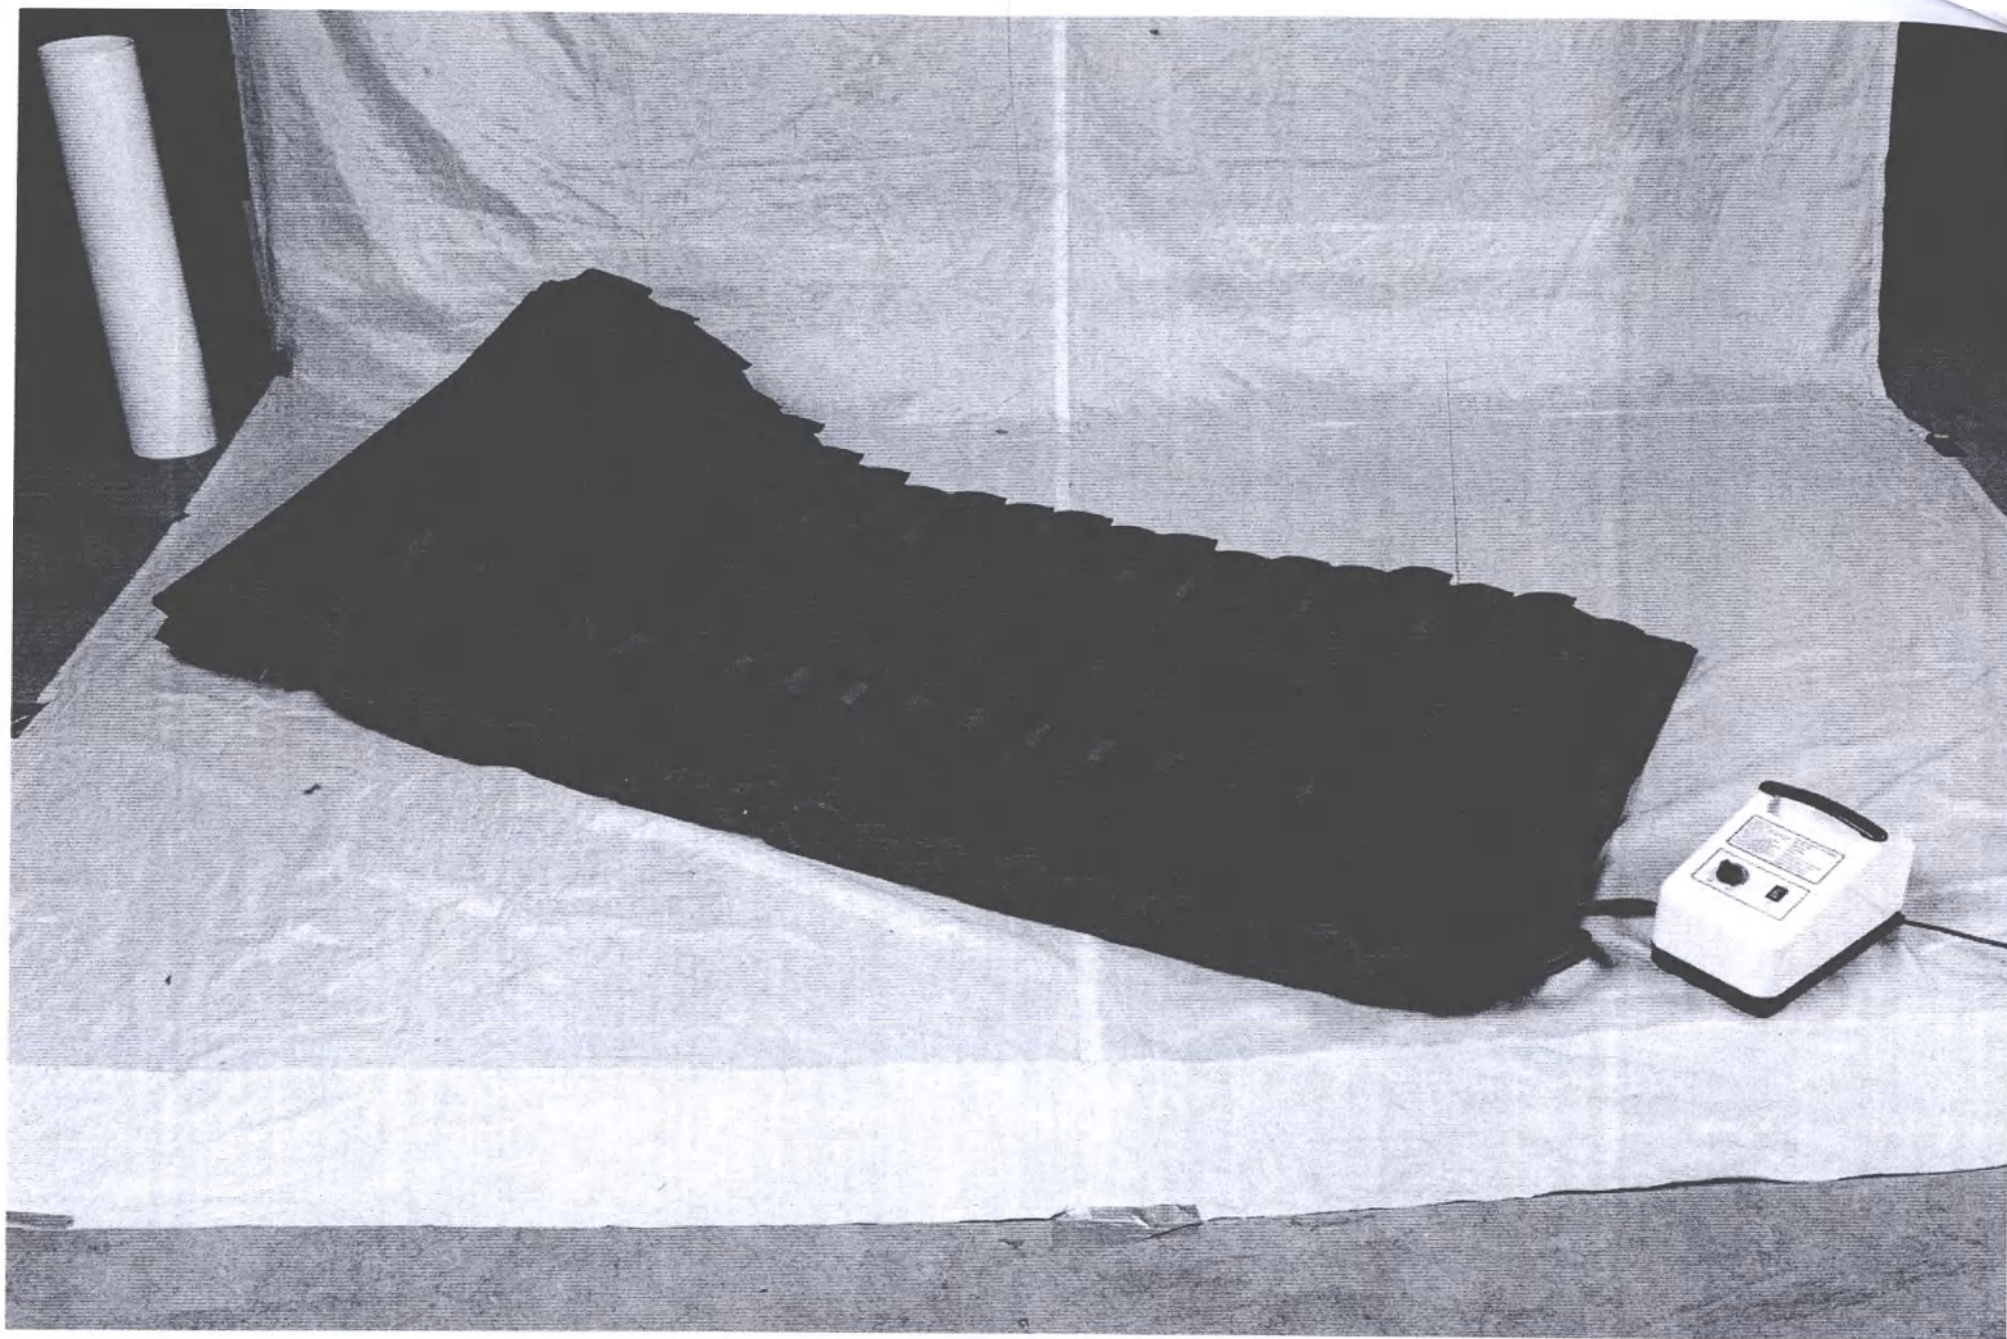

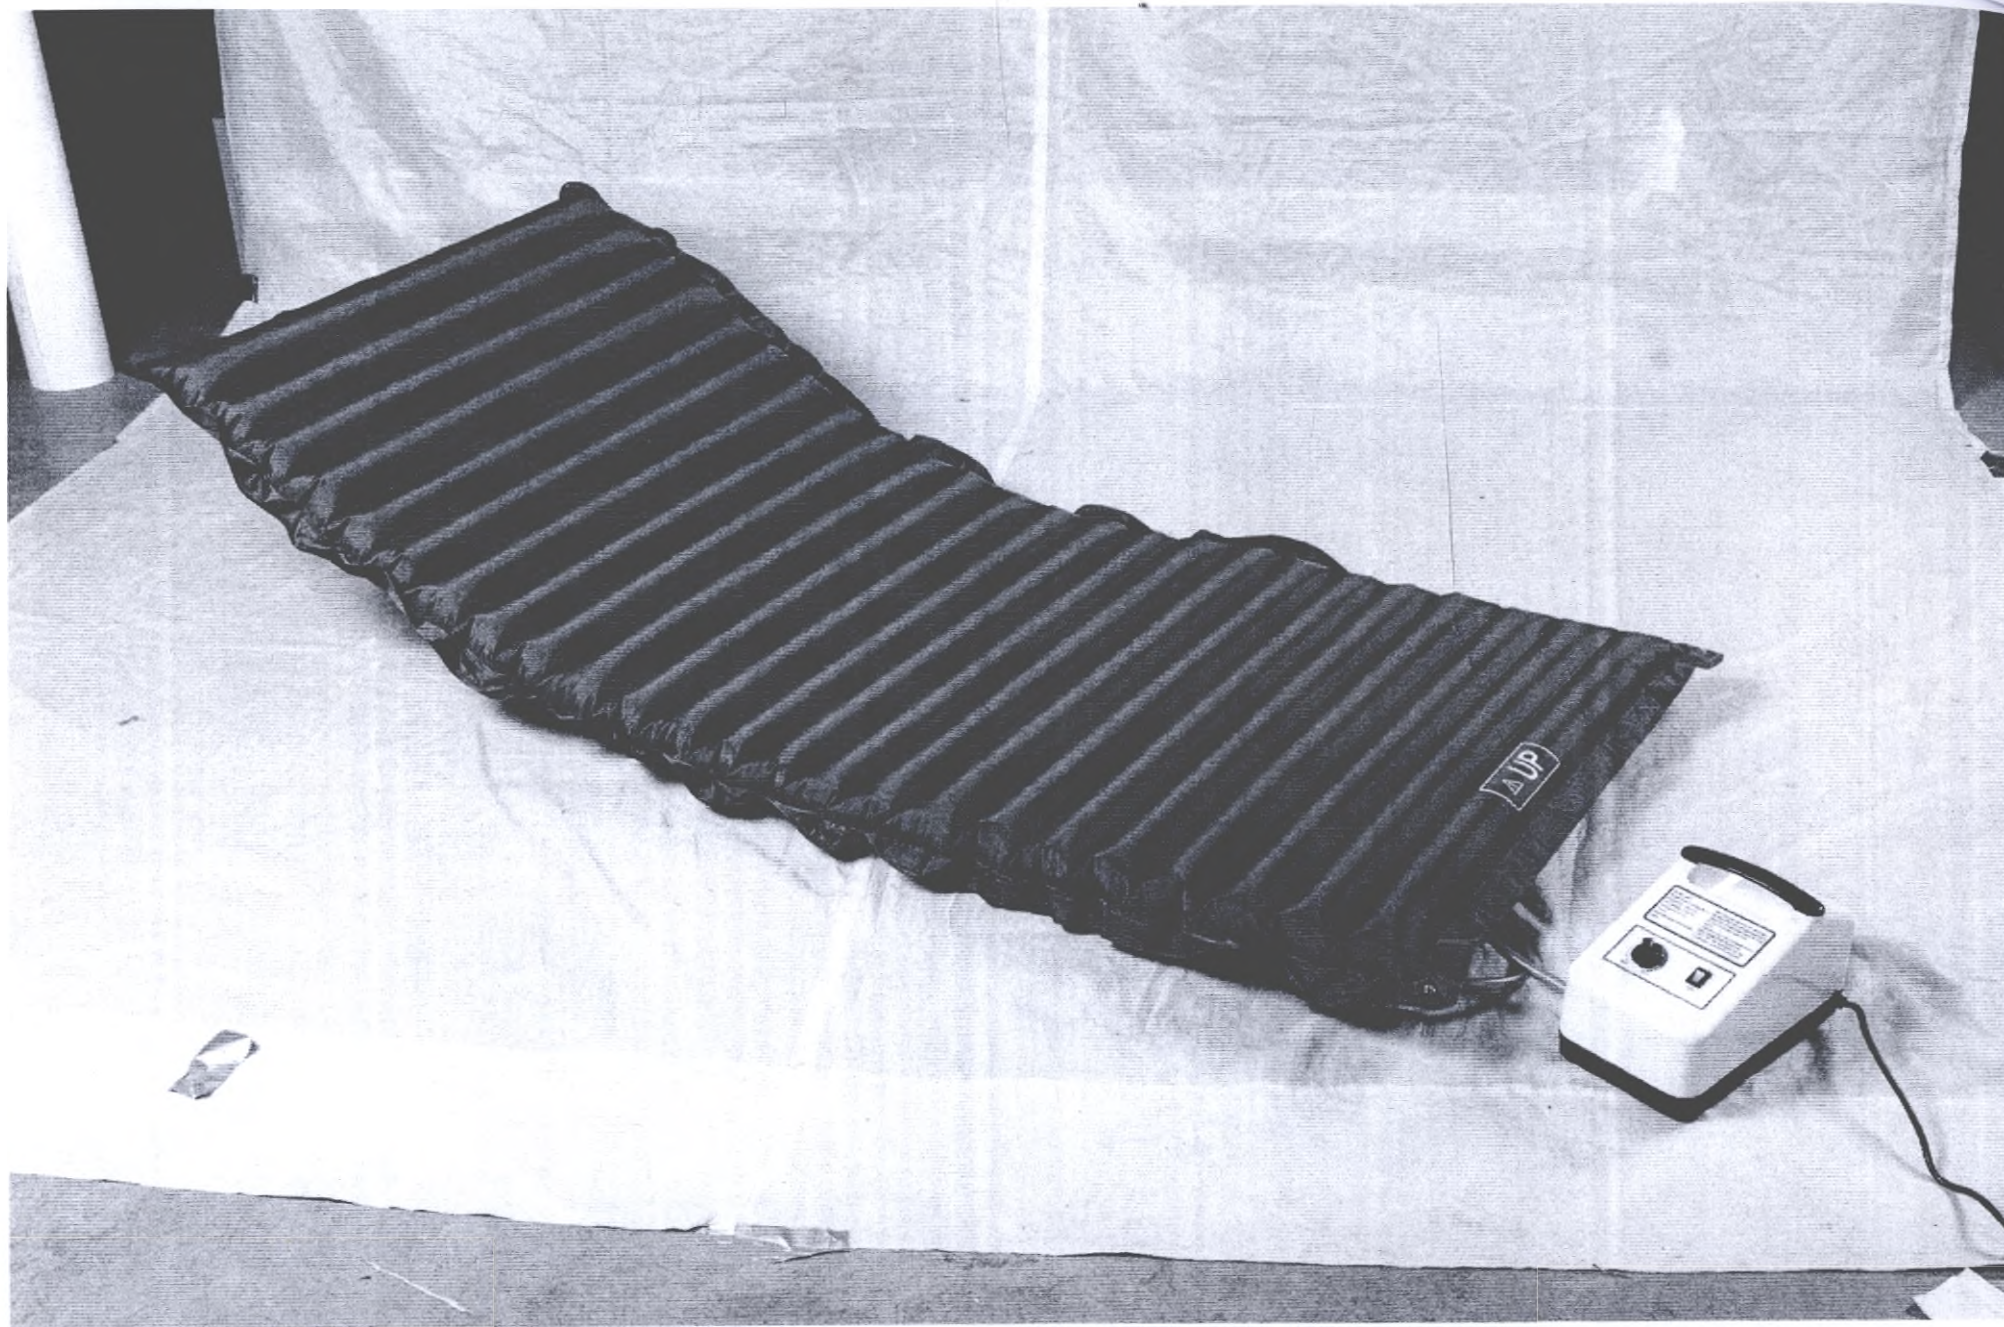





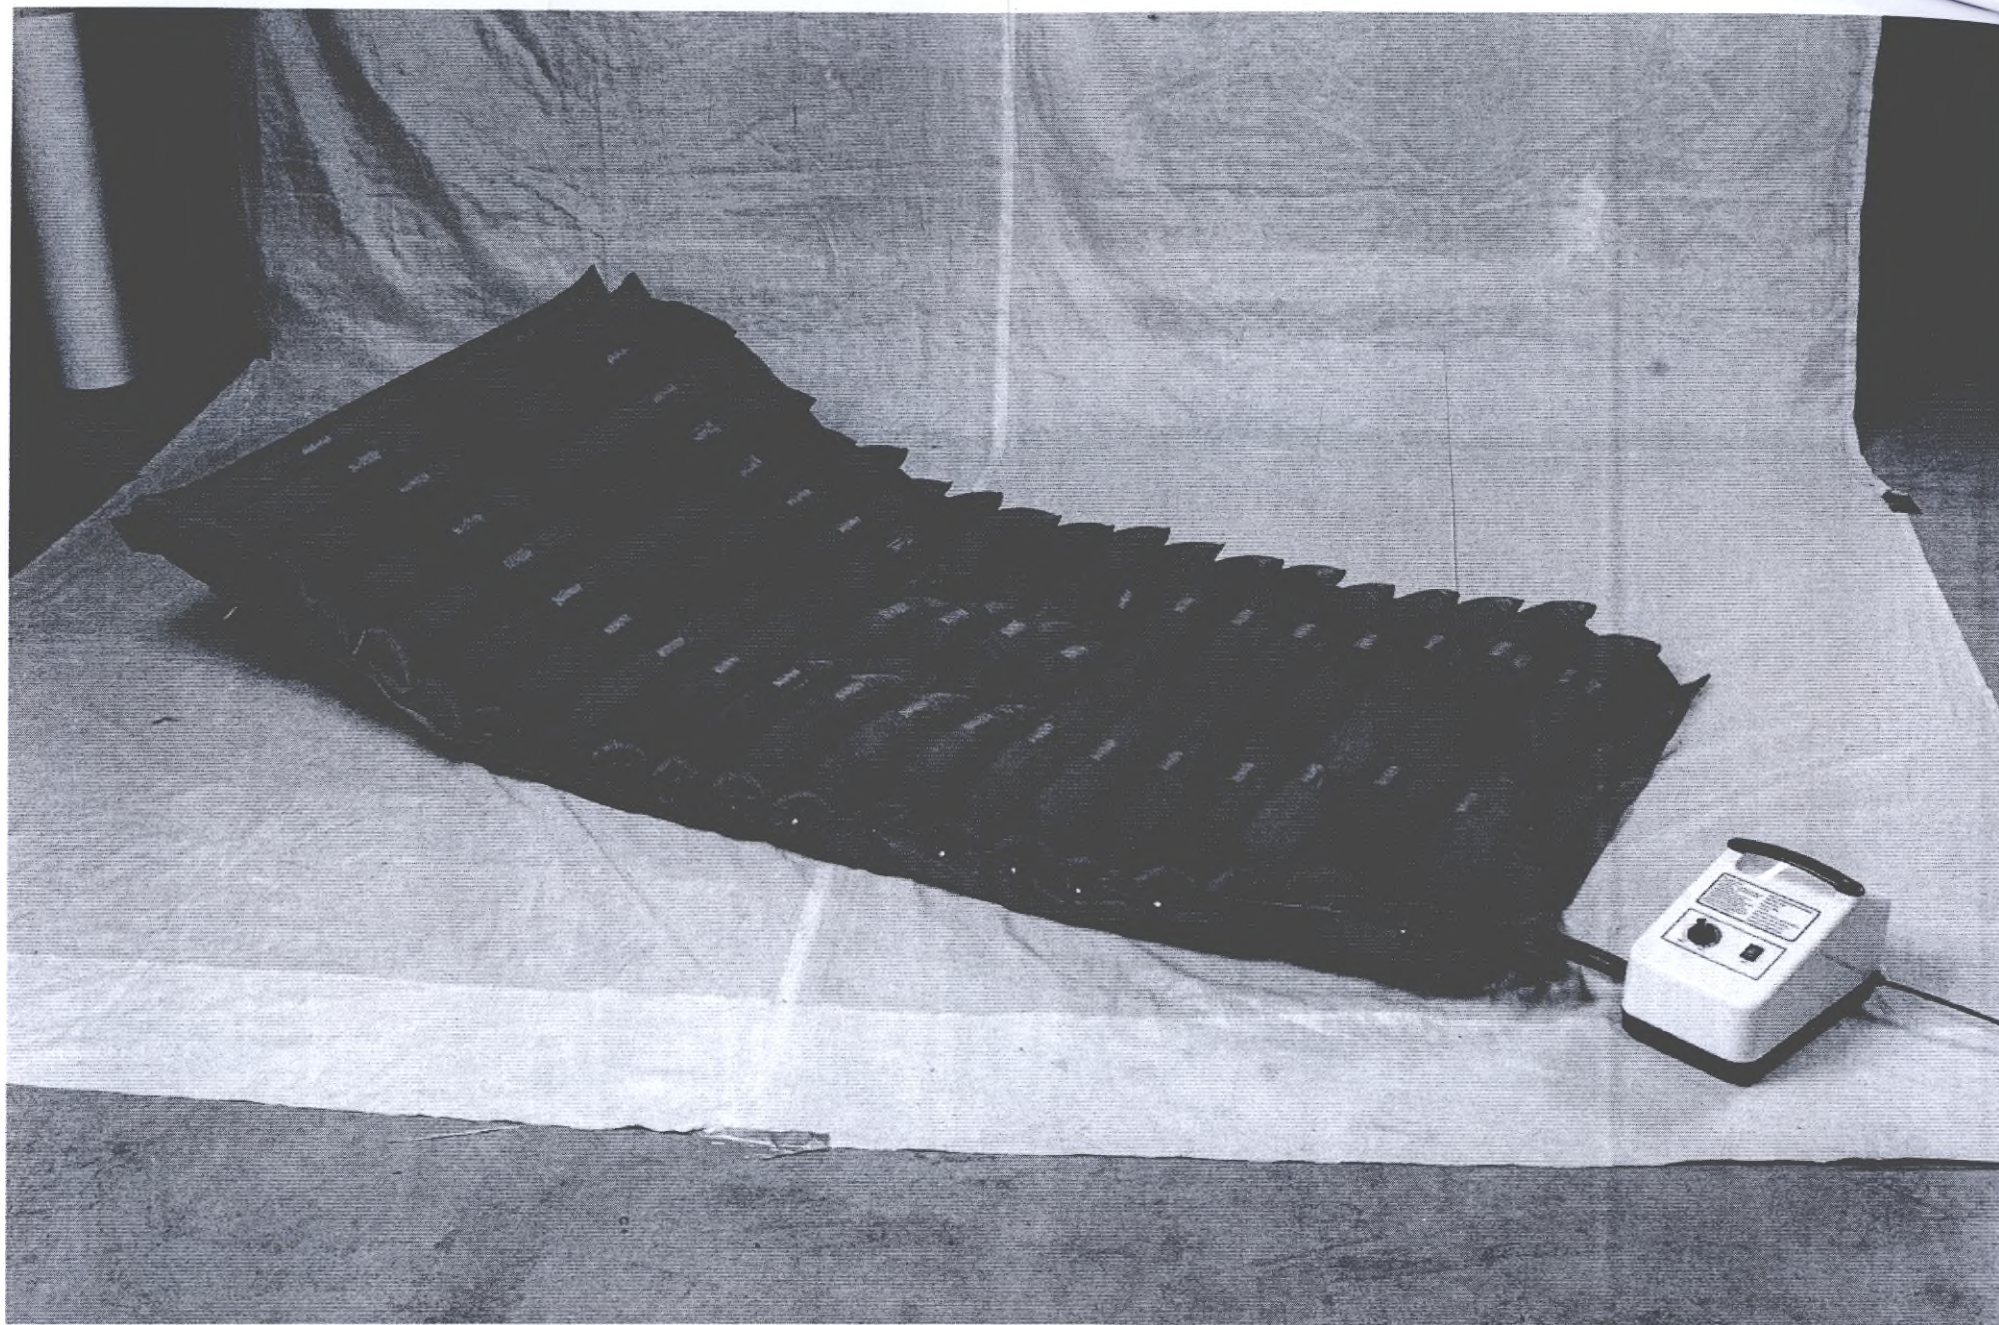



Компрессоры:

Тип А

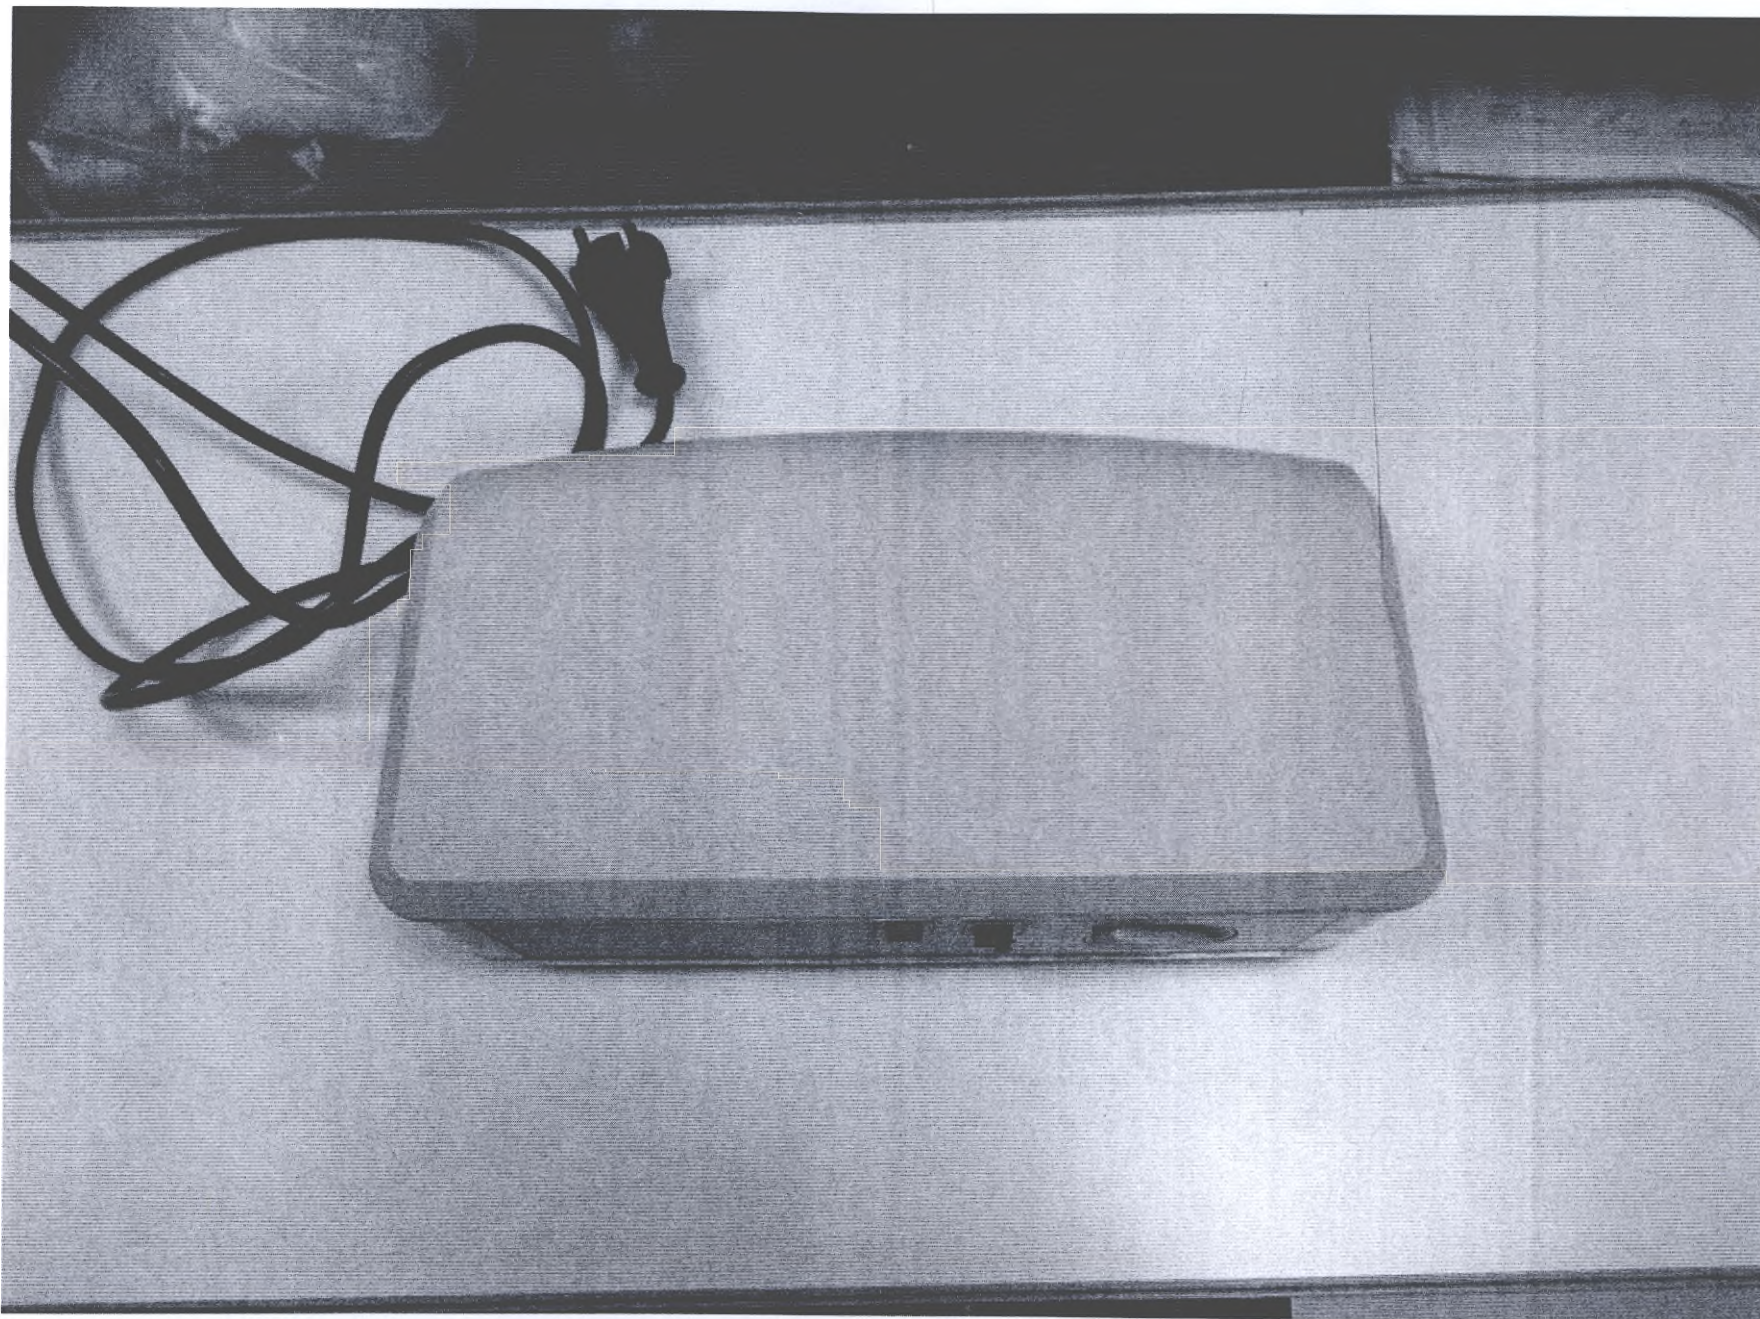

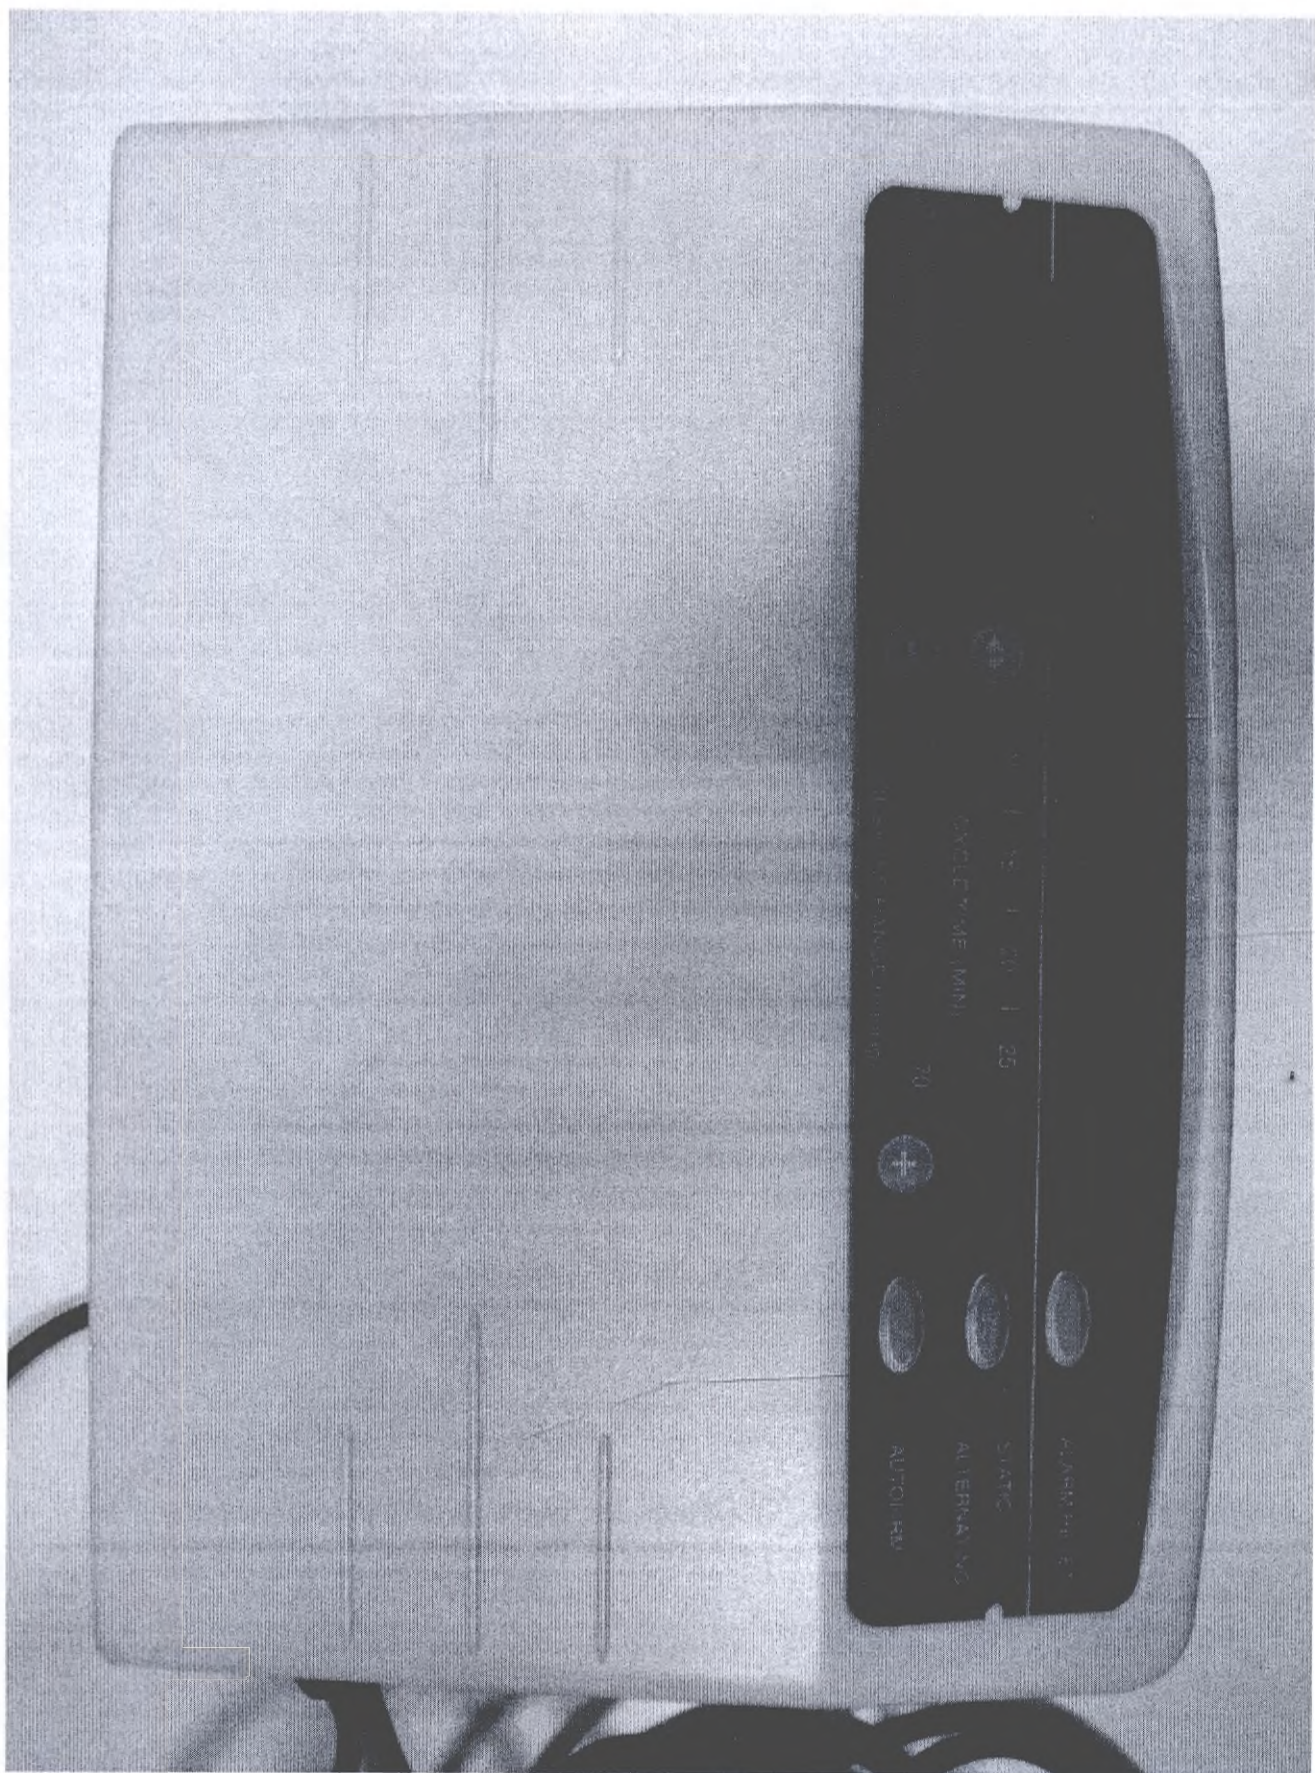

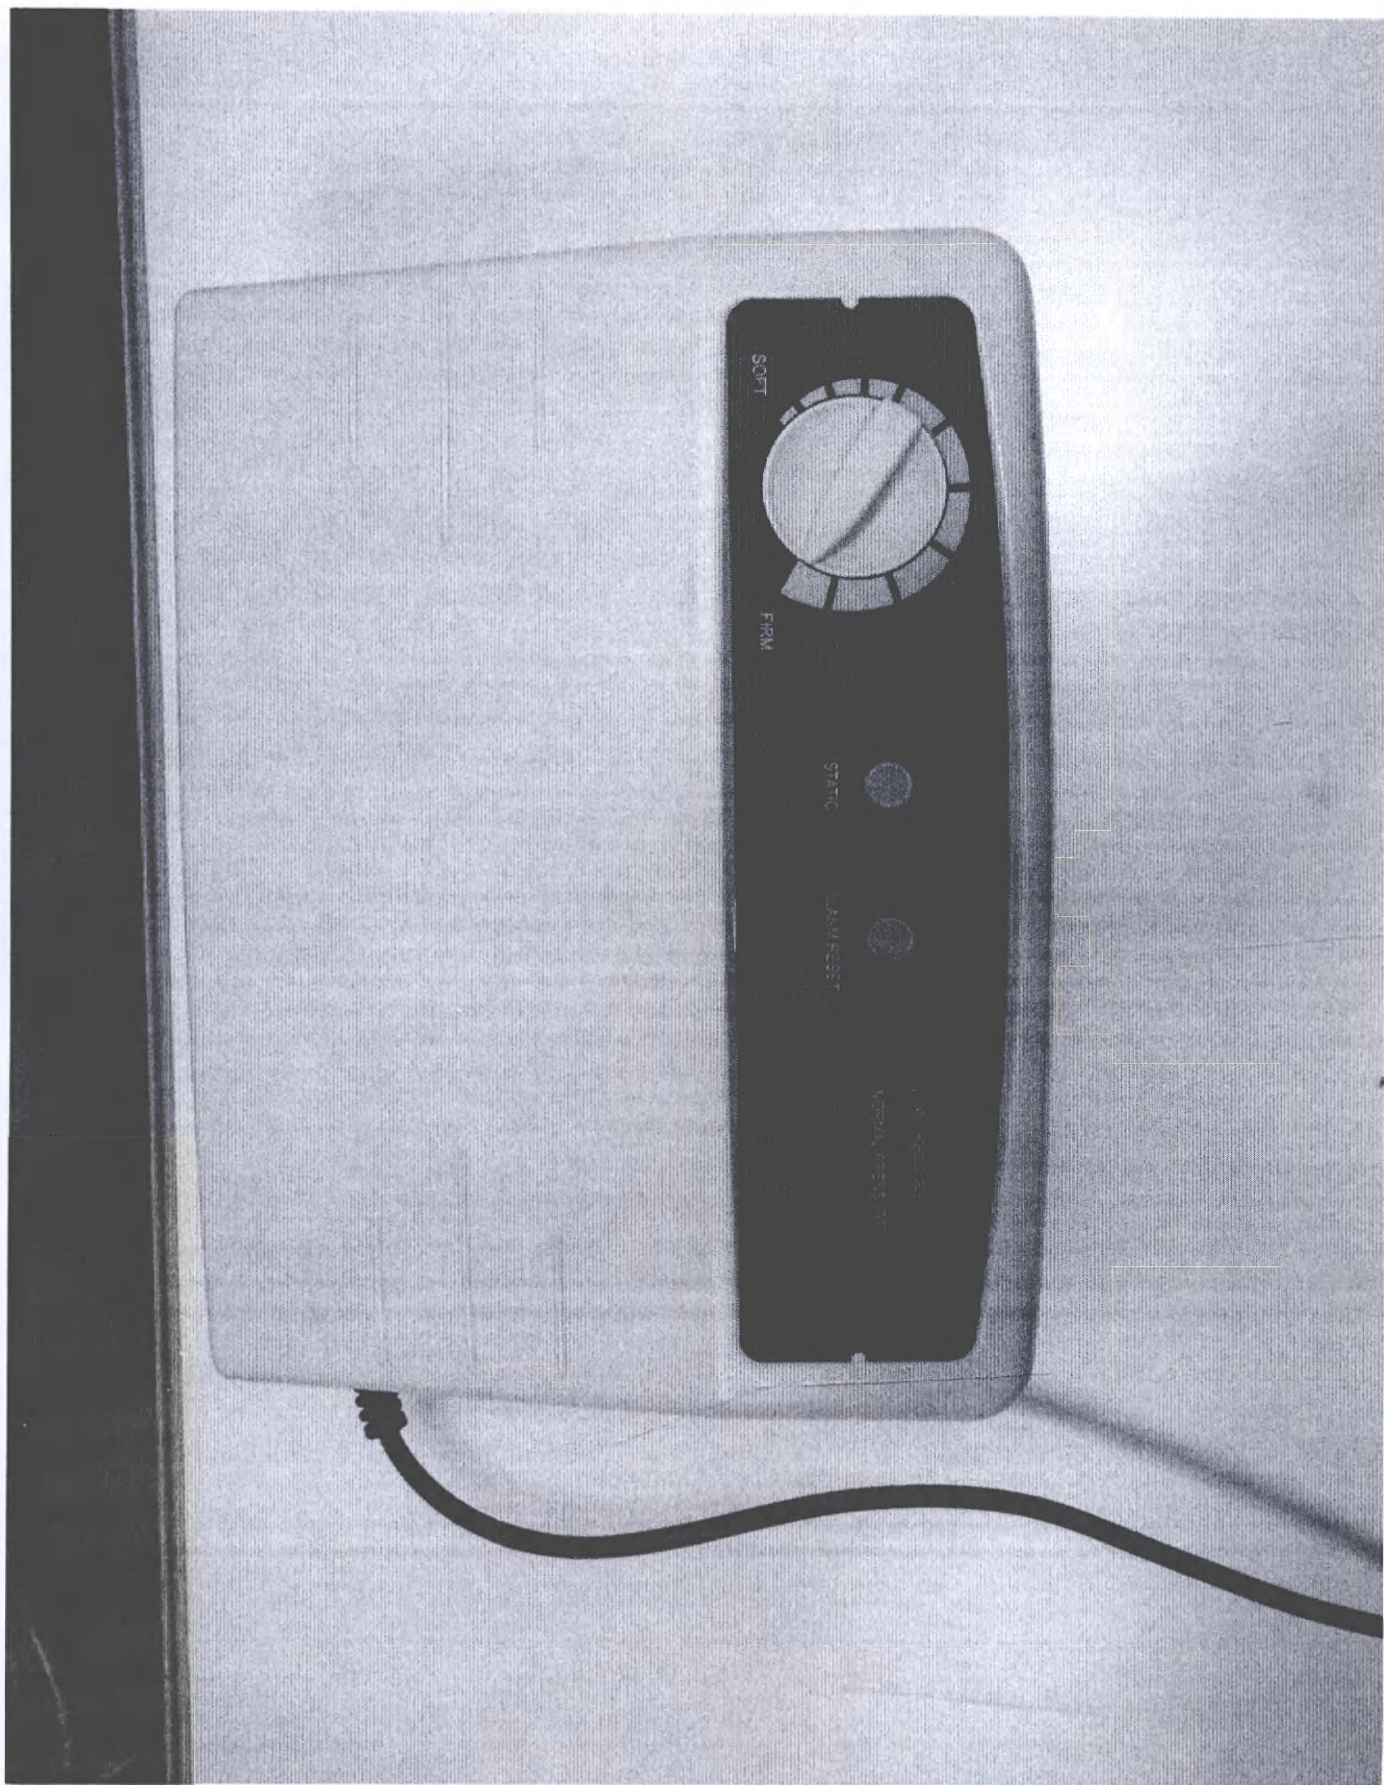

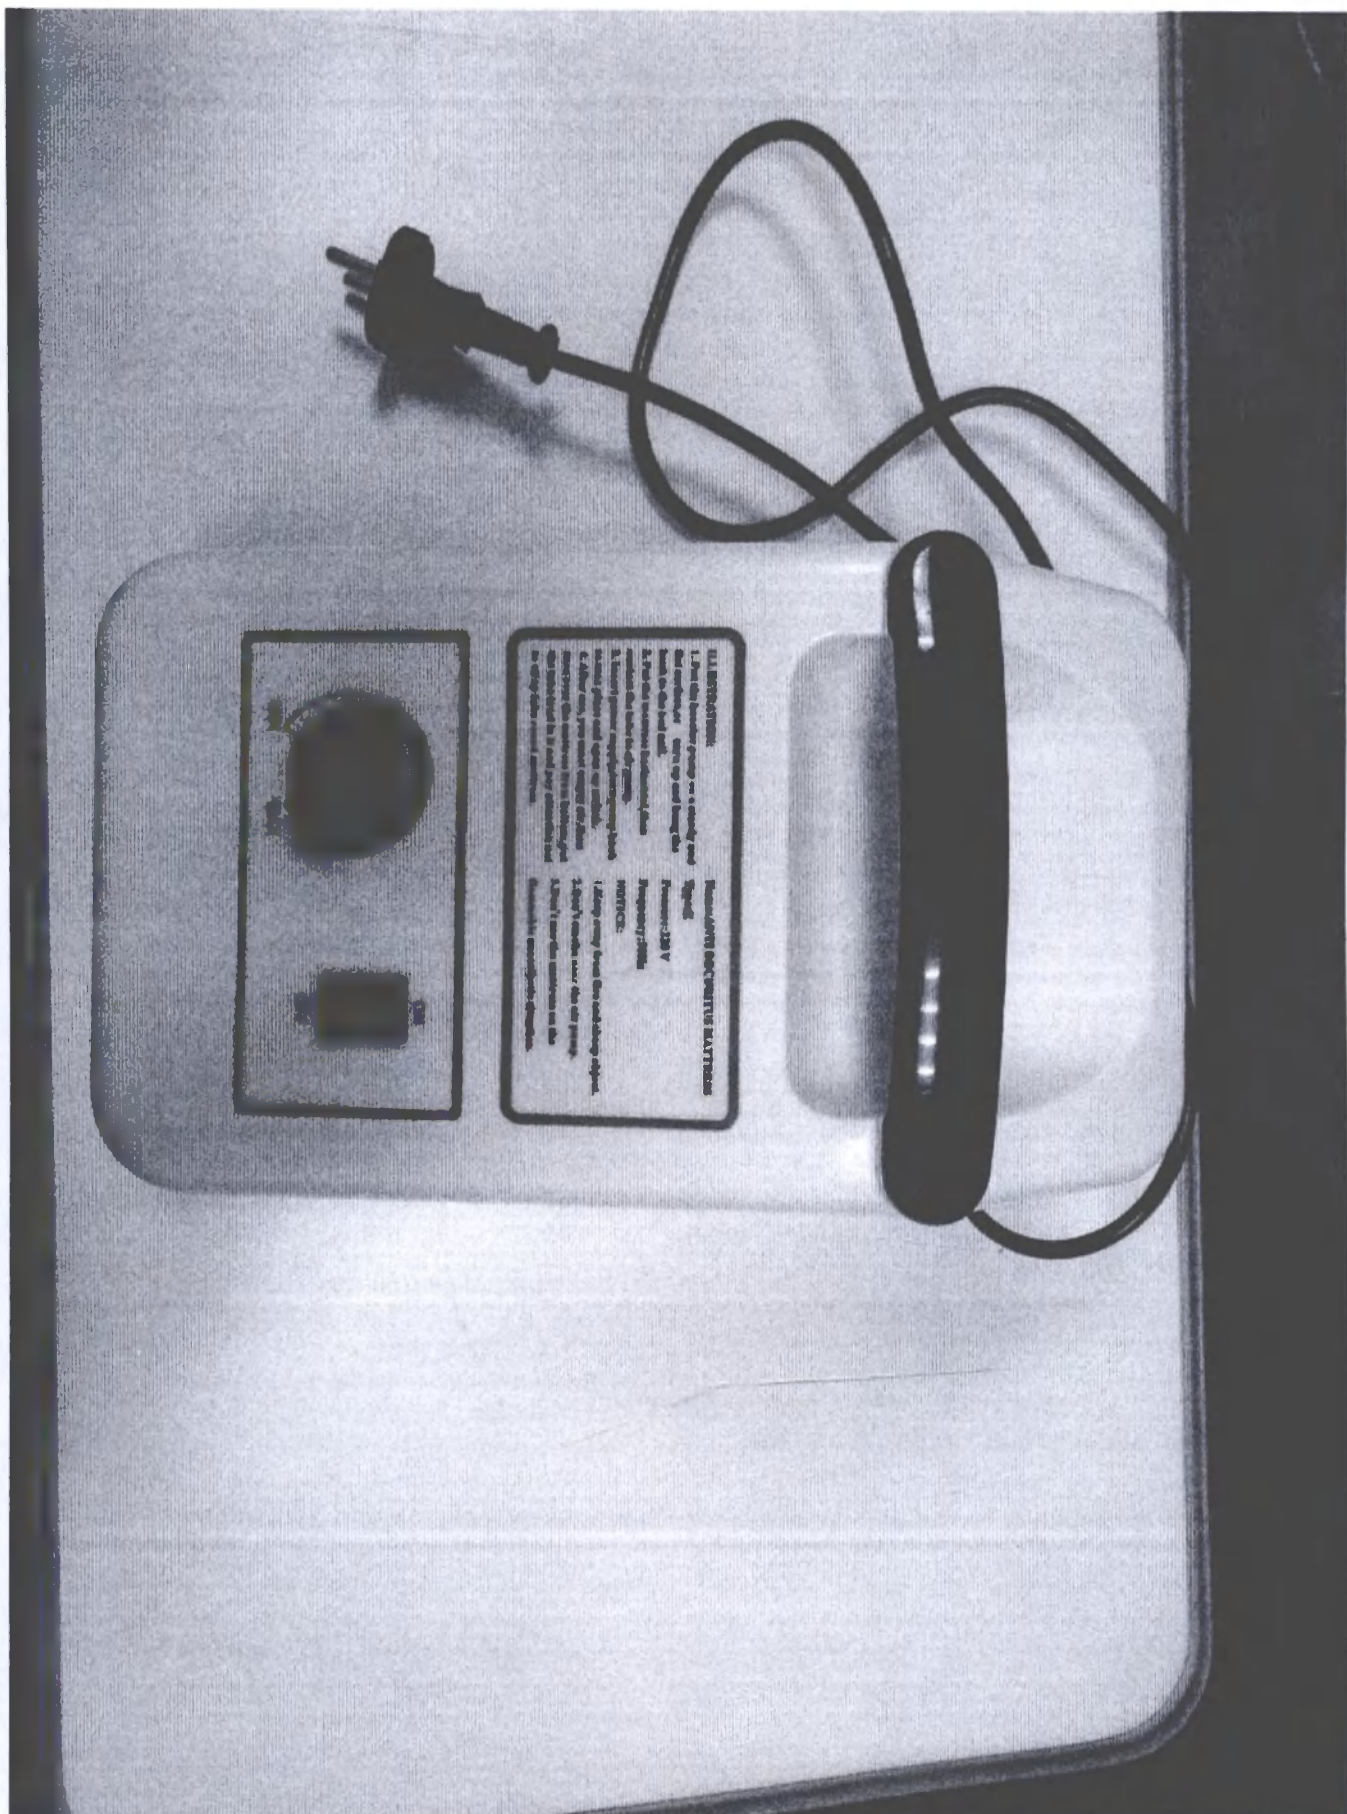

**ВАЖНО!**

1. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

2. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

3. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

4. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

5. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

6. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

7. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

8. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

9. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

10. При использовании прибора необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Наименование: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Тип: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность: 1000 Вт

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

1. Не использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

2. Не использовать прибор в помещениях с горючими материалами.

3. Не использовать прибор в помещениях с легковоспламеняющимися жидкостями.

4. Не использовать прибор в помещениях с повышенной температурой воздуха.

5. Не использовать прибор в помещениях с повышенной концентрацией пыли.


6. Не использовать прибор в помещениях с повышенной концентрацией газов.

7. Не использовать прибор в помещениях с повышенной концентрацией паров.

8. Не использовать прибор в помещениях с повышенной концентрацией дыма.

9. Не использовать прибор в помещениях с повышенной концентрацией запаха.


10. Не использовать прибор в помещениях с повышенной концентрацией шума.

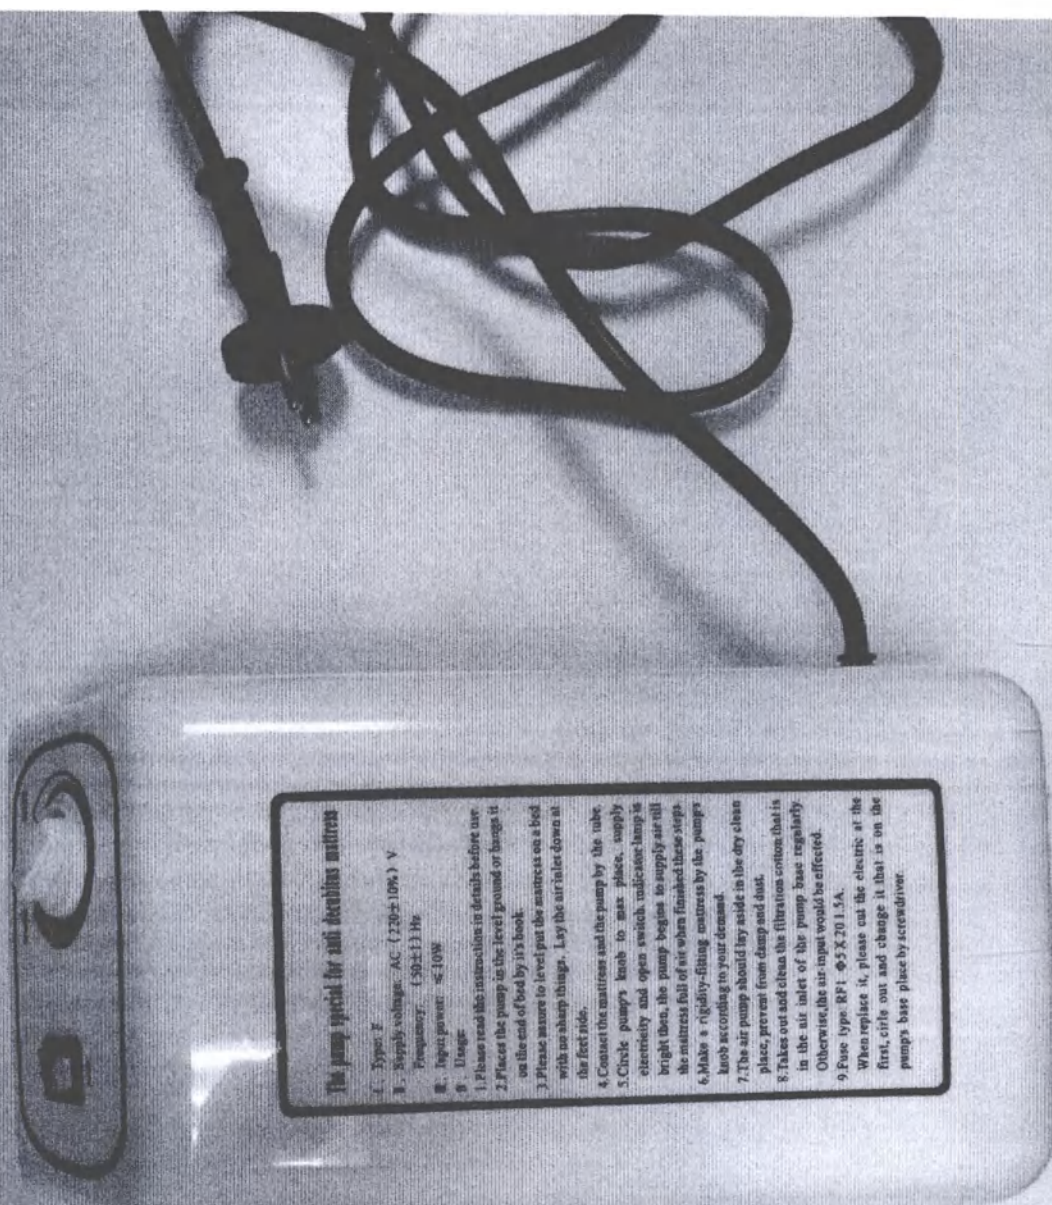


### The pump special for anti-decubitus mattress

- A. Type:** F  
**B. Supply voltage:** AC (220±10%) V  
**Frequency:** (50±1) Hz  
**C. Input power:** ≤ 10W  
**D. Usage:**
1. Please read the instructions in details before use.
  2. Place the pump on the level ground or large it on the end of bed by its back.
  3. Please ensure to level out the mattress on a bed with no sharp things. Lay the air inlet down at the feet side.
  4. Connect the mattress and the pump by the tube.
  5. Circle pump's knob to "on" place, supply electricity and open switch indication lamp is bright then, the pump begins to supply air till the mattress full of air when finished these steps.
  6. Make a rigidly-fitting mattress by the pump's knob according to your demand.
  7. The air pump should lay aside in the dry clean place, prevent from damp and dust.
  8. Take out and clean the filtration cotton that is in the air inlet of the pump base regularly. Otherwise, the air input would be effected.
  9. Fuse type: RP1-Φ5 X 20 I. 5A.
- When replace it, please cut the electric at the first, circle out and change it that is on the pump's base place by screwdriver.



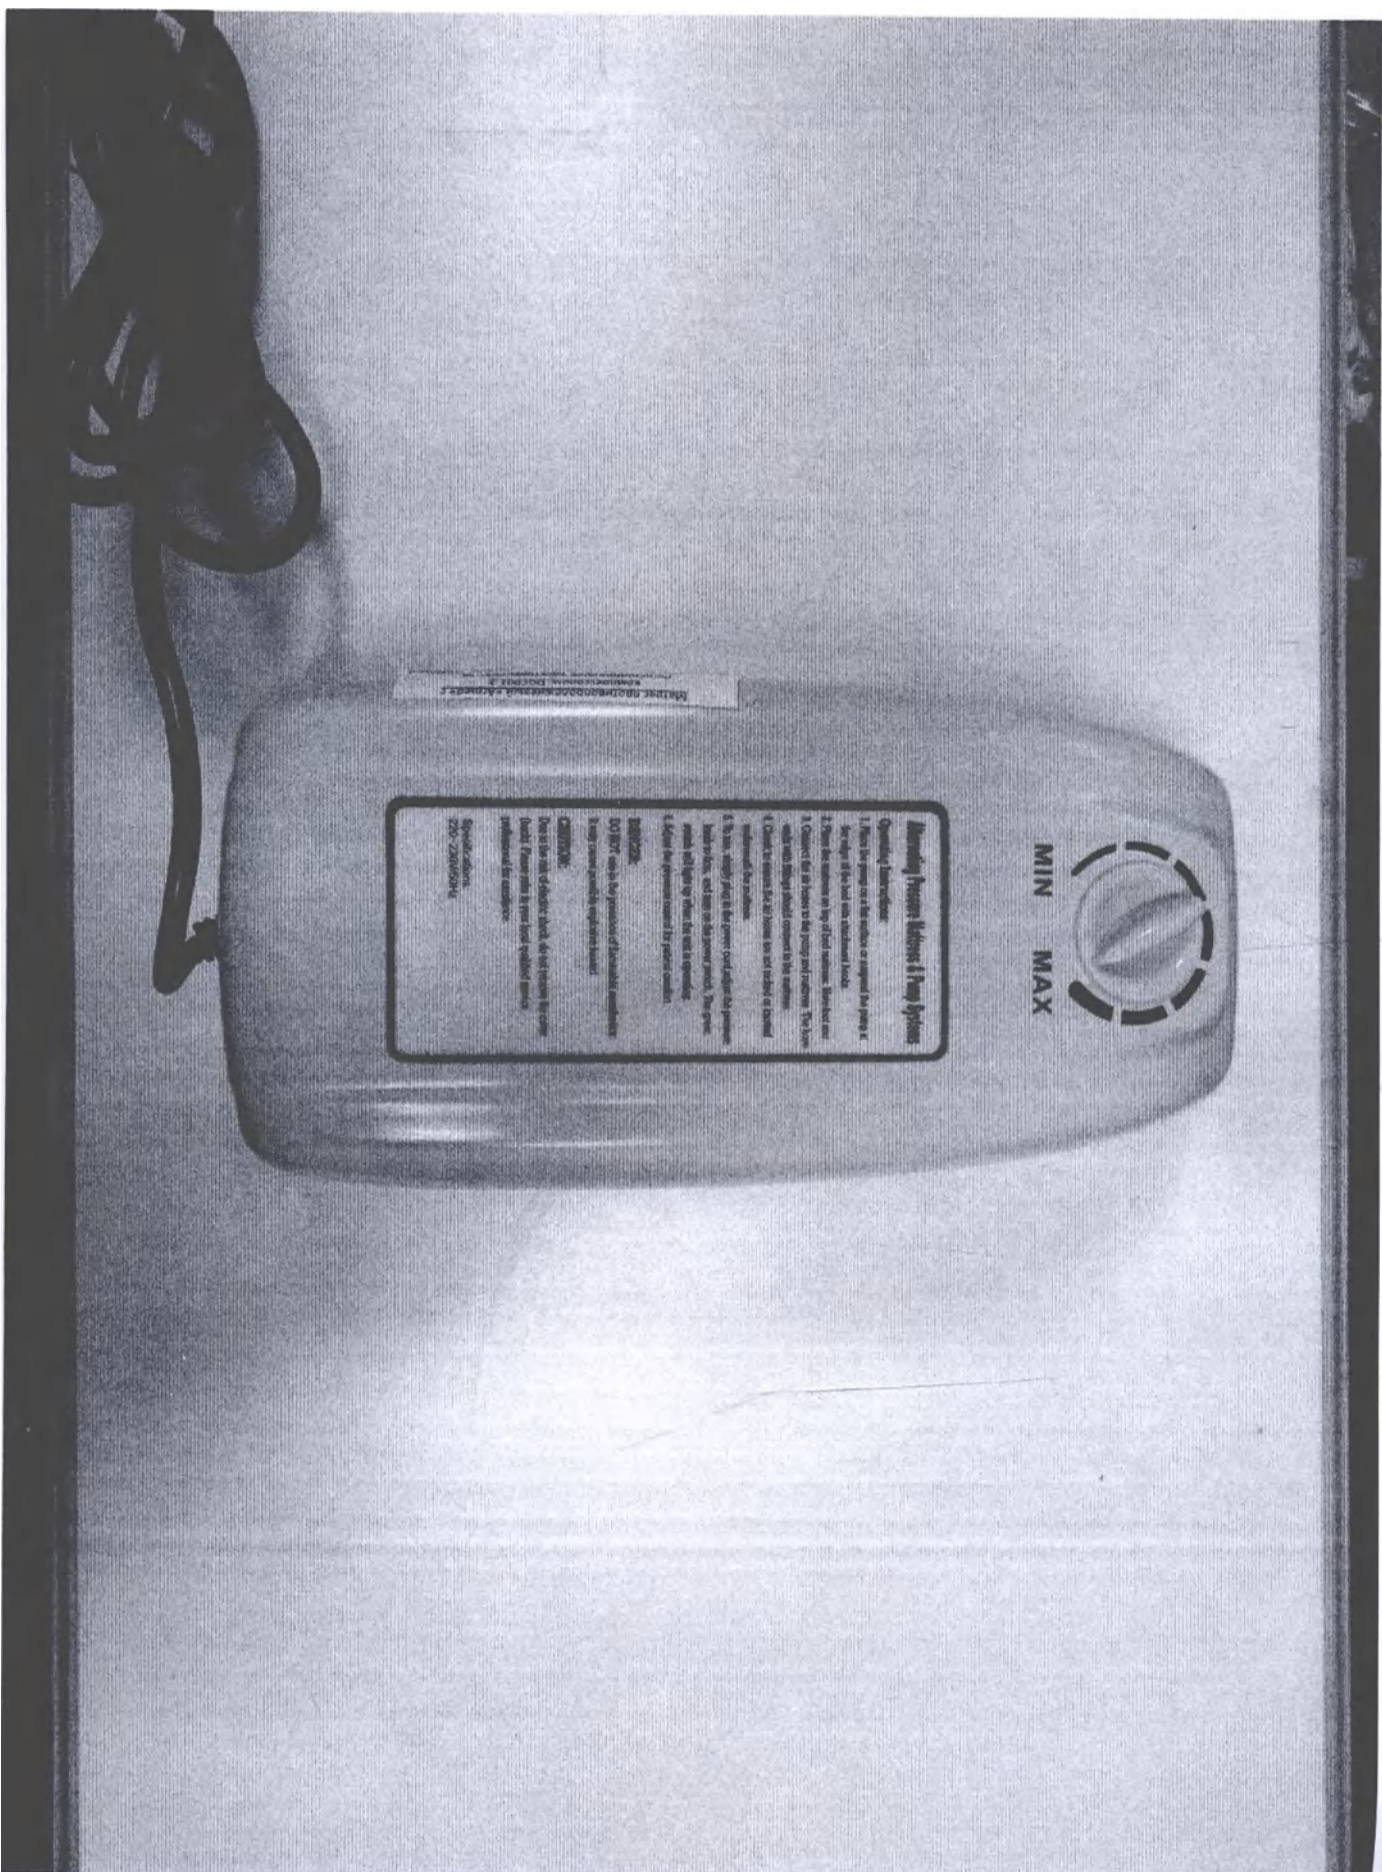

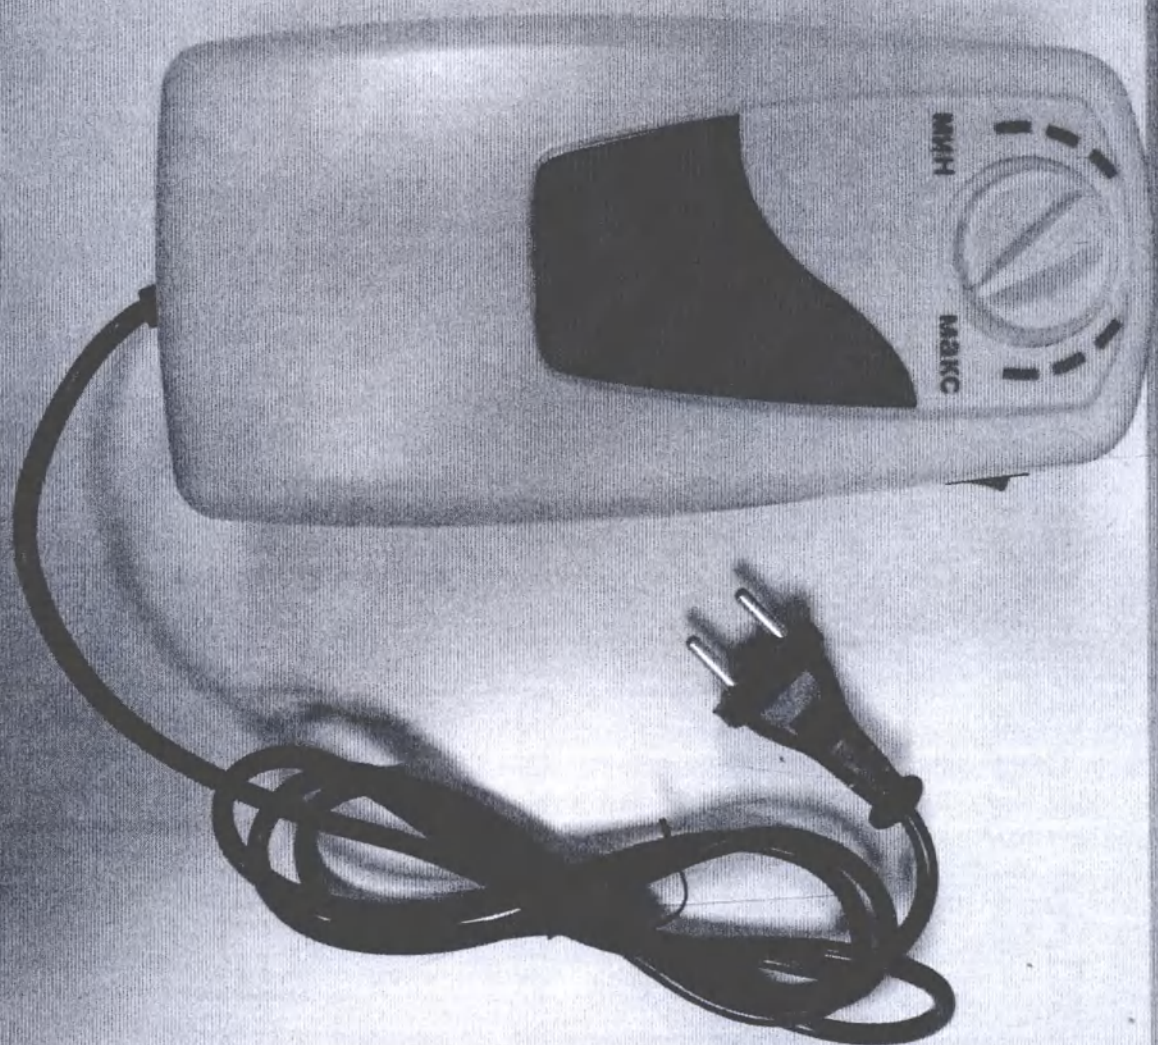

# Матрас противопрележневый «Armed» с компрессором: DGC001-3

РУ № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_ Г.

**Произведено:** Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd., No.17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

(«Джиангсу Денгуан Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд.», № 17, Данфенг Вест Роуд, Джинтан Сити, Джиангсу Провинс, 213200, Китай)

**Импортер:** ООО «Медимпорт»

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14, оф. 211

**Габаритные размеры:** 1900\*830\*89 мм

**Напряжение, частота** ~220В / 50Гц

**Потребляемая мощность** не более 10ВА

**Дата выпуска:**

IP20



Матрас  
противопролежневый  
«Armed» с компрессором:  
**DGC001-3**



Производитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.  
No. 17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China  
(«Джянгу Денгуан Медикал Тримент Инструмент Ко., Лтд.»)  
№ 17, Данфенг Вест Роуд, Джинтан Сити, Джянгу Провинс, 213200, Китай)  
Импортер: ООО «МЕДИМПОРТ», 630091, Новосибирская область, г. Новоси-  
бирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14, офис 211  
РУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года



Матрас  
противопролежневый  
«Armed» с компрессором:

**DGC001-3**



Предназначен для профилактики образования пролежней или их лечения путем циклического перераспределения опорных поверхностей, контактирующих с телом пациента. Используются в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, а также в домашних условиях.

[www.armed.ru](http://www.armed.ru)

РУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года  
Перед применением внимательно изучите Руководство по эксплуатации!

Матрас  
противопролежневый  
«Armed» с компрессором:  
**DGC001-3**



Срок службы: не менее 2 лет.  
Срок гарантии: 12 мес.  
Дата выпуска:

Эффективный трубчатый противопролежневый матрас состоит из воздушных камер в форме баллонов.

Наполнение воздухом осуществляется с помощью компрессора, рассчитанного на непрерывный режим работы.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и внимательно изучить Руководство.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

18  
восьмнадцать  
) листов



Генеральный директор  
ООО «МЕДИМПОРТ»  
Леонтьев А.М