

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»
В.С. Андреев
_____ 2020 г

The stamp is a blue circular seal. The outer ring contains the text "ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ" at the top and "МОСКВА" at the bottom. The inner part of the seal features the company name "ВИНАР" in large letters, with "ООО «Научно-производственная фирма «ВИНАР»" written around it. There is a signature across the seal and the text "company" and "tech and production" are visible at the bottom.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы химические многорежимные одноразовые паровой стерилизации ИНТЕСТ-ПФ-НЗ

ТУ 9398-049-11764404-2005

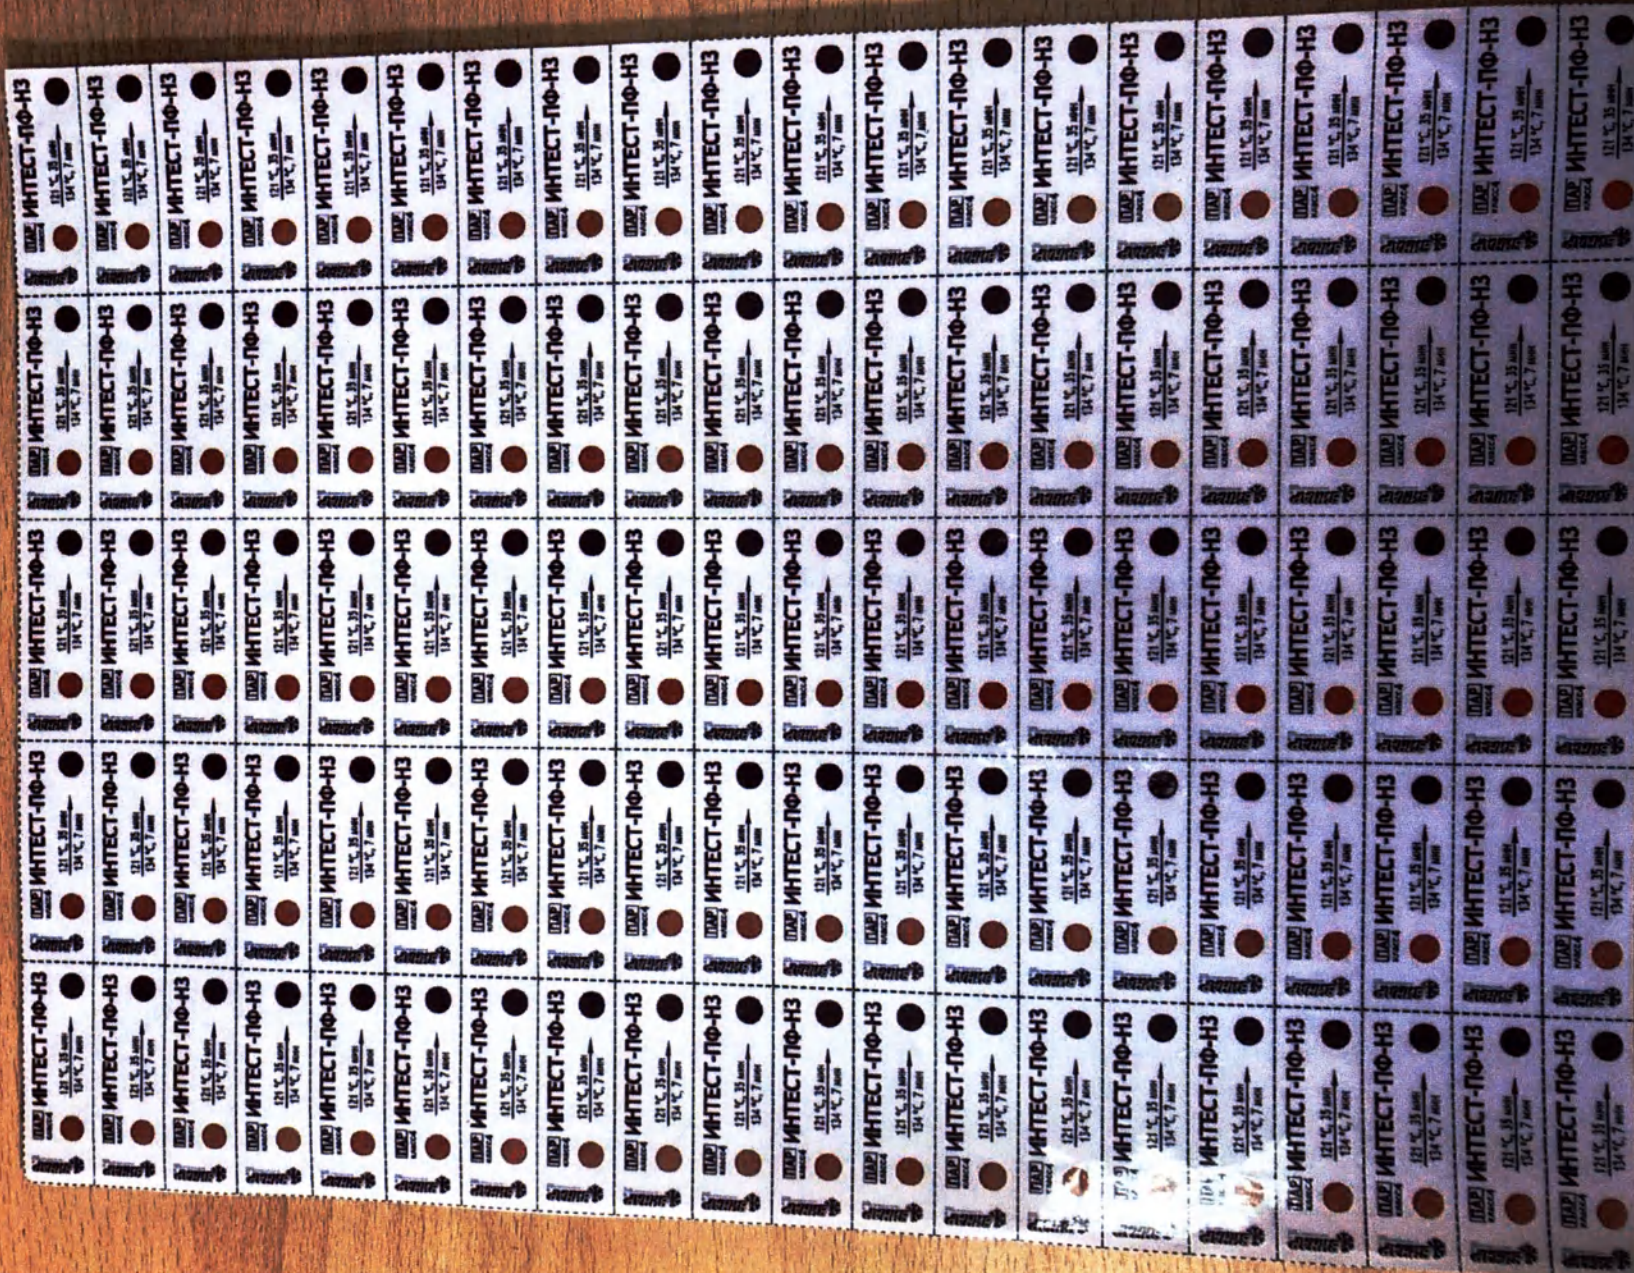

Индикаторы химические многорежимные одноразовые паровой стерилизации ИНТЕСТ-ПФ-НЗ



Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ МНОГОРЕЖИМНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНТЕСТ-ПФ-НЗ

кол-во: 100 шт.

ТУ 9398-049-11764404-2005

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ФСР 2010/07412 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

7086020

ФЕВ 2020





Промышленность. Общество с ограниченной ответственностью
 «Научно-производственная фирма «ВИАР» (ООО «ВИАР»)
 105094, Россия, Москва, Гостеприимный вал, д.3, стр. 7А, пом. VIII;
 тел./факс: +7(495) 988-7657, www.viarn.ru
 для писем: 105094, Россия, Москва, в/я 36, e-mail: viarn@viarn.ru



ПАРТИЯ	7086020
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	фев 2020
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +30 °С;
- минимальная температура минус 30 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упаковке в/я, обеспечивая попадание прямого солнечного луча, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ МНОГОРЕЖИМНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАРОВОЙ
 СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНТЕСТ-ПФ-НЗ

КОЛ-ВО: 100 ШТ.

TU 9398-049-11764404-2005

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ФСР 2010/07412 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
 ФИРМА

Всего прошнуровано и скреплено
печатью



4 лист а

Генеральный директор
ООО «НПО «ВИНАР»

В.С. Андреев