





Фотографии медицинского изделия
«Система медицинская переносная для
регистрации и работы с цифровыми
медицинскими изображениями
в лучевой диагностике «ДИАРМ-МТ-М»,
производства АО «МТЛ», Россия

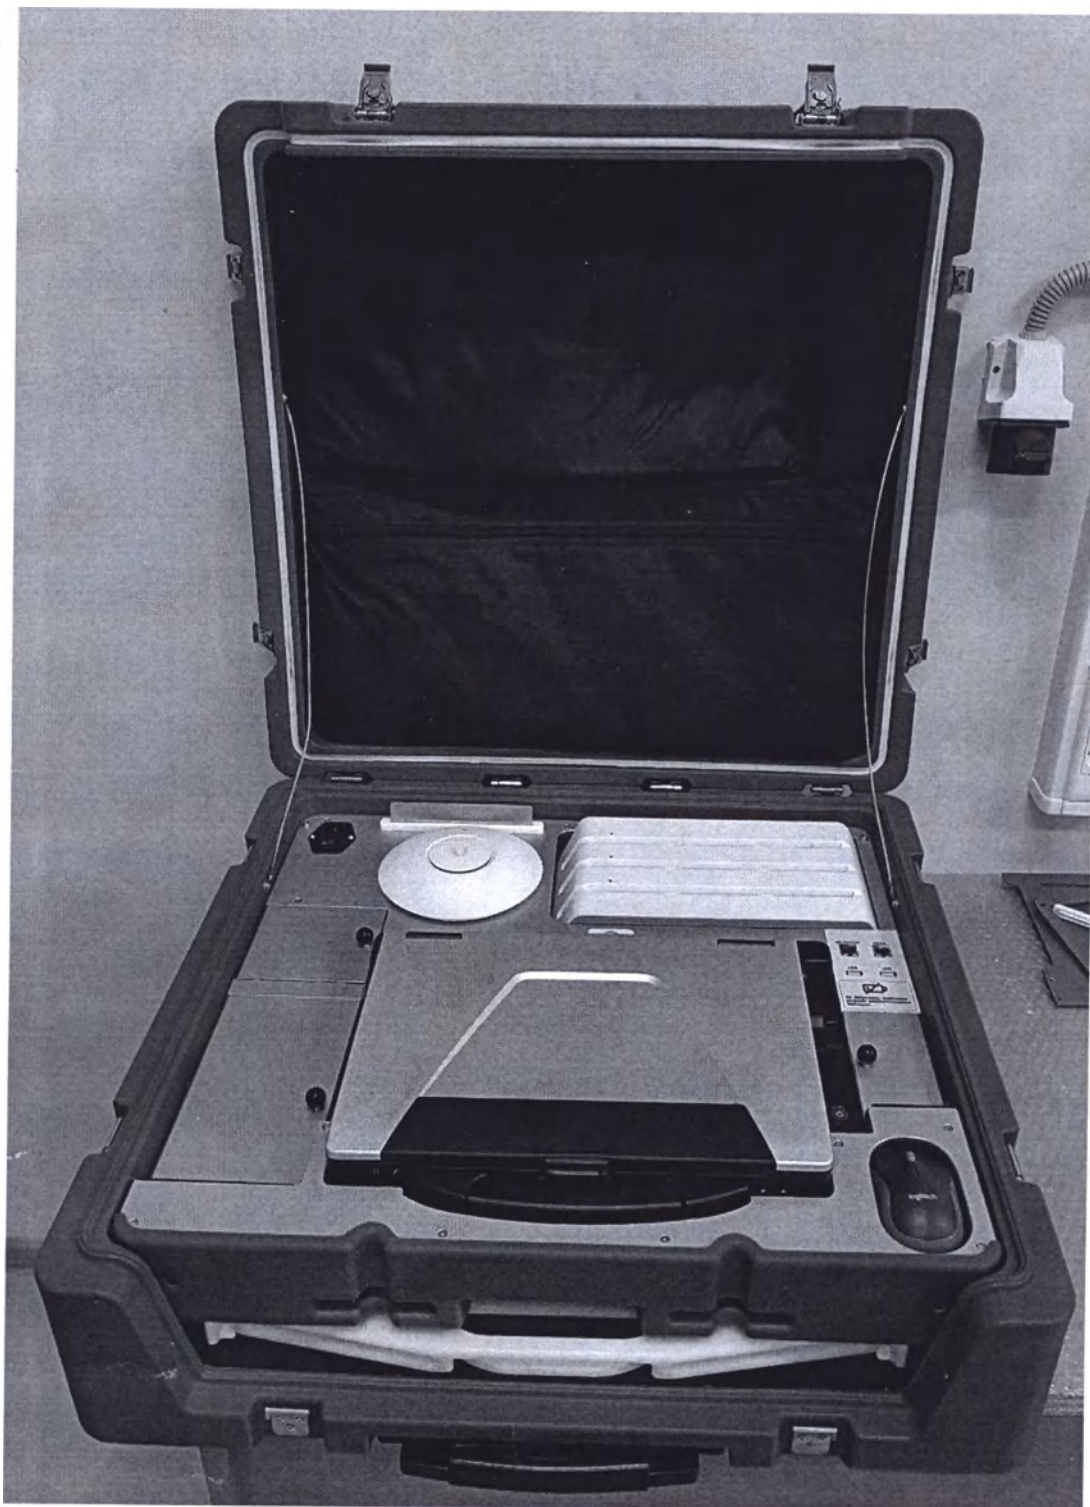


Система медицинская переносная для регистрации и работы с цифровыми медицинскими изображениями в лучевой диагностике «ДИАРМ-МТ-М» исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-1 или исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-2 в кейсе КЖЛЯ.029.113.1.026.00 производства АО «МТЛ», Россия

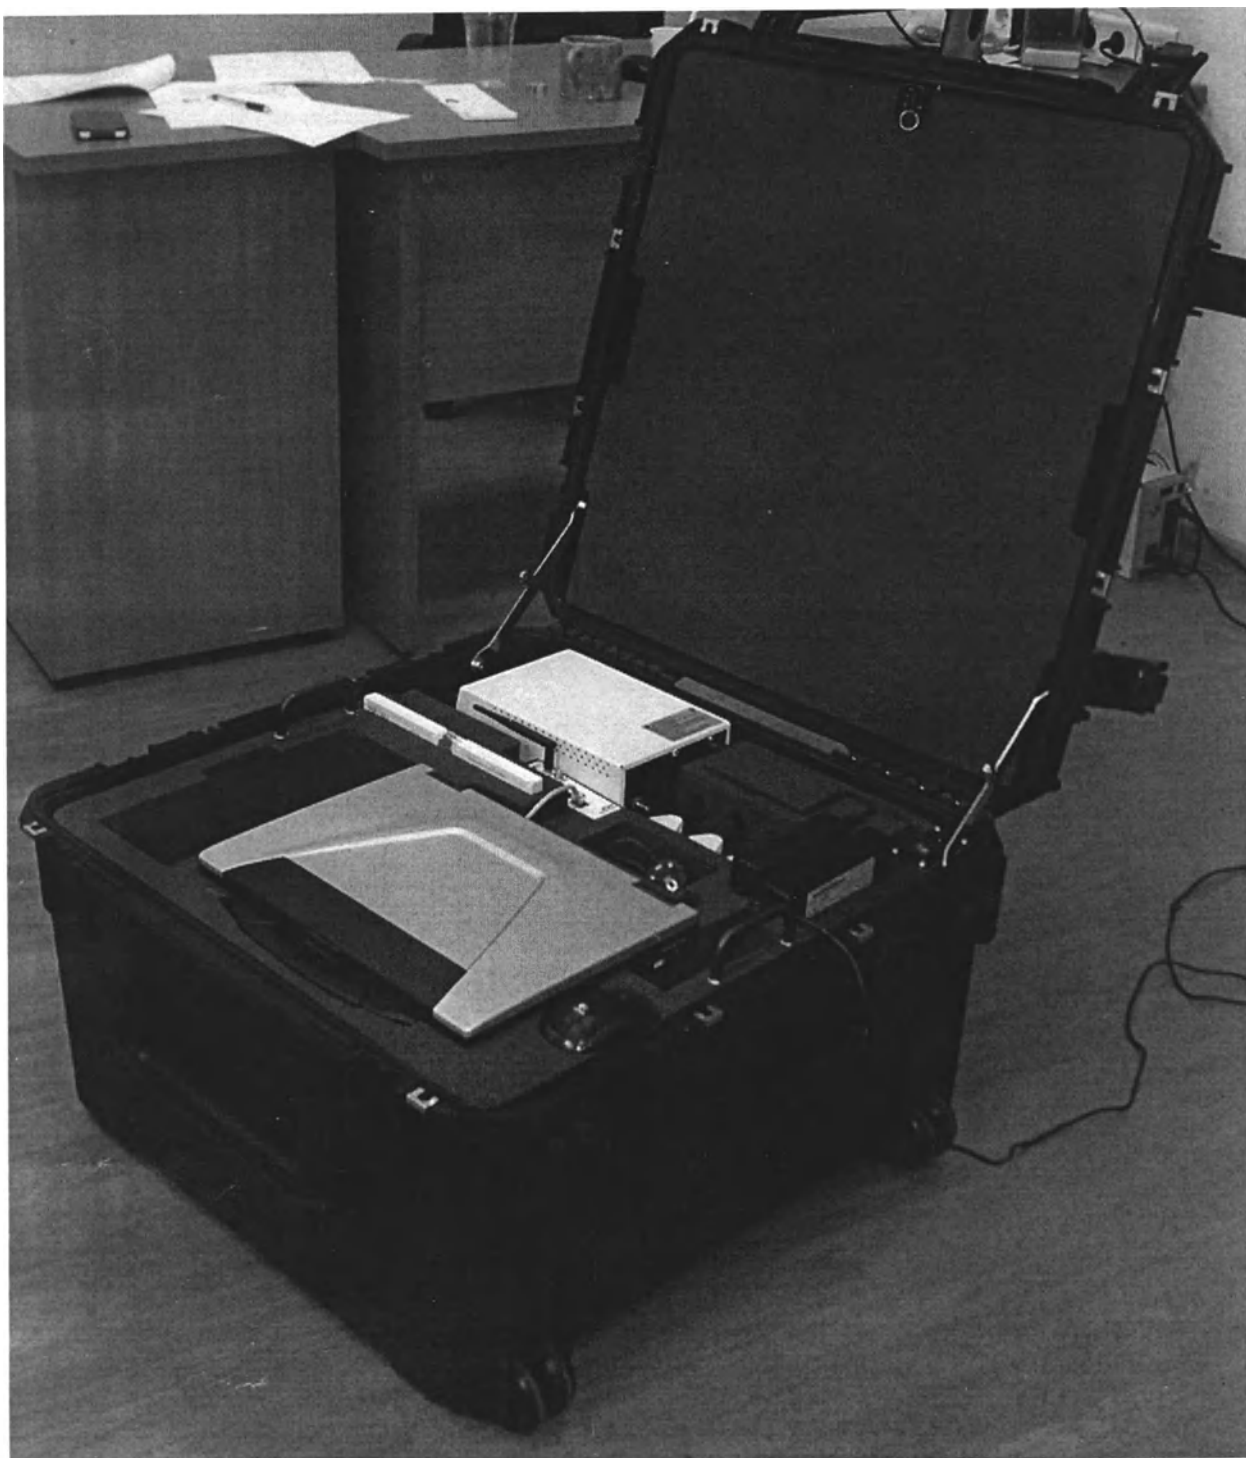


Система медицинская переносная для регистрации и работы с цифровыми медицинскими изображениями в лучевой диагностике «ДИАРМ-МТ-М» исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-1 или исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-2 в кейсе К-789-Е производства АО «МТЛ», Россия




Система медицинская переносная для регистрации и работы с цифровыми медицинскими изображениями в лучевой диагностике «ДИАРМ-МТ-М» исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-1 или исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-2 в кейсе КЖЛЯ.062.000.1.010.00 производства АО «МТЛ», Россия

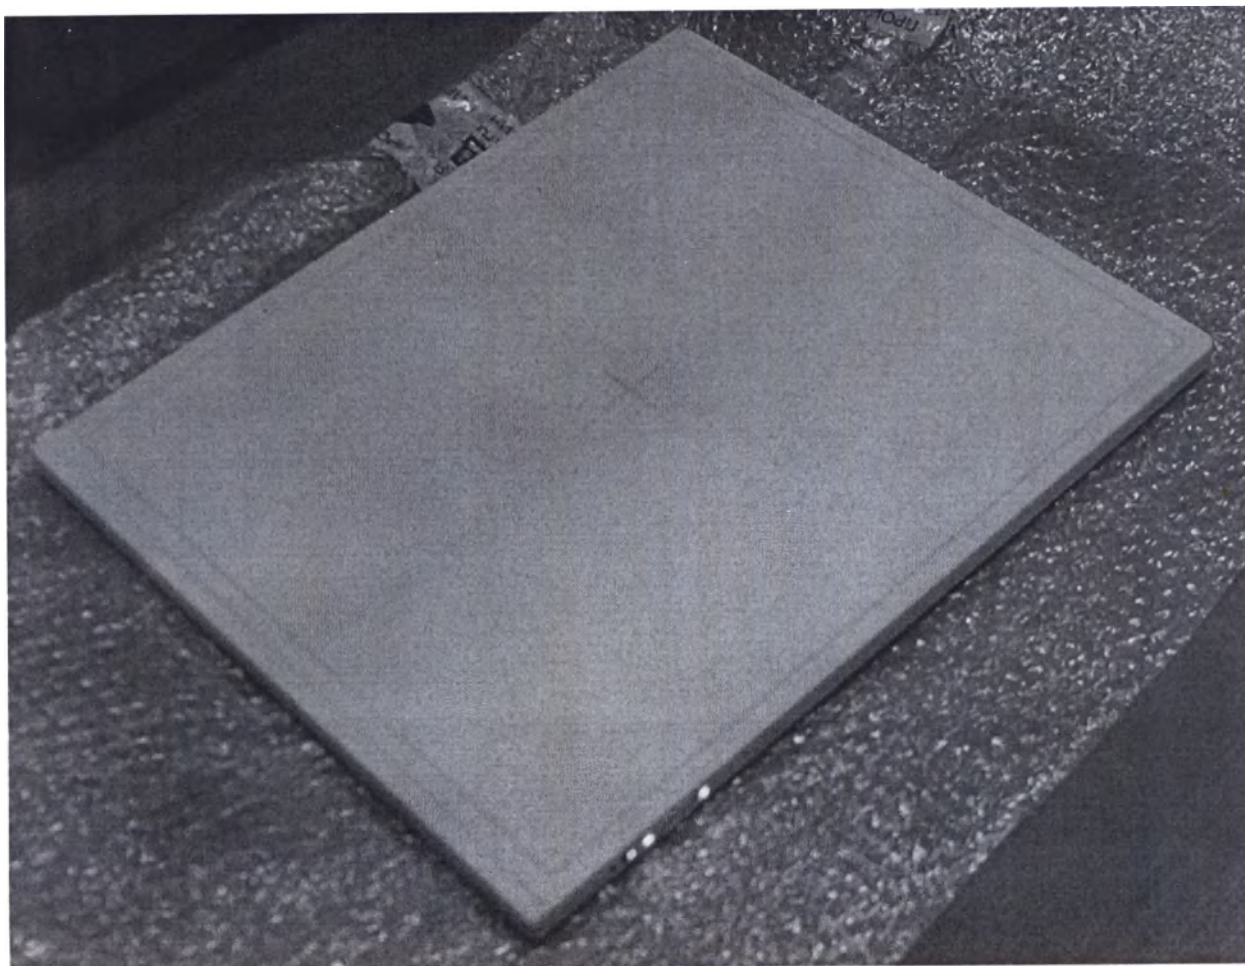


Детектор цифровой плоскопанельный
рентгеновский в выносном исполнении Pixium
2430EZ или Pixium 3543EZ
производства THALES ELECTRON DEVICES,
Франция
на фото представлен детектор Pixium 3543EZ

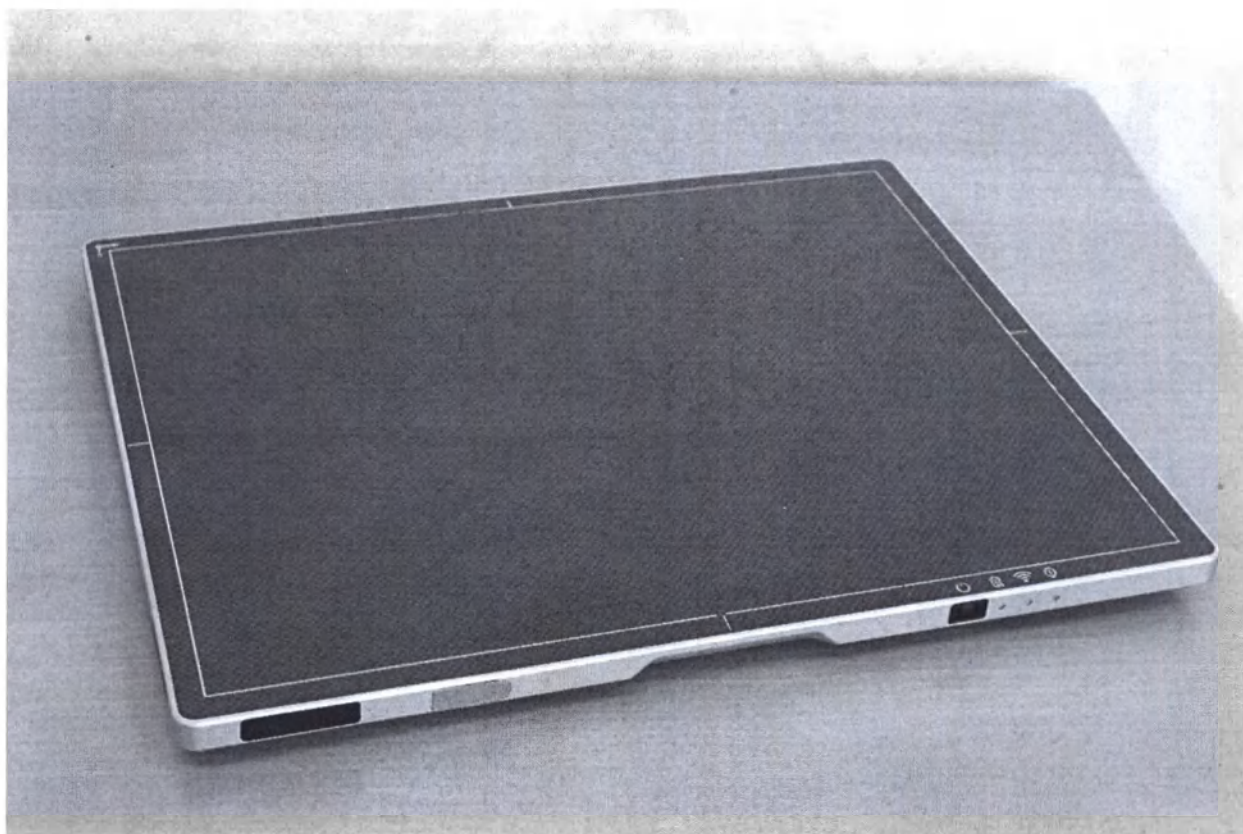

Детектор плоскпанельный цифровой рентгеновский
«СОЛО ДР-МТ» в беспроводном исполнении, производства
АО «МТЛ», Россия

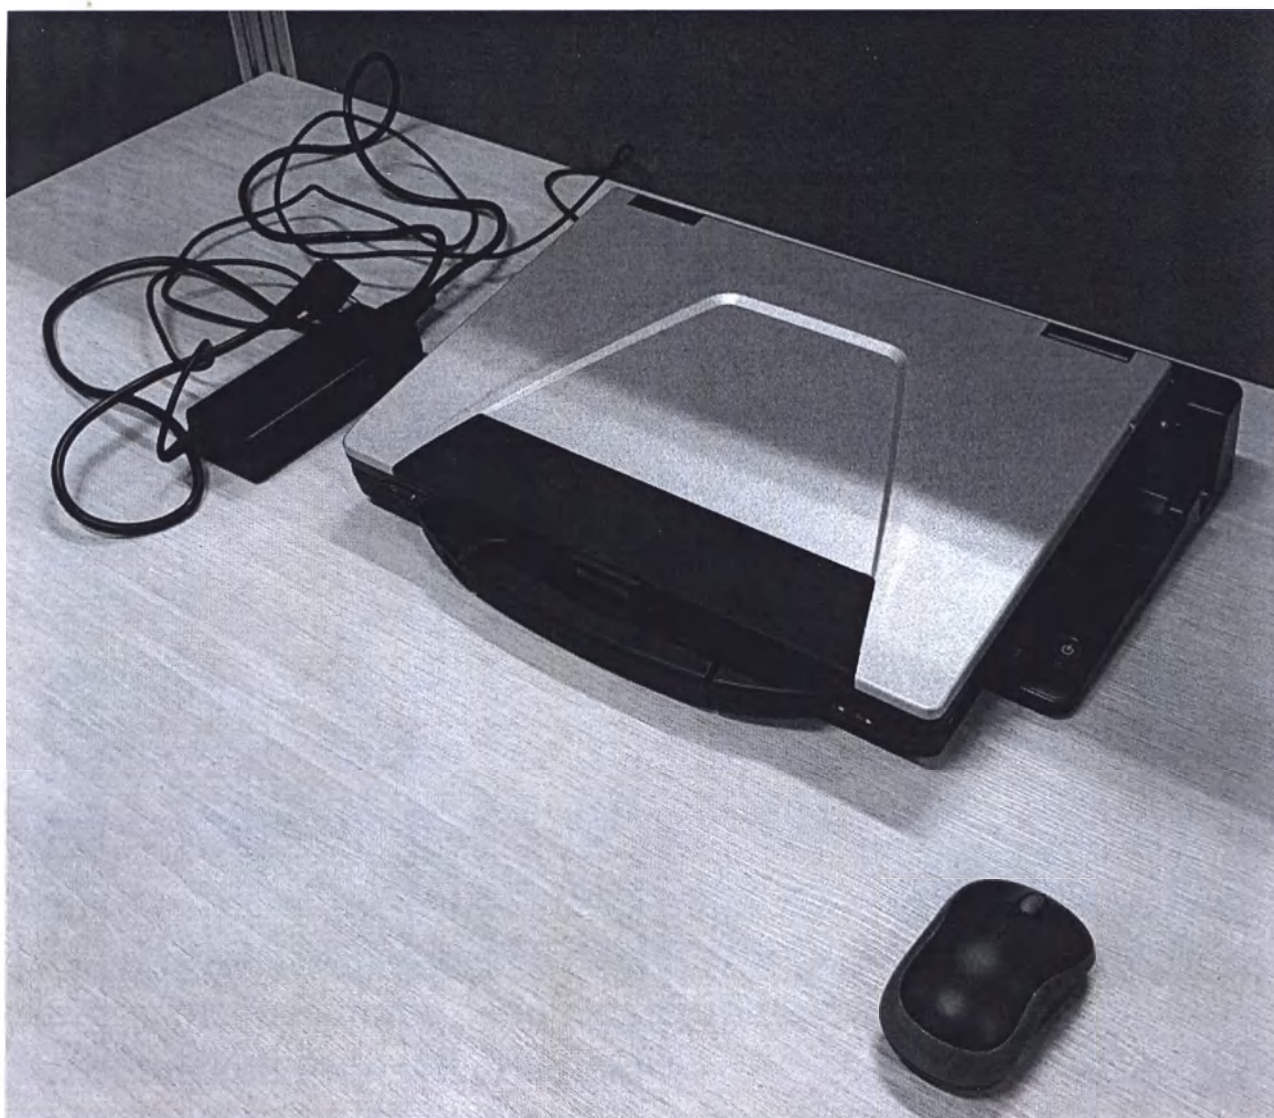


Автоматизированное рабочее место (АРМ) лаборанта с медицинской рабочей станцией МТ КЖЛЯ.029.113.1.001.00, производства АО «МТЛ», Россия

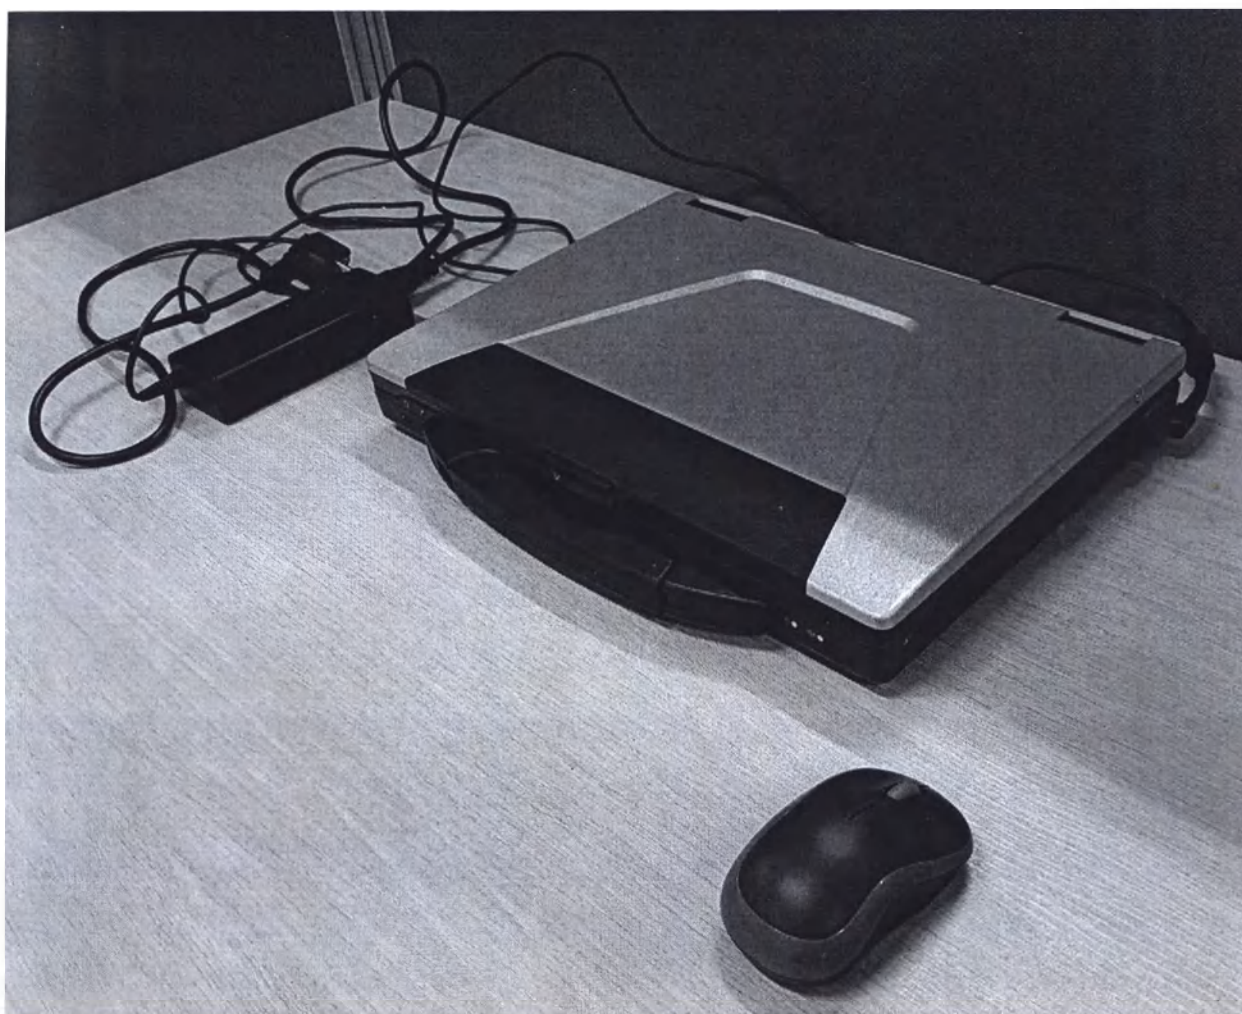

Автоматизированное рабочее место (АРМ) лаборанта с
медицинской рабочей станцией
КЖЛЯ.029.013.10.02.00.000-01, производства АО «МТЛ»,
Россия




Программный пакет «Диспо», производства ООО
«Лаборатория Инноваций МТ», Россия

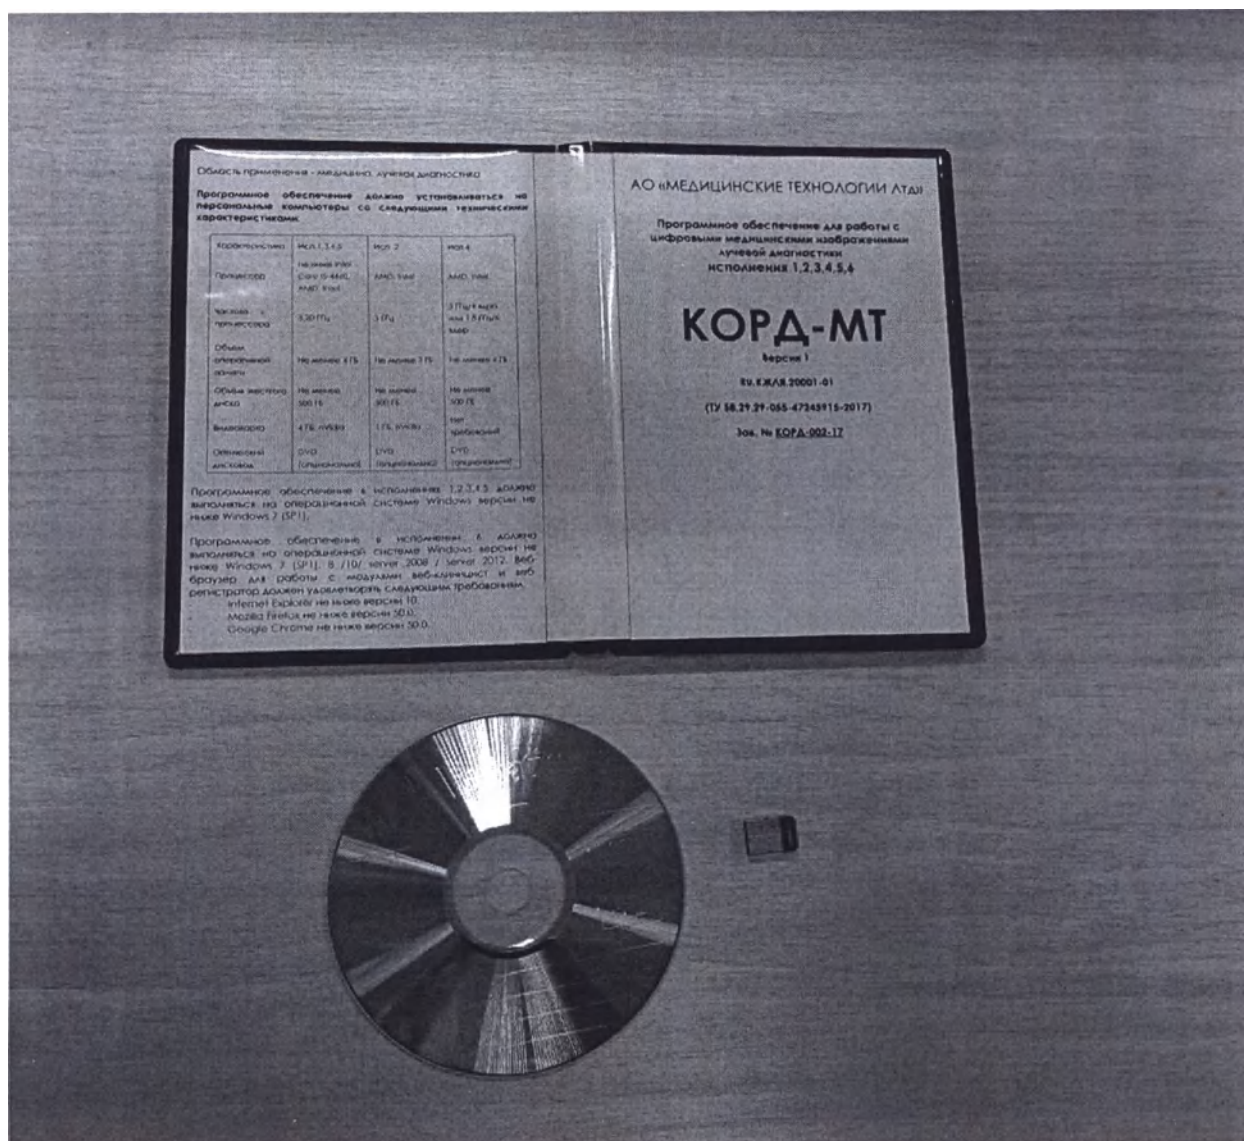

Программное обеспечение для работы с цифровыми медицинскими изображениями лучевой диагностики «КОРД-МТ», производства АО «МТЛ», Россия




Портативный ультразвуковой датчик D8 (комплектуется сменными насадками), производства WuHan Youkey Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай

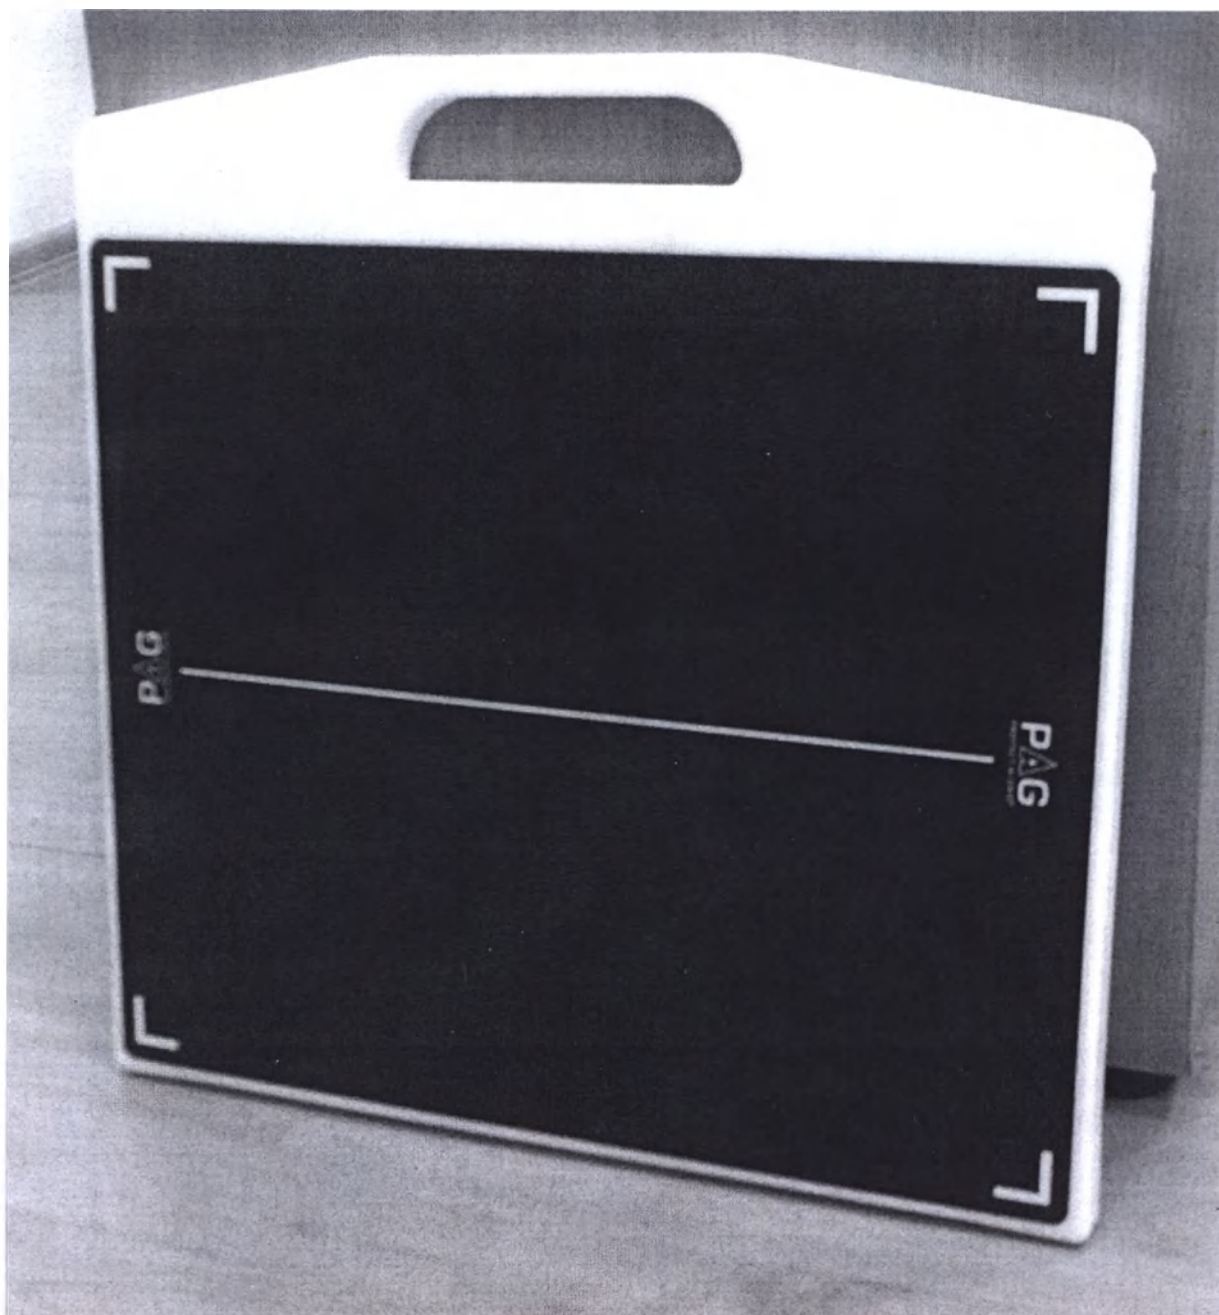

Портативный бокс с растром 24x30 или 35x43 производства Reina Imaging, США или Grid ACS, JPI Healthcare Co. (Jungwon Precision Industries Co., Ltd.), Корея

На фото представлен портативный бокс с растром 35x43 производства Reina Imaging, США

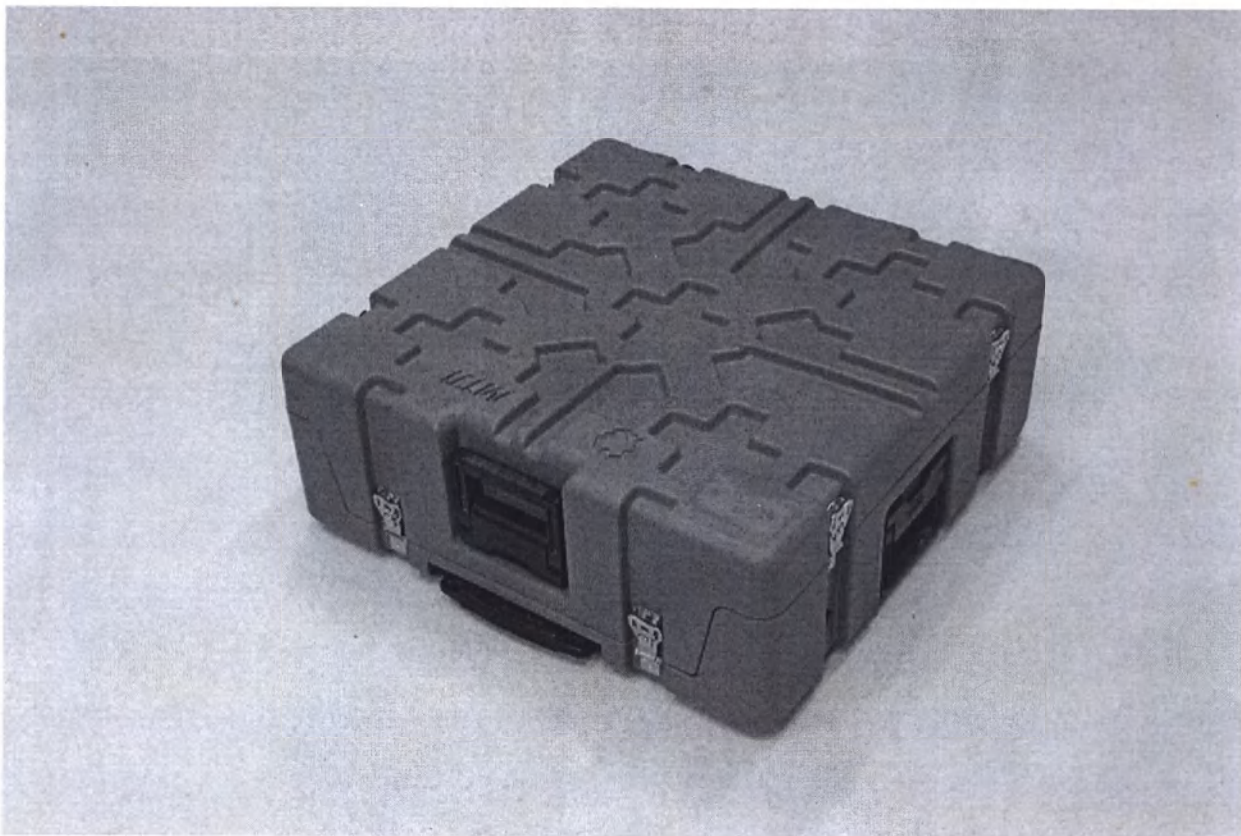


Кейс КЖЛЯ.029.113.1.026.00, производства ООО
«ПрофПак», Россия




Кейс К-789-Е, производства ООО «КОРСАР», Россия



Кейс КЖЛЯ.062.000.1.010.00, производства АО «МТЛ»,
Россия

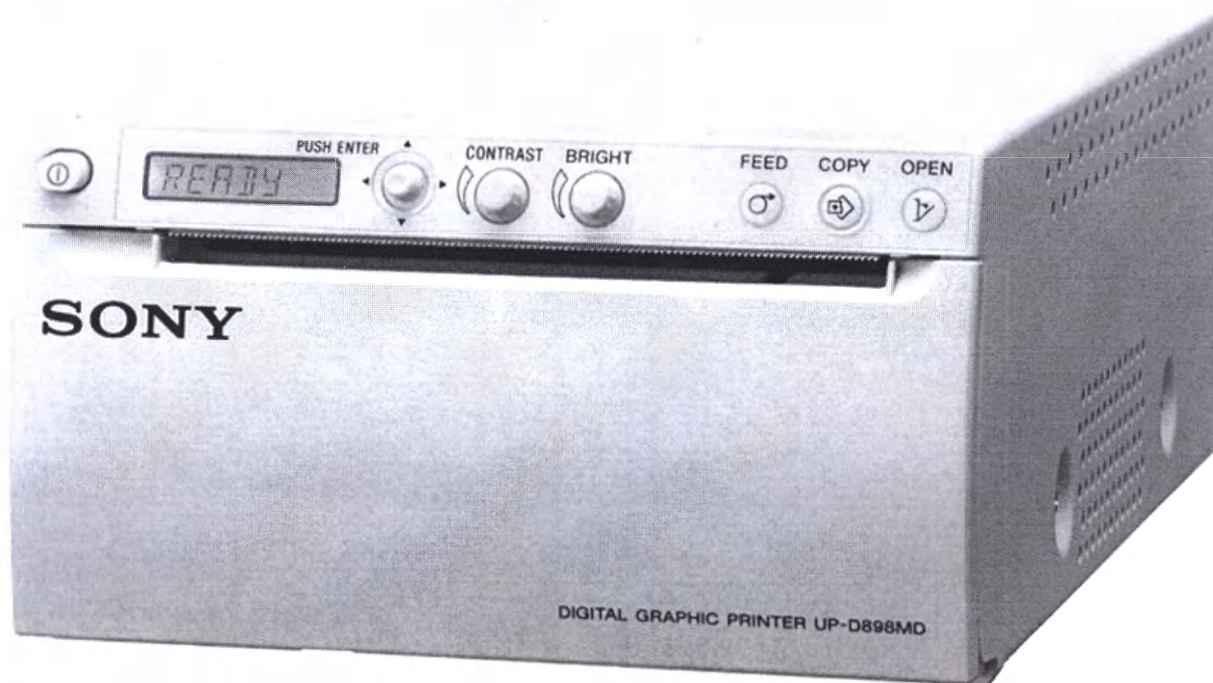

Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-D898MD, производства Sony Corporation, Япония

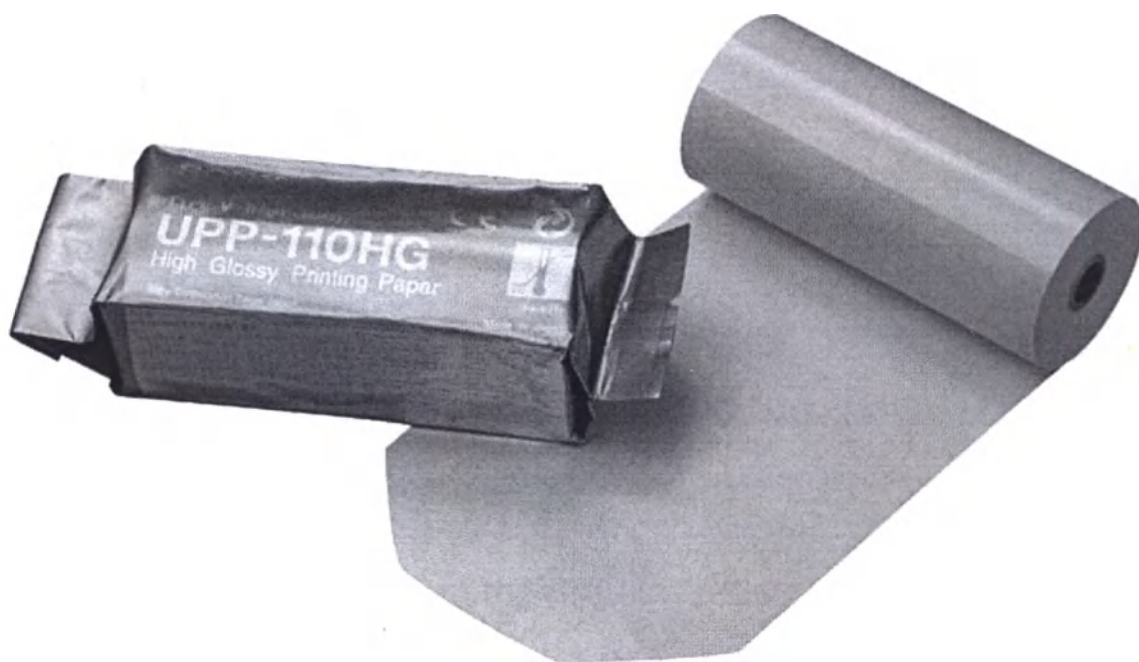

Носитель для печати UPP-110HG, производства Sony Corporation, Япония



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17 листов
Генеральный директор
А.Б. Эйлазов