

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor)): Фасовка 50 тестов. Общий вид

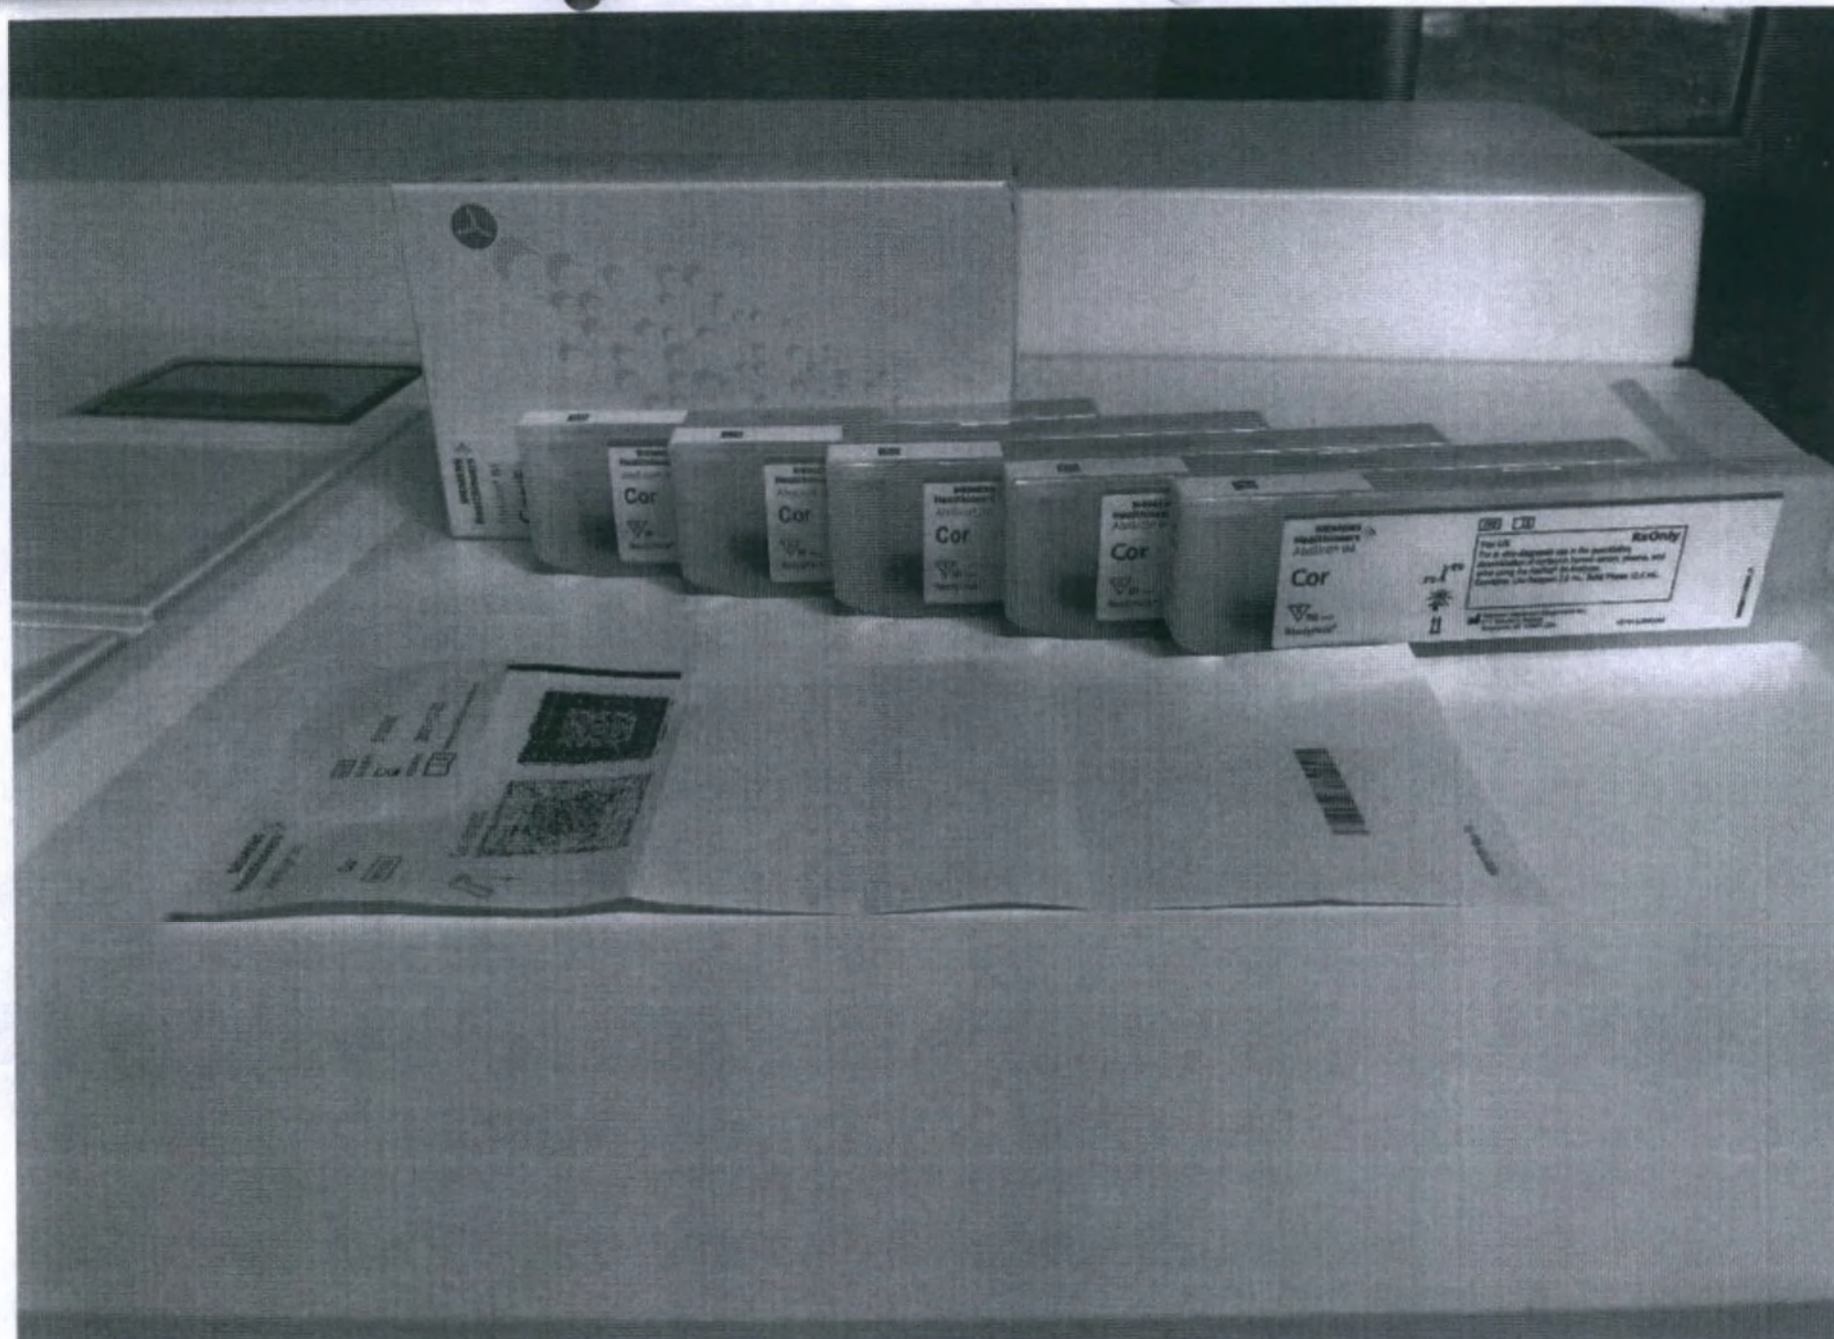


Рисунок 2. Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor)): Фасовка 250 тестов. Общий вид

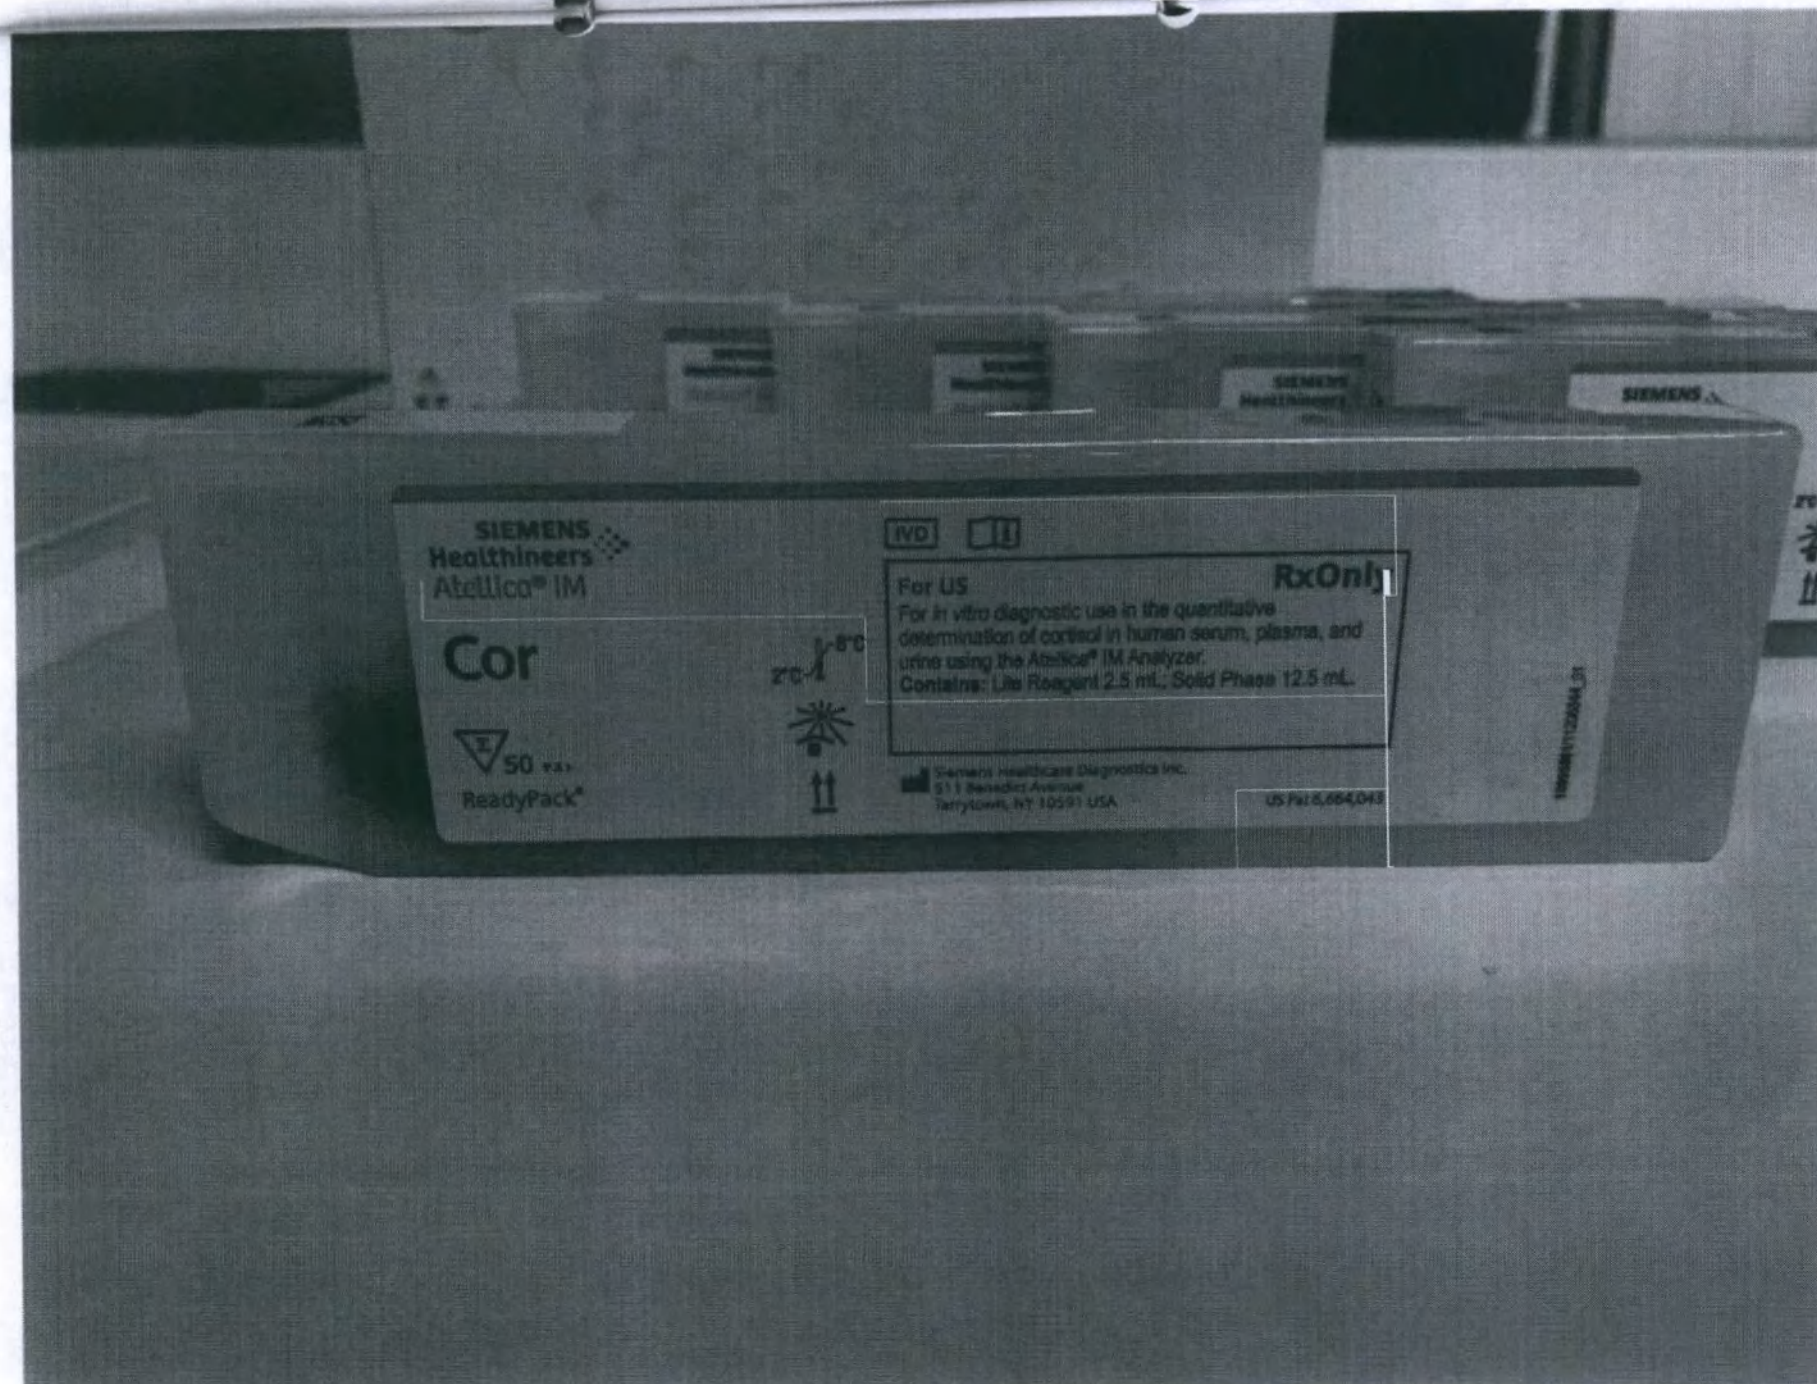


Рисунок 3. Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor)): Основной реагент Atellica IM

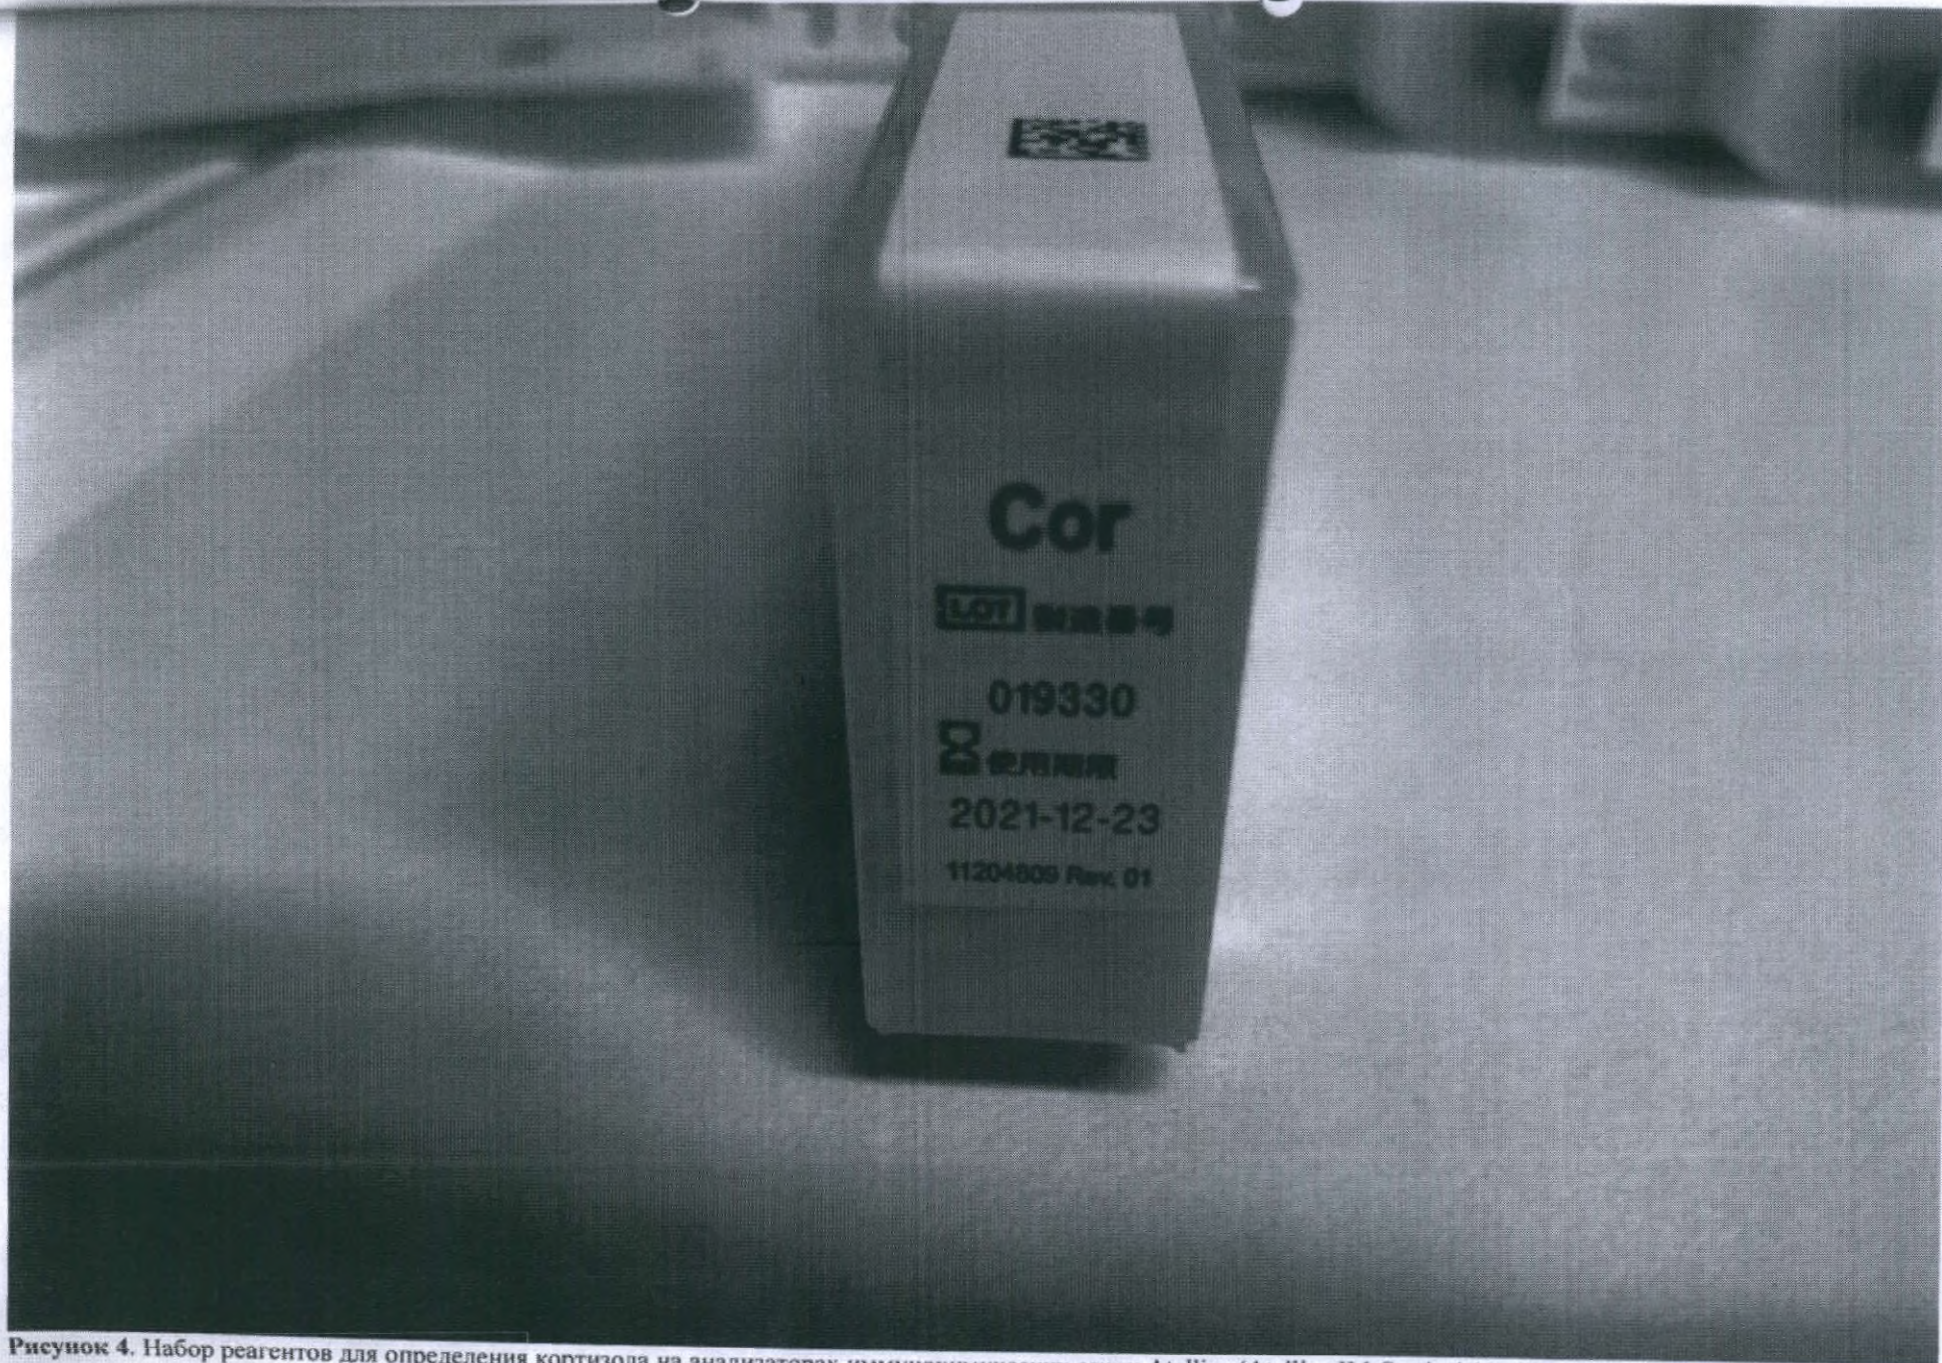


Рисунок 4. Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серий Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor)): Основной реагент Atellica IM Cor

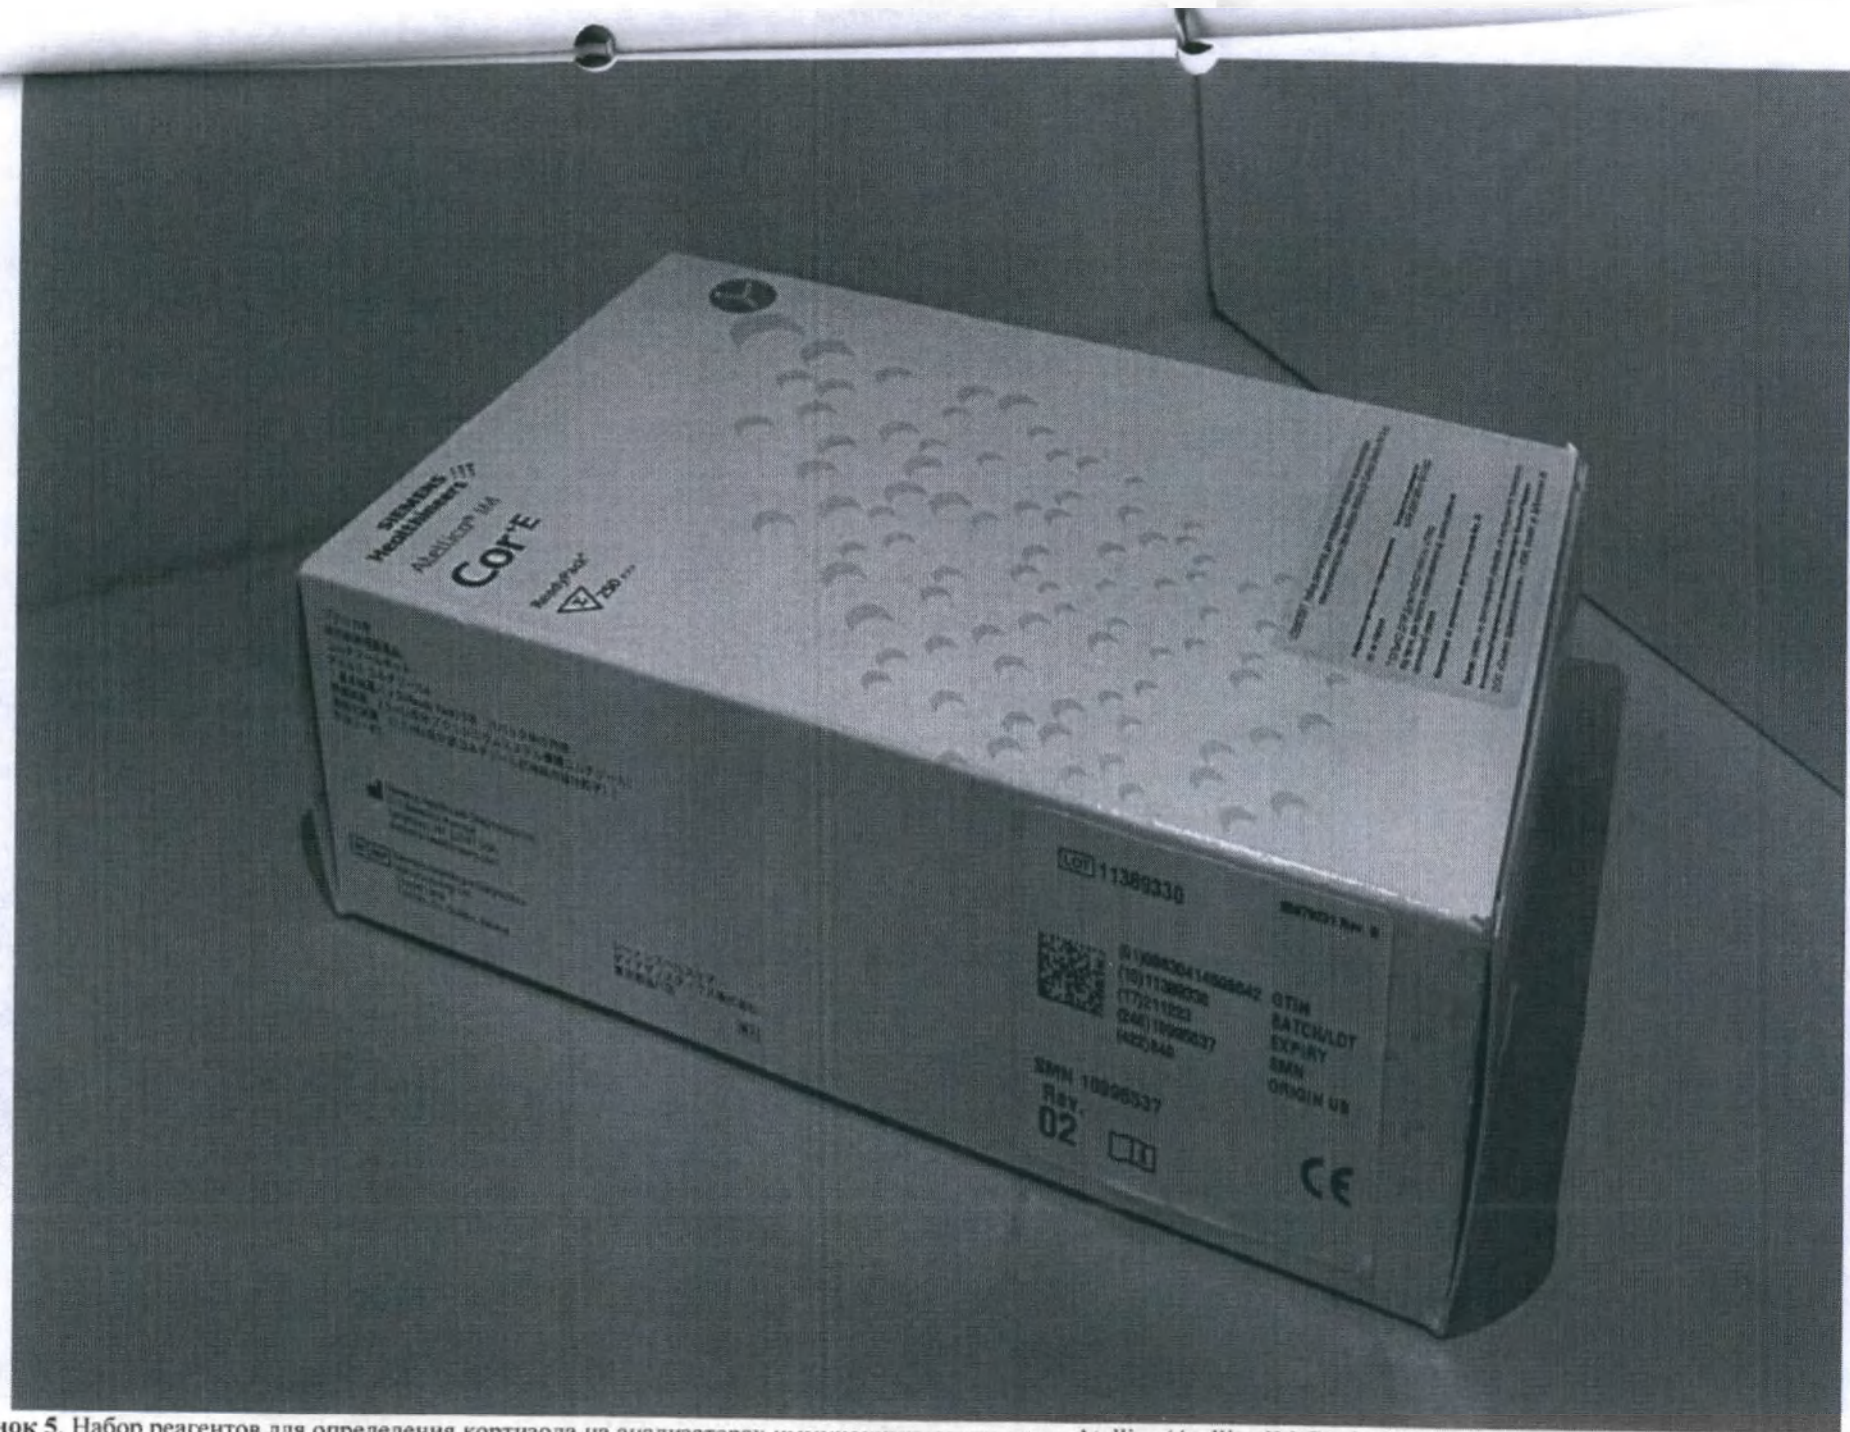


Рисунок 5. Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor)), с русскоязычным стикером

10995537 Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor))

Информация о производителе и стране происхождения
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/12839 от 09.12.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель поставщика на территории Российской Федерации
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 98

Рисунок 6. Русскоязычная маркировка набора реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor))

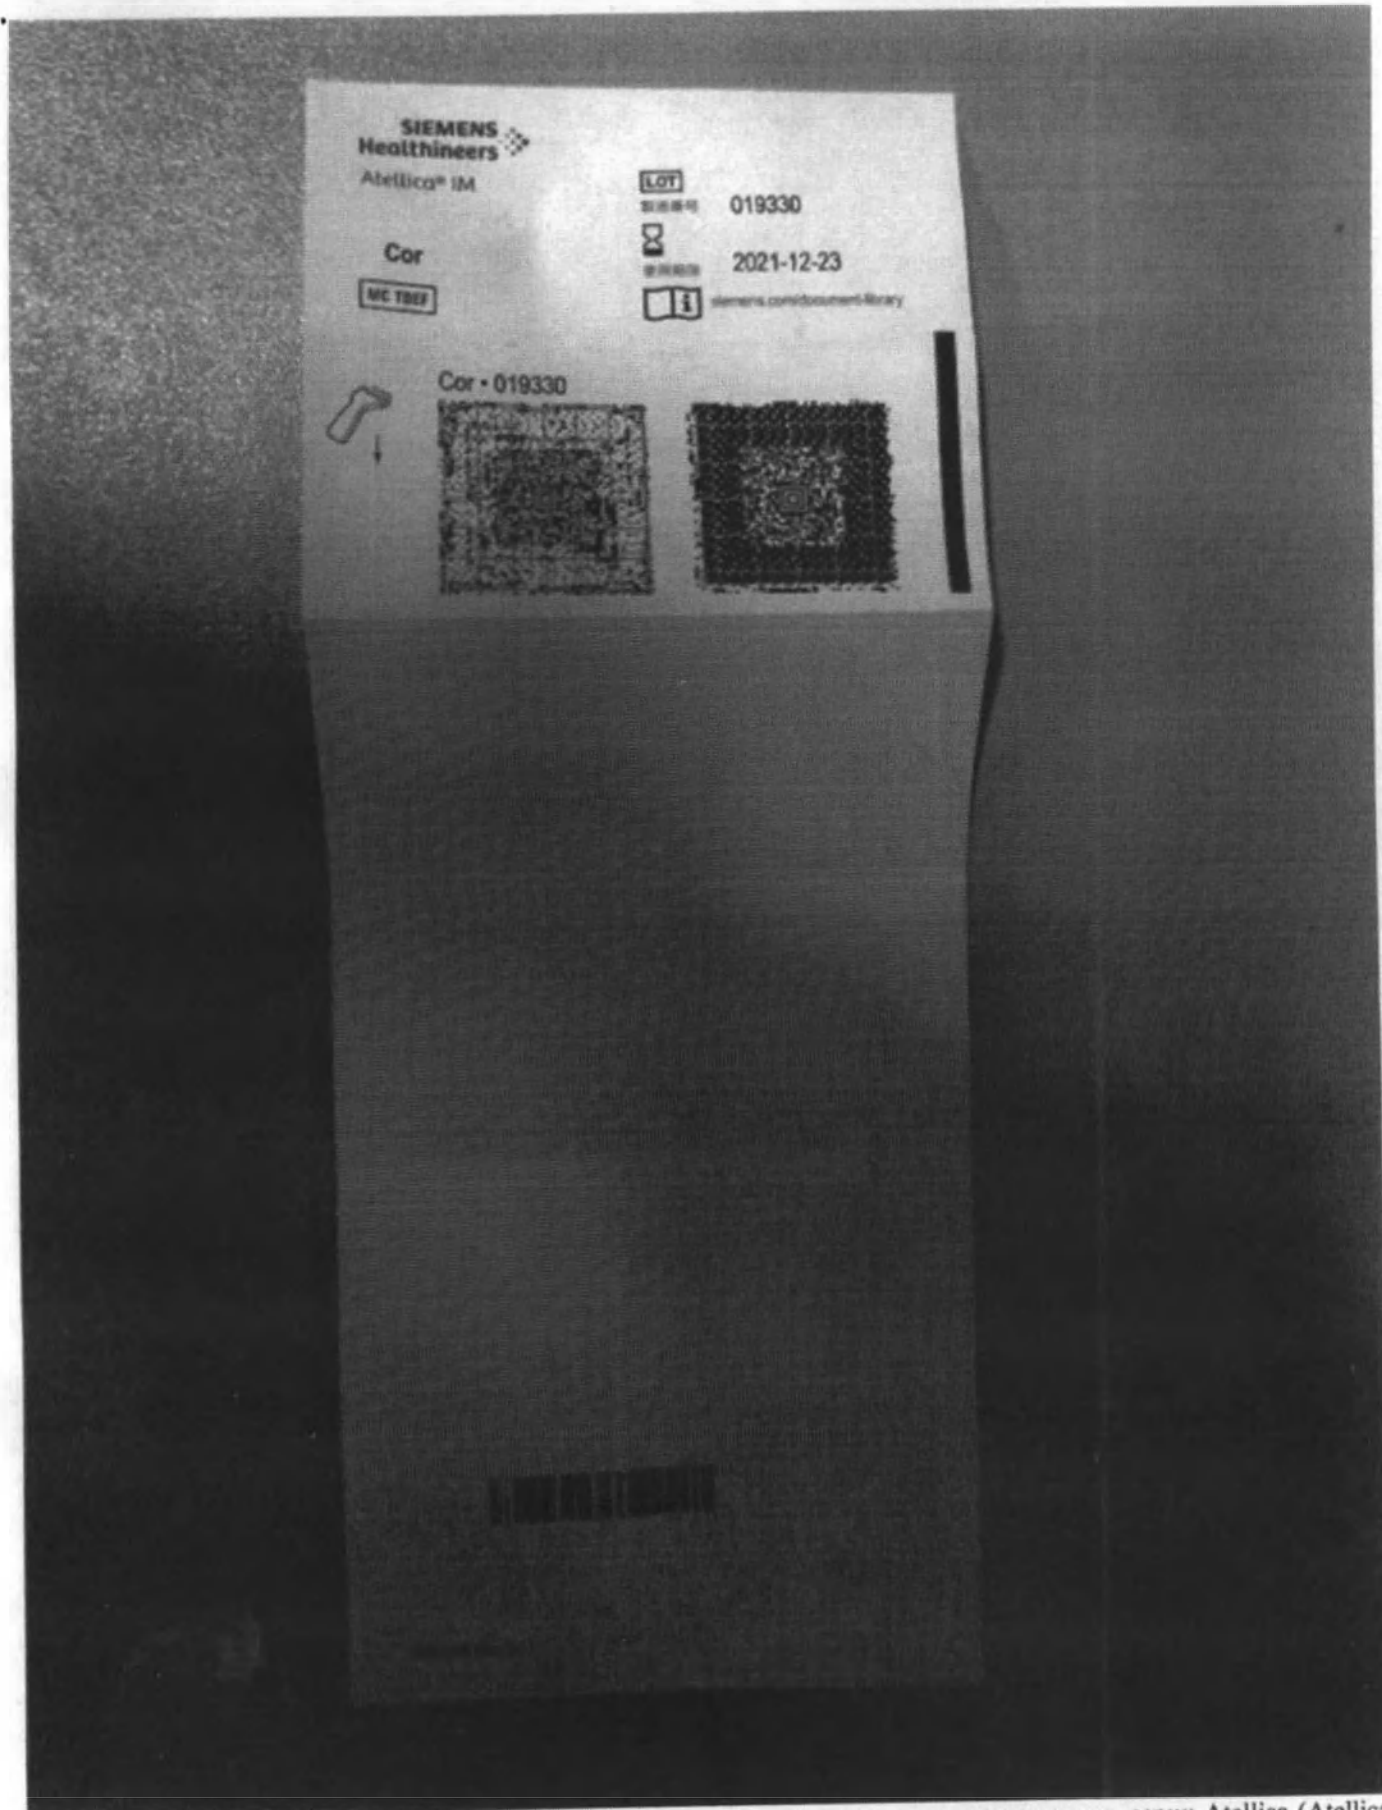


Рисунок 7. Набор реагентов для определения кортизола на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Cortisol (Atellica IM Cor)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM Cor



8

Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

