

Руководитель группы регистрации
ООО «Сиенс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор калибраторов Е для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Calibrator E (Atellica IM CAL E))»**

производства «Сиенс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

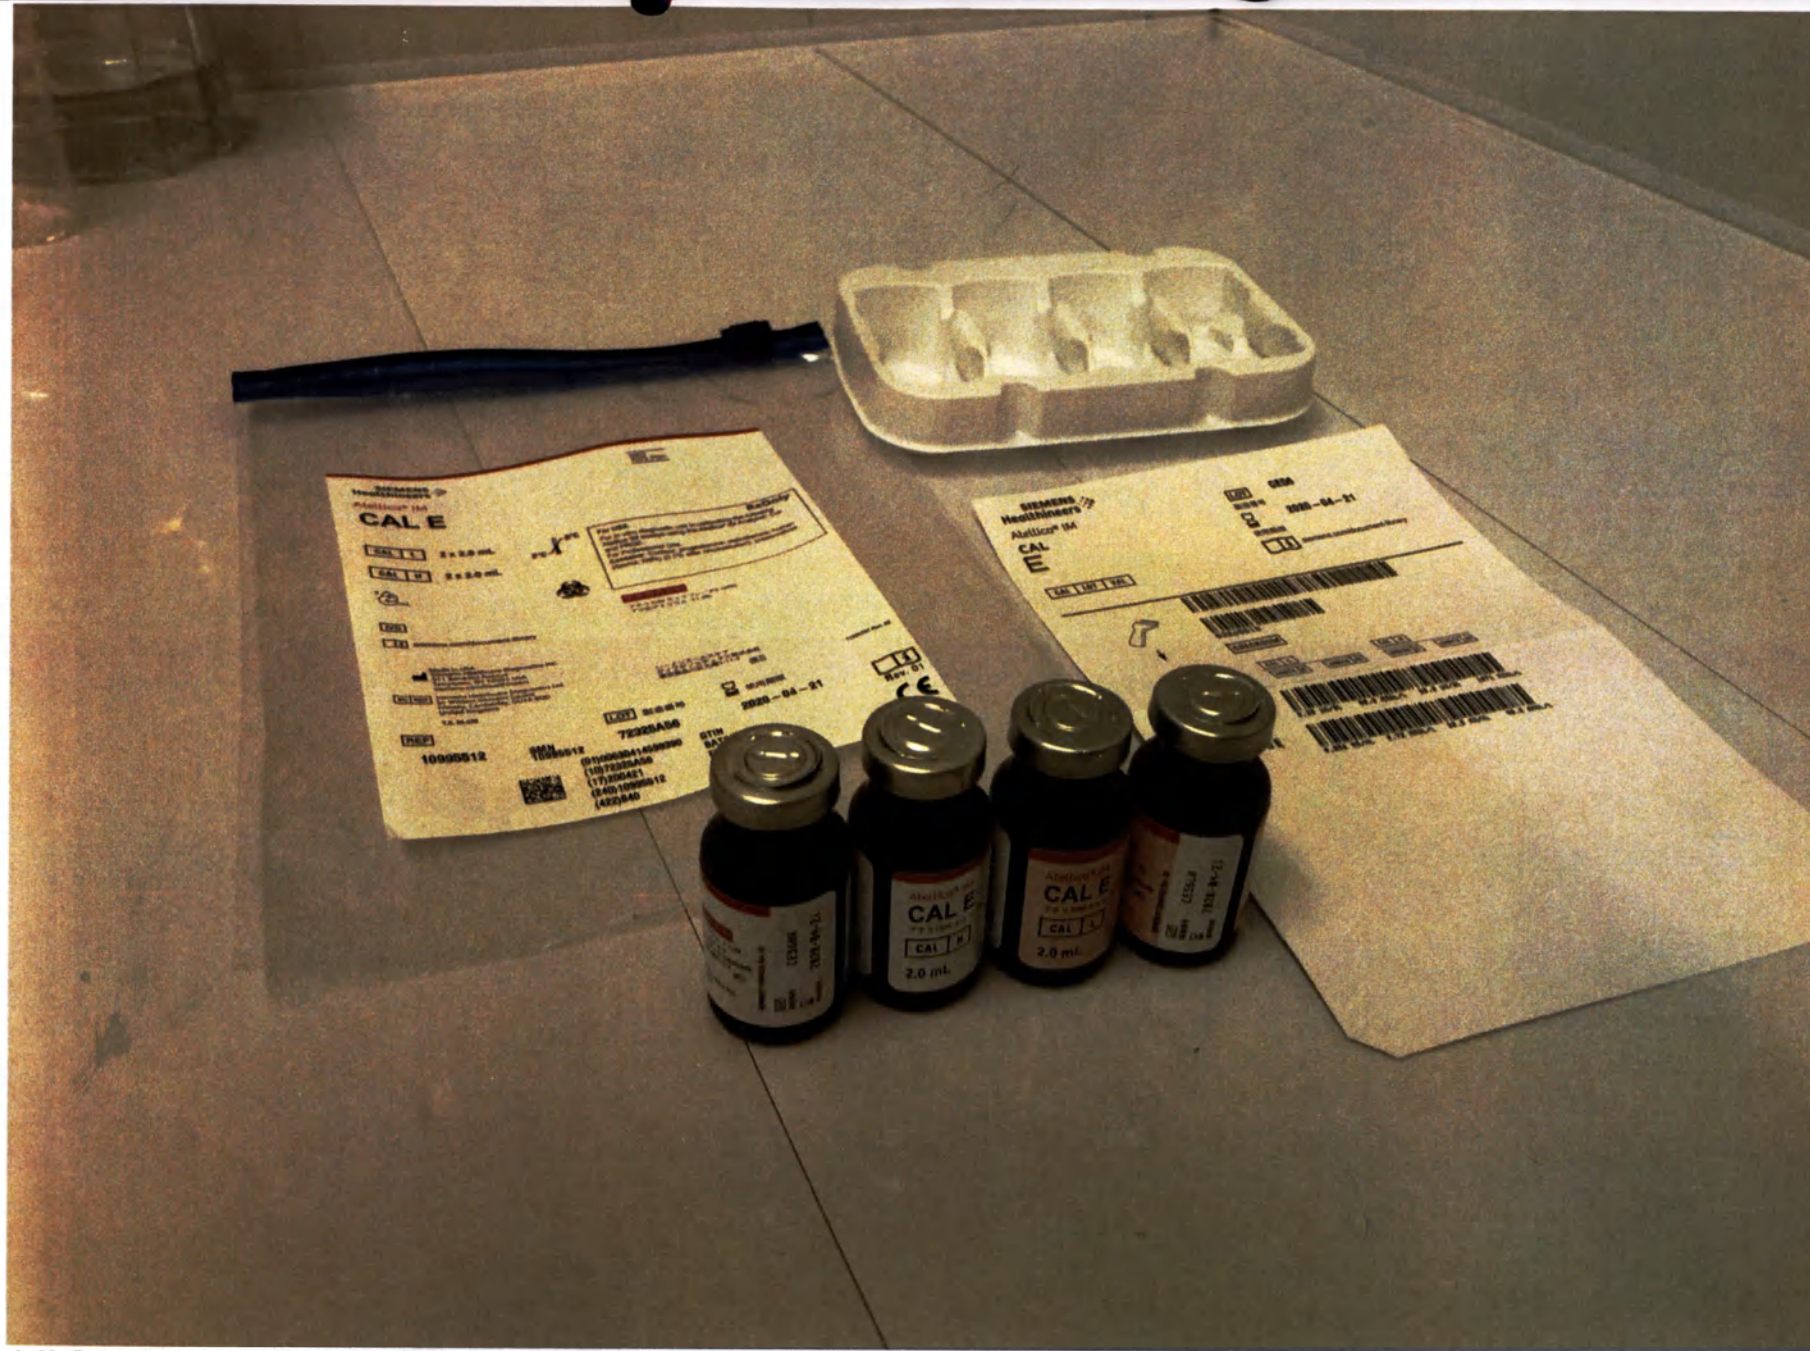


Рисунок 1. Набор калибраторов Е для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator E (Atellica IM CAL E)): Фасовка 2 упаковки. Общий вид

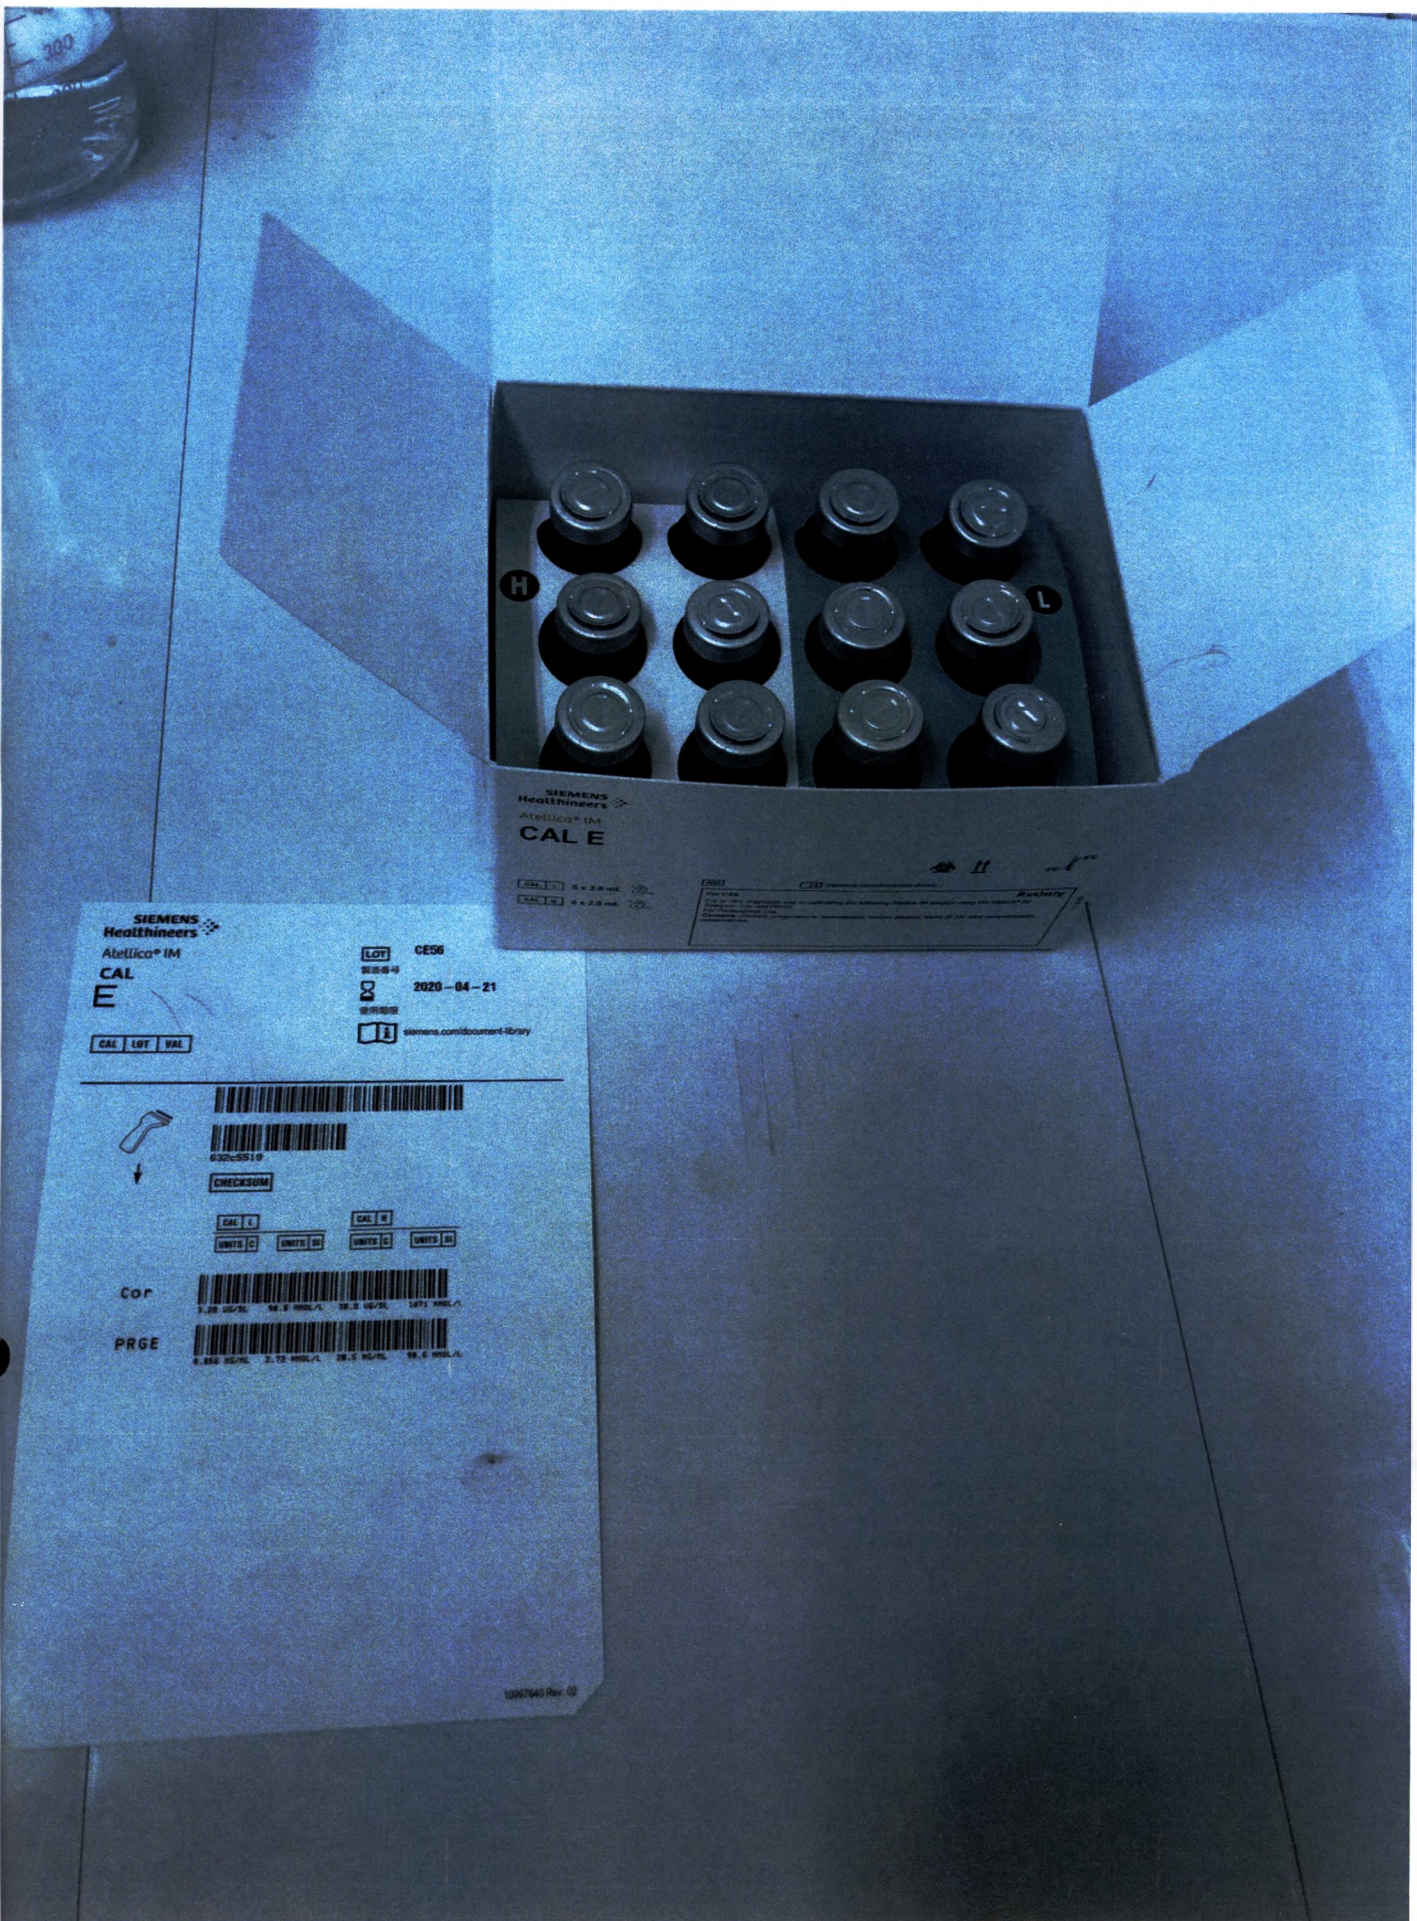


Рисунок 2. Набор калибраторов Е для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator E (Atellica IM CAL E)): Фасовка 6 упаковок. Общий вид

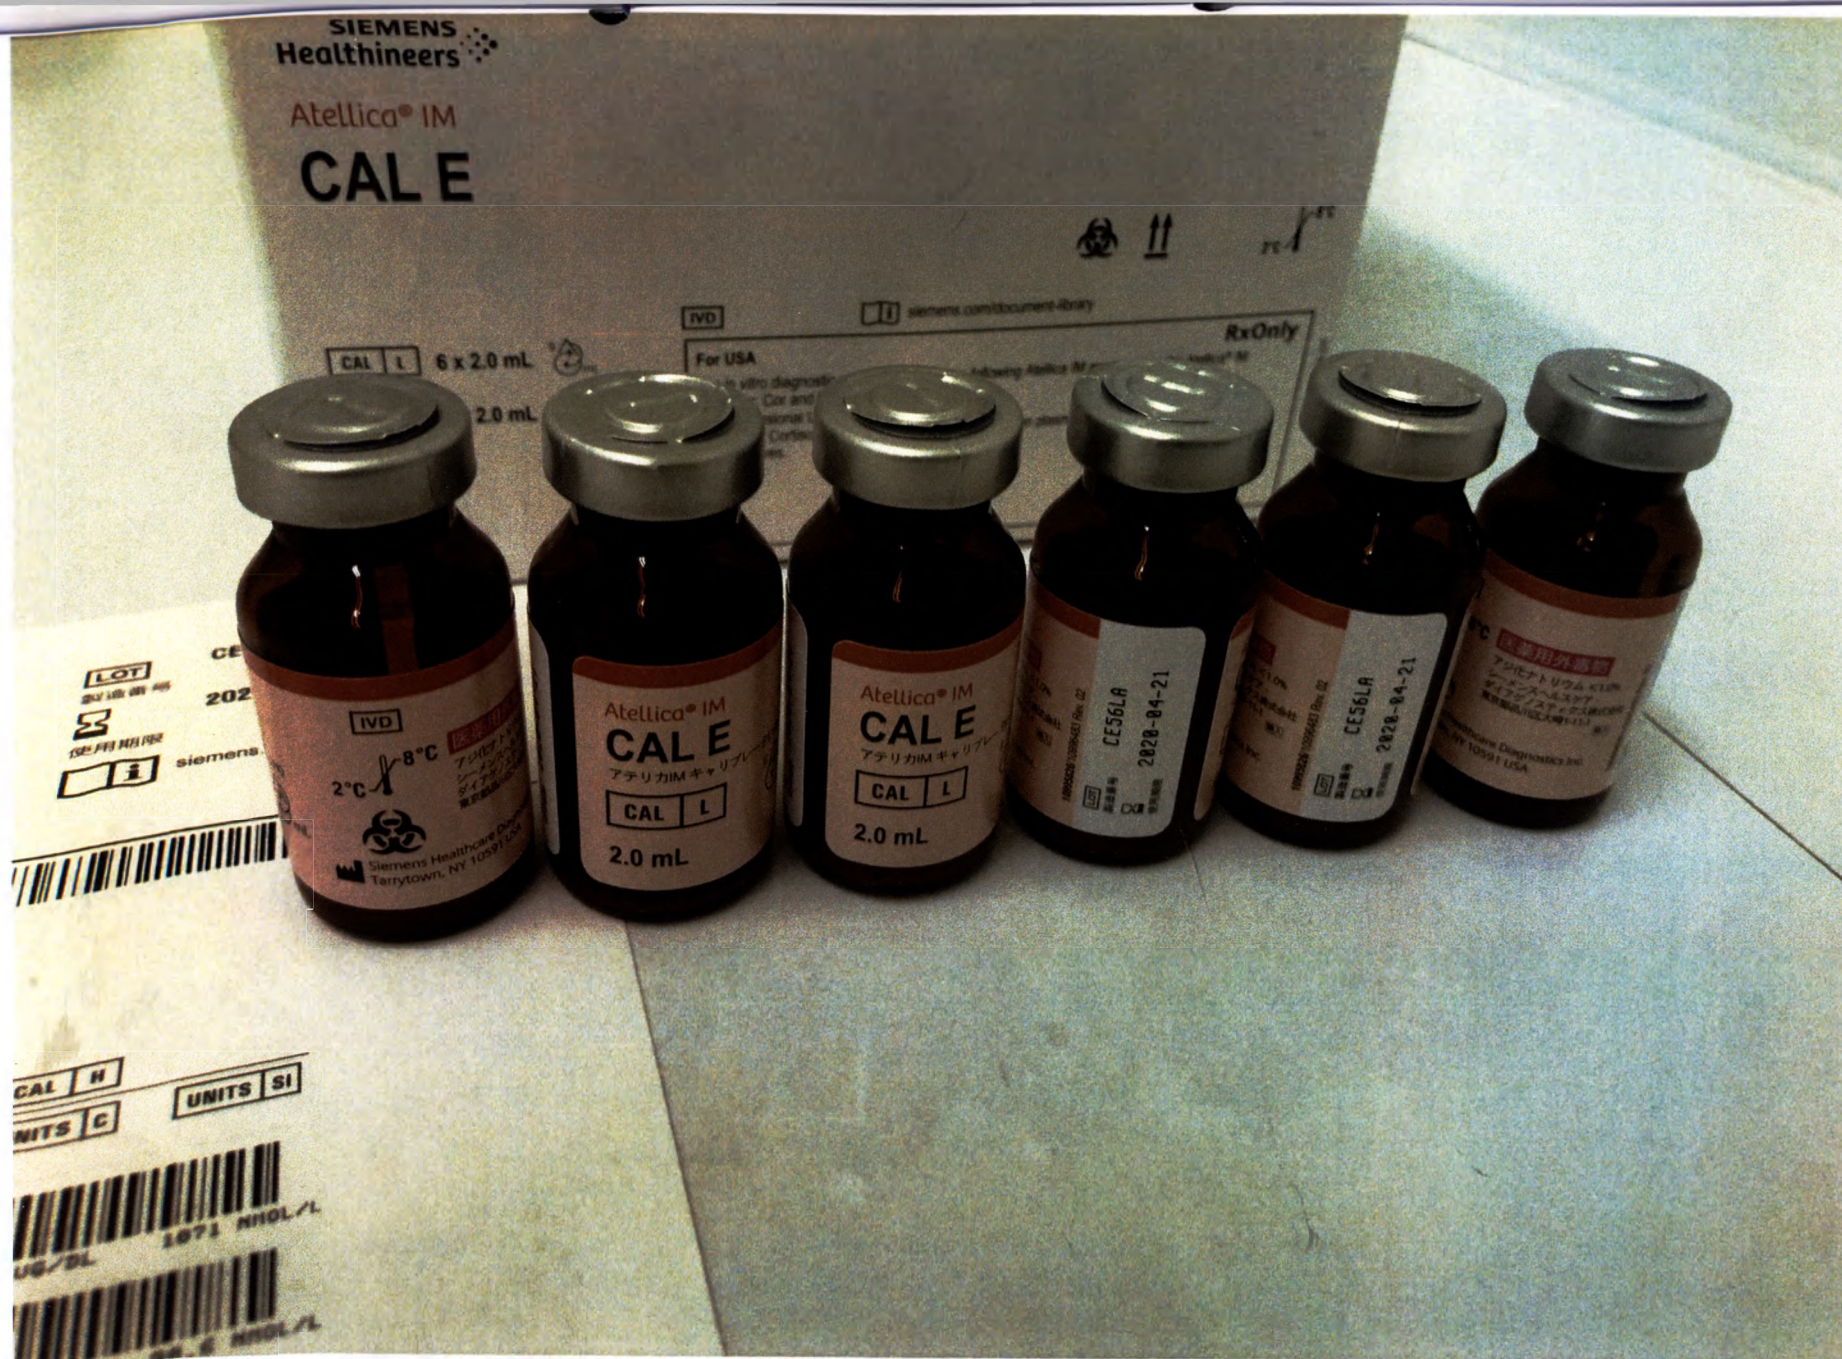


Рисунок 3. Набор калибраторов Е для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator E (Atellica IM CAL E)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL E L, 2,0 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

E

CAL LOT VAL

LOT CE56

製造番号



2020-04-21

使用期限



siemens.com/document-library



632c5519

CHECKSUM

CAL L

UNITS C

UNITS SI

CAL H

UNITS C

UNITS SI

Cor



3.28 UG/DL 98.5 NMOL/L 38.8 UG/DL 1871 NMOL/L

PRGE



8.856 NG/ML 2.72 NMOL/L 28.5 NG/ML 98.6 NMOL/L

10007640 Rev. 02

Рисунок 5. Набор калибраторов E для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator E (Atellica IM CAL E): Лист значений параметров лота калибратора

Всего прошито и пронумеровано 6 листа (ов)

ООО «Сименс Здравоохранение»

