


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольный материал 1 для подтверждения рабочих характеристик теста
Фруктозамин (Fructosamine) при проведении количественного
определения фруктозамина кинетическим колориметрическим методом в
сыворотке или плазме крови человека на биохимических анализаторах
ARCHITECT «Фруктозамин Контрольный материал 1 (Fructosamine
Control 1)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Fructosamine Control 1

CONTROL 1 4 x 1 mL



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01



REF 3R05-10




2021-03-31



90788Y600



307322R01



FOR USE WITH
ARCHITECT

IVD




SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1


PRODUCT OF GERMANY

(01) 00380740161972 (17) 210331


(10) 90788Y600 (240) 3R0510

Abbott

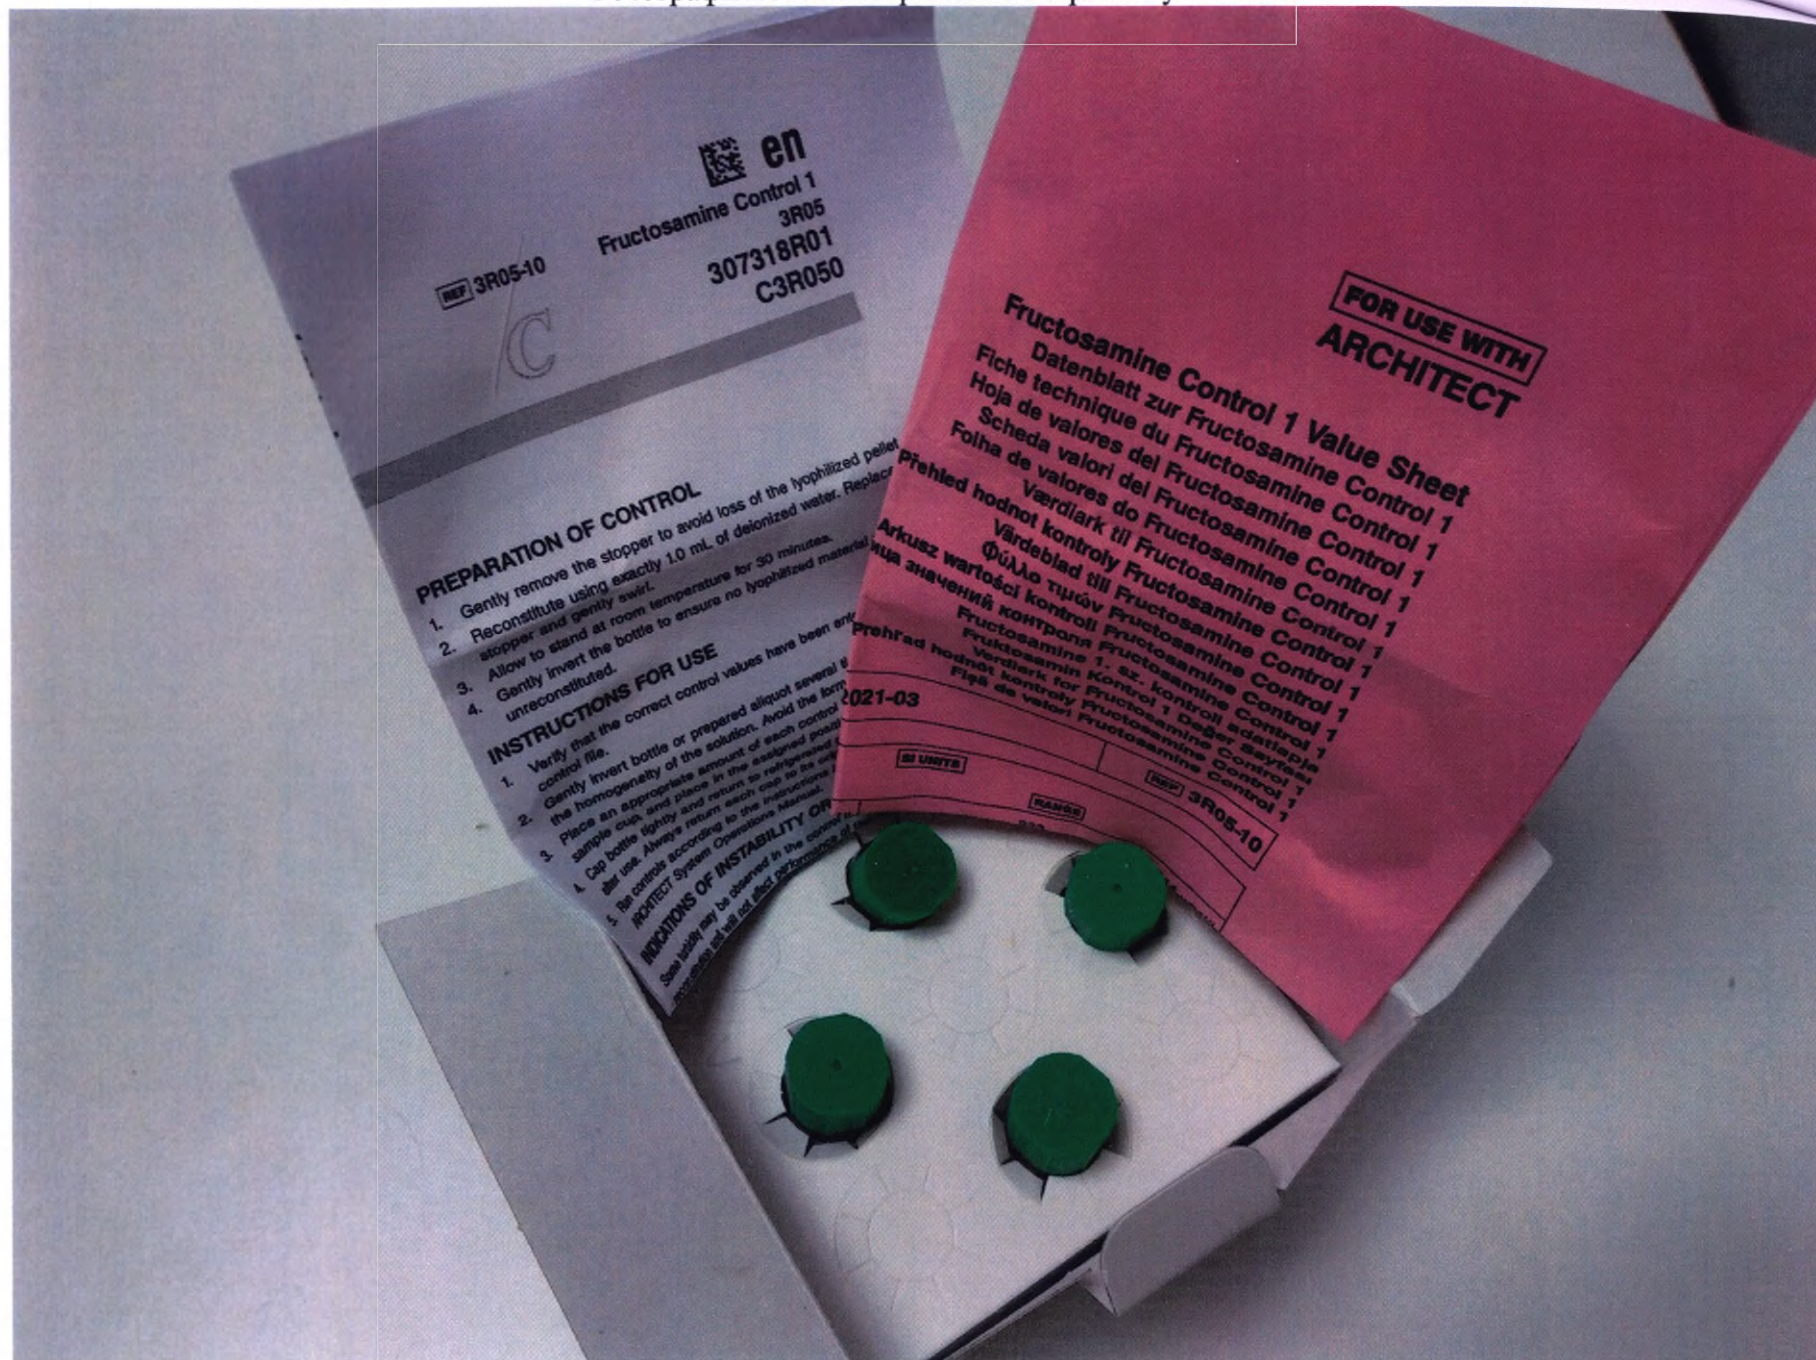

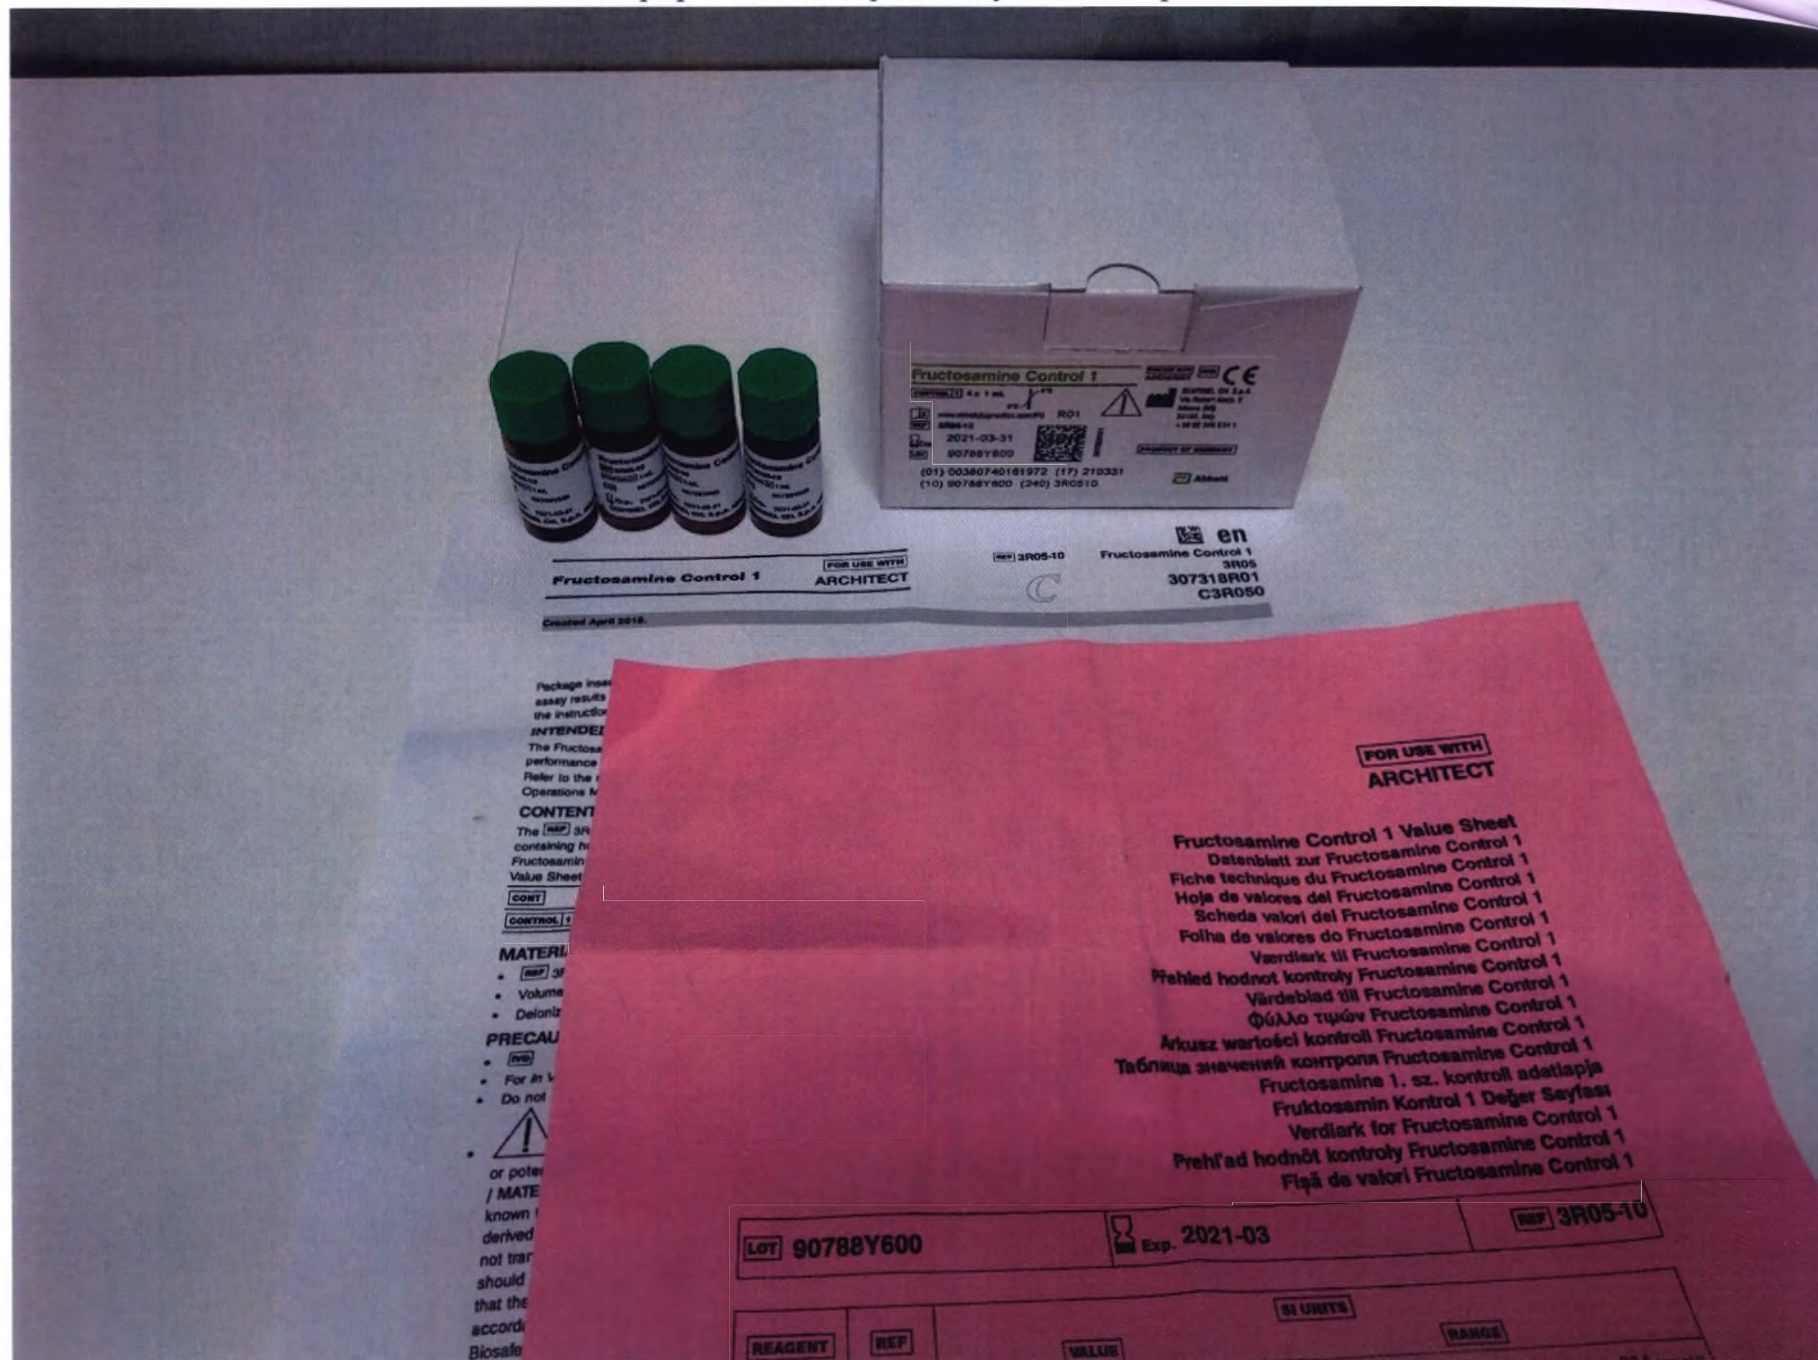



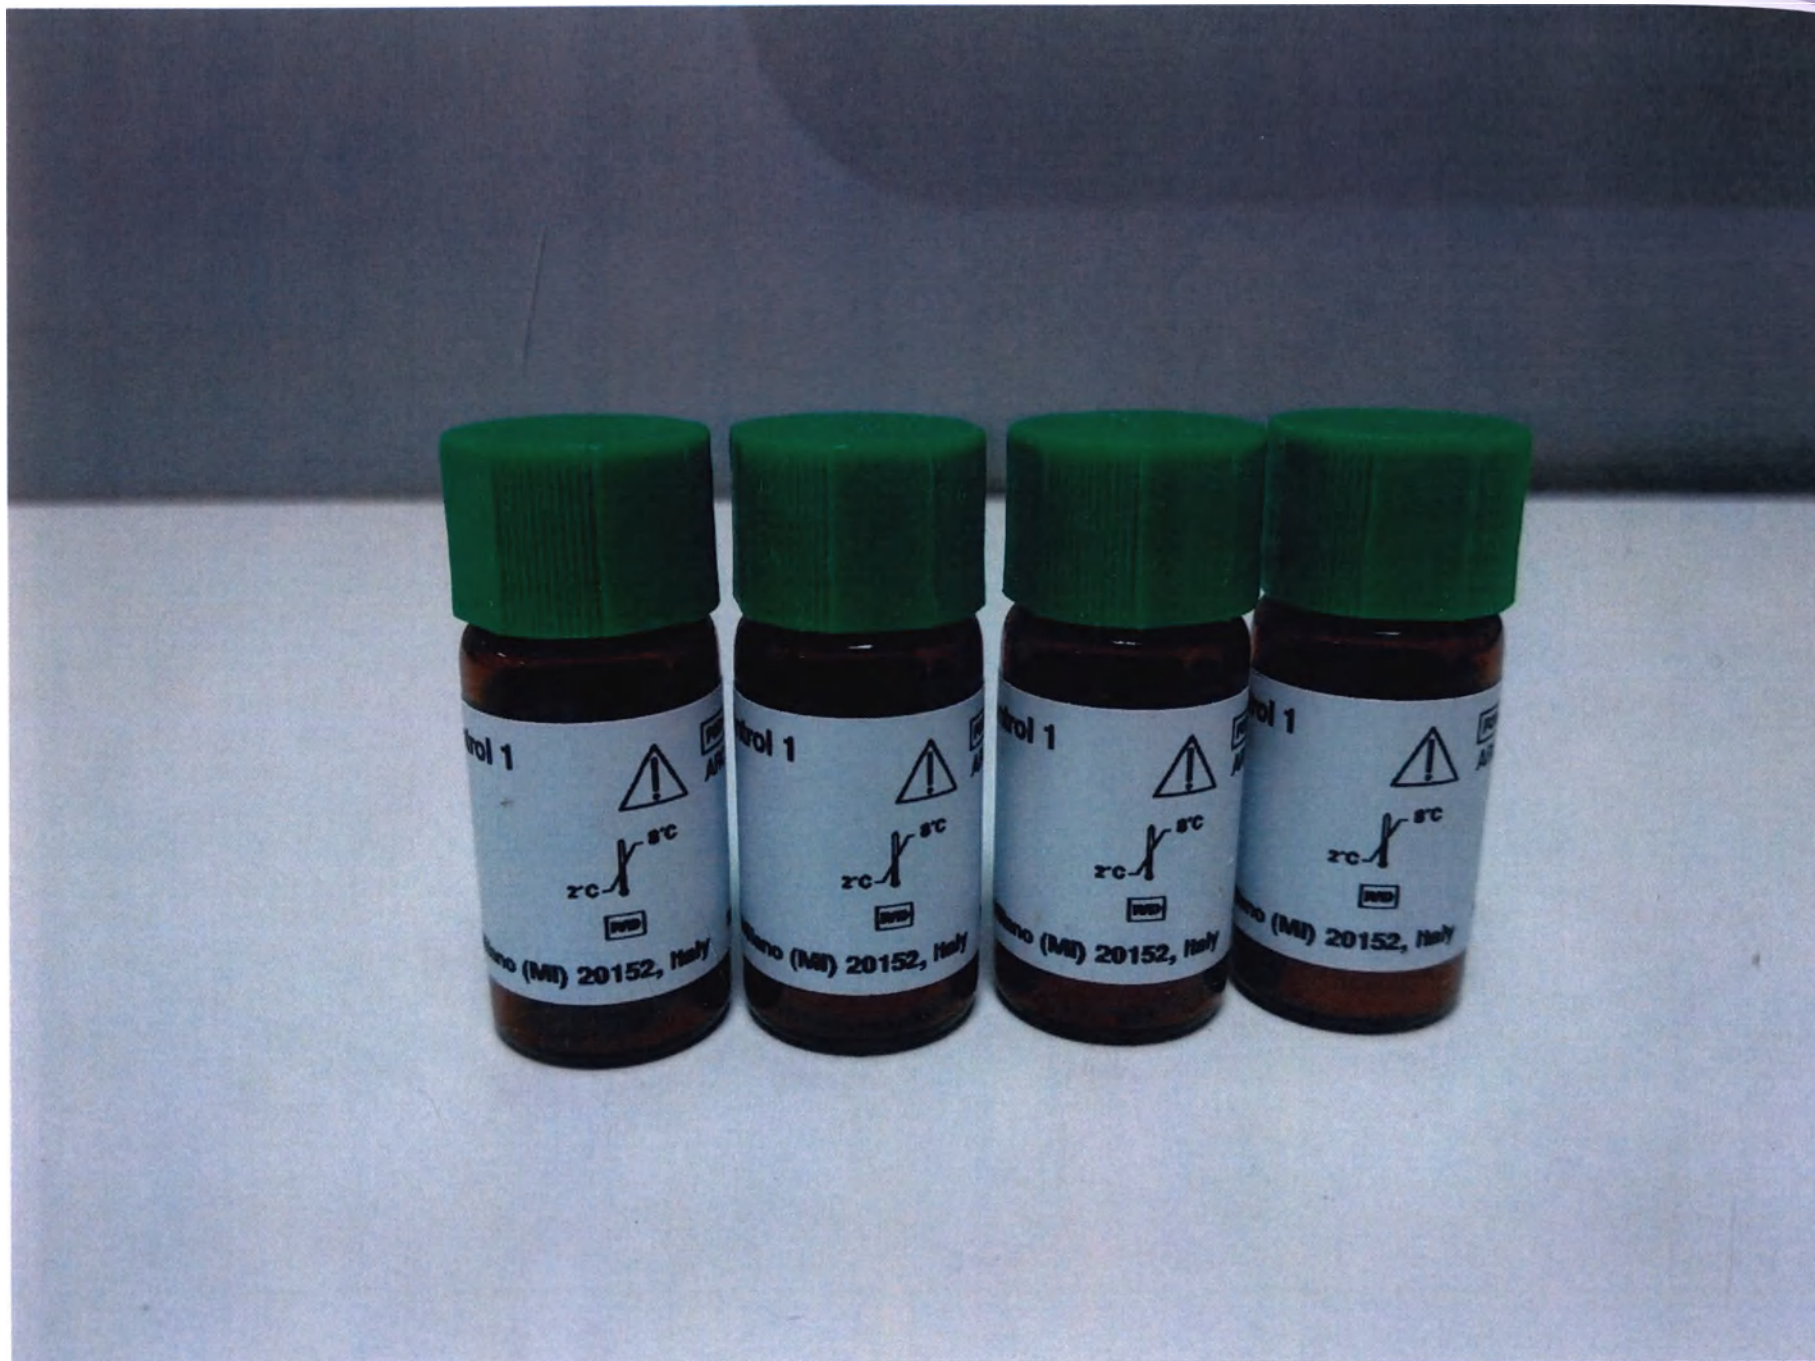

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольный материал 1 для подтверждения рабочих характеристик теста
Фруктозамин (Fructosamine) при проведении количественного определения
фруктозамина кинетическим колориметрическим методом в сыворотке или
плазме крови человека на биохимических анализаторах ARCHITECT
«Фруктозамин Контрольный материал 1 (Fructosamine Control 1)»**

**REF****3R05-10****IVD**

Контрольный материал 1 для подтверждения рабочих характеристик теста Фруктозамин (Fructosamine) при проведении количественного определения фруктозамина кинетическим колориметрическим методом в сыворотке или плазме крови человека на биохимических анализаторах ARCHITECT «Фруктозамин Контрольный материал 1 (Fructosamine Control 1)»

Производитель: Sentinel CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2 Milano (MI) 20152, Italy (Италия)

Производственная площадка: Sentinel CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2 Milano (MI) 20152, Italy (Италия)

Страна происхождения: Германия

/ Состав: Контрольный материал 1 (Control 1) - 4 x 1 мл; Инструкция по применению; Таблица значений /ПУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 1, 6 этаж;

Тел: +7 (495) 258 42 70; Факс: +7 (495) 258 42 71

Fructosamine Control 1

Fructosamine Control 1



FOR USE WITH
ARCHITECT IVD CE
SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1

PRODUCT OF GERMANY

Abbott

Маркировка отдельного флакона

Fructosamine Control 1

REF 3R05-10


CONTROL 1 1 mL

LOT

Exp.



FOR USE WITH
ARCHITECT



IVD

SENTINEL CH. S.p.A. Milano (MI) 20152, Italy 307315R01

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

Подпись

